

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «ДРГ Биомед»

Березин В.В.
«22» августа 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов AMH ELISA для количественного иммуноферментного определения
Антимюллера гормона (АМГ) в сыворотке и плазме крови

REF**EIA-6141****AMH
ELISA****DRG** 

Inhalt/Content

Vol./No.

LOT**LOT 324K082****230831**
(YYMMDD)**+2°C****+8°C**DRG Instruments GmbH
Frauenbergstr. 18
D-35039 Marburg**IVD****2208**
(YYMM)

(01)04048474061413(17)230831(10)324K082



Упаковка

DRG DRG



DRG Instruments GmbH, Germany

Frauenbergstraße 18, D-35039 Marburg


Tel. +49 (0) 64 21/170 00

Fax +49 (0) 64 21/17 00 50

Internet: www.drg-diagnostics.de

E-mail: drg@drg-diagnostics.de


Логотип DRG	
«Для учреждений здравоохранения» «Для профессионального применения»	
Набор реагентов AMHELISA для количественного иммуноферментного определения Антимюллерова гормона (АМГ) в сыворотке и плазме крови РУ № _____	
DRG Instruments GmbH, Германия	
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: ООО «ДРГ Биомед» 194156, Россия, Санкт-Петербург, Сердобольская ул, д.1, лит. А, пом.28-Н 8(812) 492-56-93 drg@drgspb.ru	
LOT 96	
Состав	Объем/число
Микропланшет	1 планшет (96 лунок)
Стандарт 0	1 флакон, 1 мл;
Стандарт 1	1 флакон, 1 мл;
Стандарт 2	1 флакон, 1 мл;
Стандарт 3	1 флакон, 1 мл;
Стандарт 4	1 флакон, 1 мл;
Стандарт 5	1 флакон, 1 мл;
Низкий контроль	1 флакон, 1 мл;
Высокий контроль	1 флакон, 1 мл;
Ферментный конъюгат	1 флакон, 14 мл
Субстратный раствор	1 флакон, 14 мл
Стоп-раствор	1 флакон, 14 мл
Промывочный раствор	1 флакон, 30 мл
Инструкция по применению.	1 шт.
+2°C +8°C	
ШТРИХ КОД	

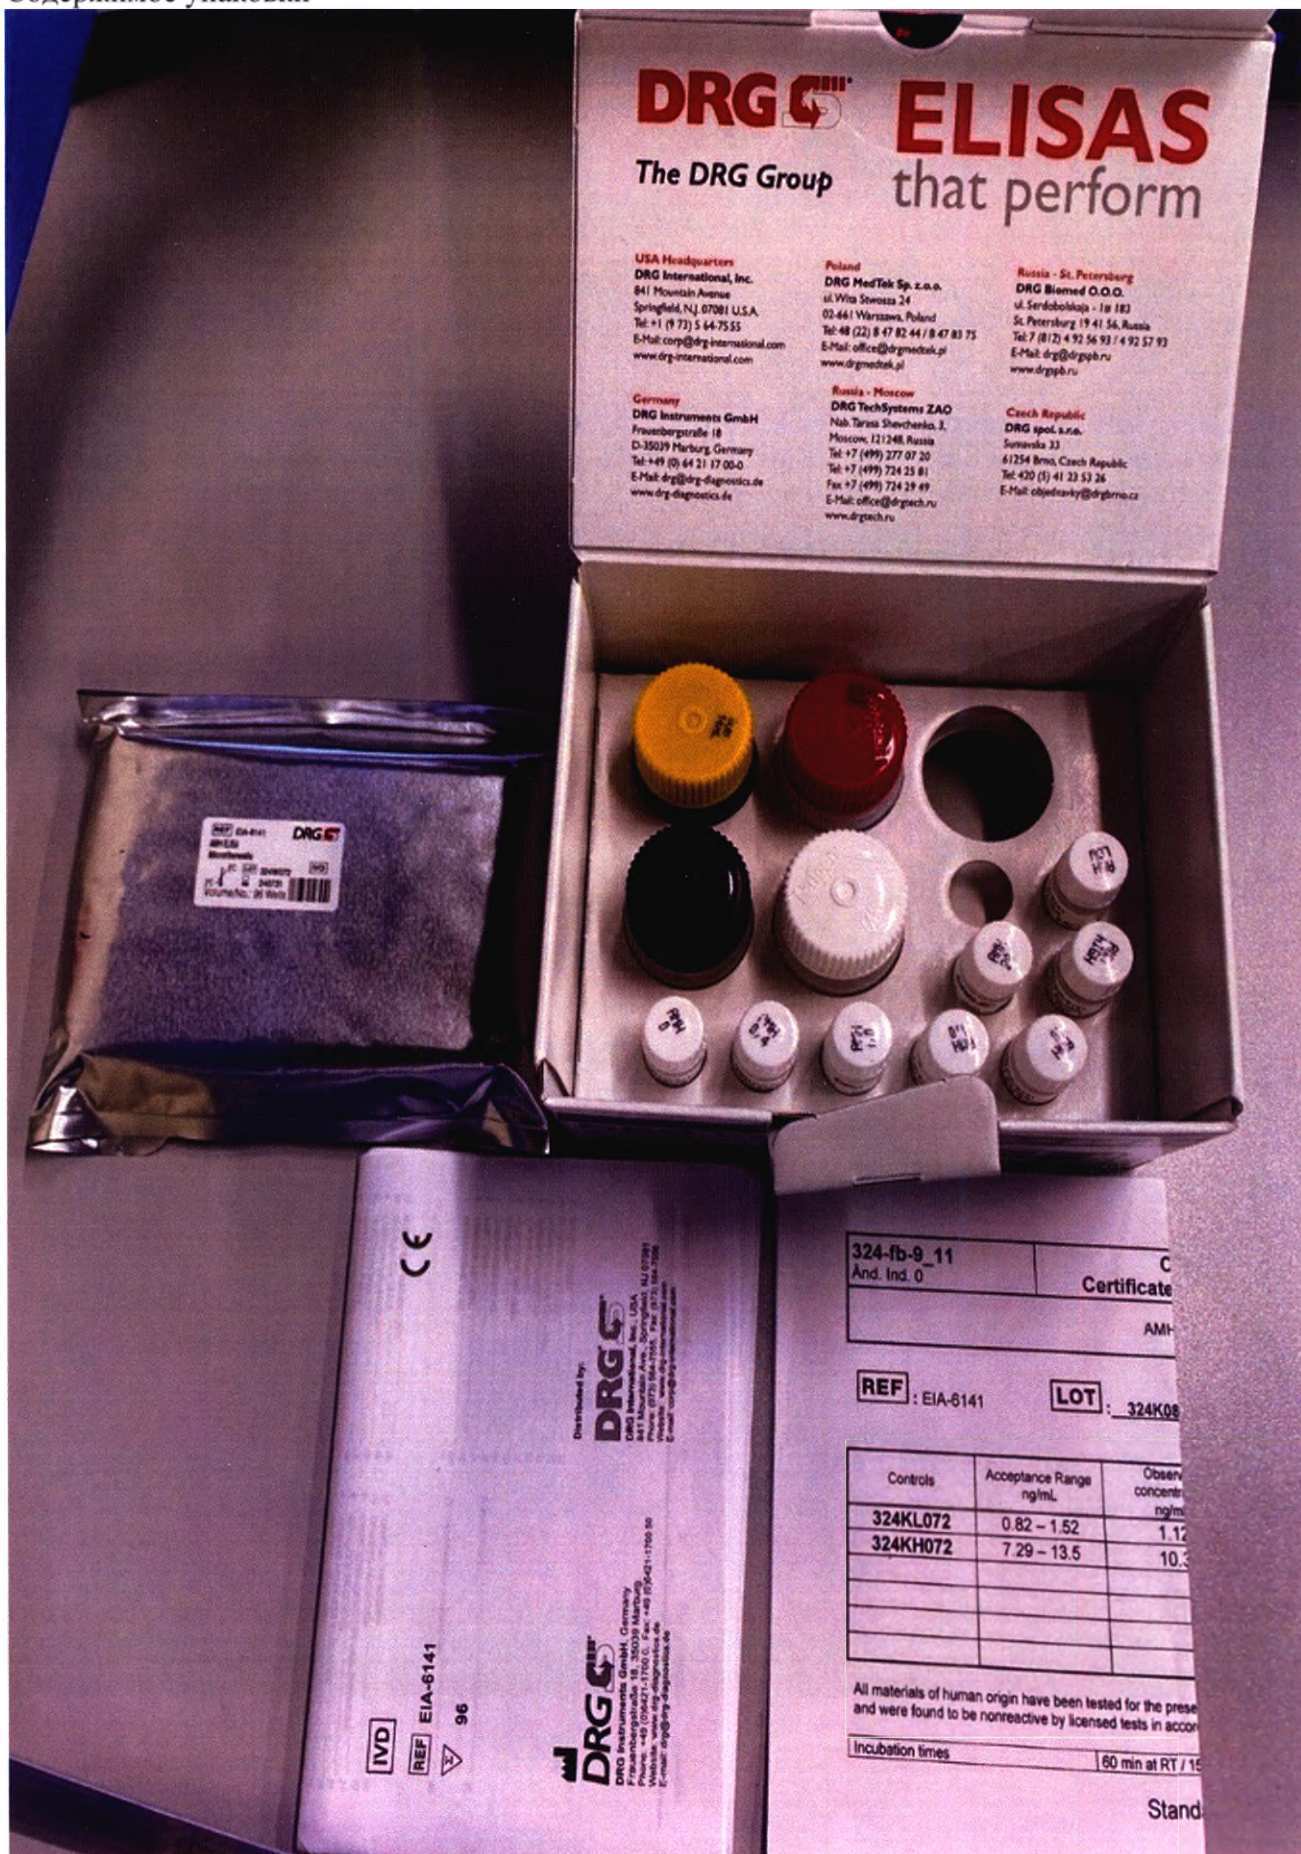

Общий вид и маркировка индивидуальной упаковки микропланшета



Микропланшет, 12 стрипов по 8 лунок

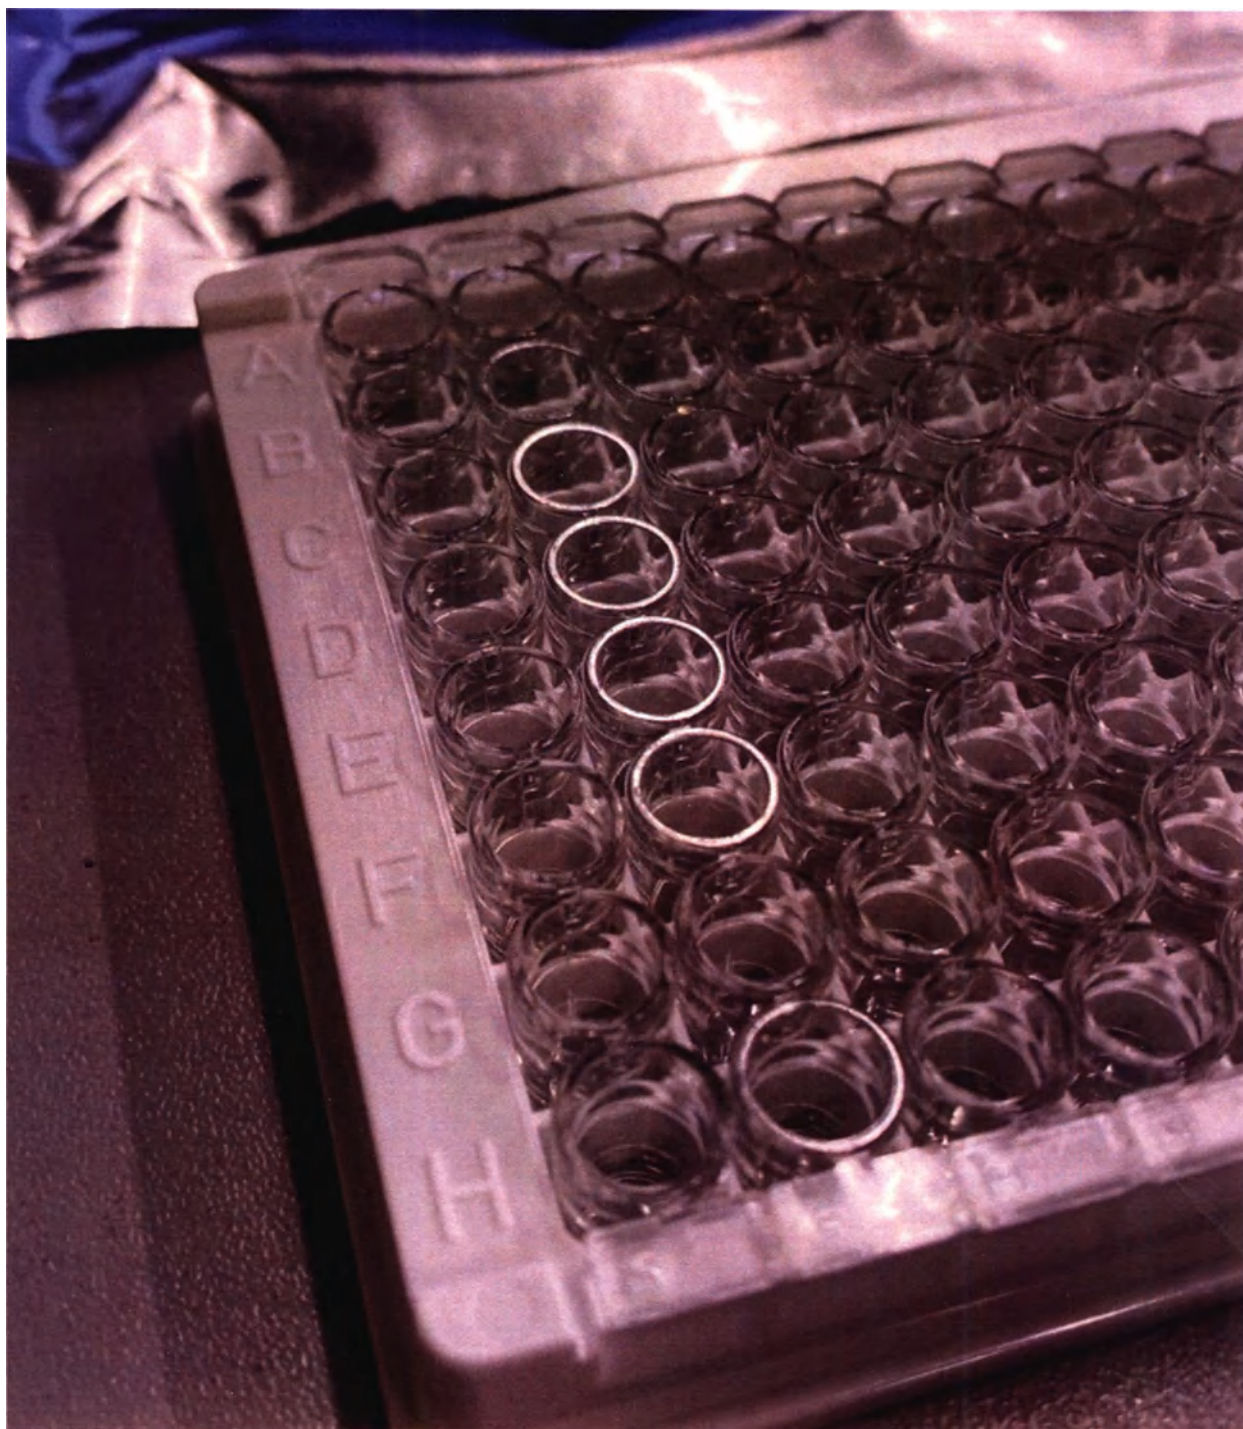


Стандарт 0 – 1 флакон, 1 мл;
 Стандарт 1 – 1 флакон, 1 мл;
 Стандарт 2 – 1 флакон, 1 мл;
 Стандарт 3 – 1 флакон, 1 мл;
 Стандарт 4 – 1 флакон, 1 мл;
 Стандарт 5 – 1 флакон, 1 мл;




Контроль низкий уровень – 1 флакон, 1мл;
Контроль высокий уровень – 1 флакон, 1 мл;




Конъюгат ферментный - 1 флакон, 14 мл;

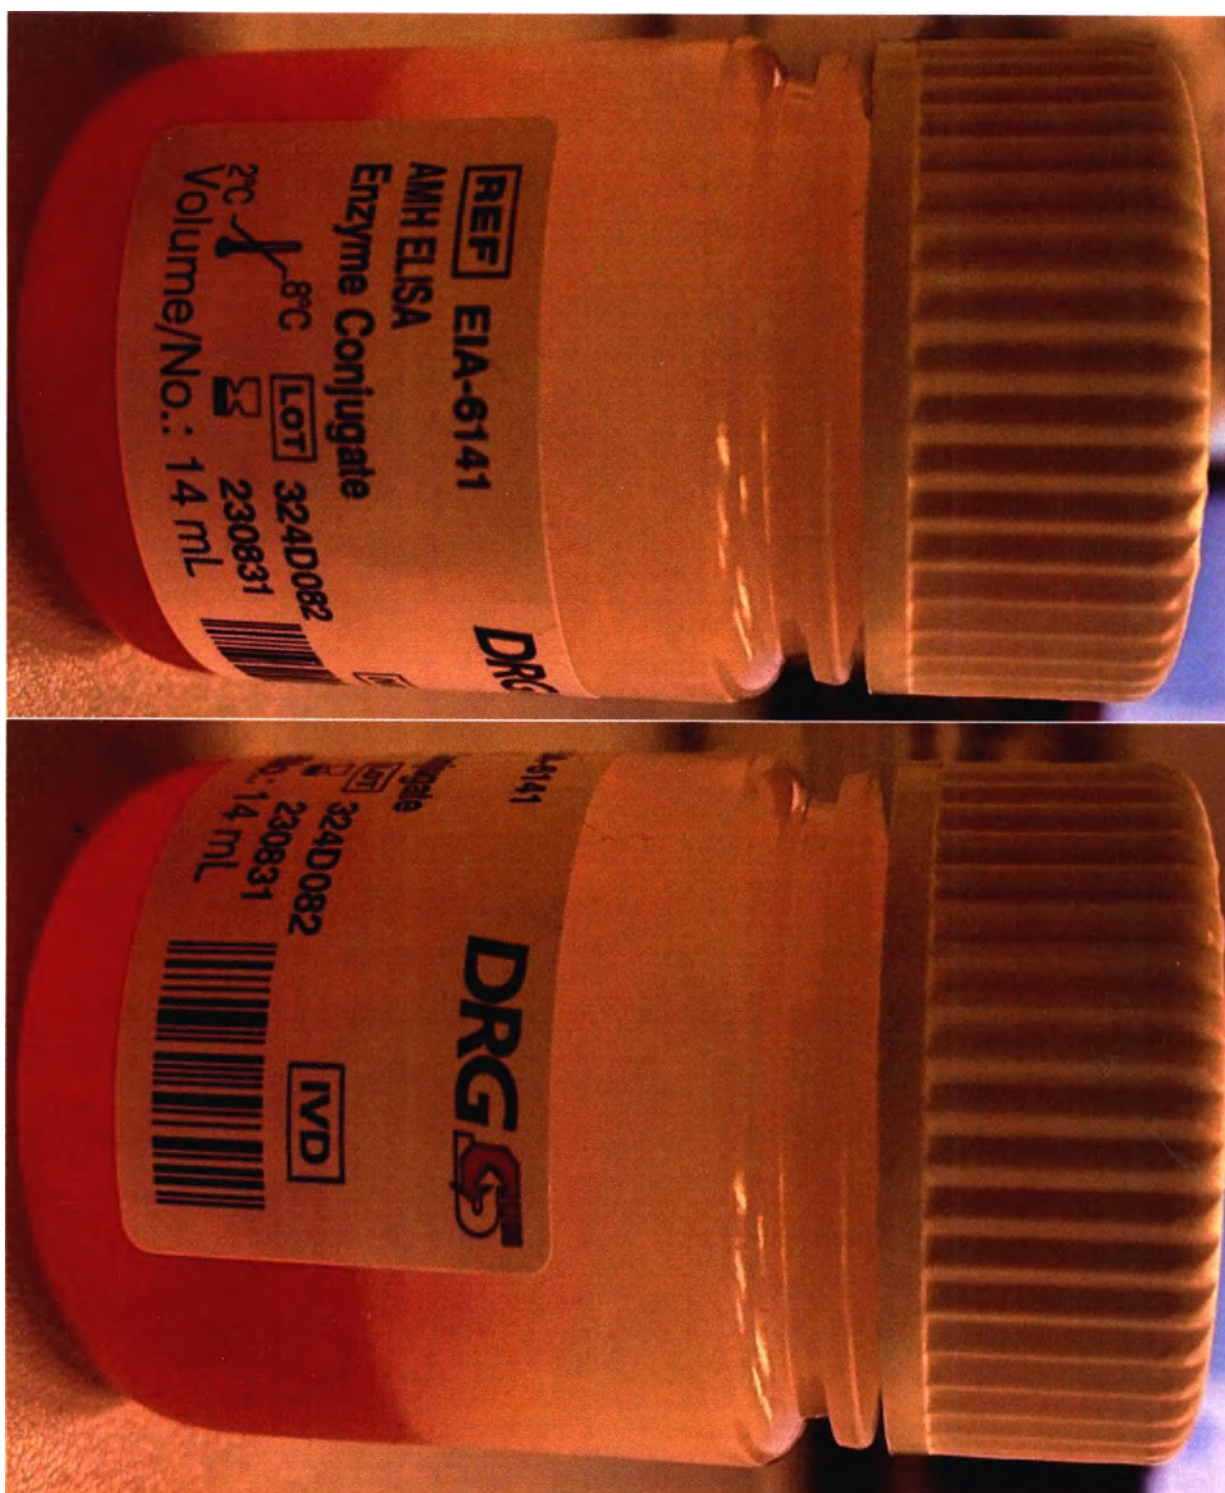

Раствор субстрата - 1 флакон, 14 мл;

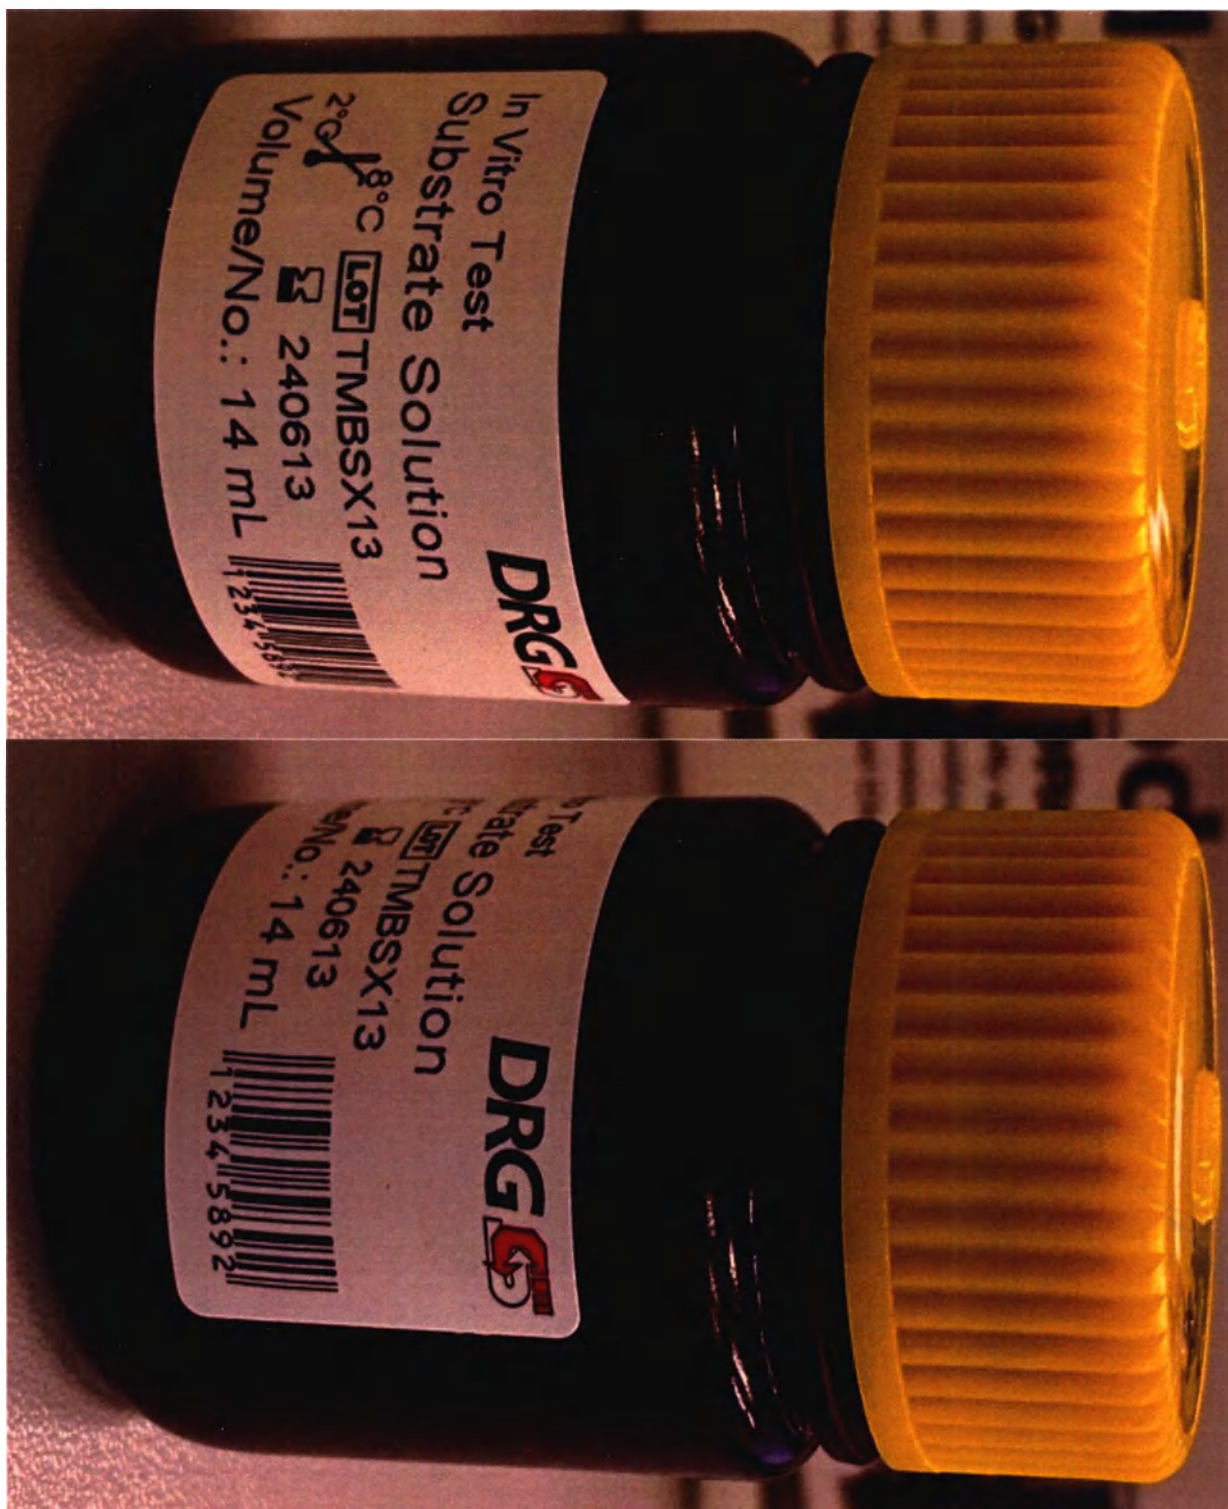

Стоп-раствор – 1 флакон, 14 мл

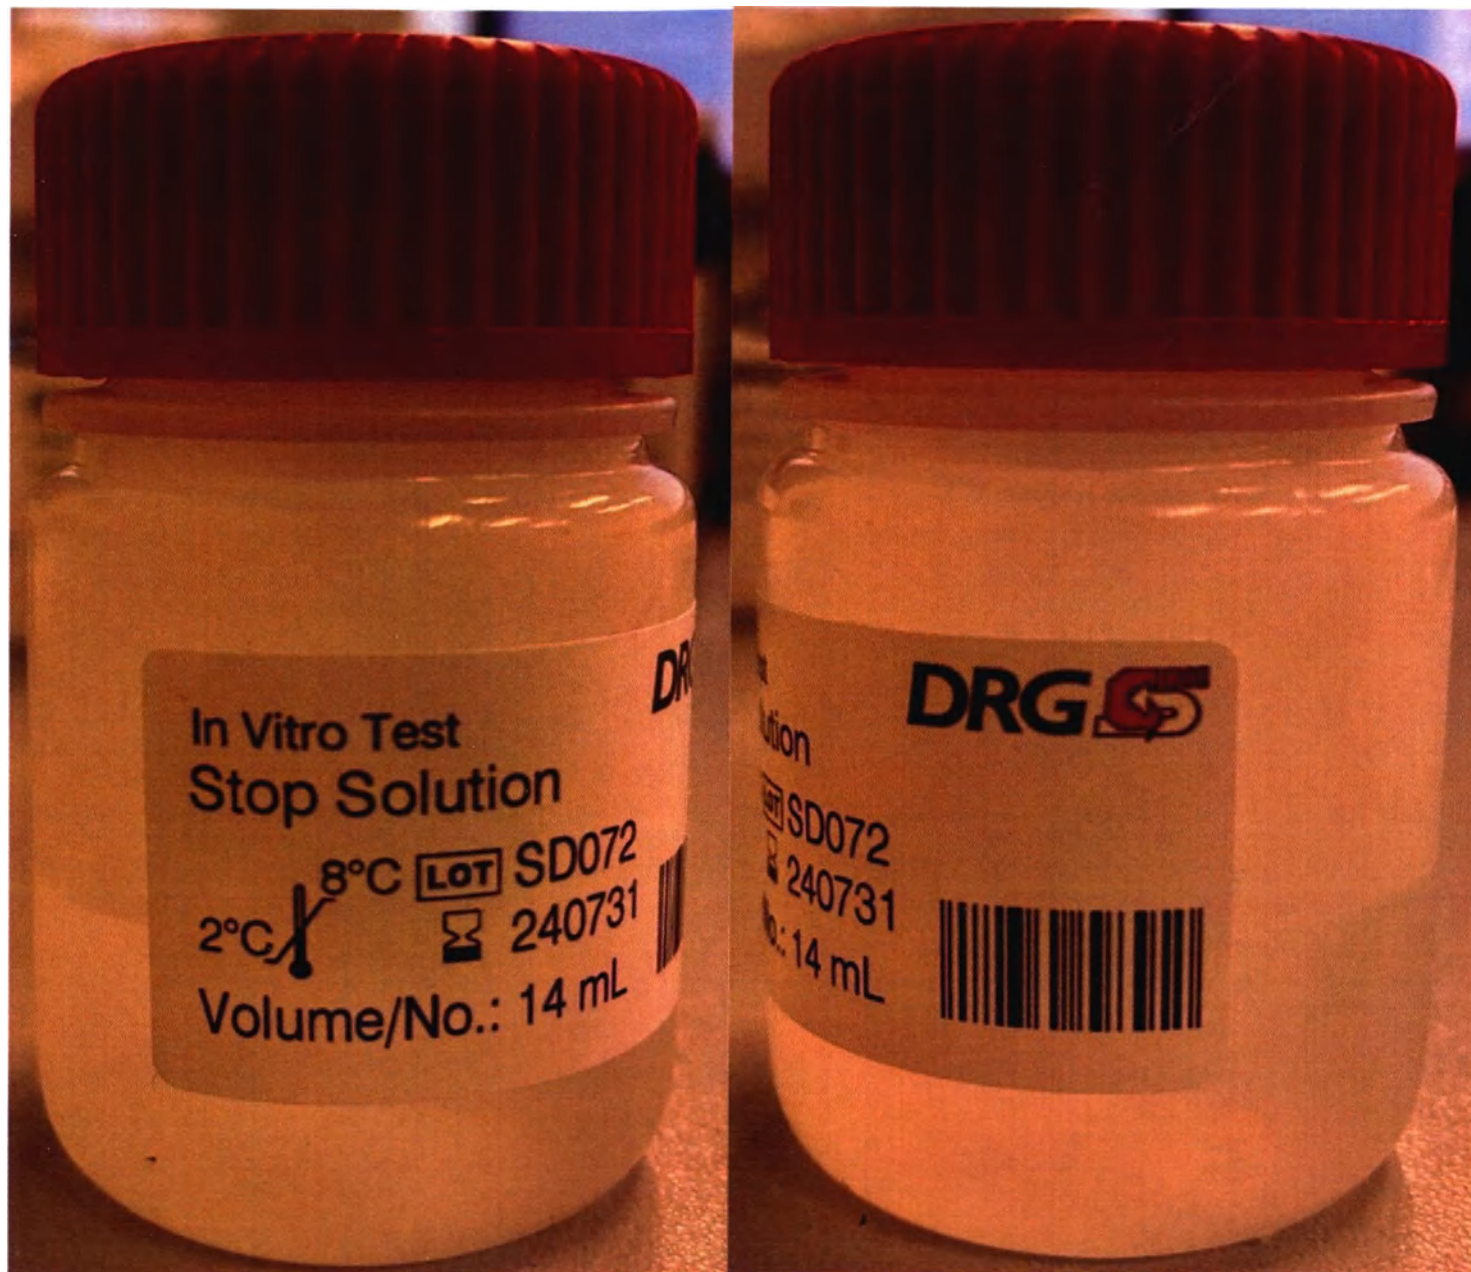

Промывочный раствор – 1 флакон, 30 мл;



Прошито
Пронумеровано
Скреплено печатью

13

листа (ов)

Генеральный директор

Березин В.В.

