

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «М-МОСТ»

Д.В. Паулкин

2023 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Система ультразвуковой диагностики»

Производитель: ООО «Медицинская техническая компания Цзюйжун» (Ханчжоу) /
Focus & Fusion Healthcare (Hangzhou) Co., Ltd., KHP

Версия 1.0

2023 год

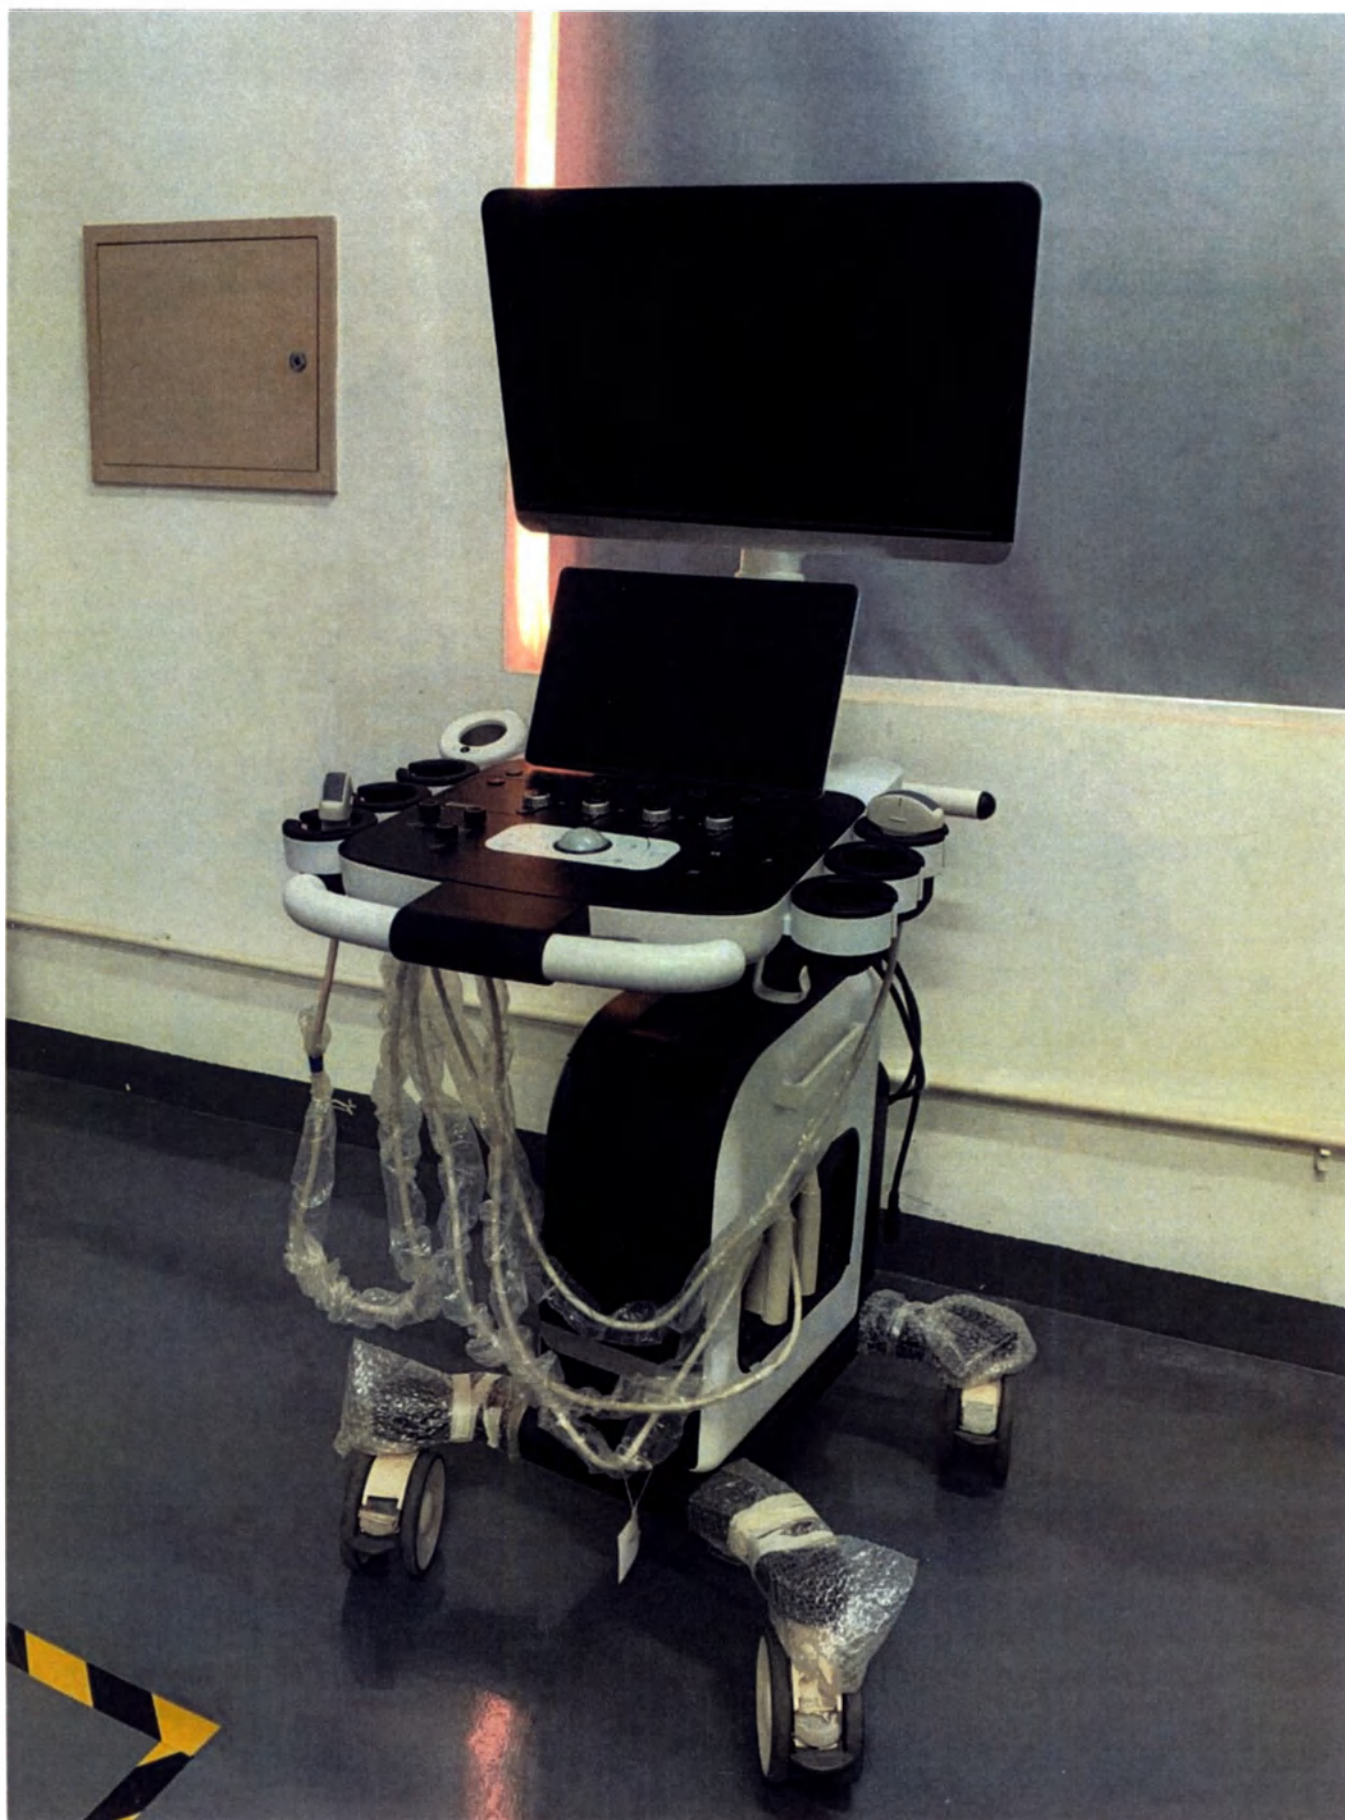


Рисунок 1 – Общий вид медицинского изделия в варианте исполнения Cetus 45Exp

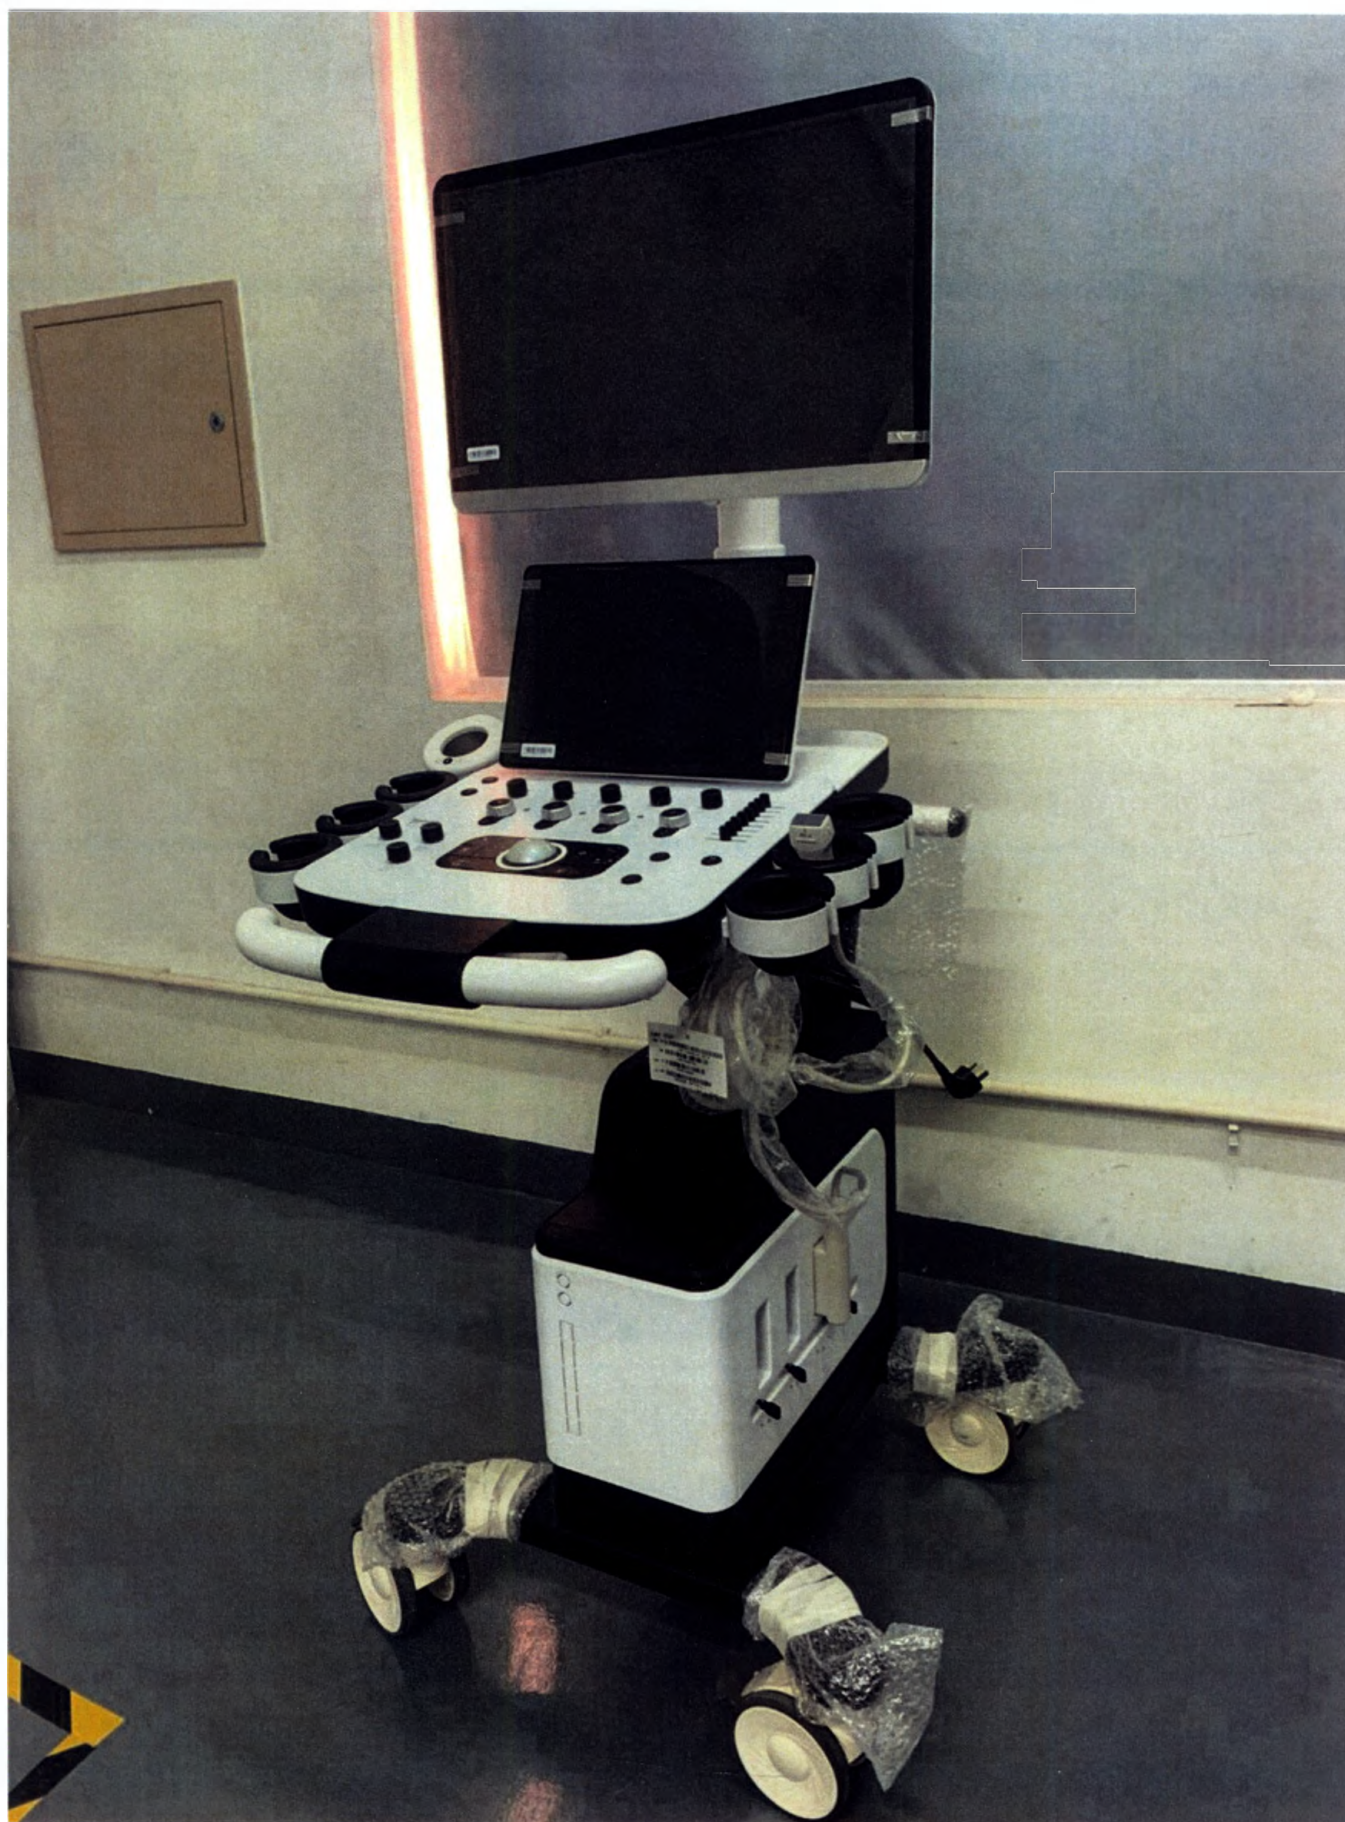


Рисунок 2 – Общий вид медицинского изделия в варианте исполнения Danus 40Exp

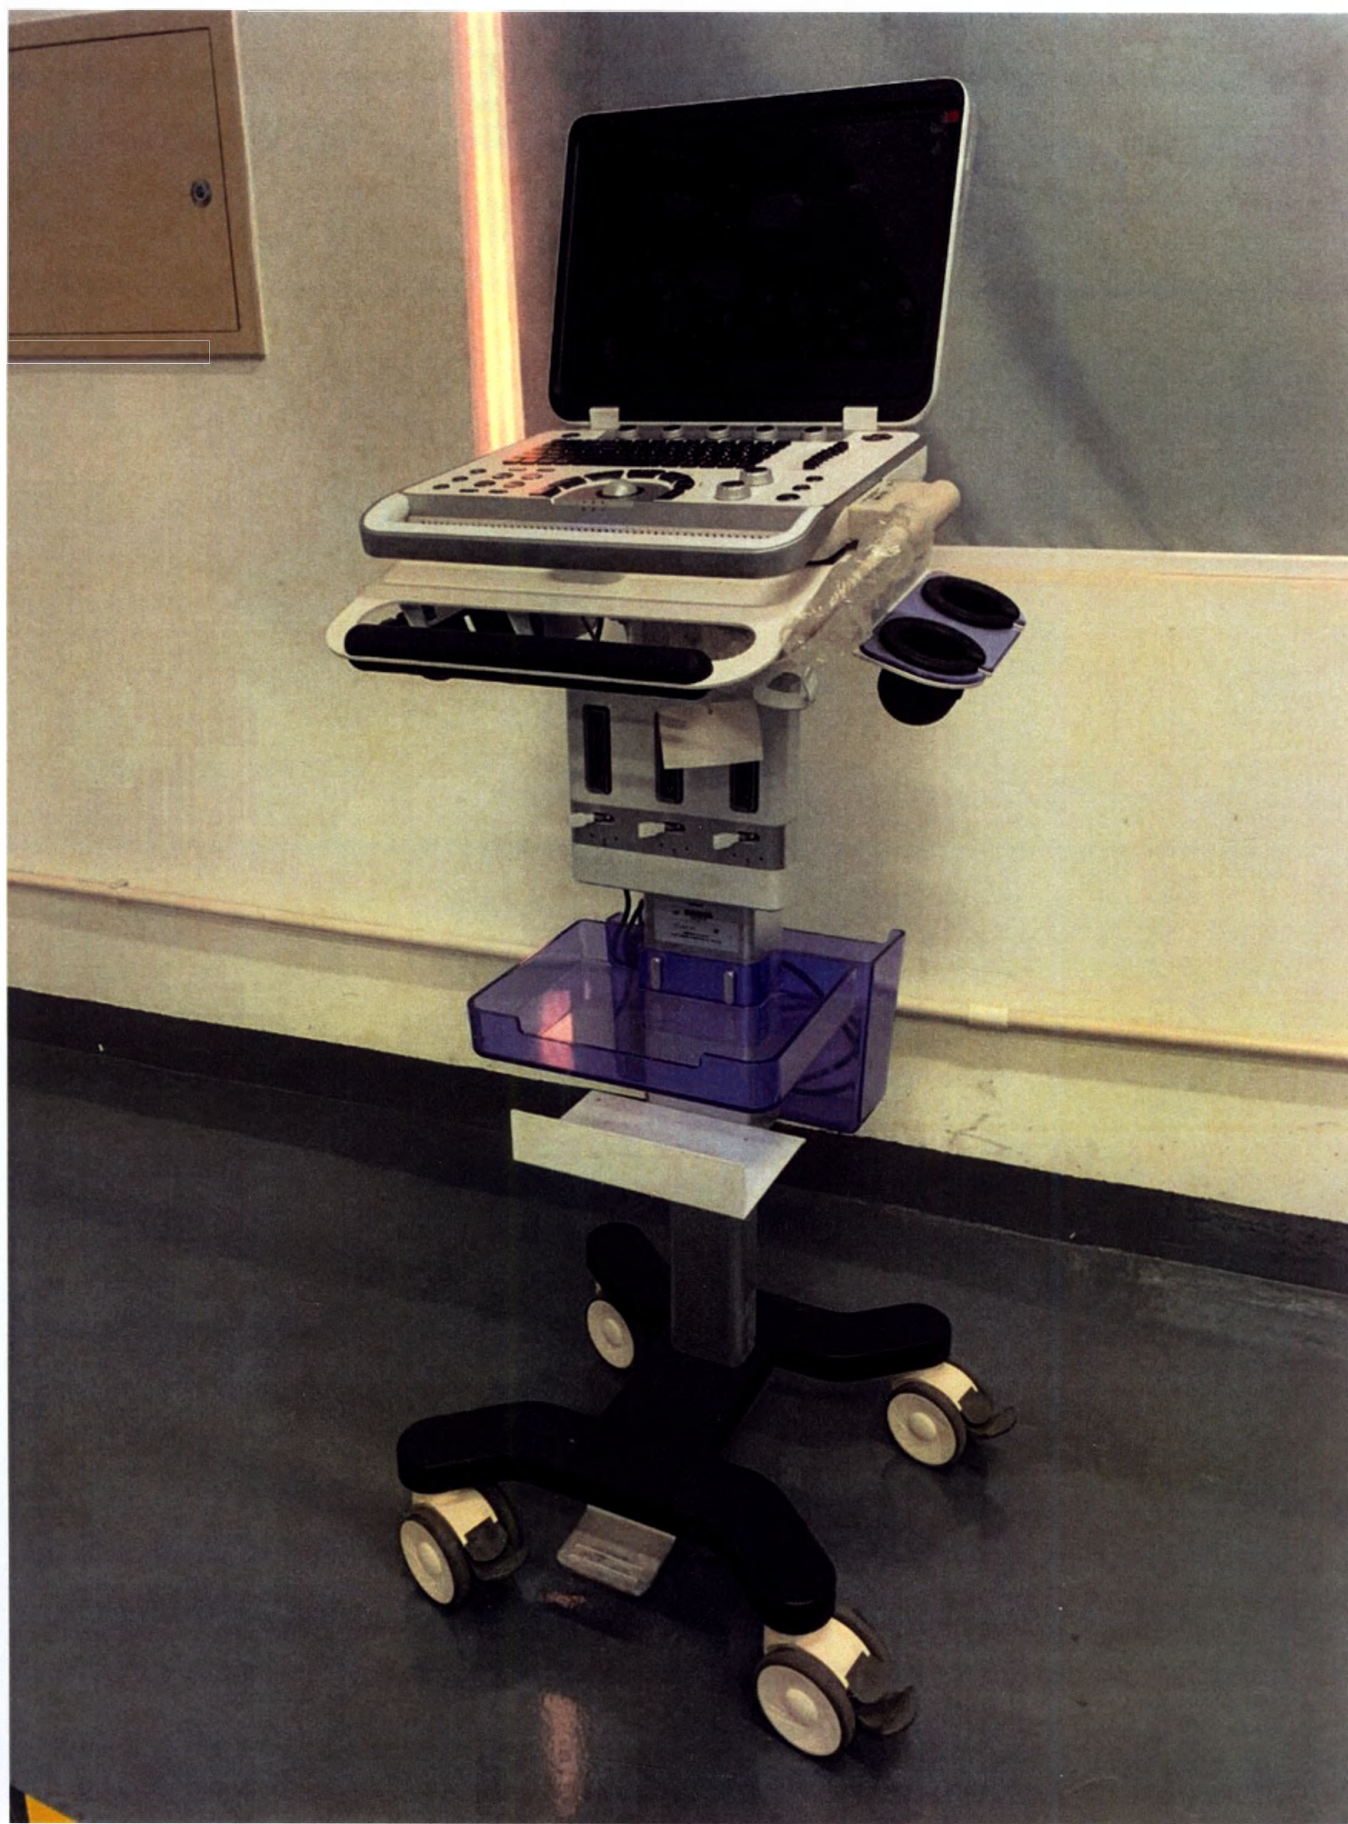


Рисунок 3 – Общий вид медицинского изделия в варианте исполнения Finus 70Exp



Рисунок 4 – Датчик конвексный C5-1

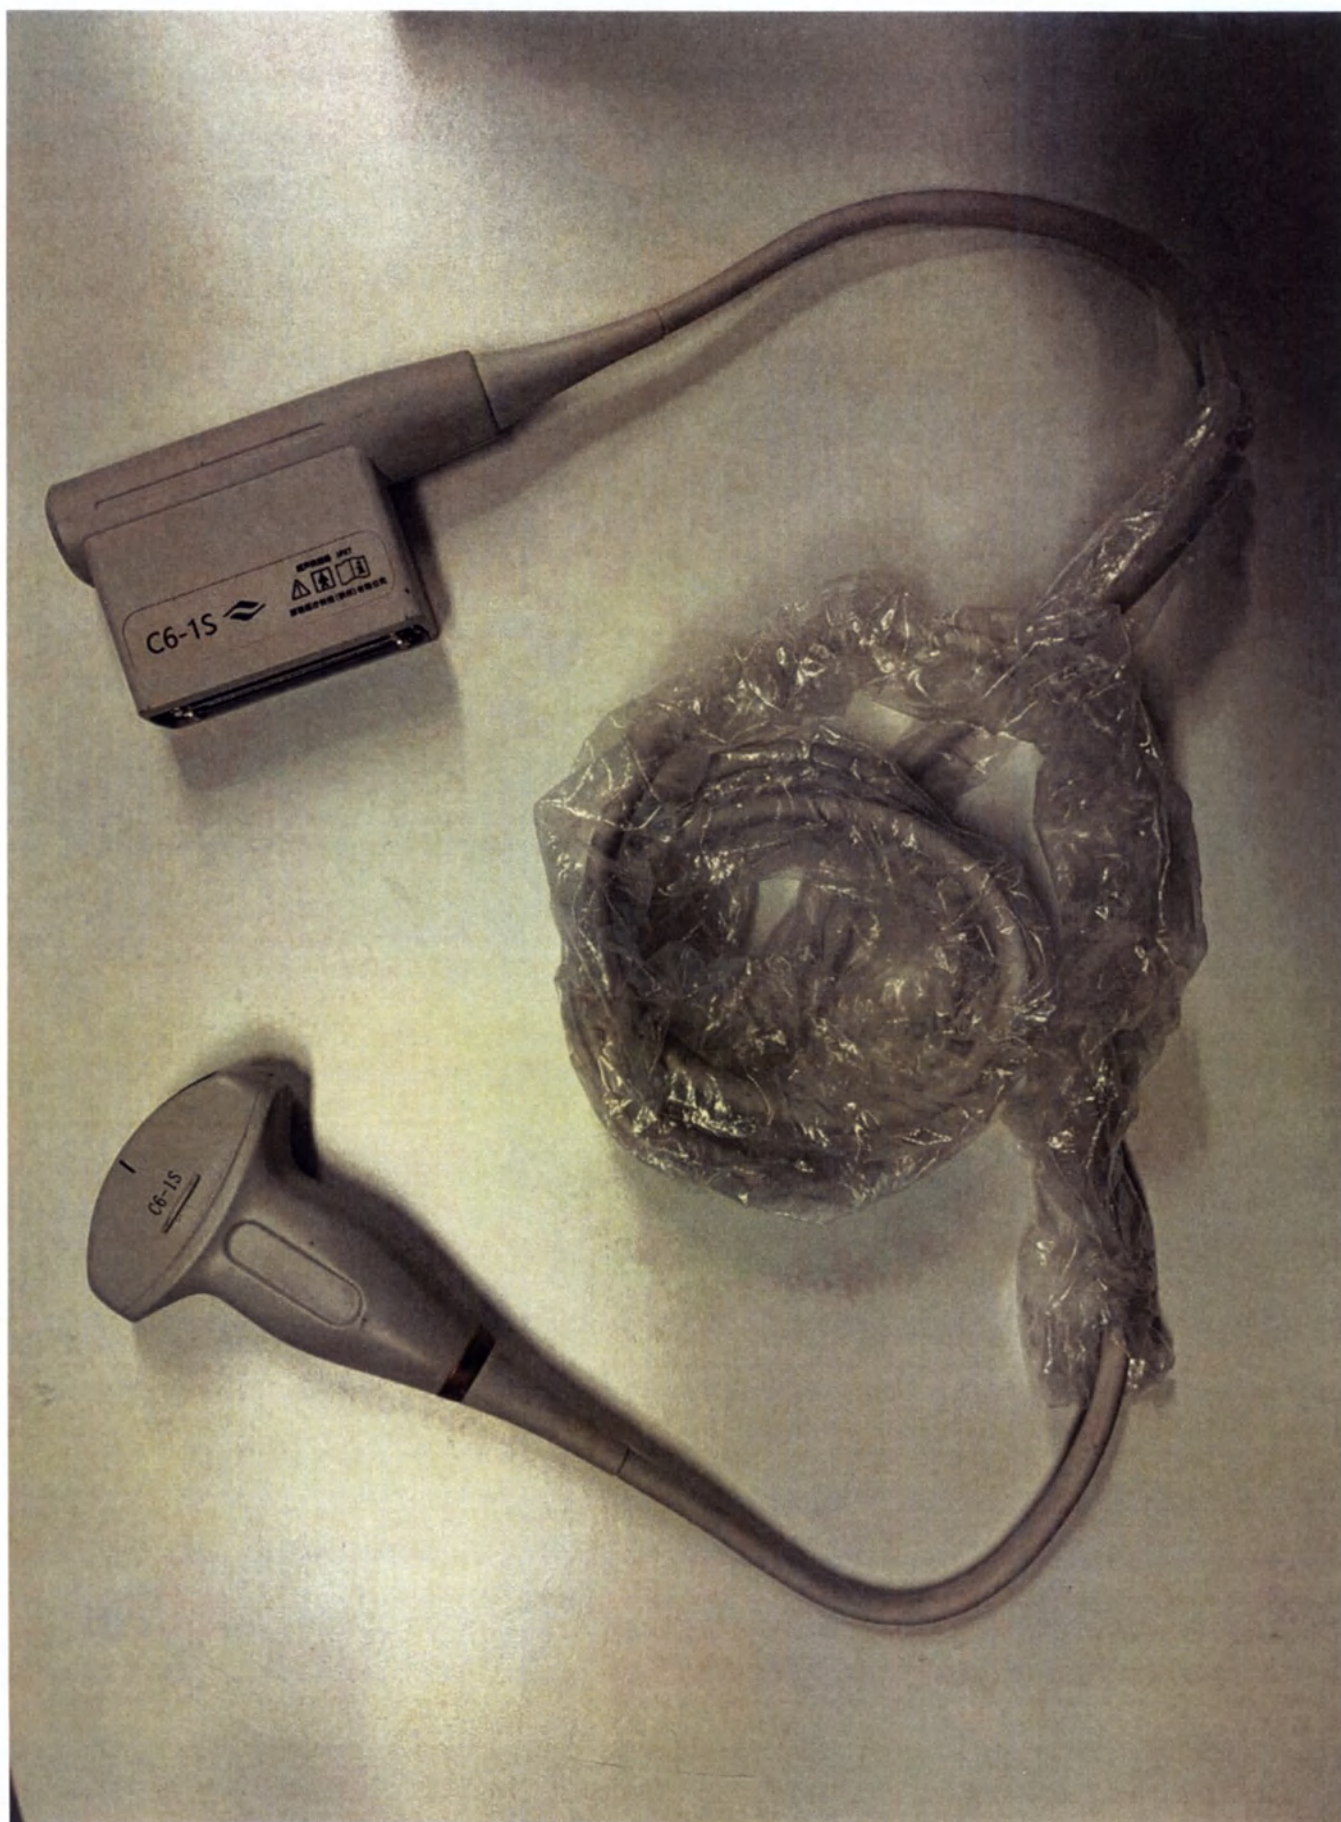


Рисунок 5 – Датчик конвексный C6-1S



Рисунок 6 – Датчик конвексный MC10-3

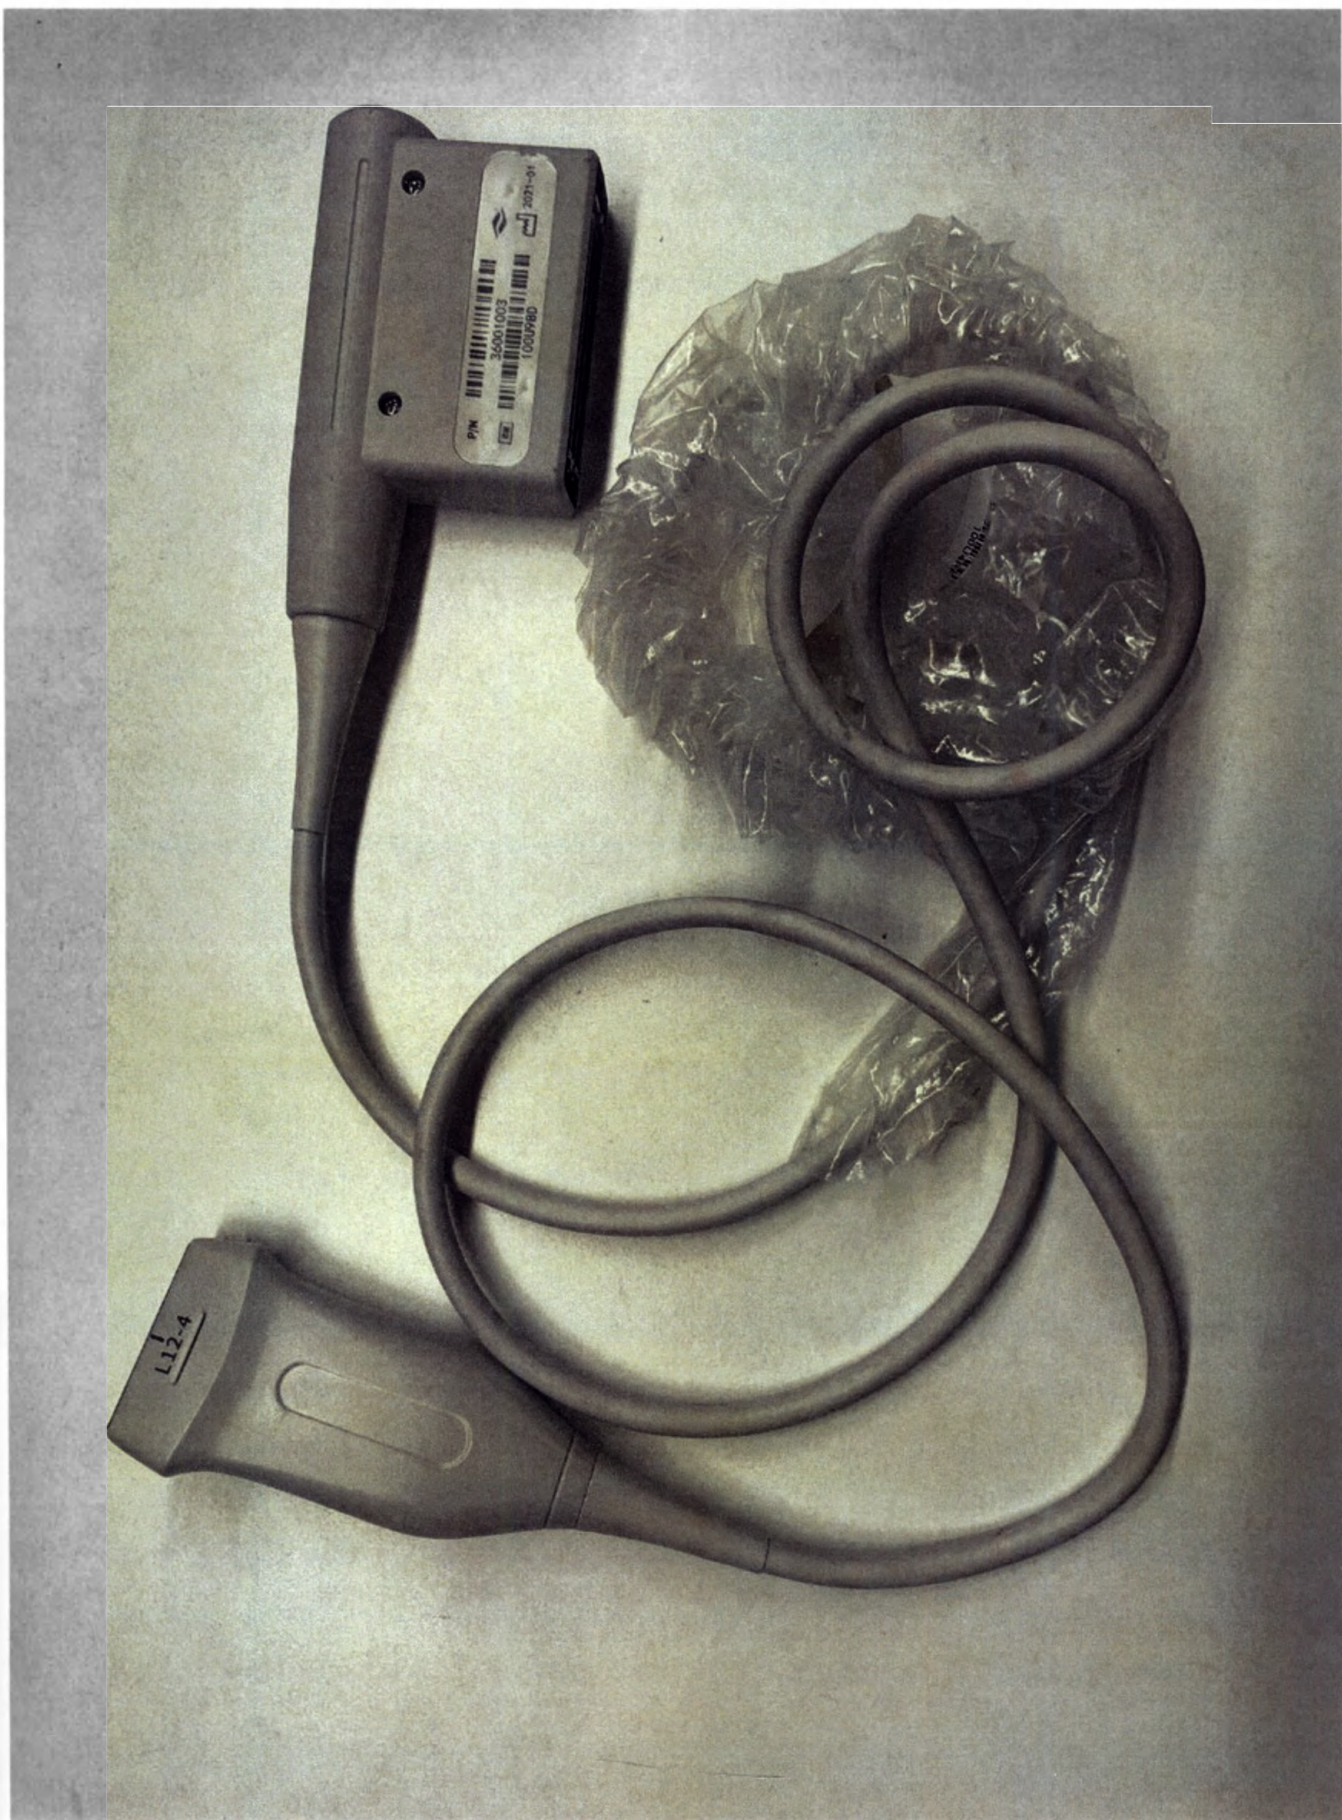


Рисунок 7 – Датчик линейный L12-4

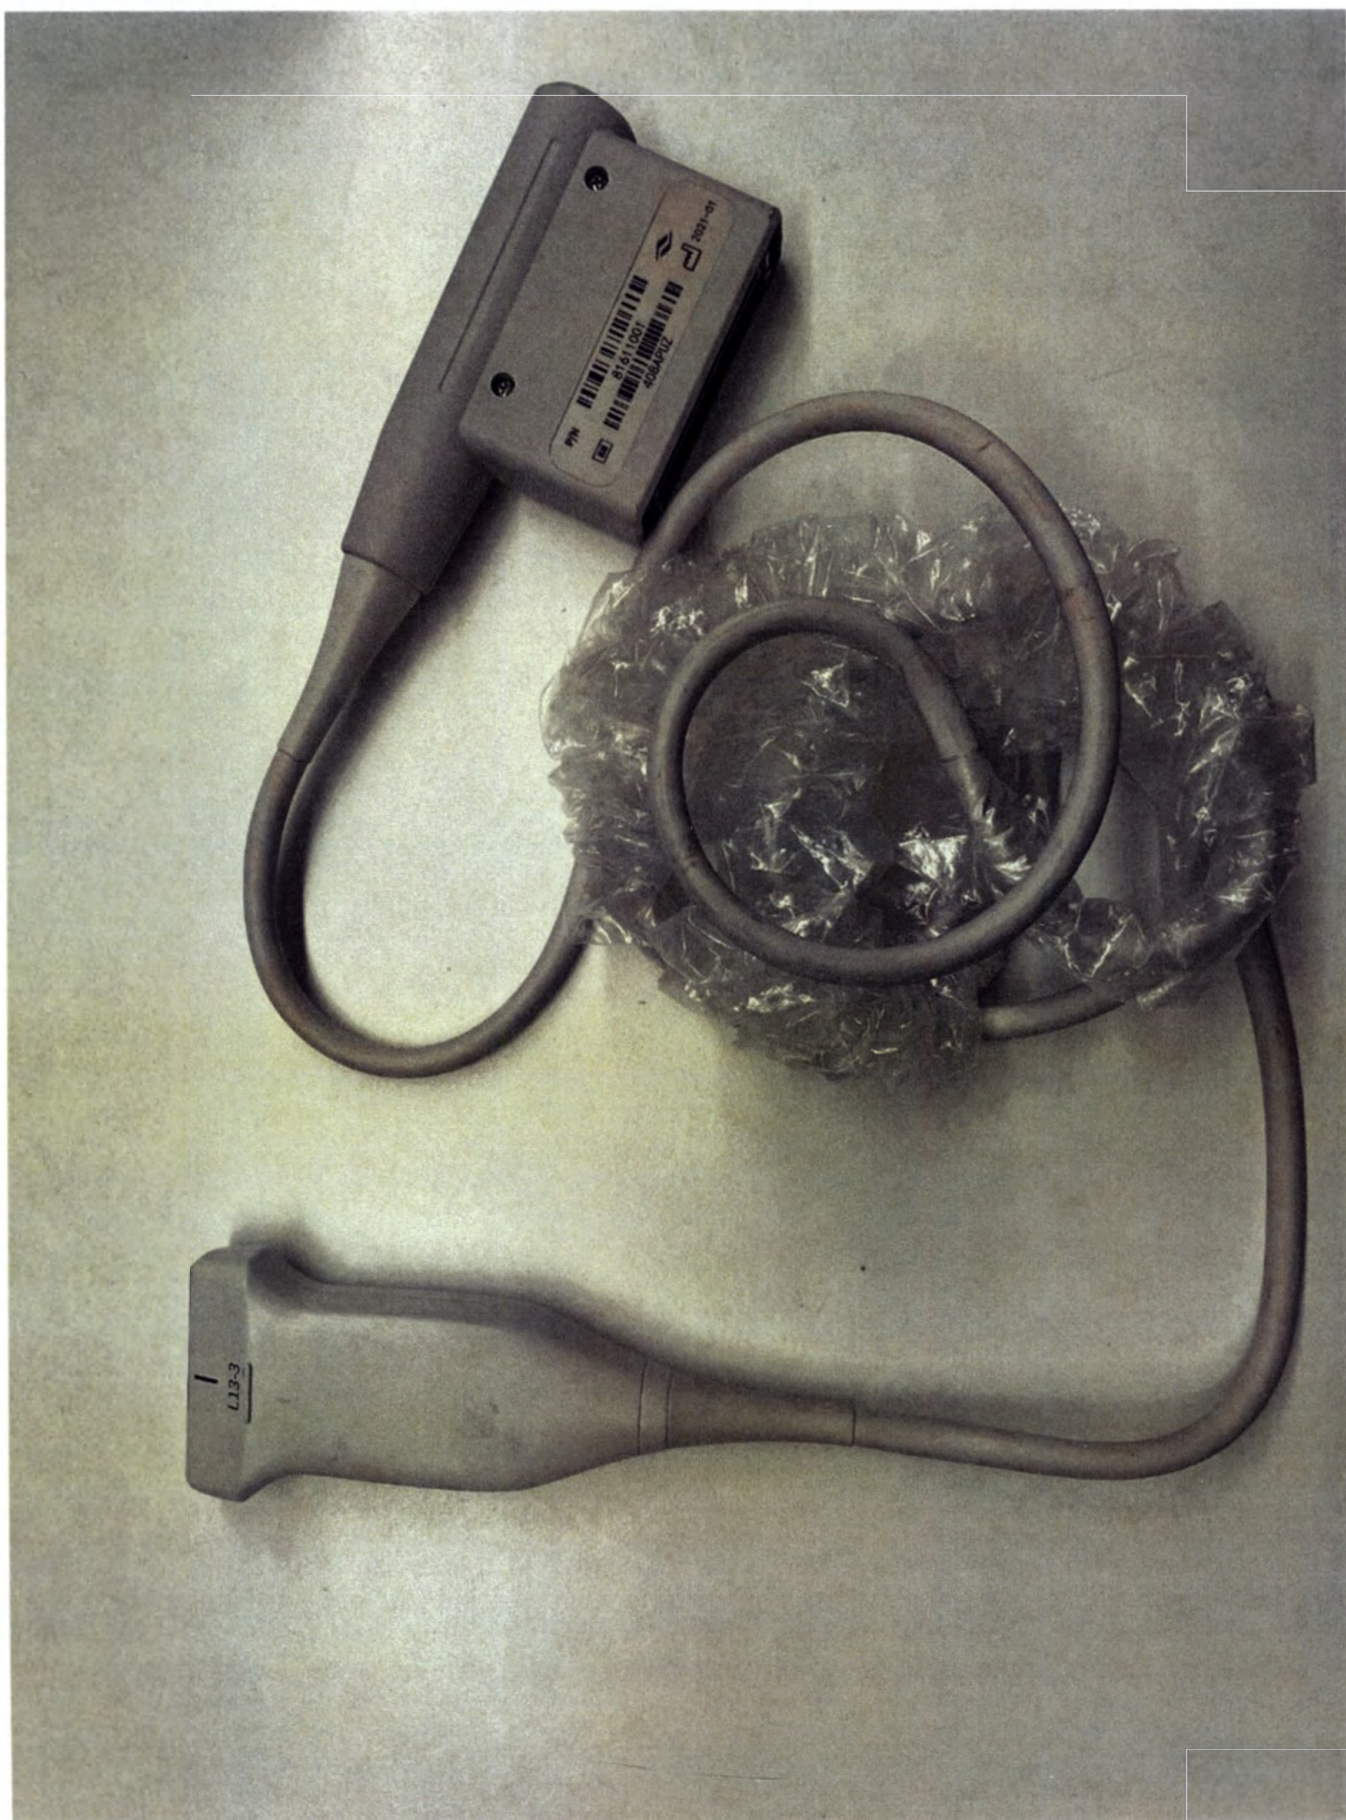


Рисунок 8 – Датчик линейный L13-3



Рисунок 9 – Датчик линейный L17-5



Рисунок 10 – Датчик секторный фазированный P5-1S



Рисунок 11 – Датчик секторный фазированный P5-2



Рисунок 12 – Датчик секторный фазированный P8-2



Рисунок 13 – Датчик внутриволокнистый EC9-4



Рисунок 14 – Датчик конвексный трехмерный (3D) V6-2



Рисунок 15 – Сенсорный экран EV133FHM-N40



Рисунок 16 – Монитор LM215WF3



Рисунок 17 – Кабель питания HO5VV-F



Рисунок 18 – Нагреватель геля 84020291



Рисунок 19 – Перезаряжаемый литий-ионный аккумуляторный комплект LI6 Ah5001



Рисунок 20 – Адаптер питания MDS-150AAS19 B



Рисунок 21 – Беспроводная сетевая карта Wi-Fi TL-WDN5200


Ultrasound Diagnostic Systems




MODEL : Cetus 45Exp

INPUT : 100-240V~, 5A, 50~60Hz

Focus & Fusion Healthcare (Hangzhou) Co., Ltd
4 to 5F, Building 1, No.86 Jingguan Avenue, Linan,
Hangzhou, 311305 Zhejiang, China



2022-08



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Elfenstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175



0197






Рисунок 22 – Маркировка основного блока Системы ультразвуковой диагностики в вариантах исполнения Cetus и Danus на примере варианта исполнения Cetus 45Exp


Ultrasound Diagnostic Systems

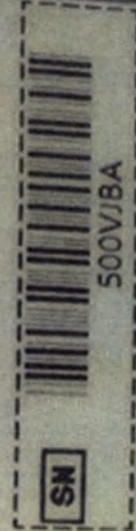

MODEL : Finus 70Exp

INPUT : 19V $\approx$ 7.89A

Focus & Fusion Healthcare (Hangzhou) Co., Ltd.
4 to 5F, Building 1, No. 86 Jingguan Avenue, Linan,
Hangzhou, 311305 Zhejiang, China



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175



2022-09



0197

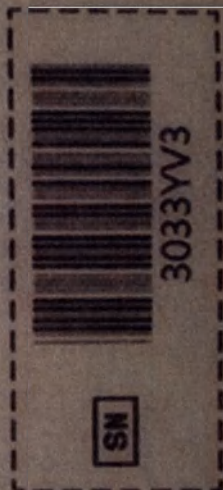


Рисунок 23 – Маркировка основного блока Системы ультразвуковой диагностики в варианте исполнения Finus на примере варианта исполнения Finus 70Exp

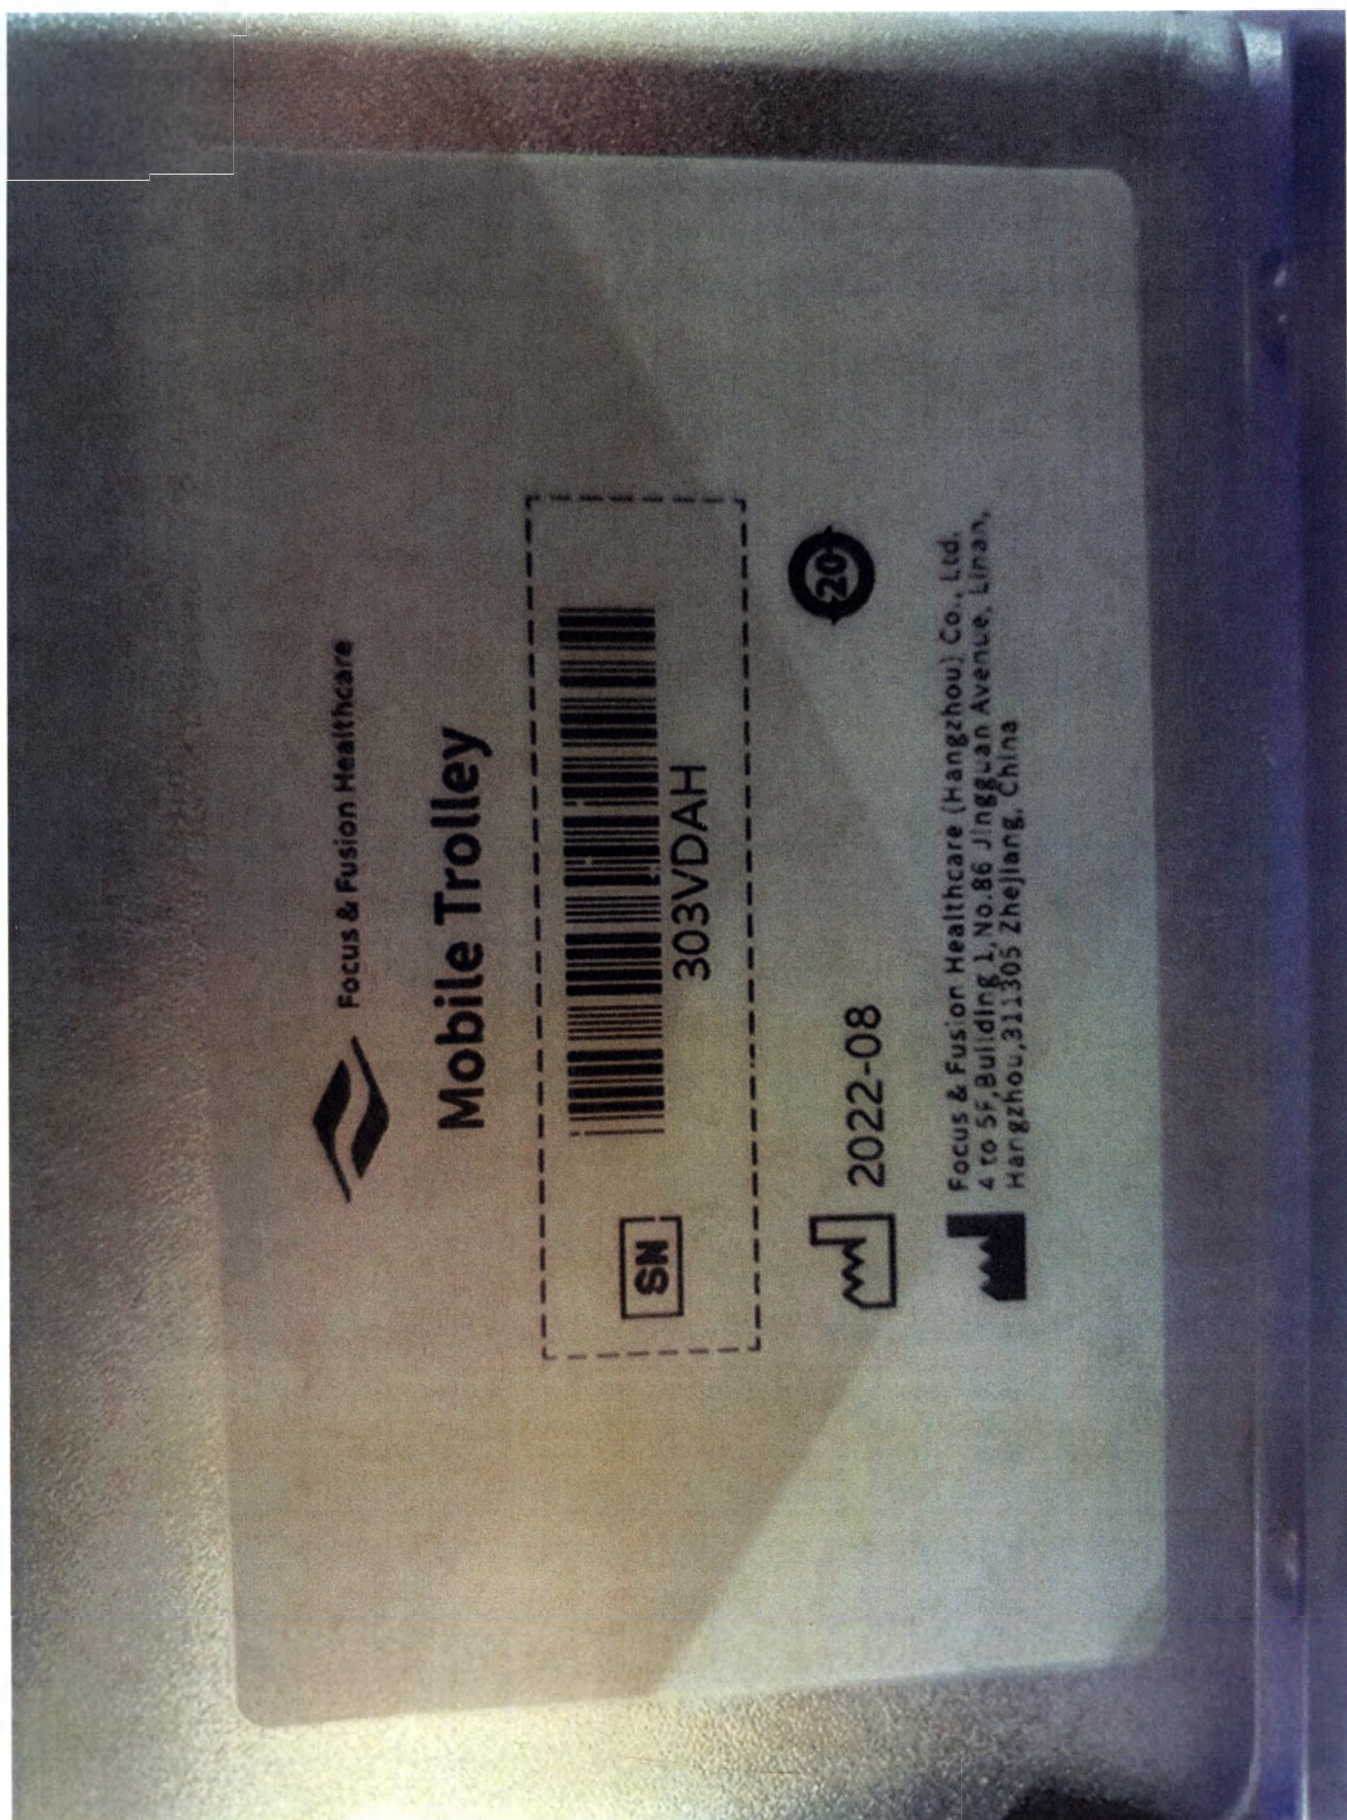


Рисунок 24 – Маркировка мобильной тележки Системы ультразвуковой диагностики в варианте исполнения Finus на примере варианта исполнения Finus 70Exp

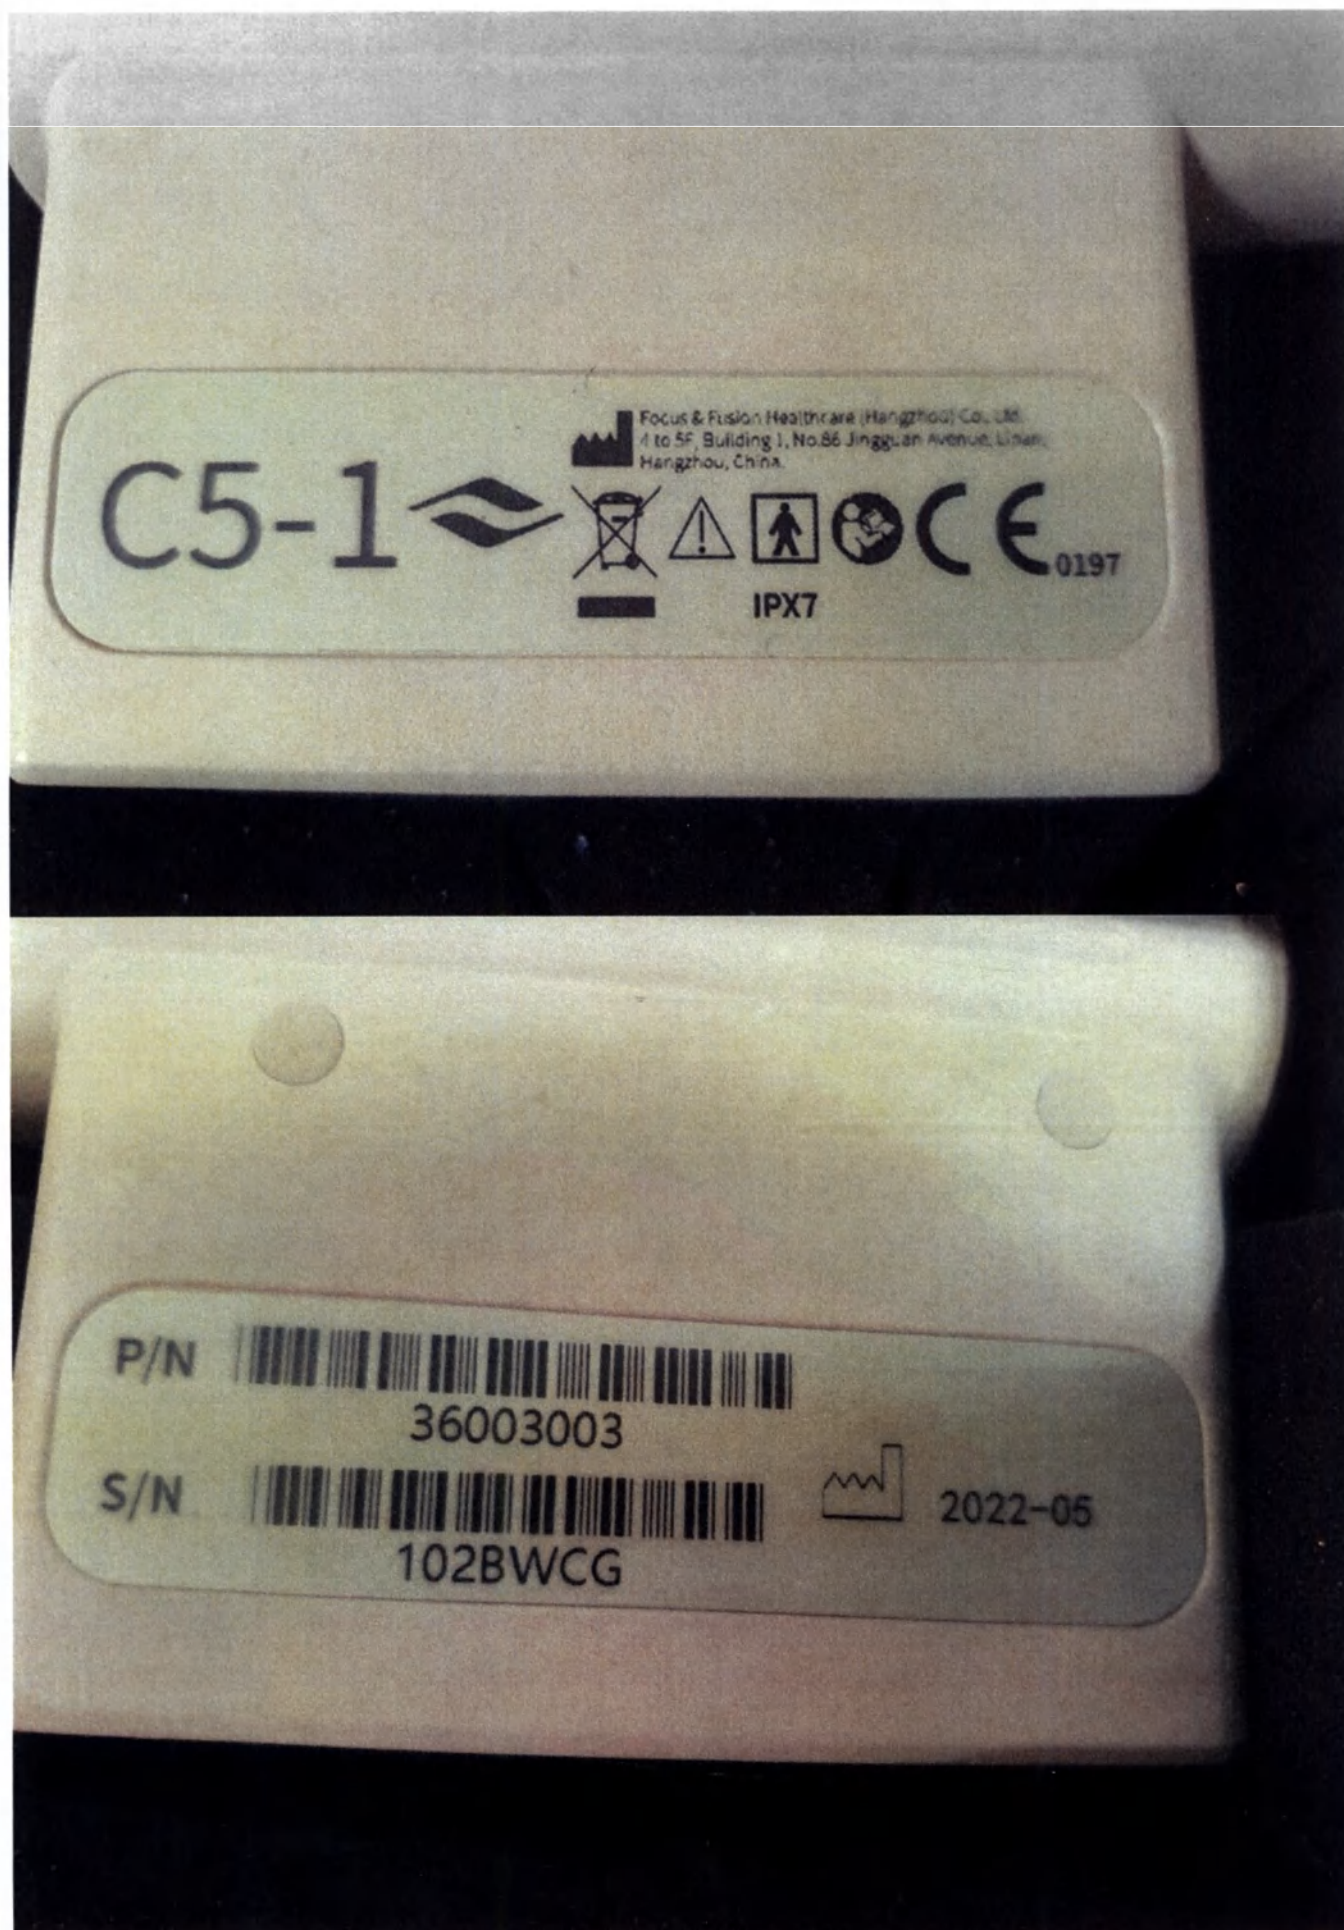


Рисунок 25 – Маркировка датчика на примере датчика конвексного C5-1

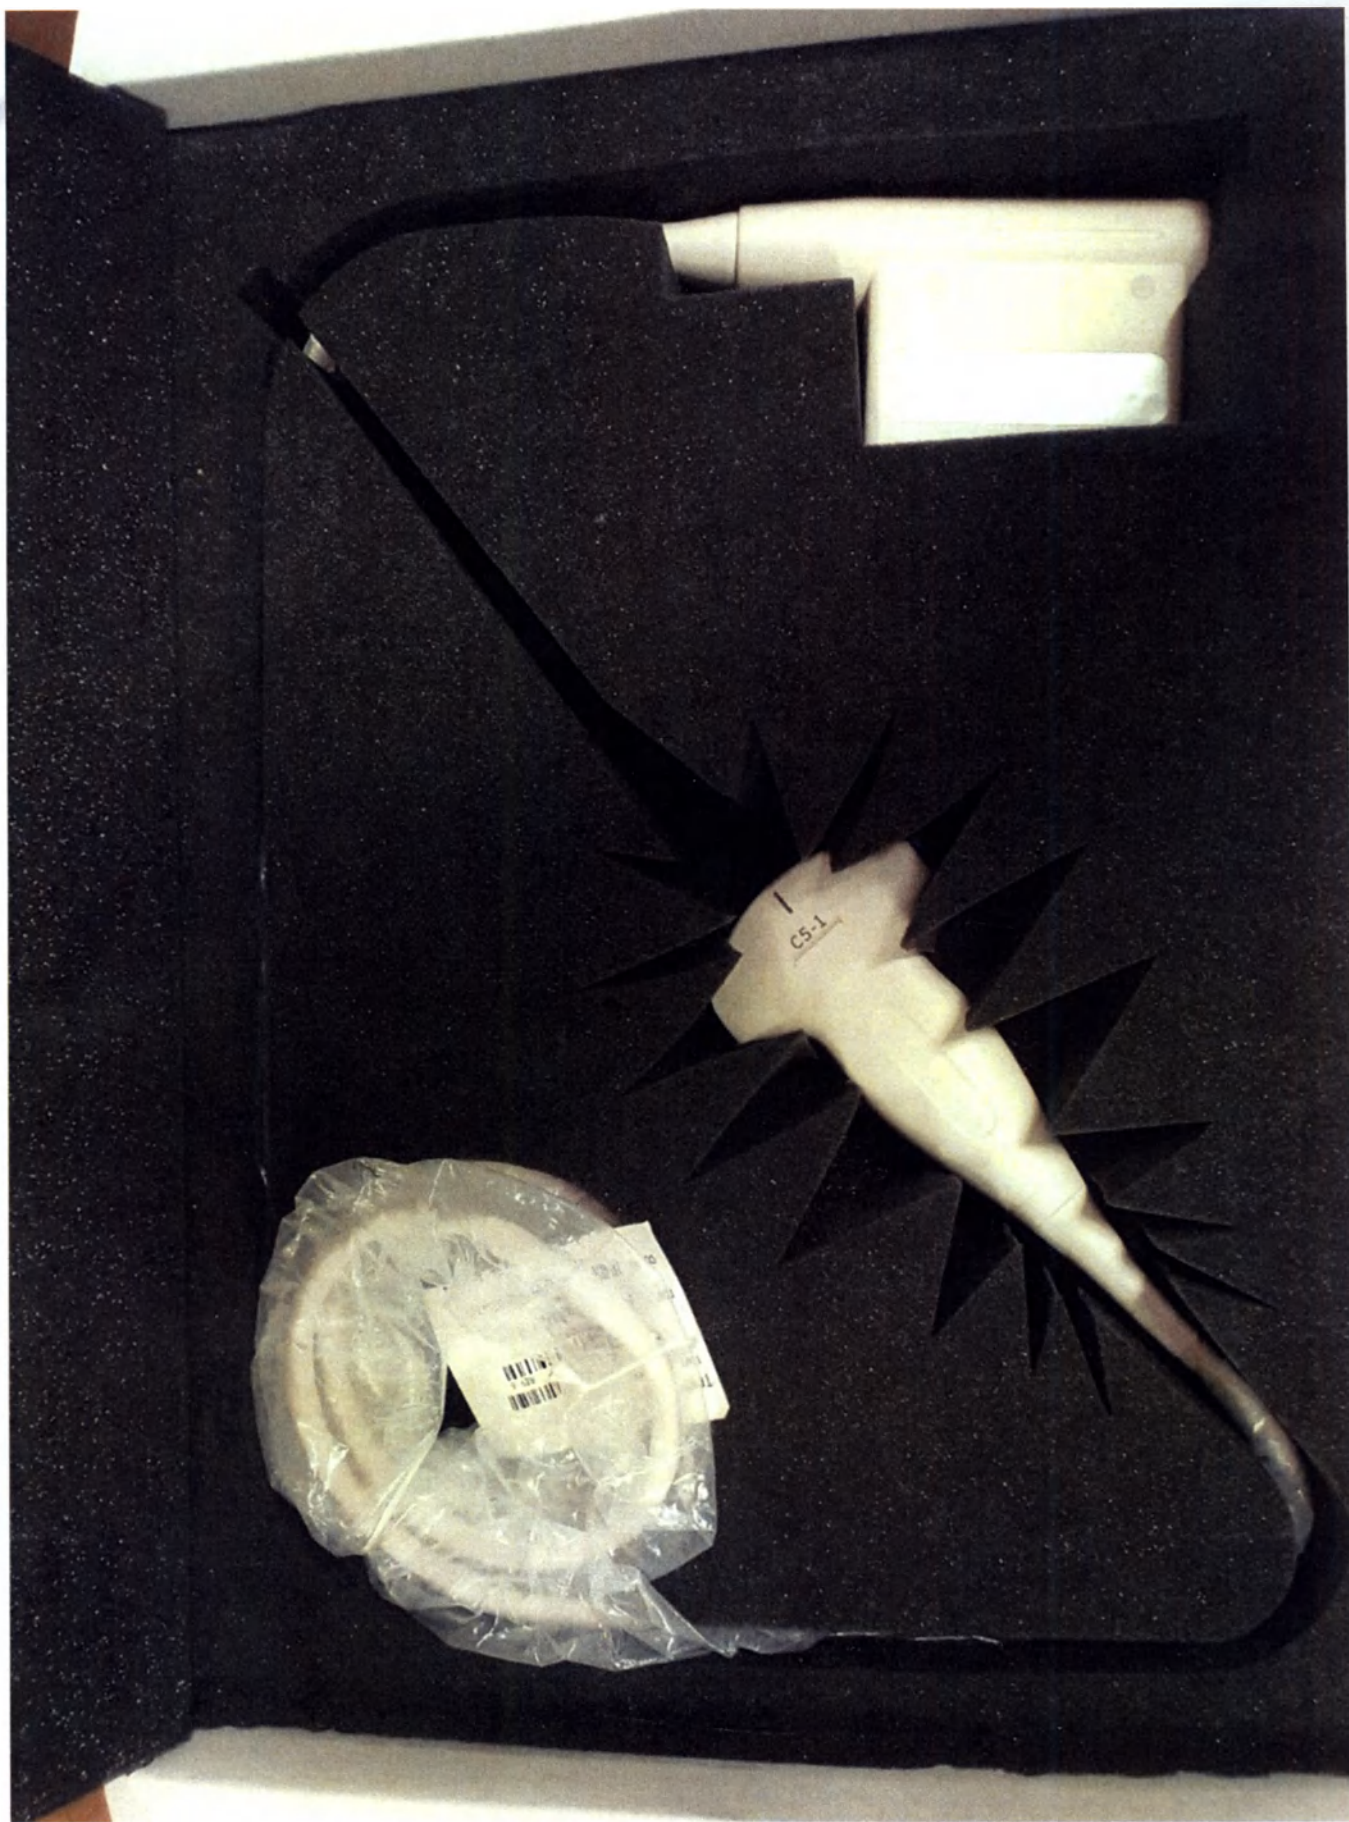


Рисунок 26 – Упаковка датчика на примере датчика конвексного C5-1

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 24 листов
Подпись _____

