



Фотографии медицинского изделия
Комплекс рентгеновский диагностический
стационарный Р-600 «Дуограф»
производства ООО «ВКО Медпром», Россия




Стол снимков А1-В0200, производства ООО «ВКО Медпром»,
Россия

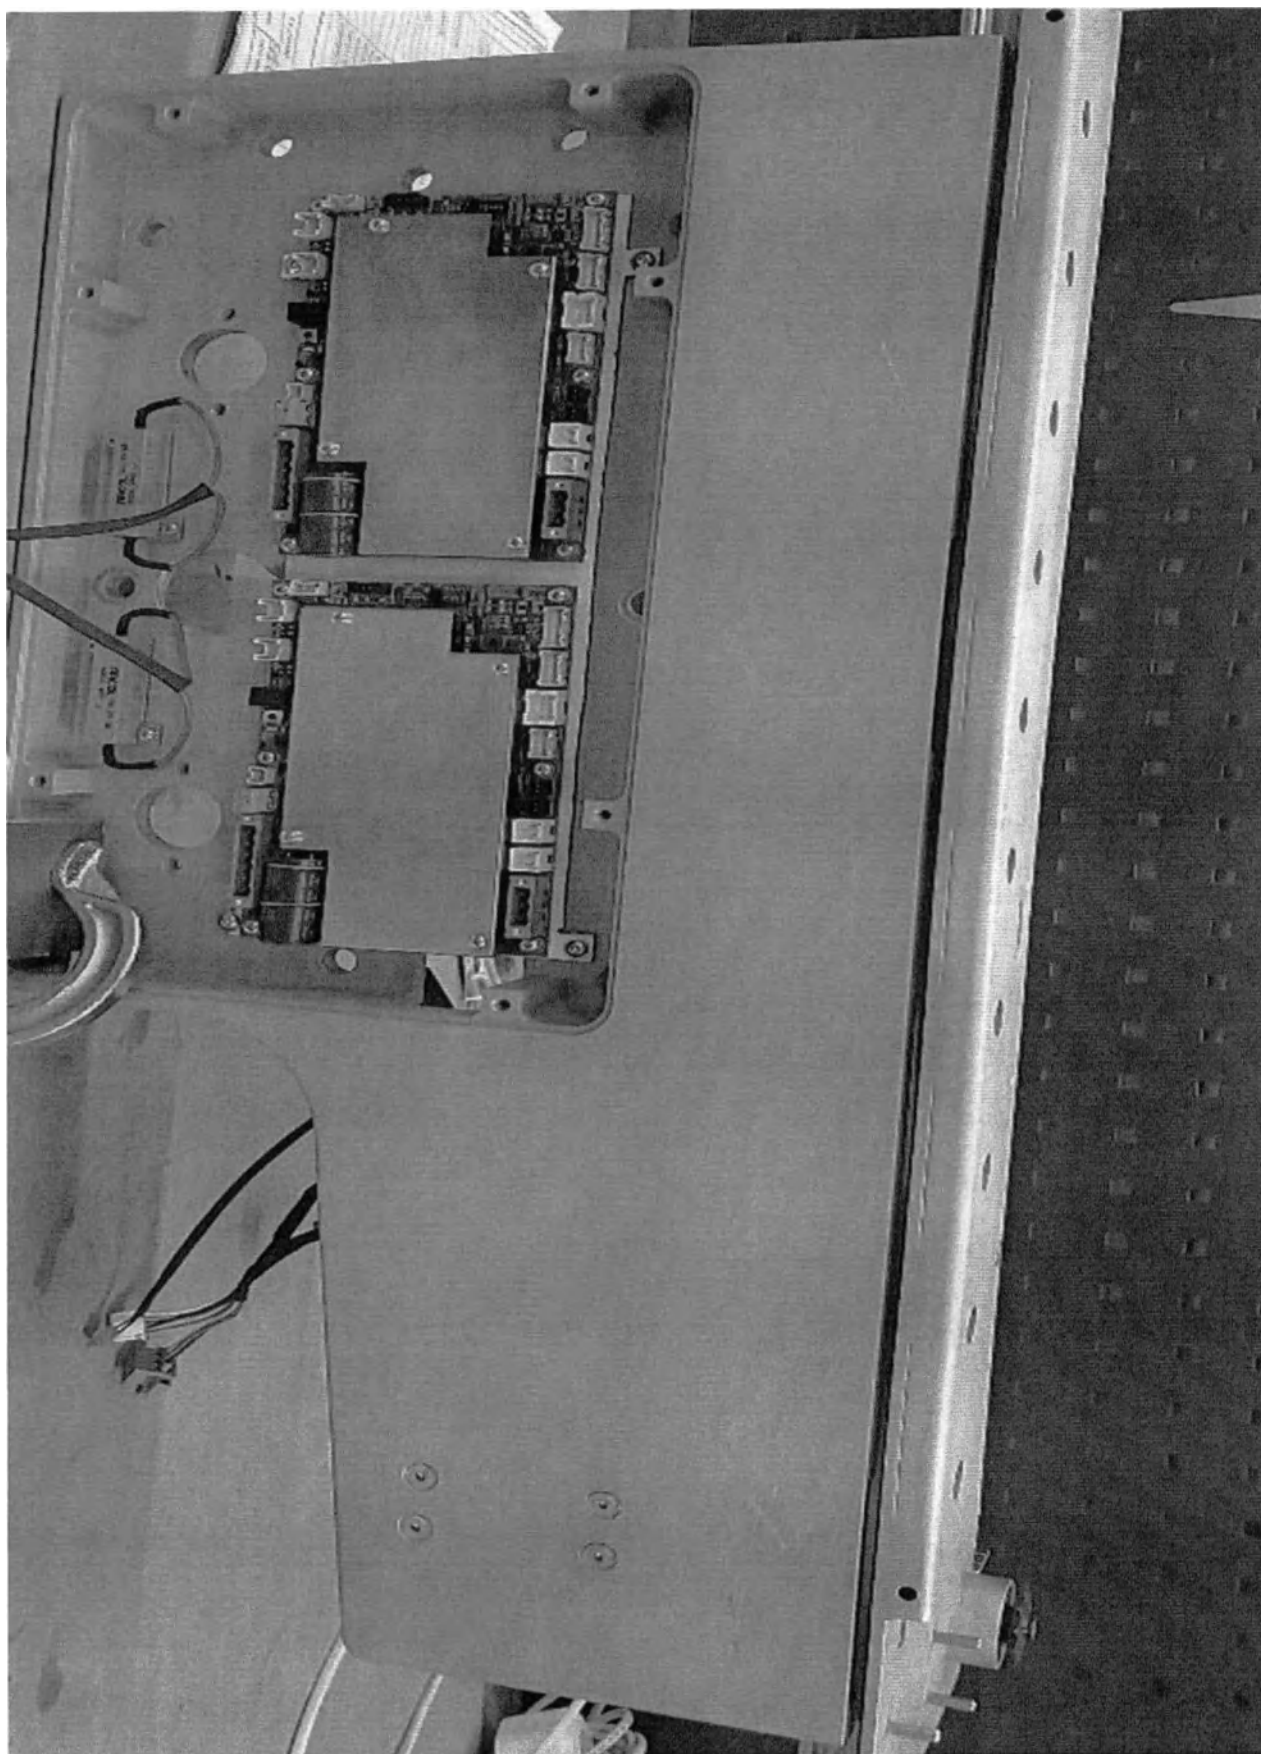


1. Модуль томосинтеза (многосрезовая линейная томография – объемная рентгенография), производства ООО «ВКО Медпром», Россия

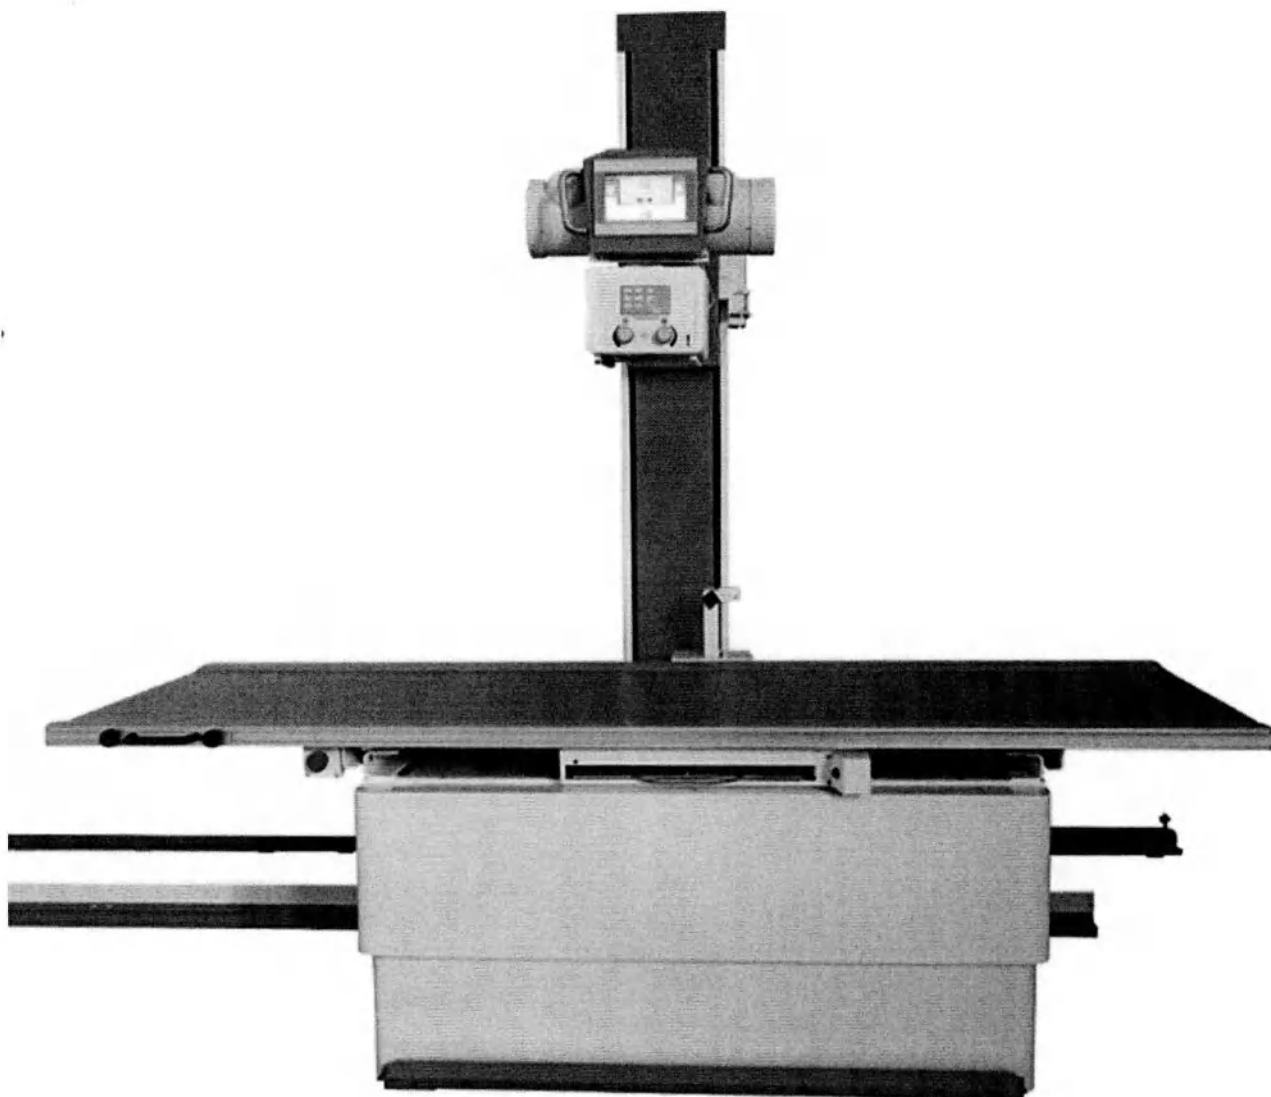


Стол со штативом снимков ТОМОС-ДЕ, производства
ООО «Севкаврентген-Д» Россия

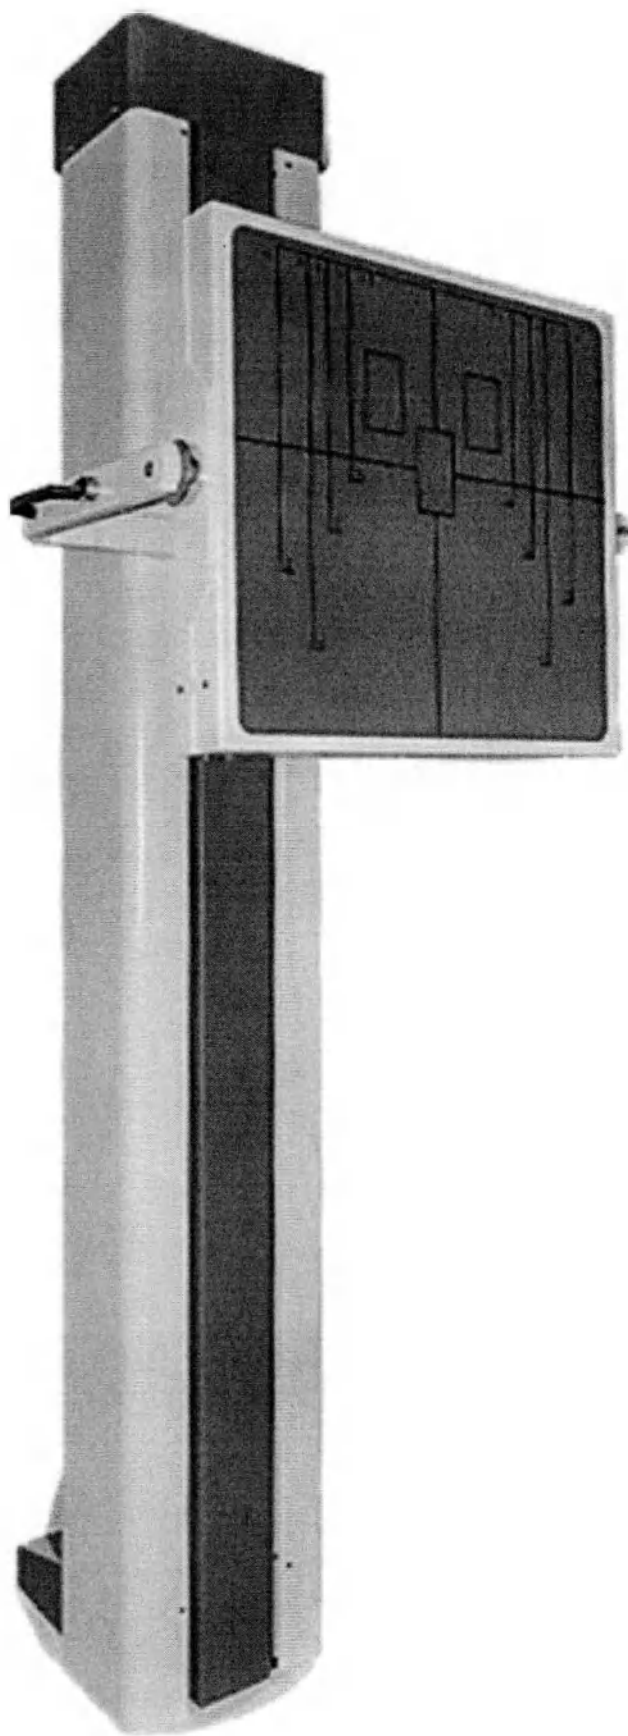


Стойка снимков СС-Д или СС-ДП, производства
ООО «Севкаврентген-Д», Россия

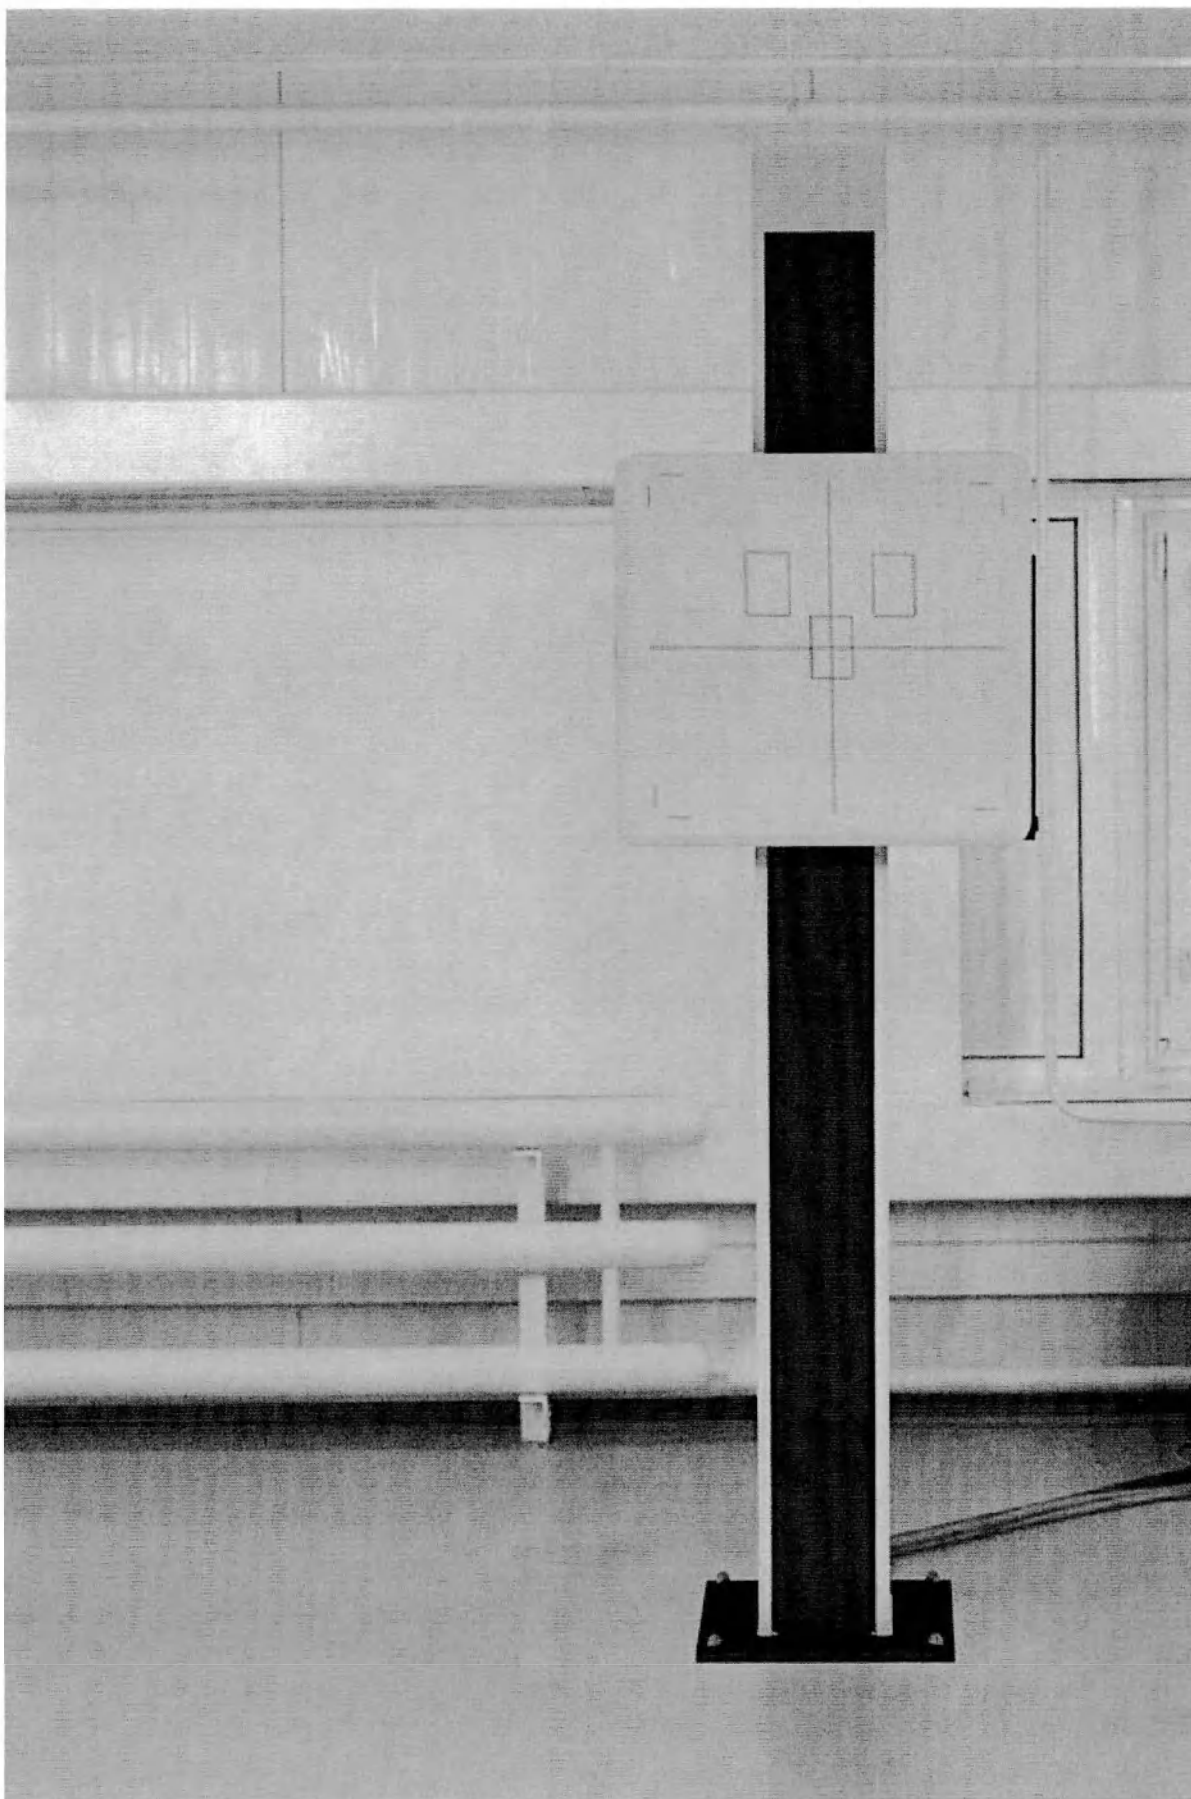


Стойка снимков цифровая А1-В0100, производства ООО «ВКО Медпром», Россия

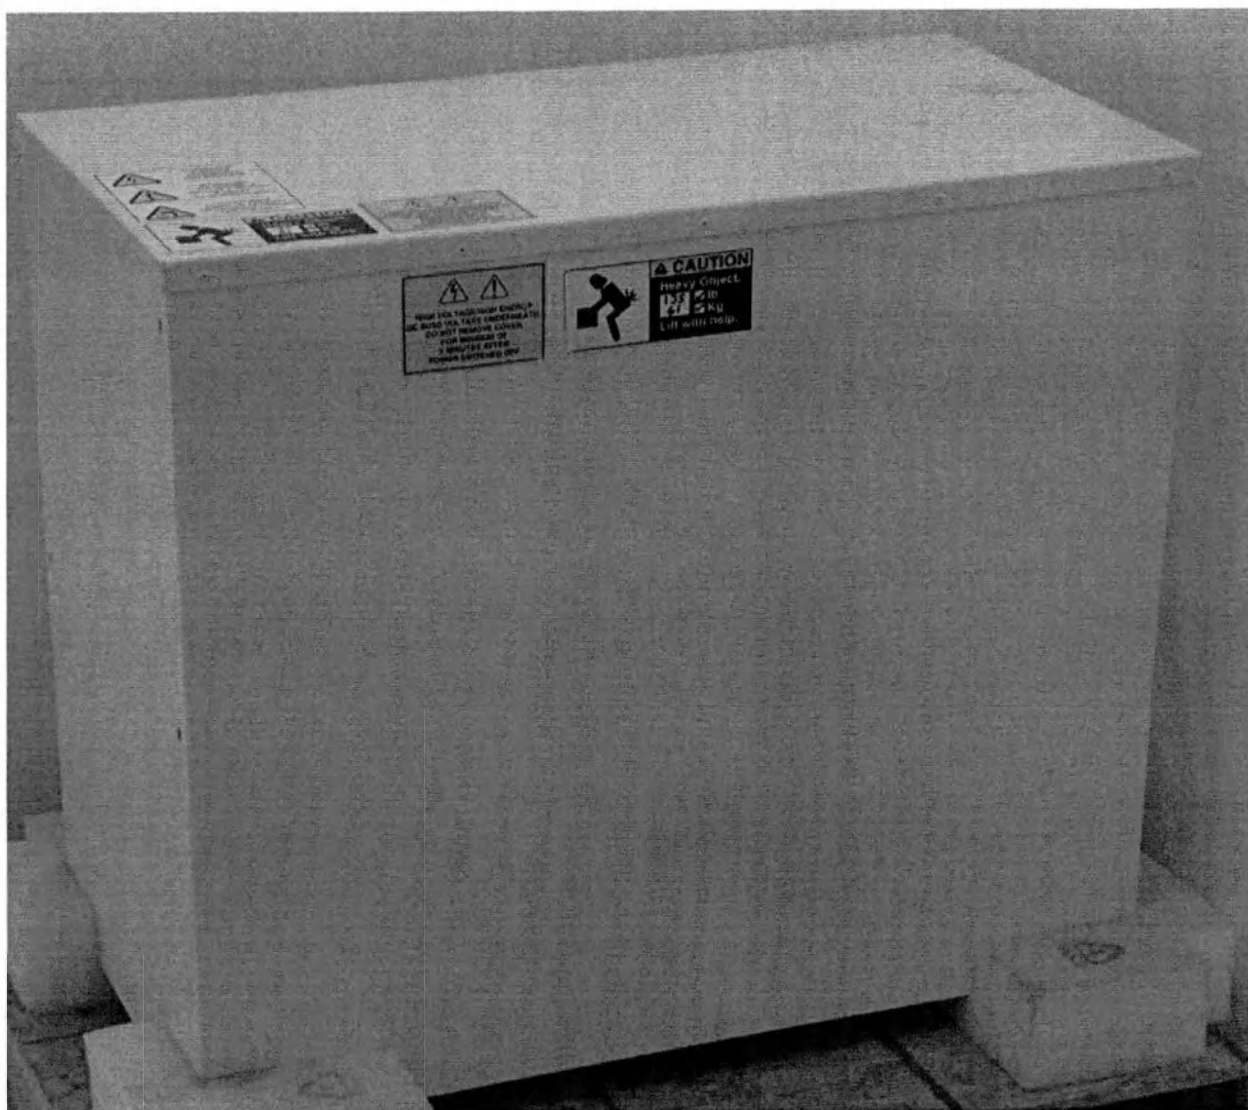


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) серии CMP 200 50kW или серии CMP 200 65kW или серии CMP 200 80kW , производства Communications & Power Industries Canada Inc., Канада

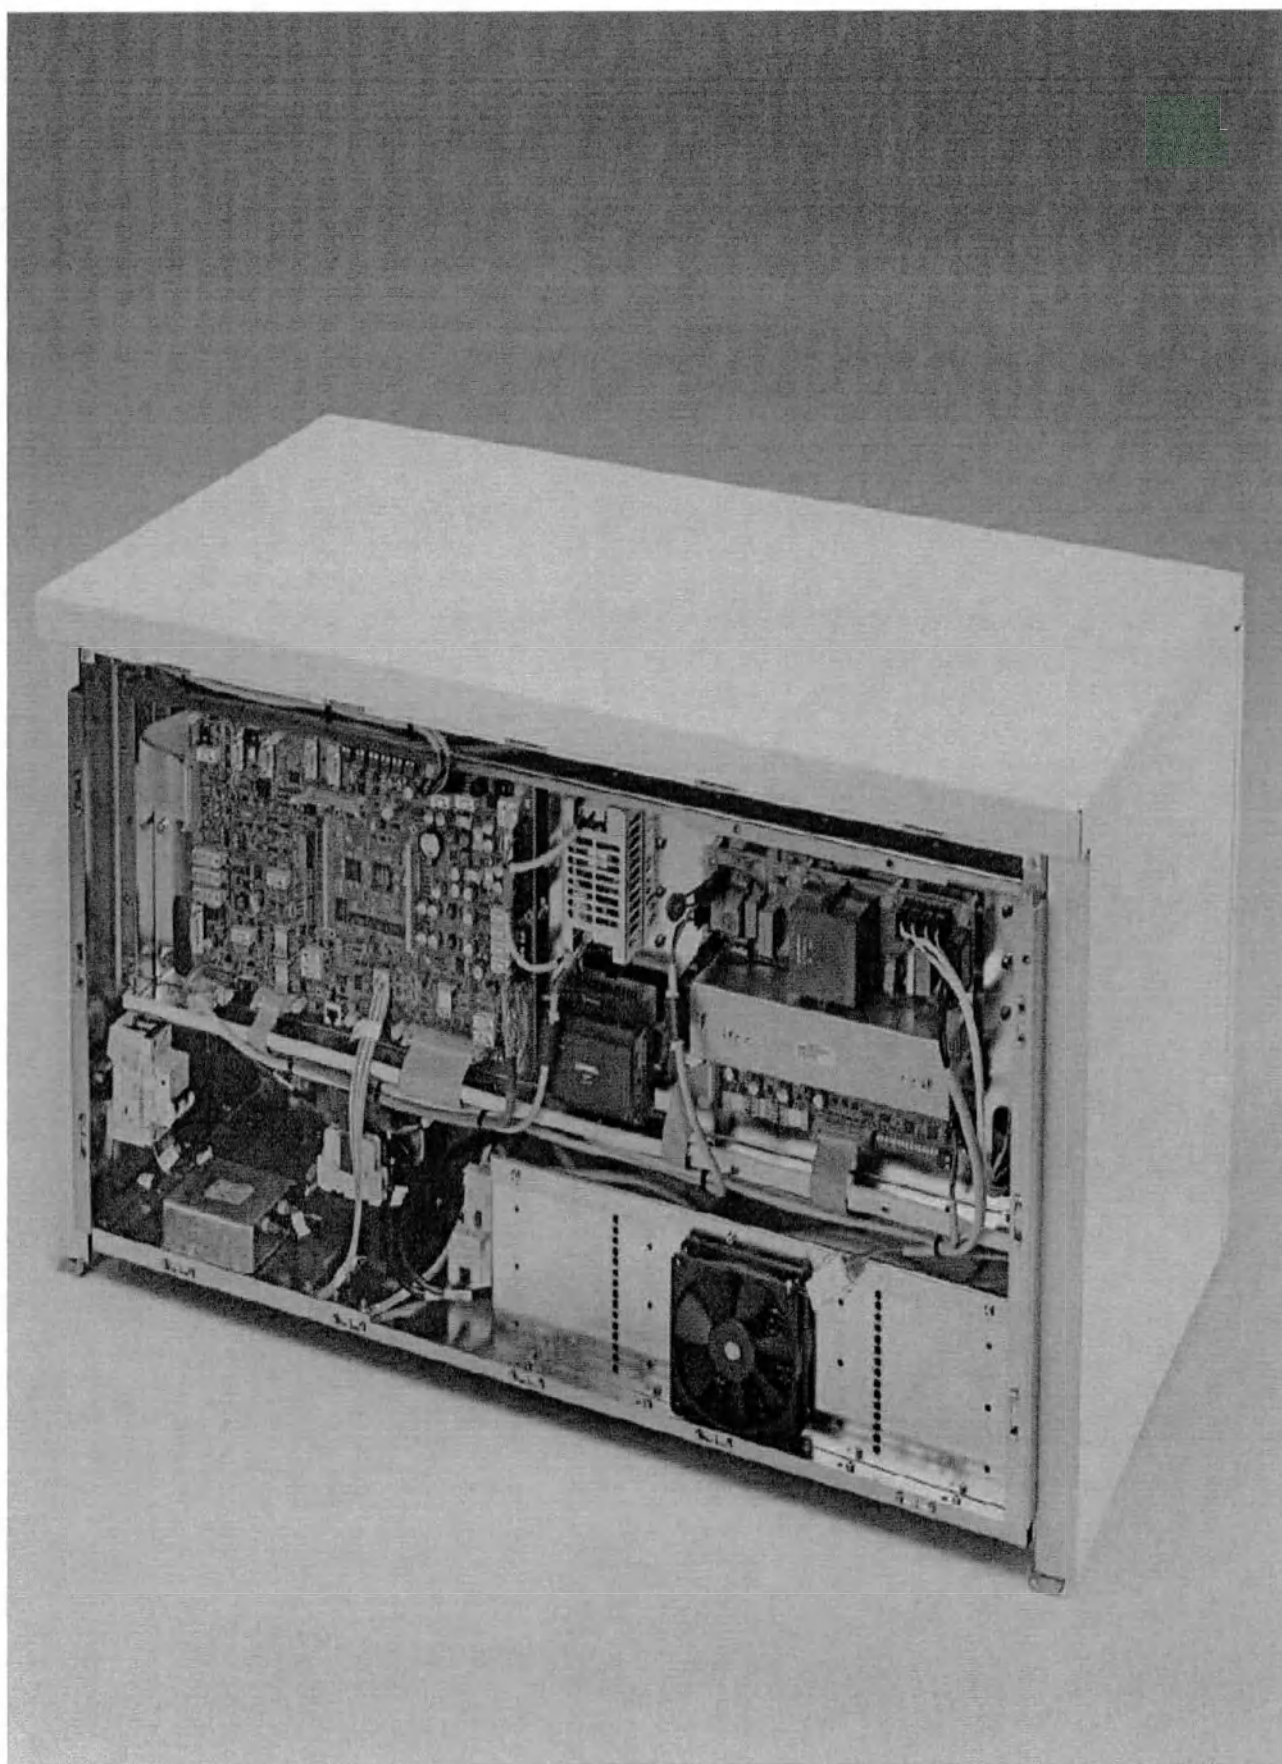

Рентгеновское питающее устройство (РПУ) Polydoros RF 80 55kW или Polydoros RF 80 65kW или Polydoros RF 80 80kW, производства Siemens, Германия

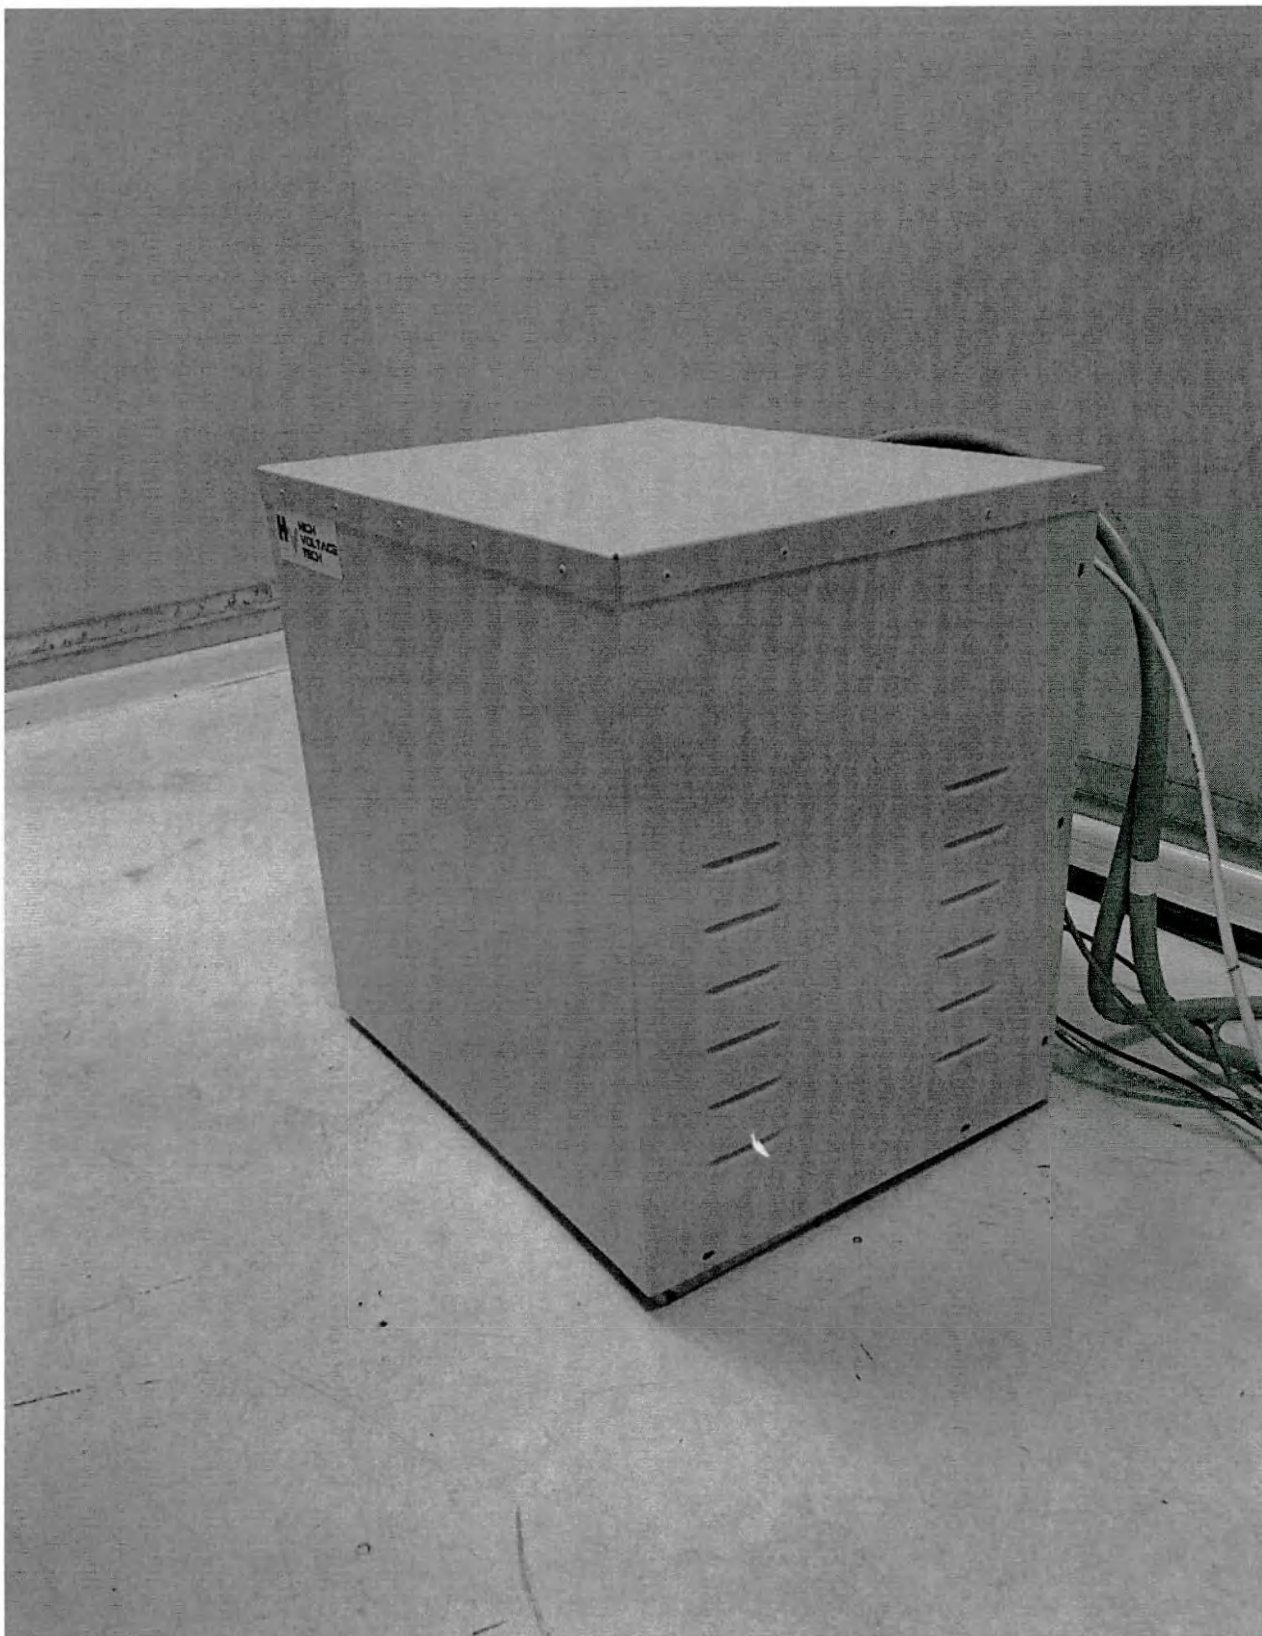


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) Cetus 50R01 или Cetus 65R01, производства iRay Imaging Technology (Haining) Limited, Китай

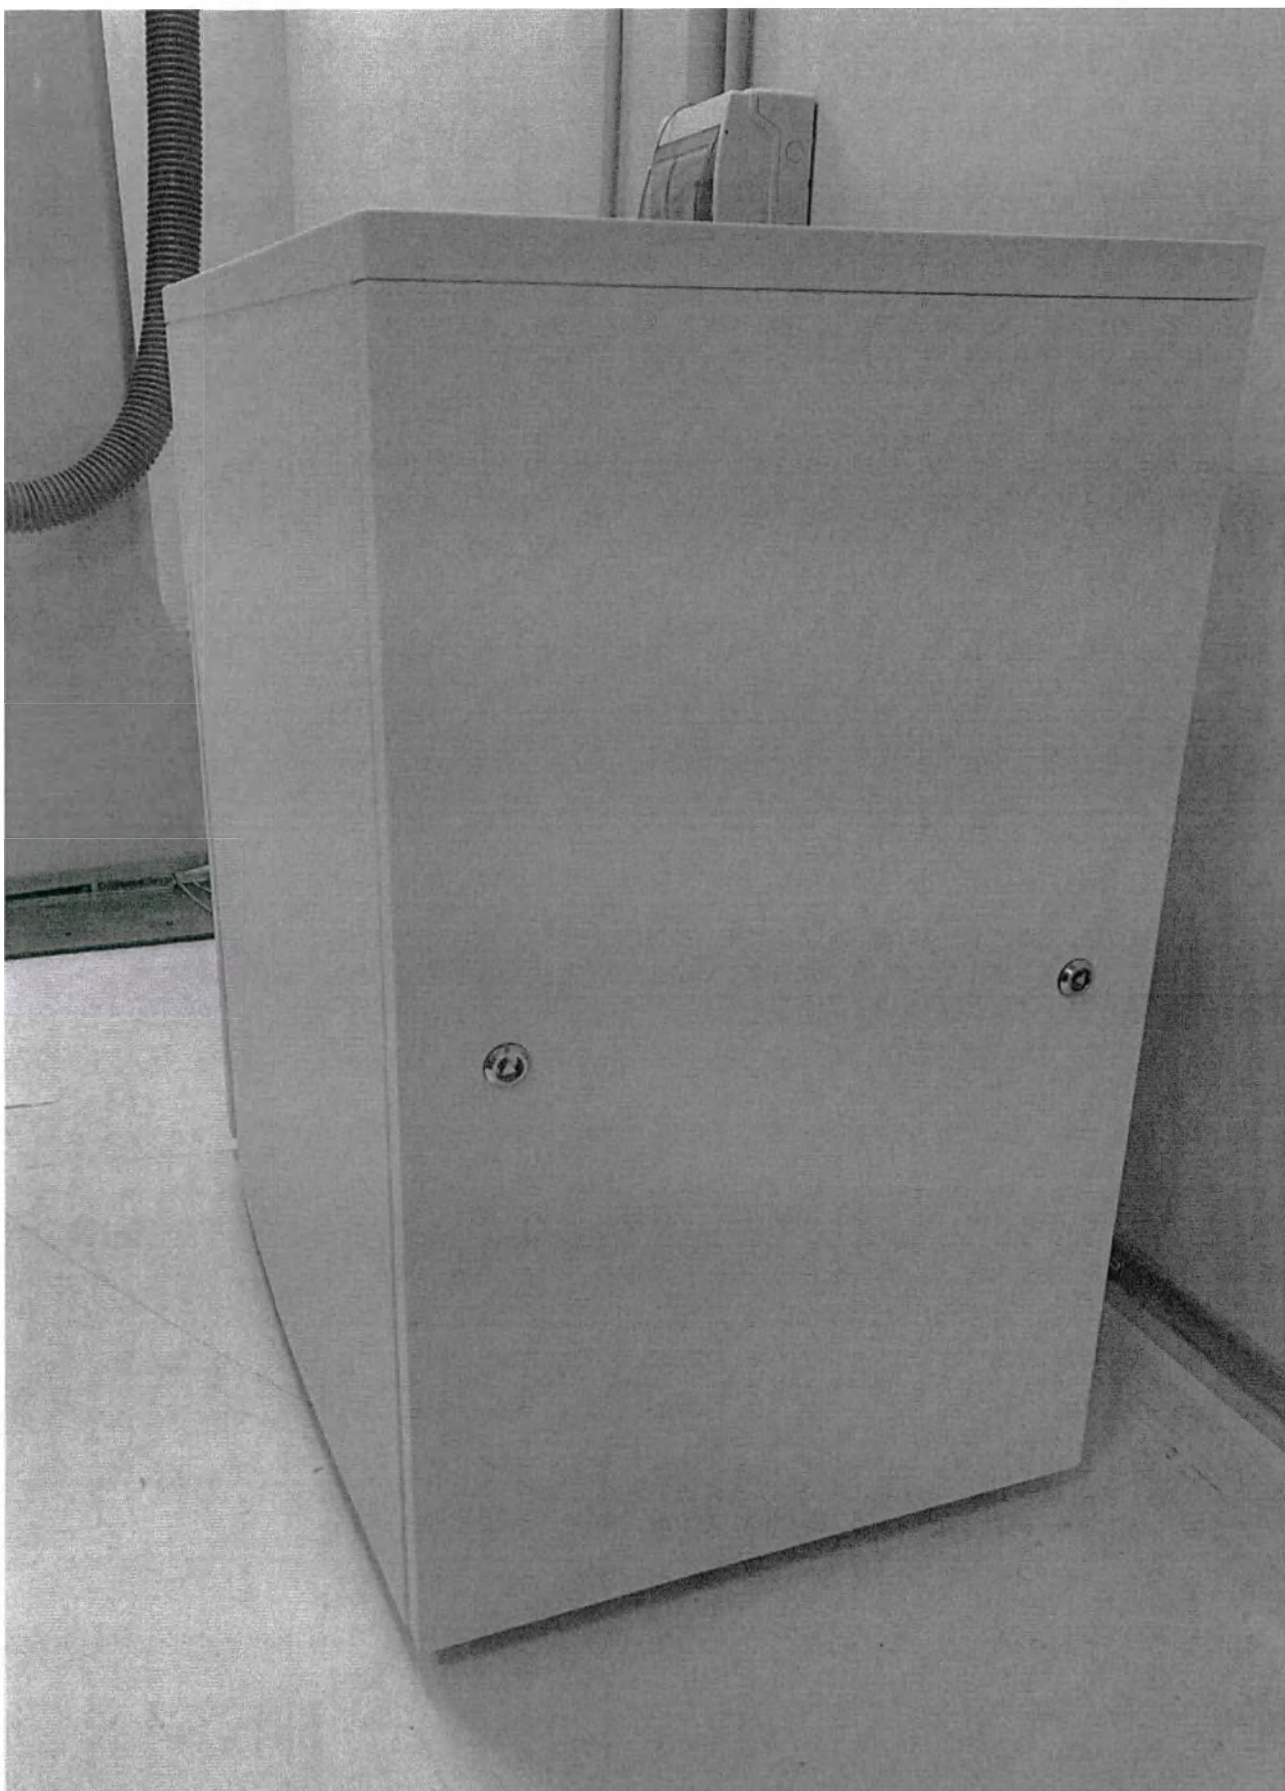


Рентгеновское питающее устройство (РПУ) X1-B0700 или X1-B0800, производства ООО «ВКО Медпром», Россия




Комплект (пара) кабелей высоковольтных с наконечниками производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины или Varex Imaging Corporation, Китай или Tianjin Wanbo Wire & Cable Co.,Ltd, Китай

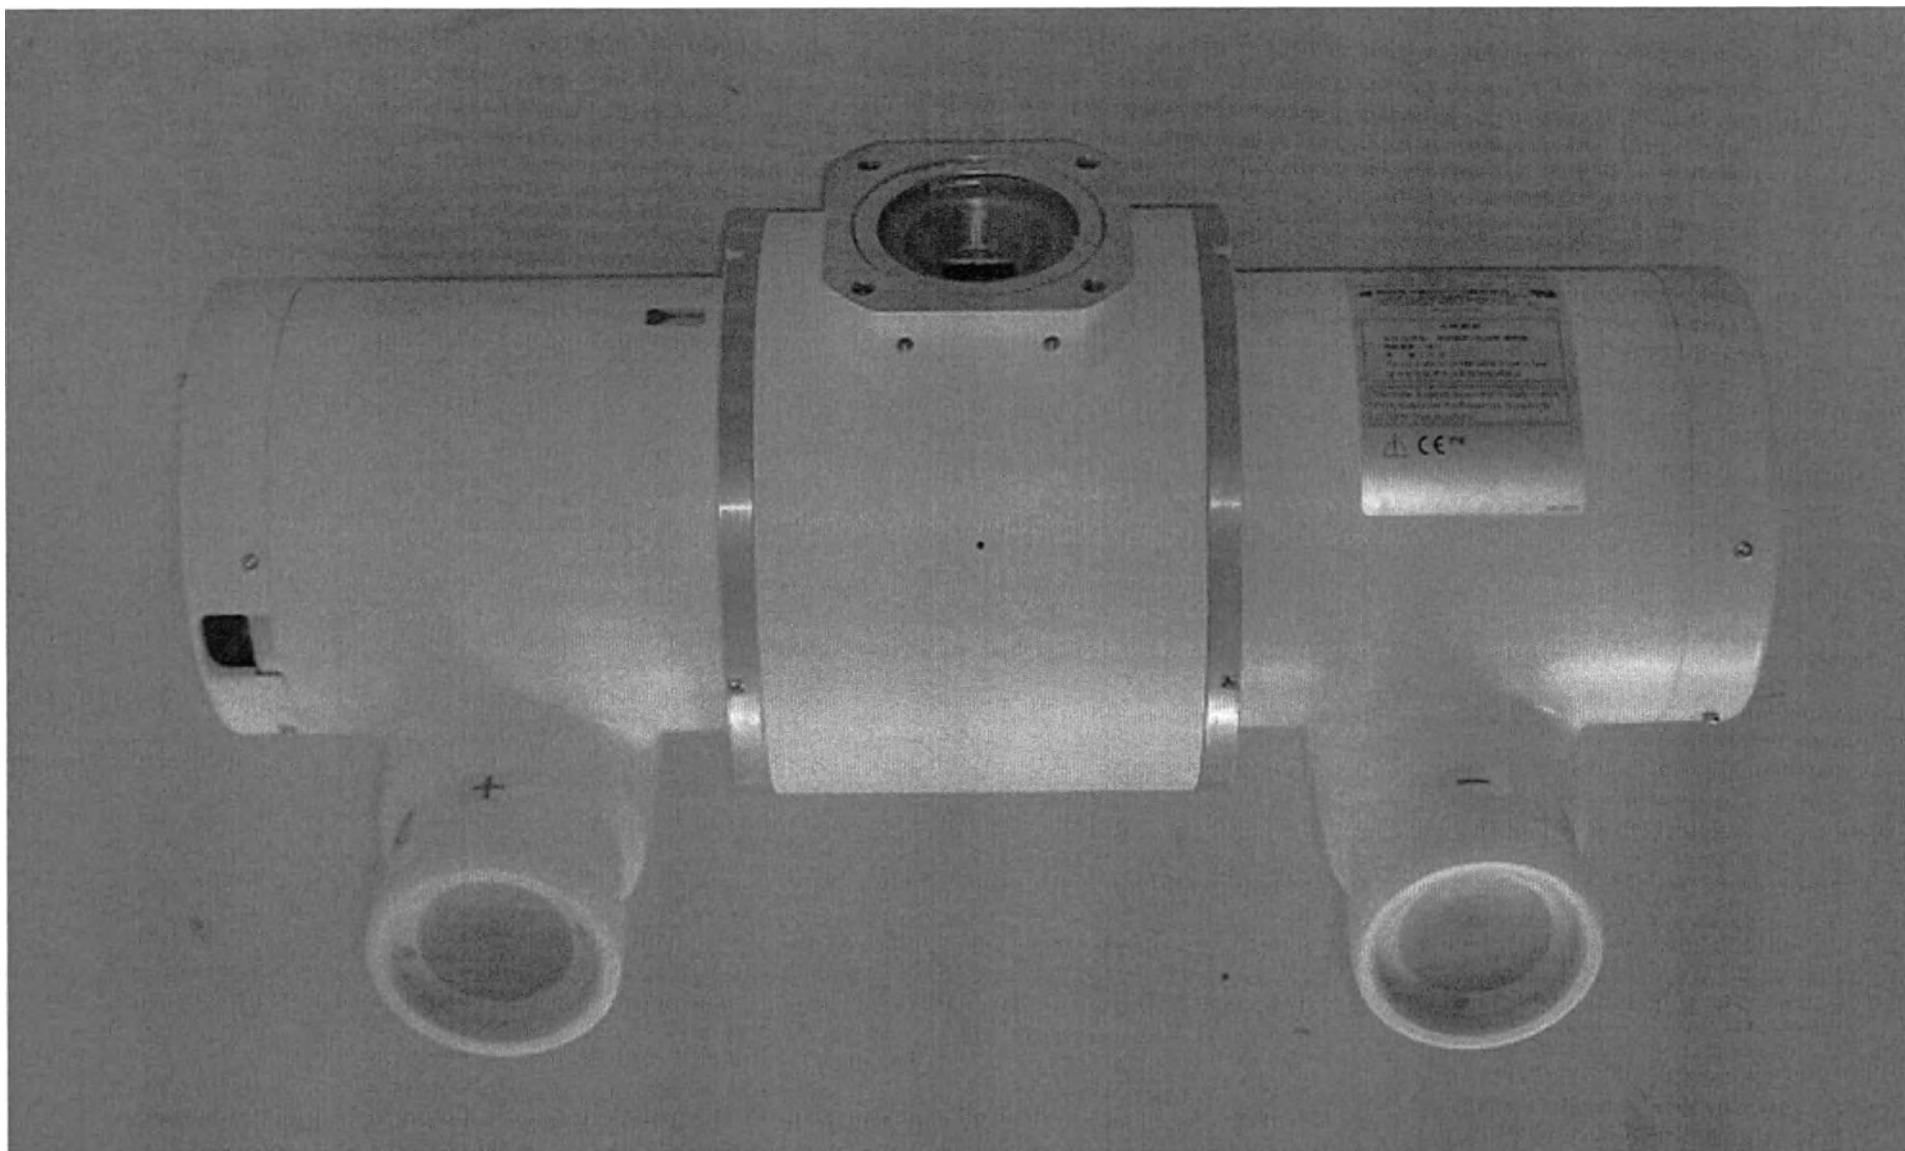


Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой E7242 или E7252 или E7864, производства Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd, Япония

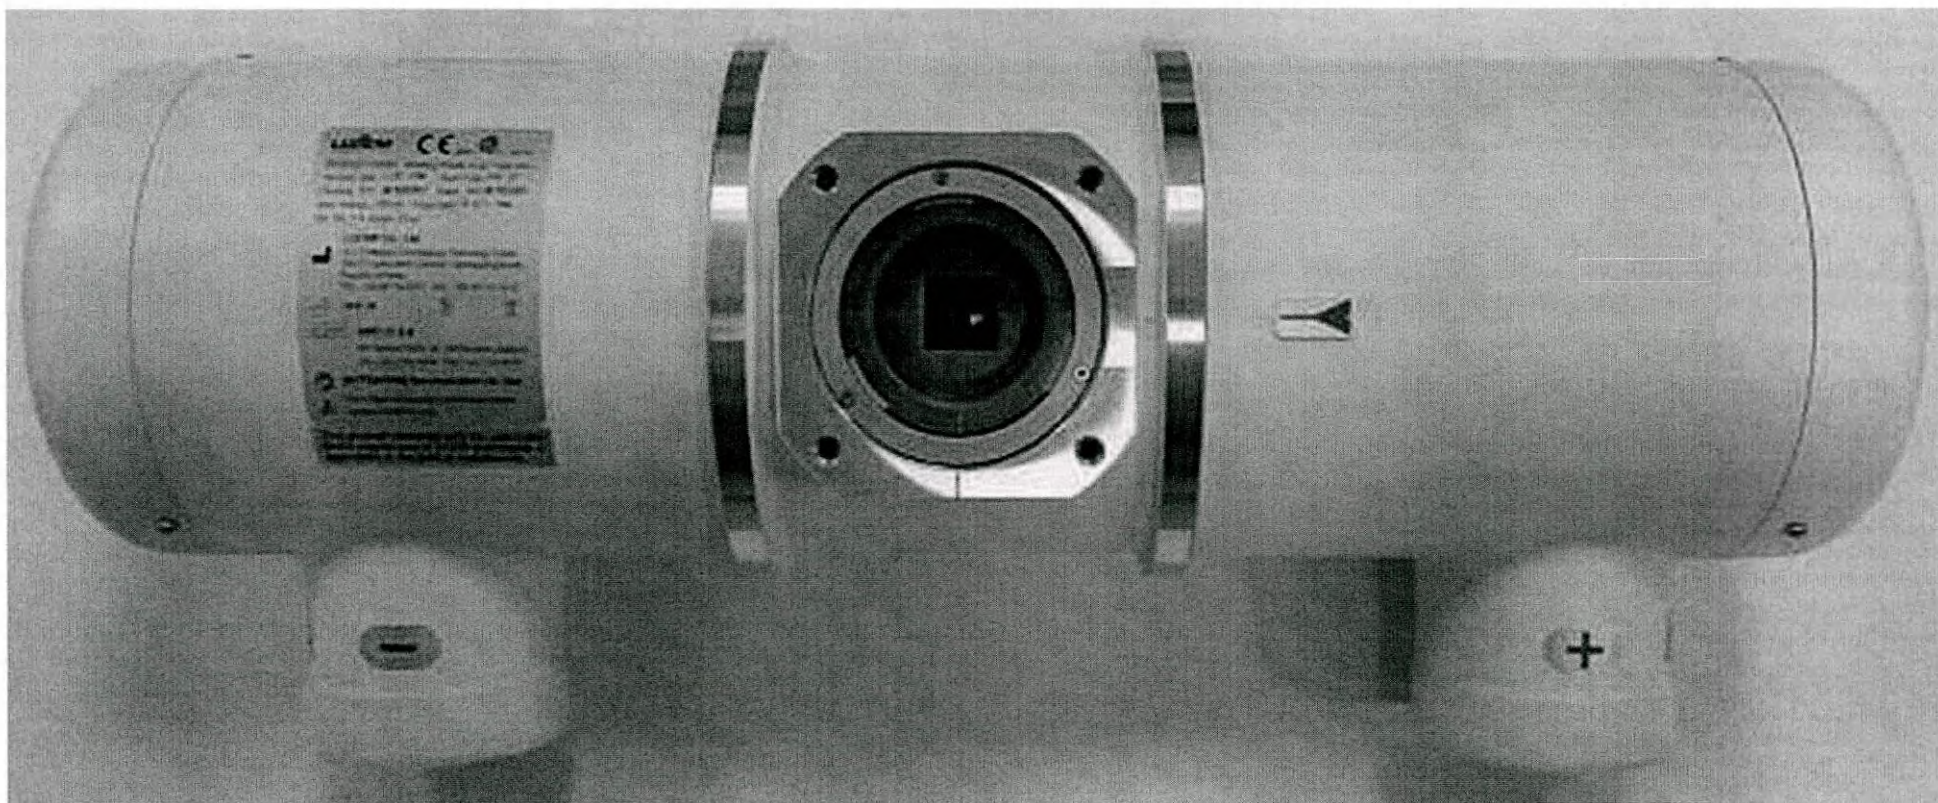


Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой LUC-11 или LUC-14, производства Lucem Co., Ltd., Республика Корея

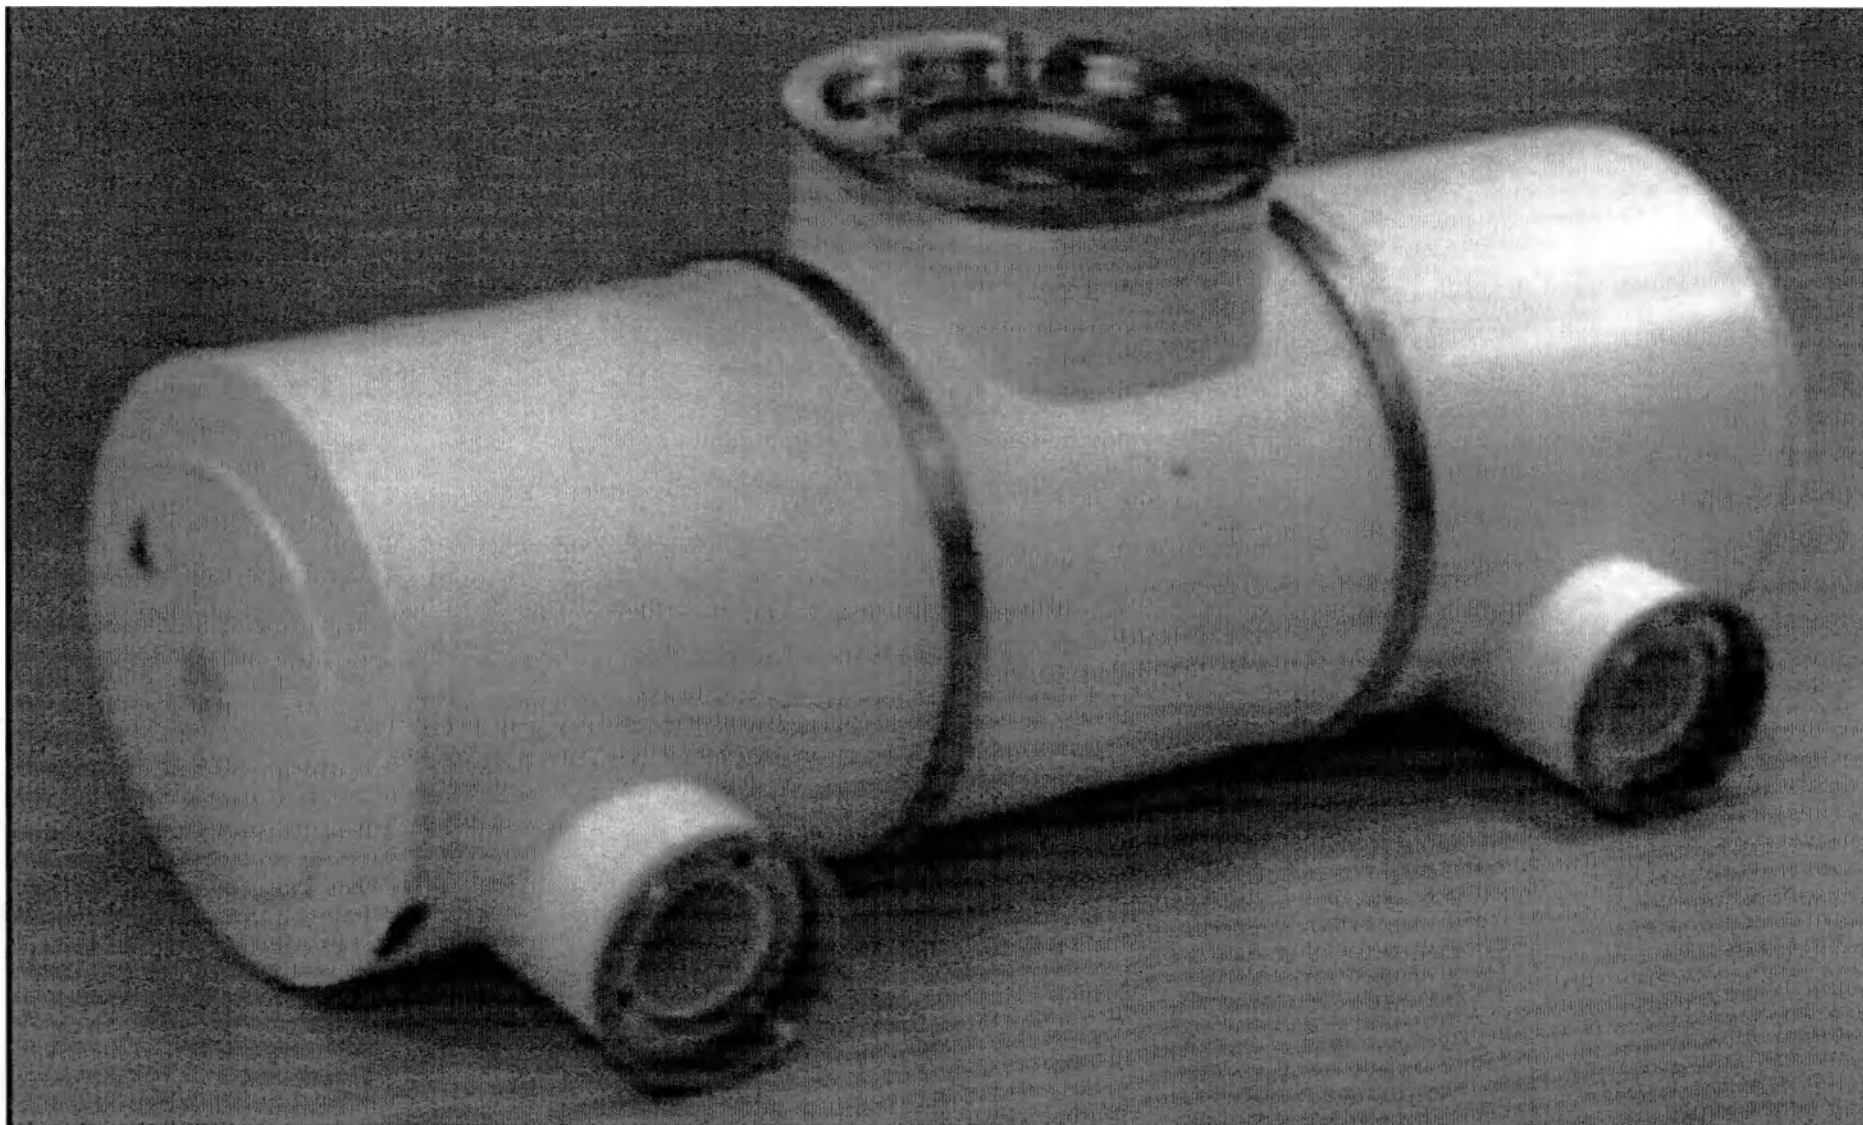

Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой SV 150/40/80HC-100 или SV 150/40/80C-100
производства Siemens, Германия

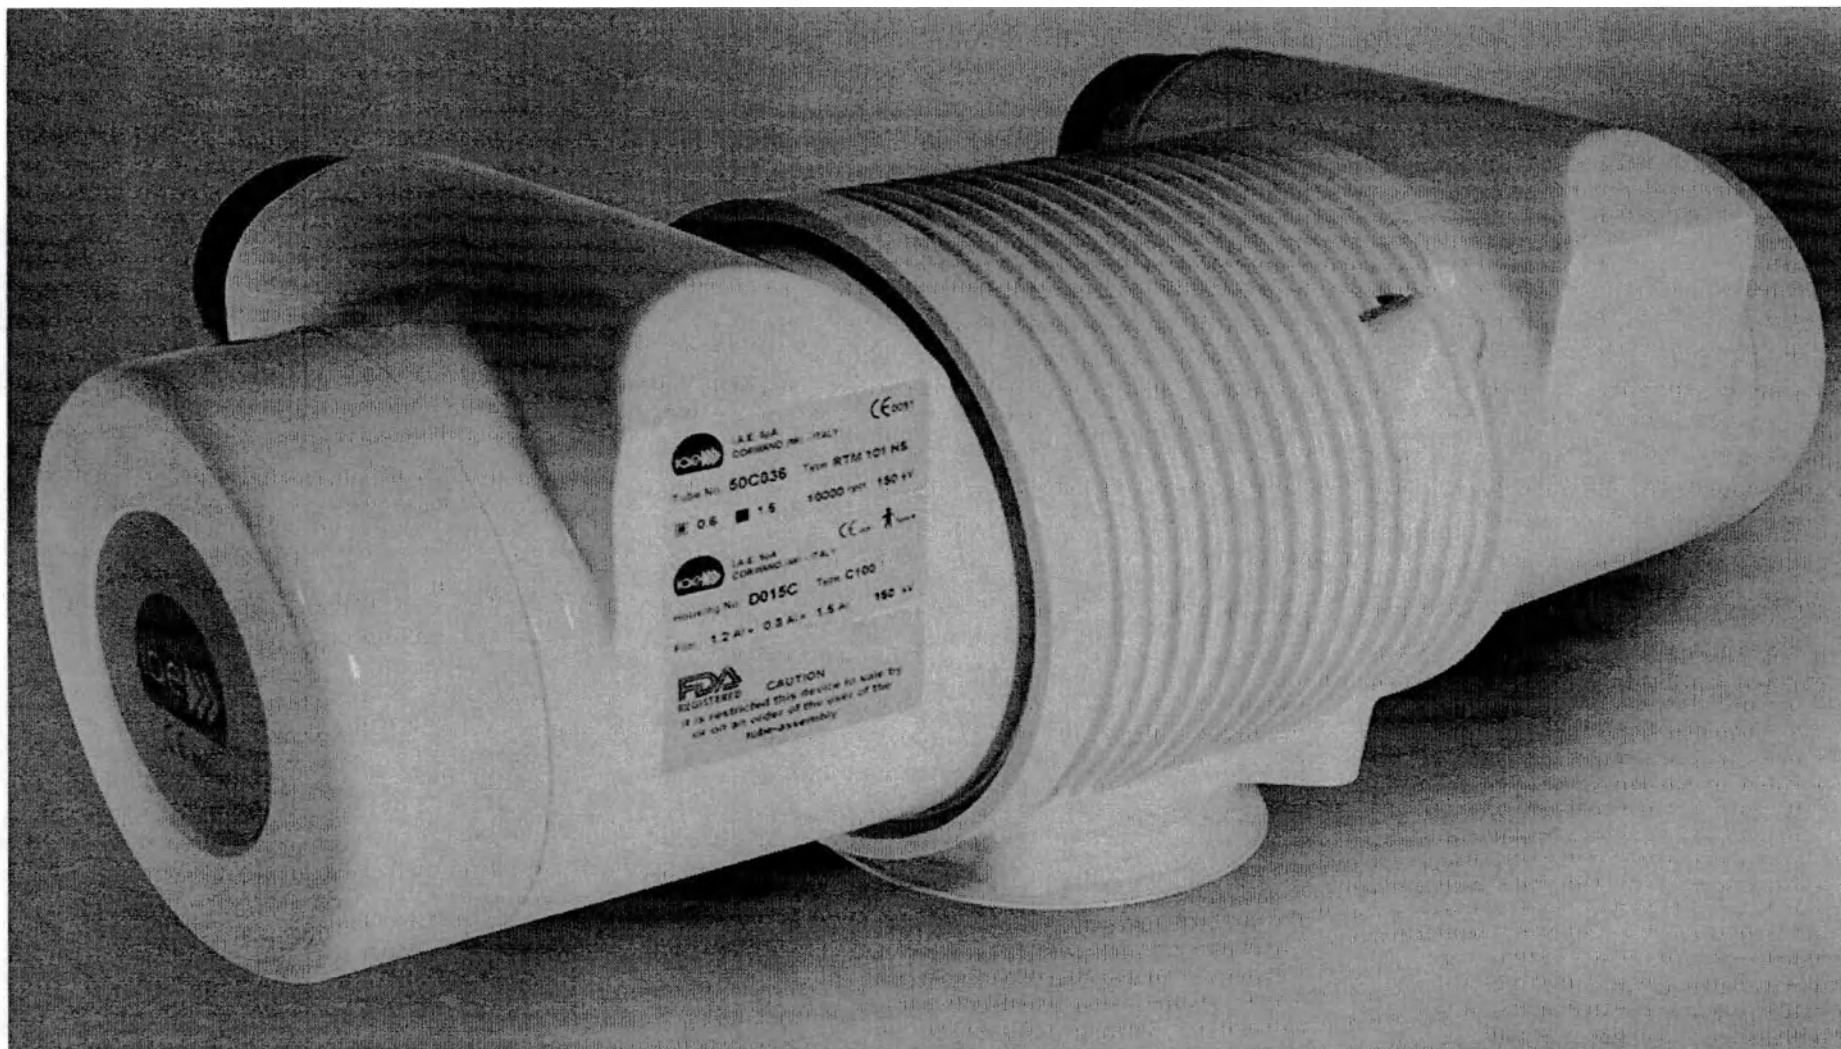

Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой серии RTM101HS, серии RTC600HS, серии RTC700HS, производства IAE Spa, Италия

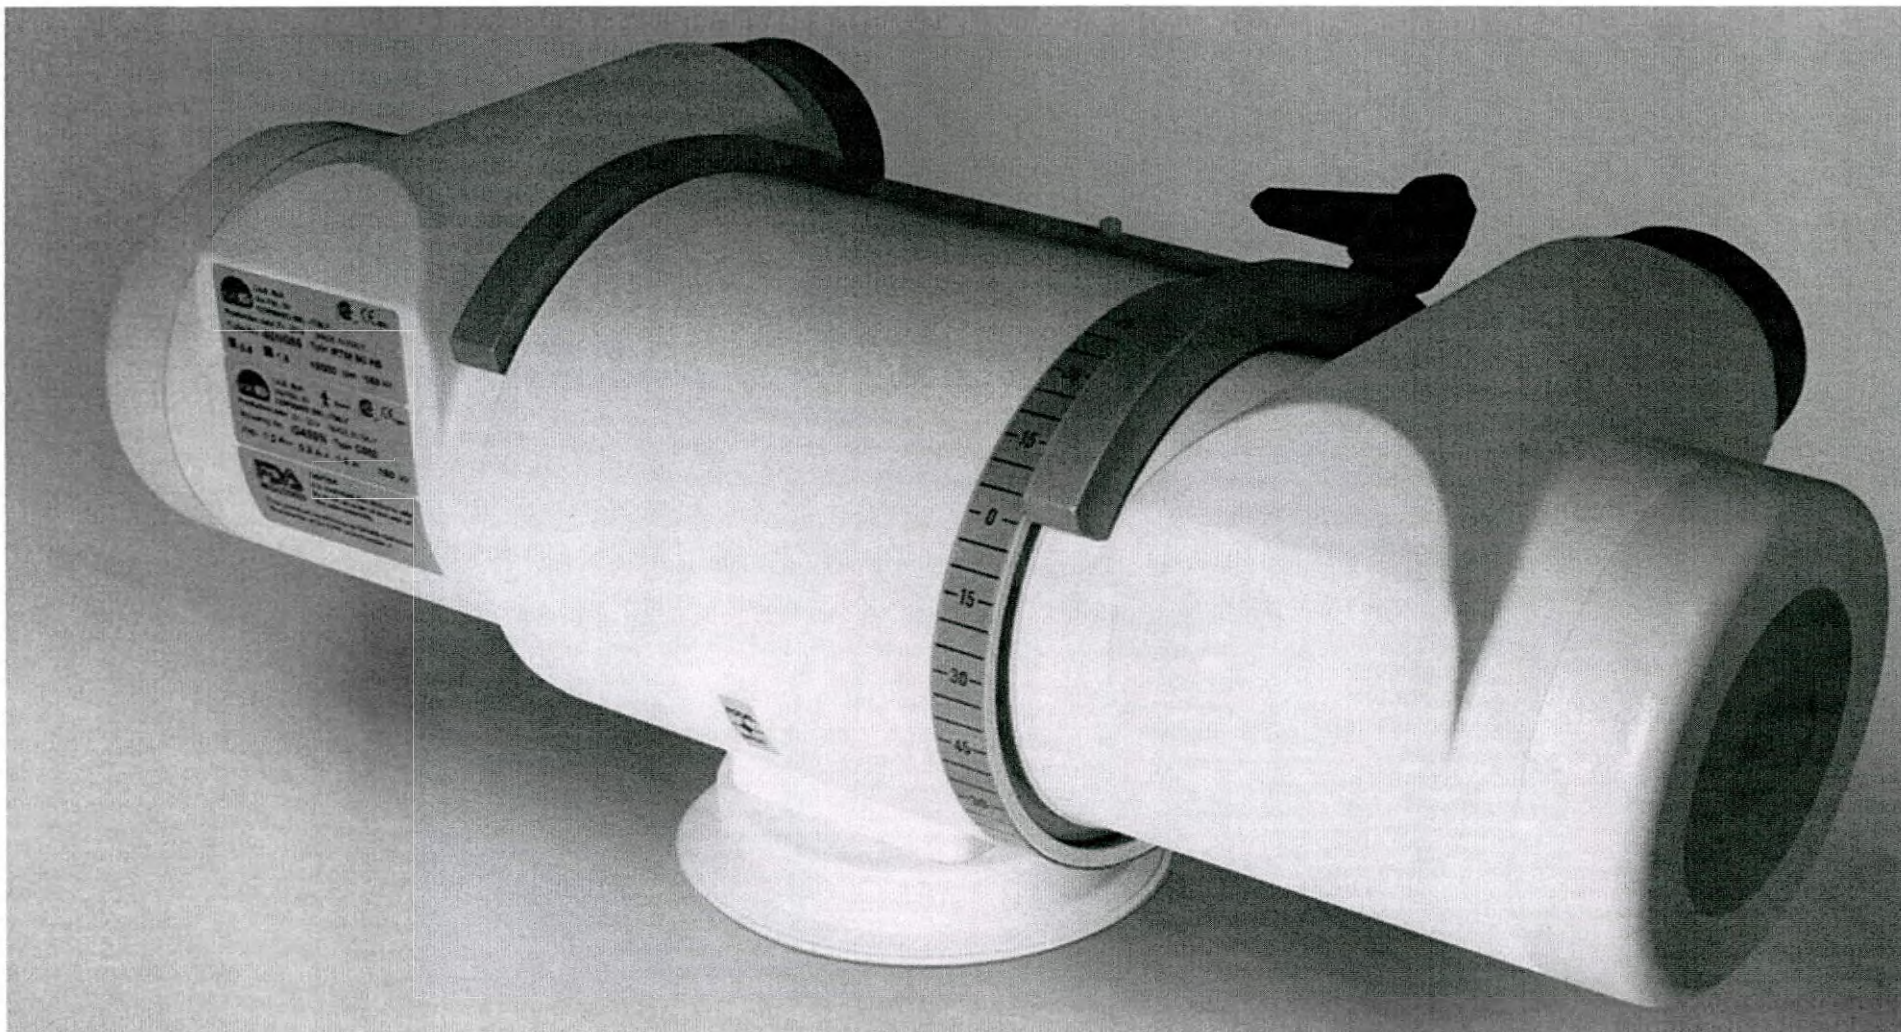


Излучатель рентгеновский с рентгеновской трубкой серии RTM782HS, производства IAE S.p.A, Италия




Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии R 221, производства Ralco srl., Италия



Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением R 225, производства Ralco srl., Италия

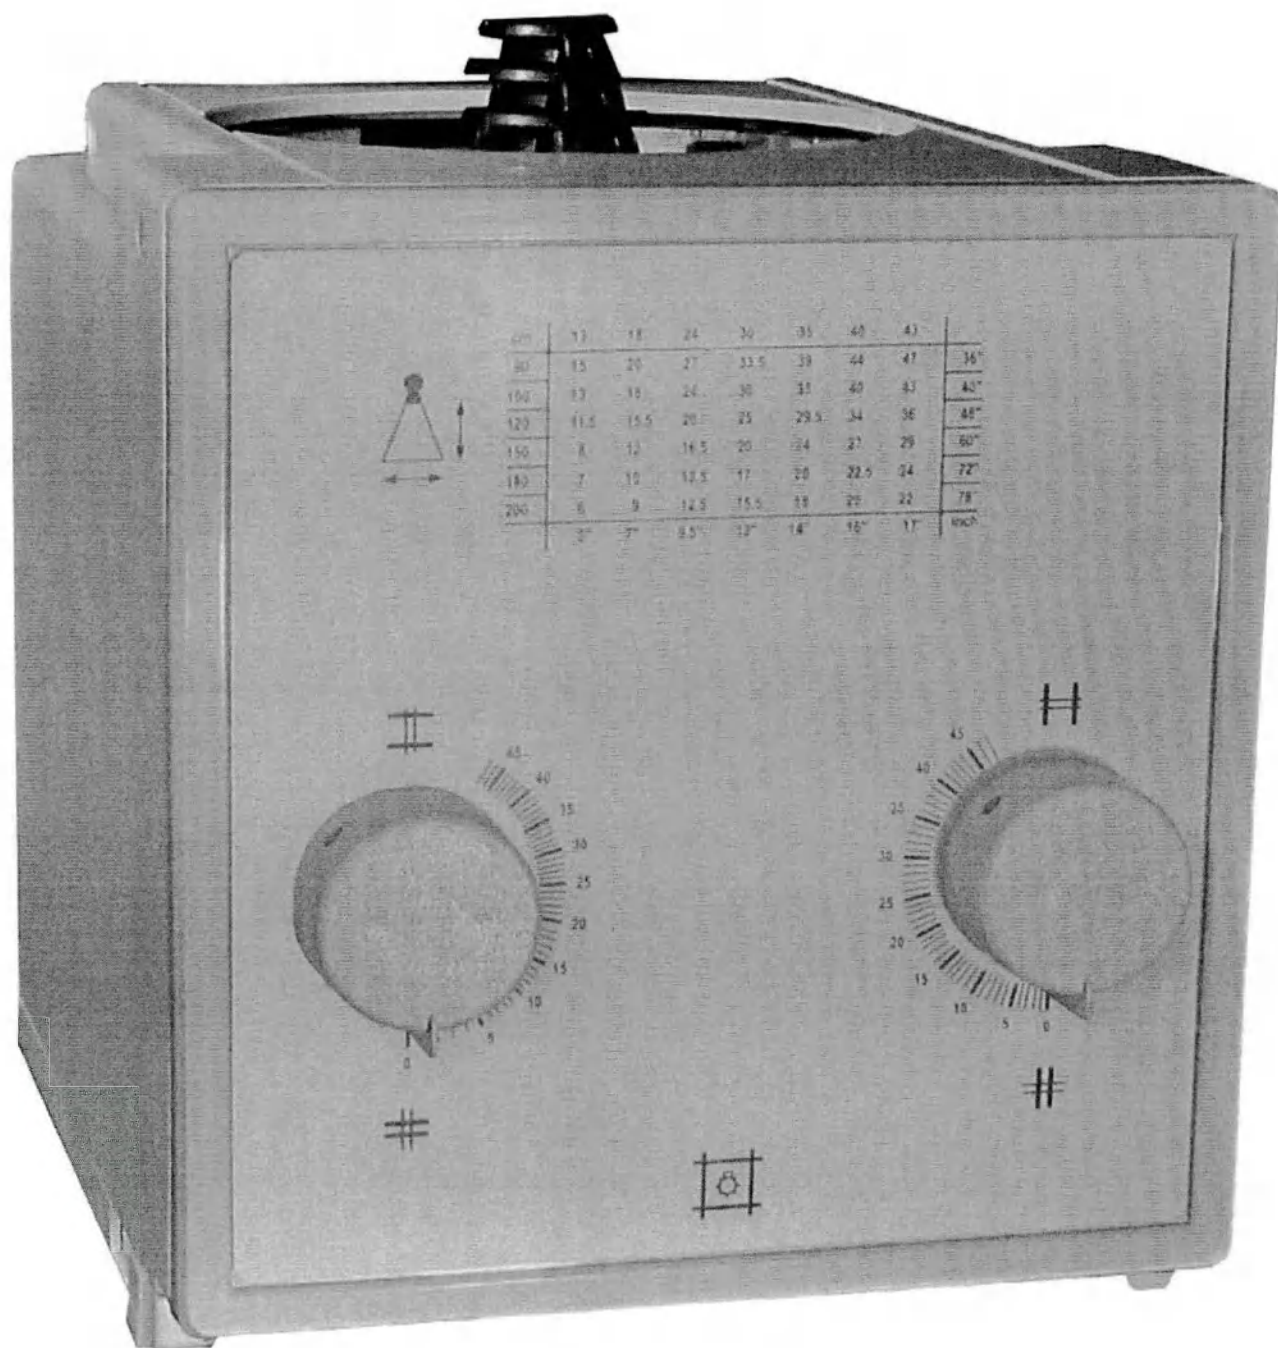

Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением R 302, производства Ralco srl., Италия

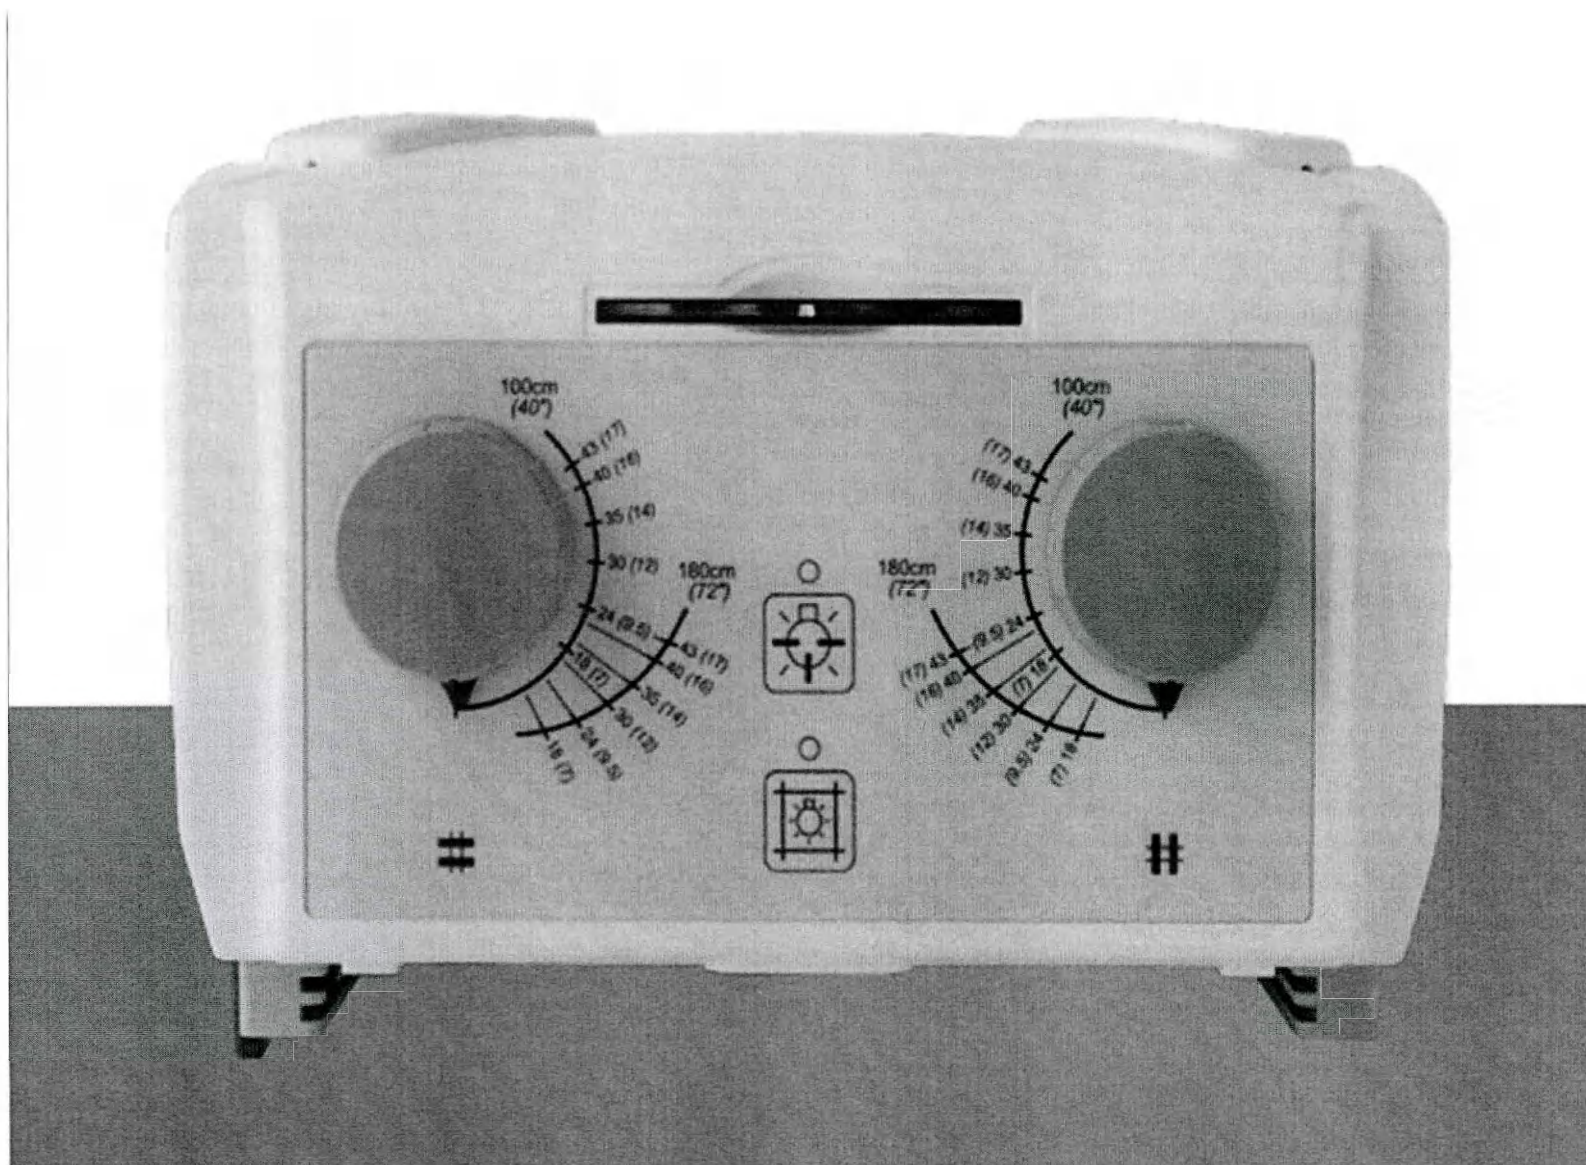


Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии Optica 10 или серии Optica 20, производства Varex Imaging Nederland B.V., Цирмины или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation.




Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии Optica 30, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging




Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим или ручным управлением серии Optica 40, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины

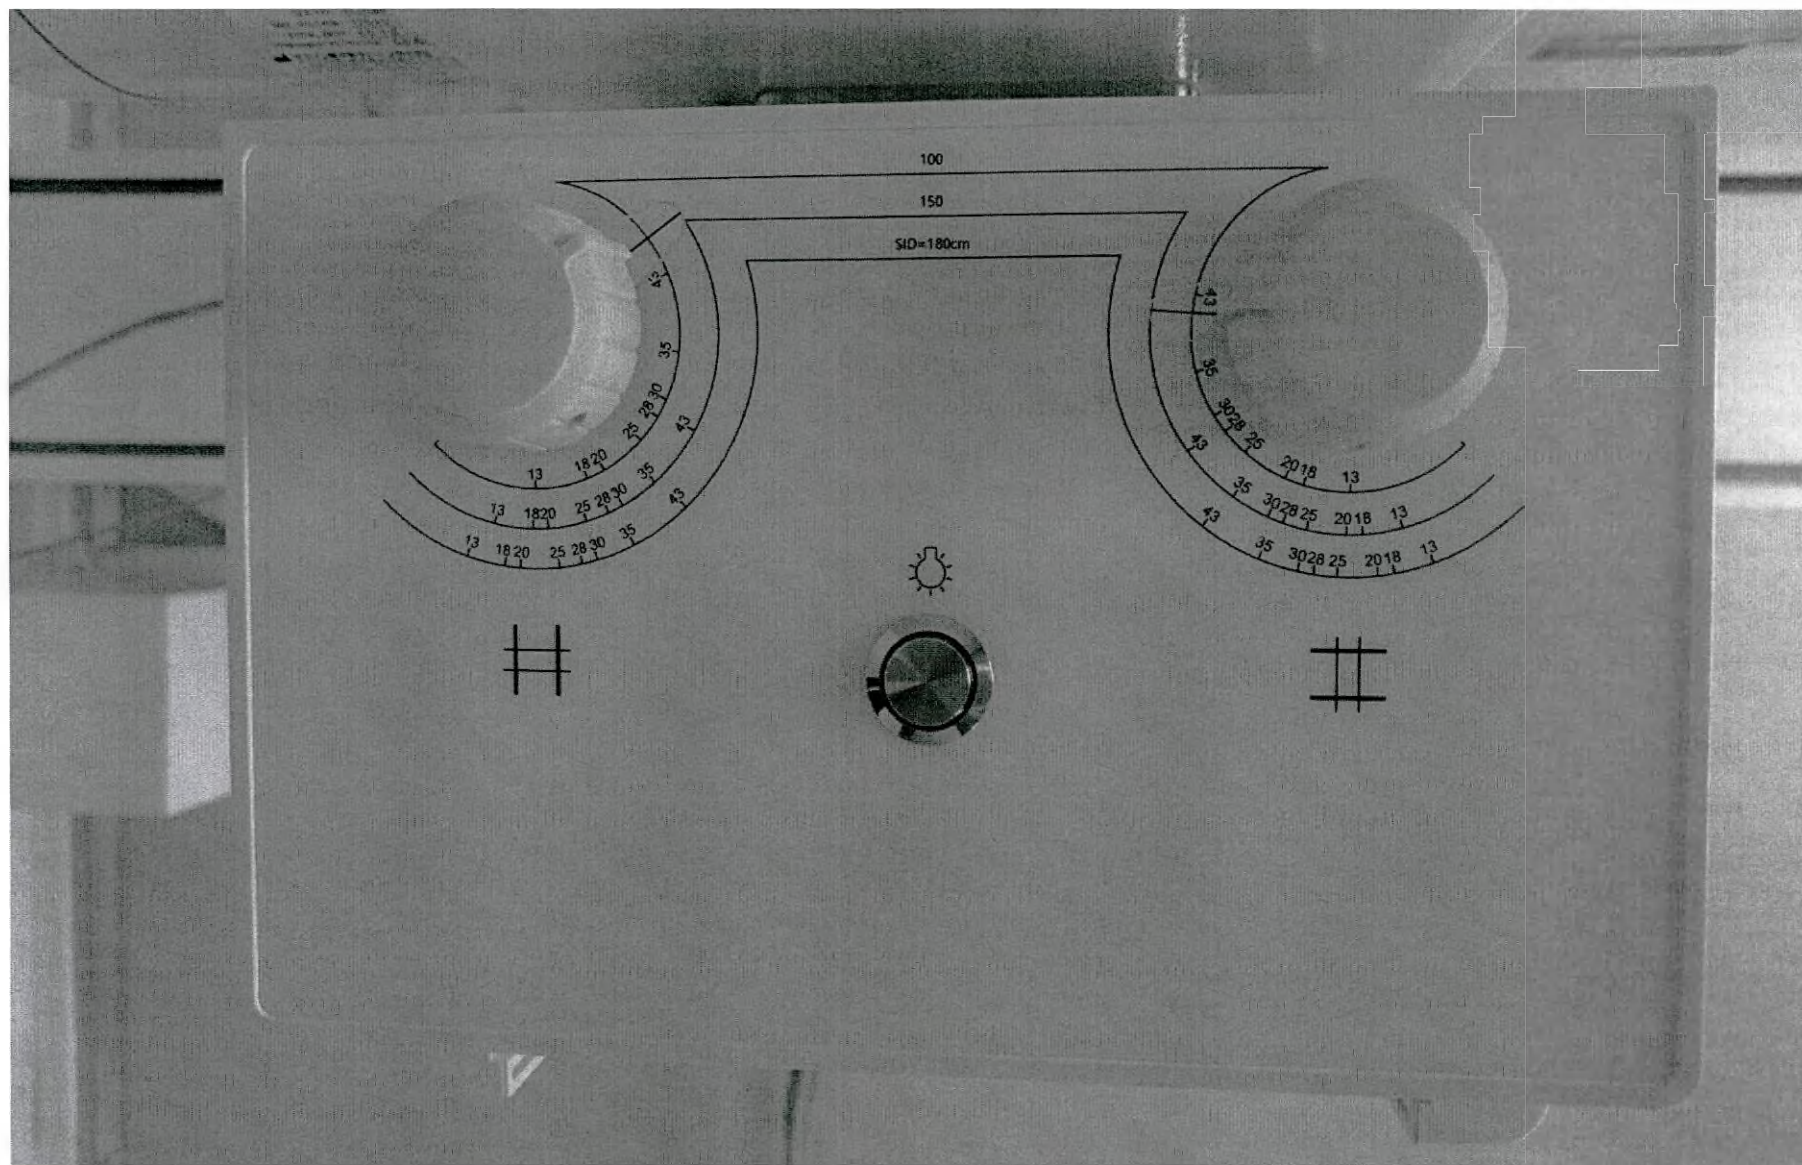

Коллиматор с соединительными элементами, с ручным управлением CRUX FR04, производства
Fairy Medical Electrics (Jiaxing) Co., Ltd, Китай

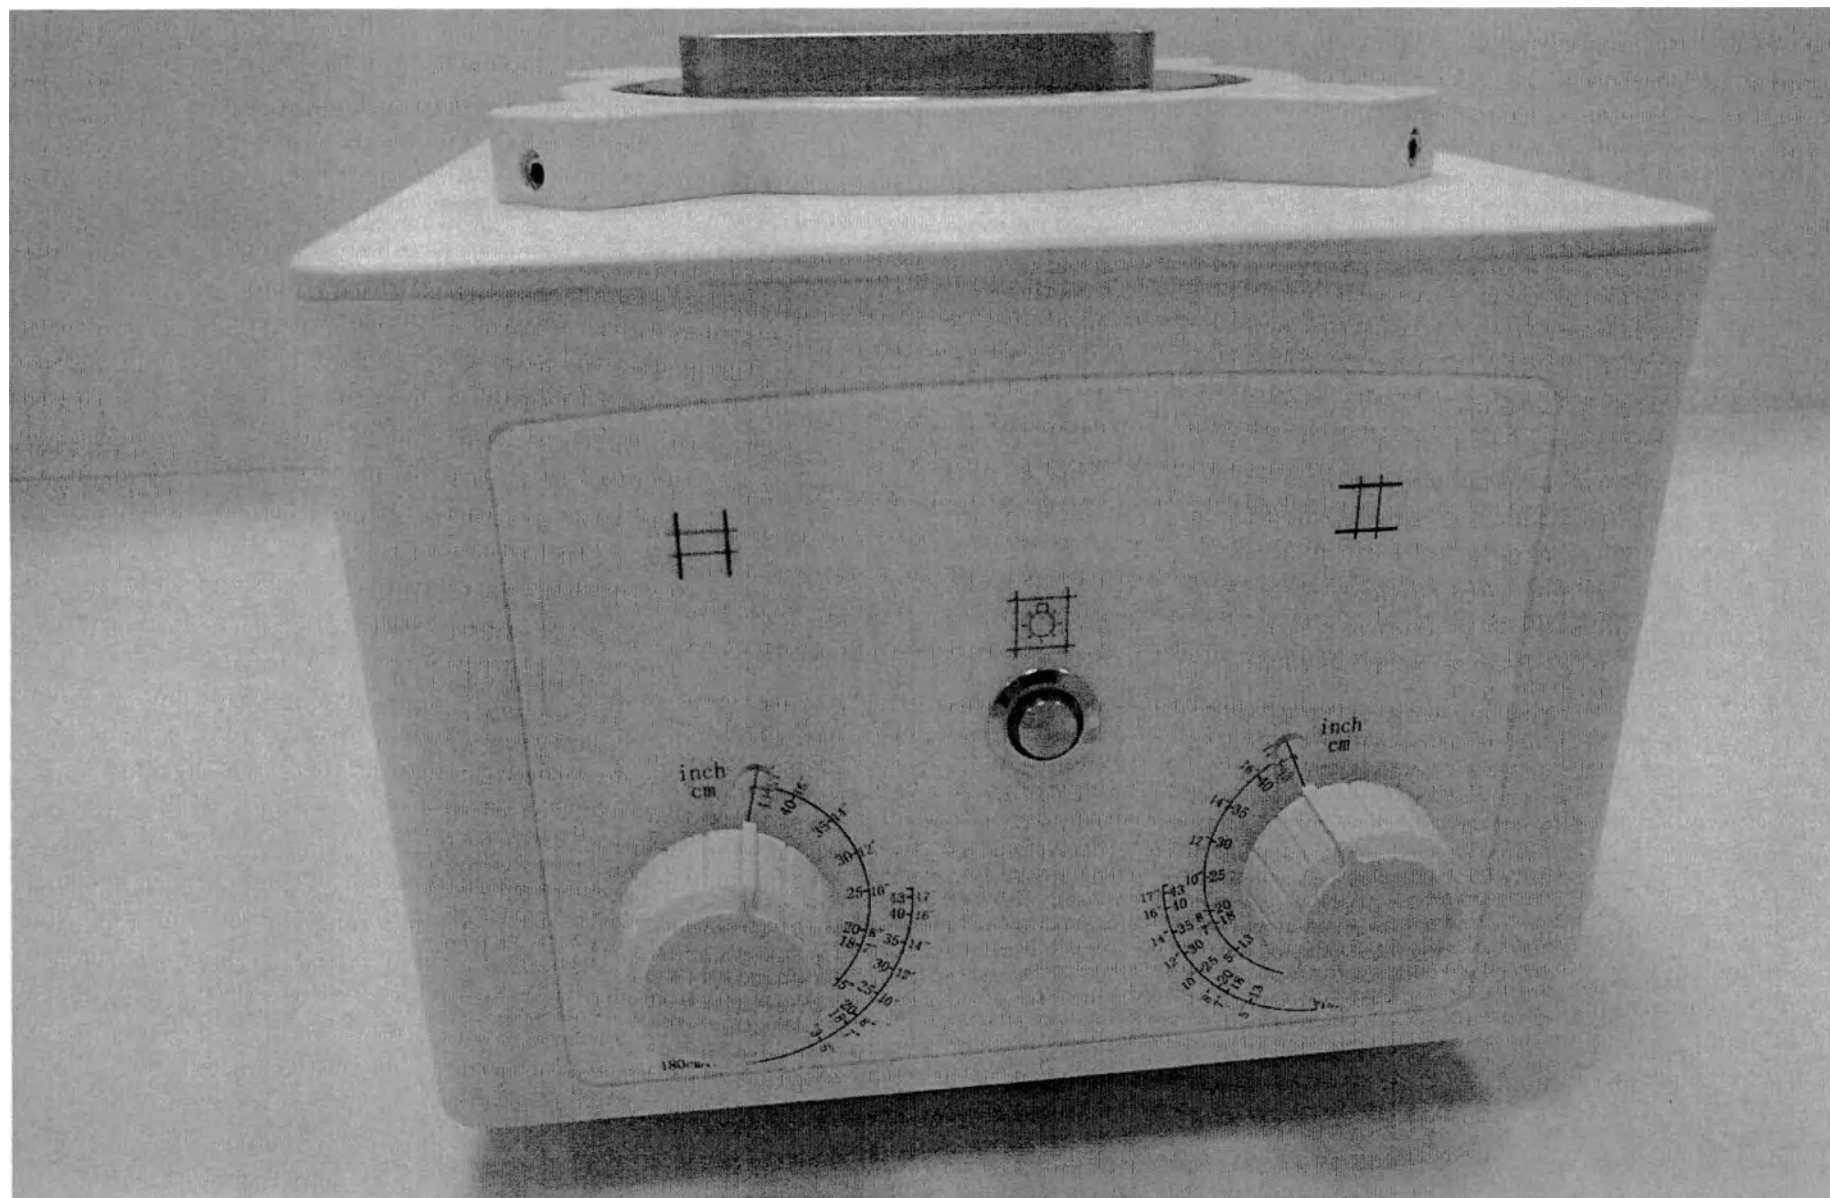


**Коллиматор с соединительными элементами, с ручным управлением CRUX FR10, производства
Fairy Medical Electrics (Jiaxing) Co., Ltd, Китай**

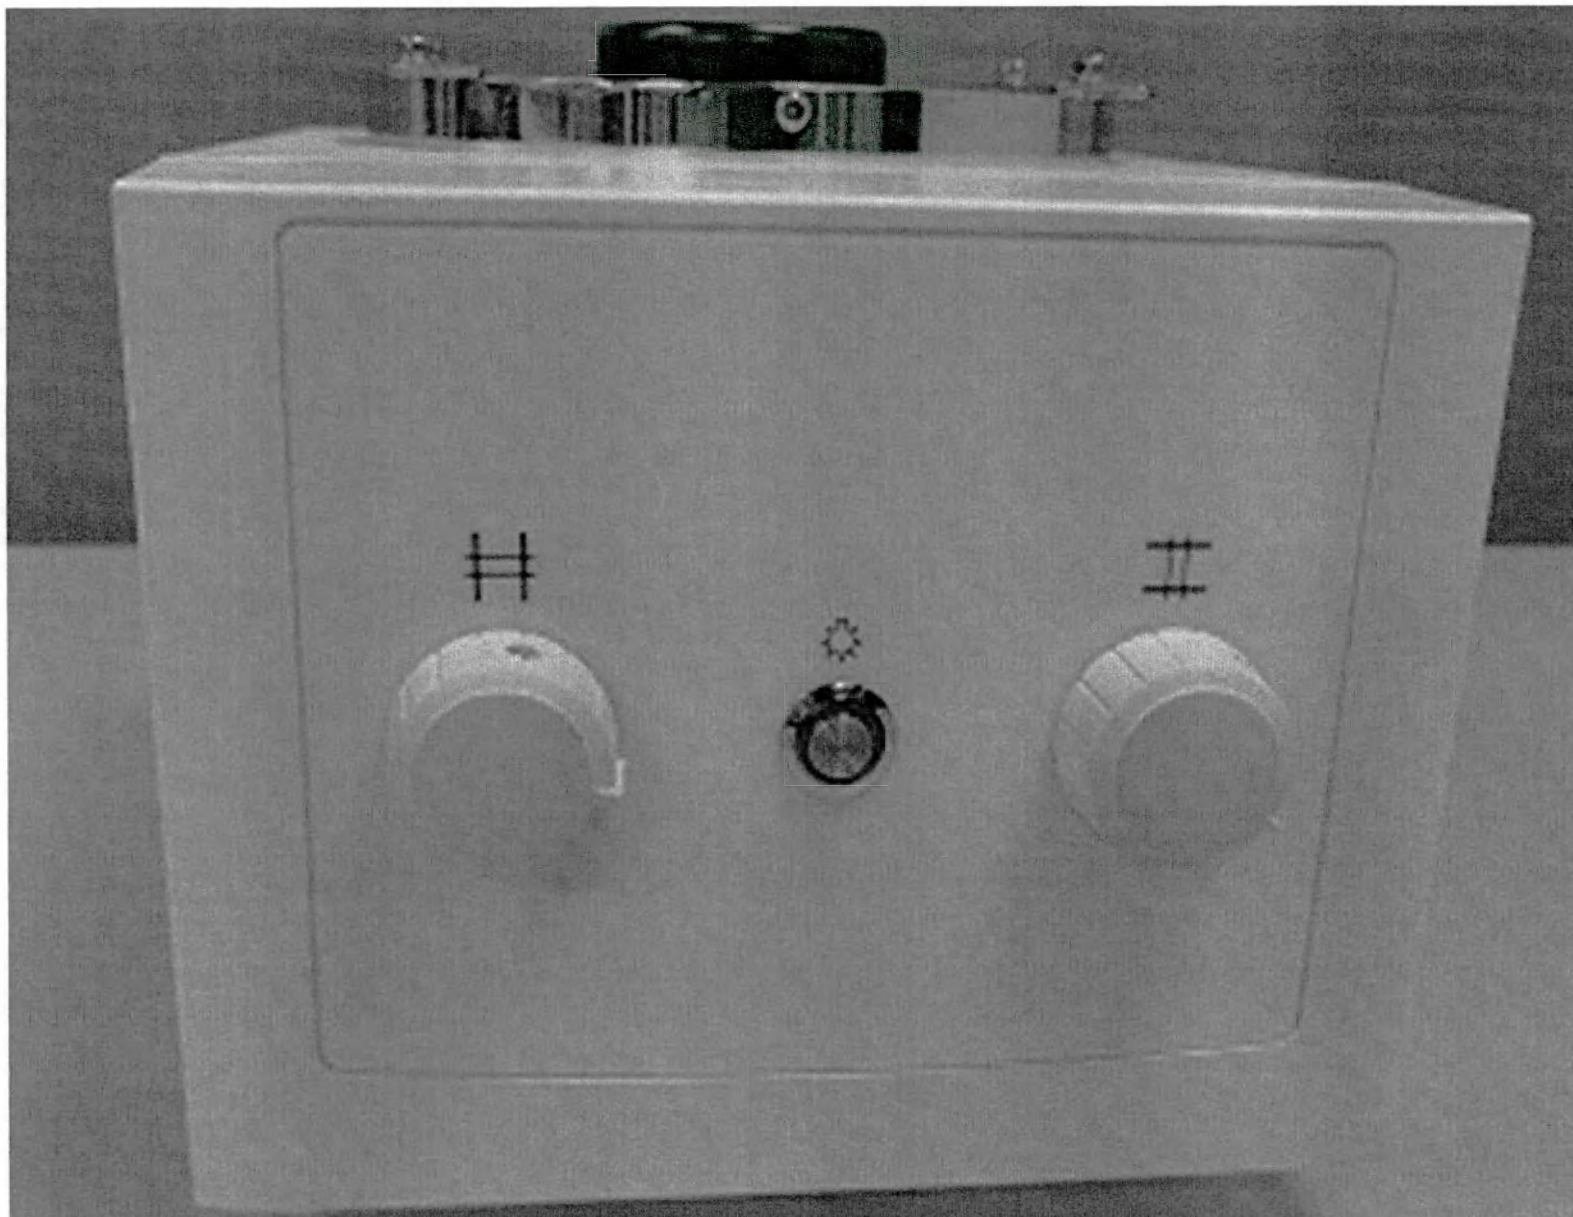


Коллиматор с соединительными элементами, с автоматическим управлением CRUX RF10,
производства Fairy Medical Electrics (Jiaxing) Co., Ltd, Китай




Комплекс аппаратно-программный для регистрации и обработки рентгеновских изображений
«СОЛО ДР-МТ», производства АО «МТЛ», Россия

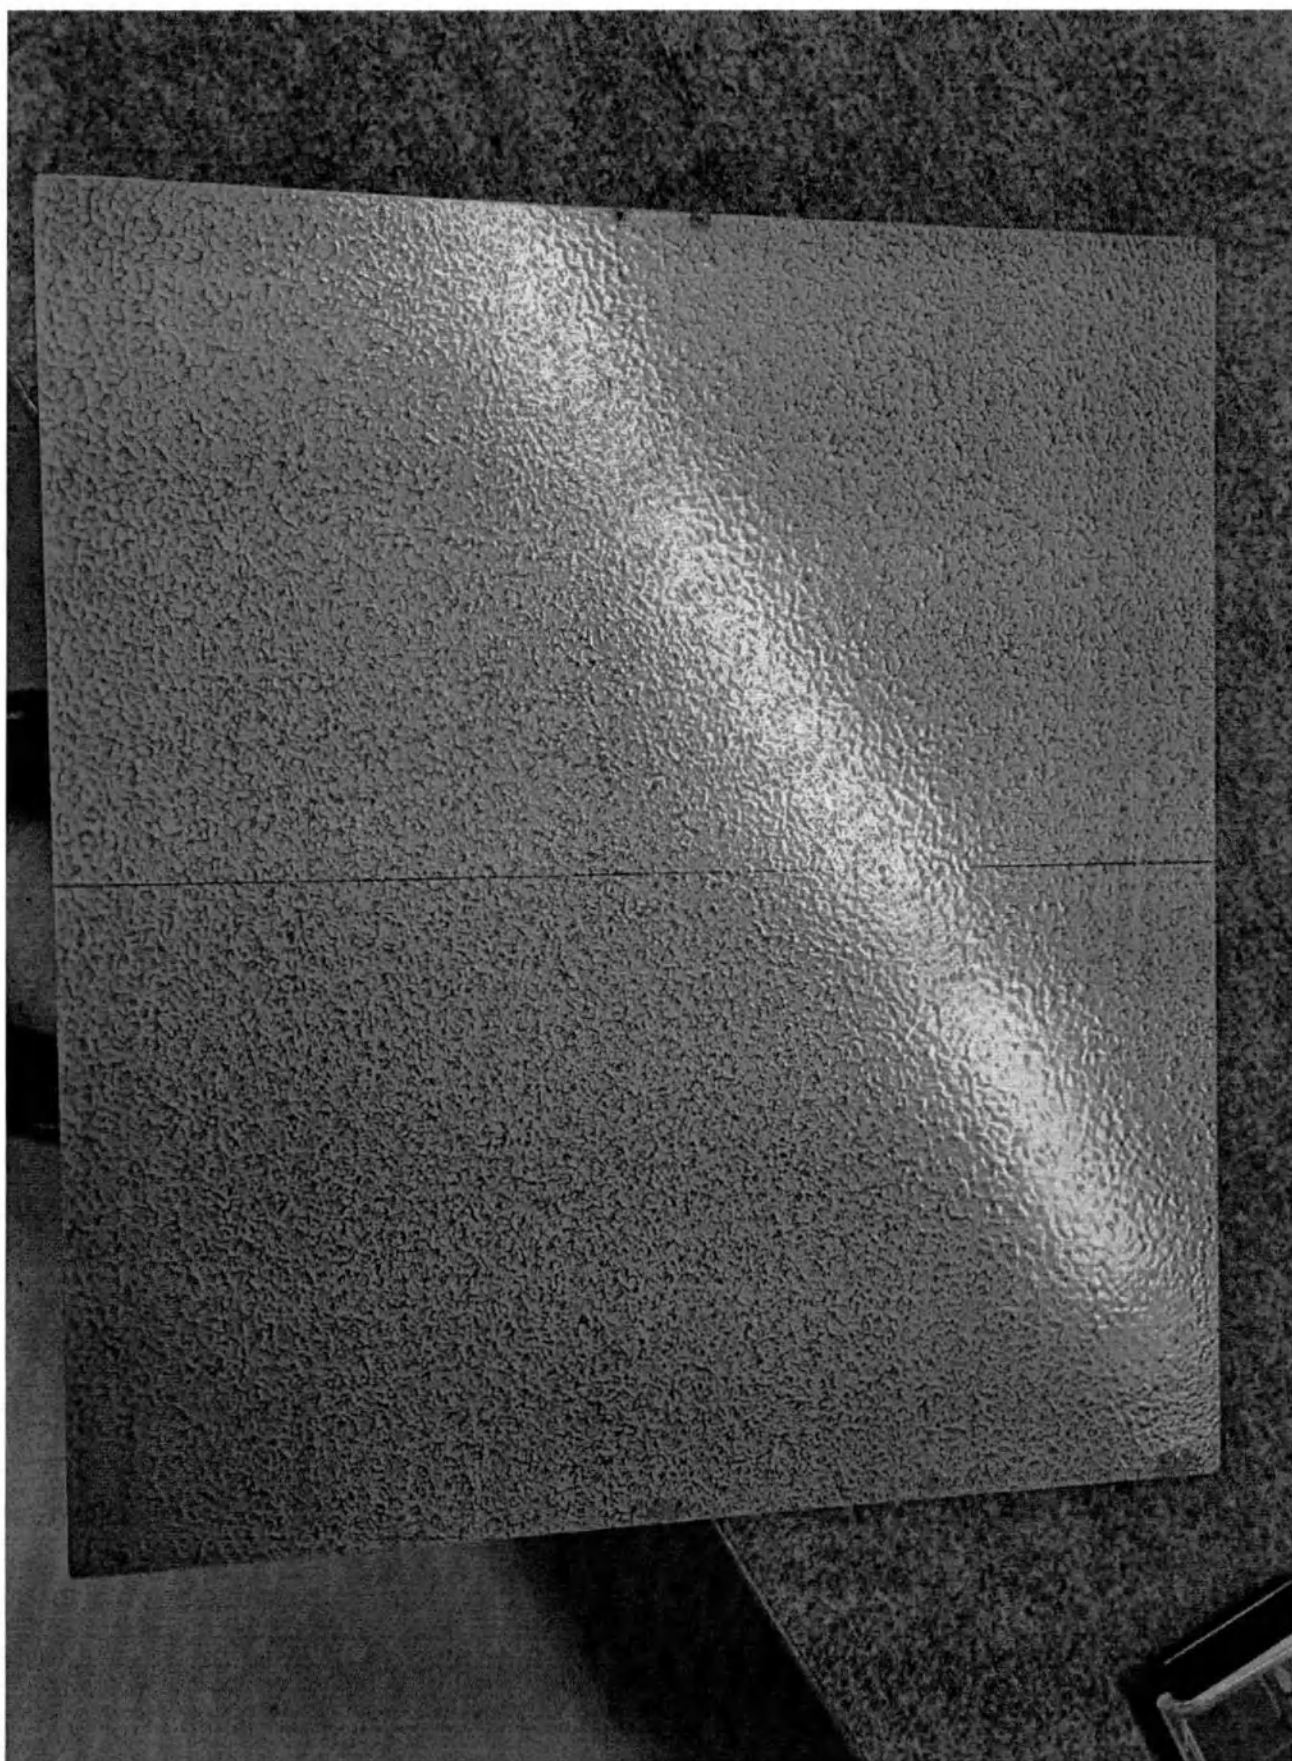


Растр рентгеновский отсеивающий Lysholm, производства Gridline А.В., Швеция

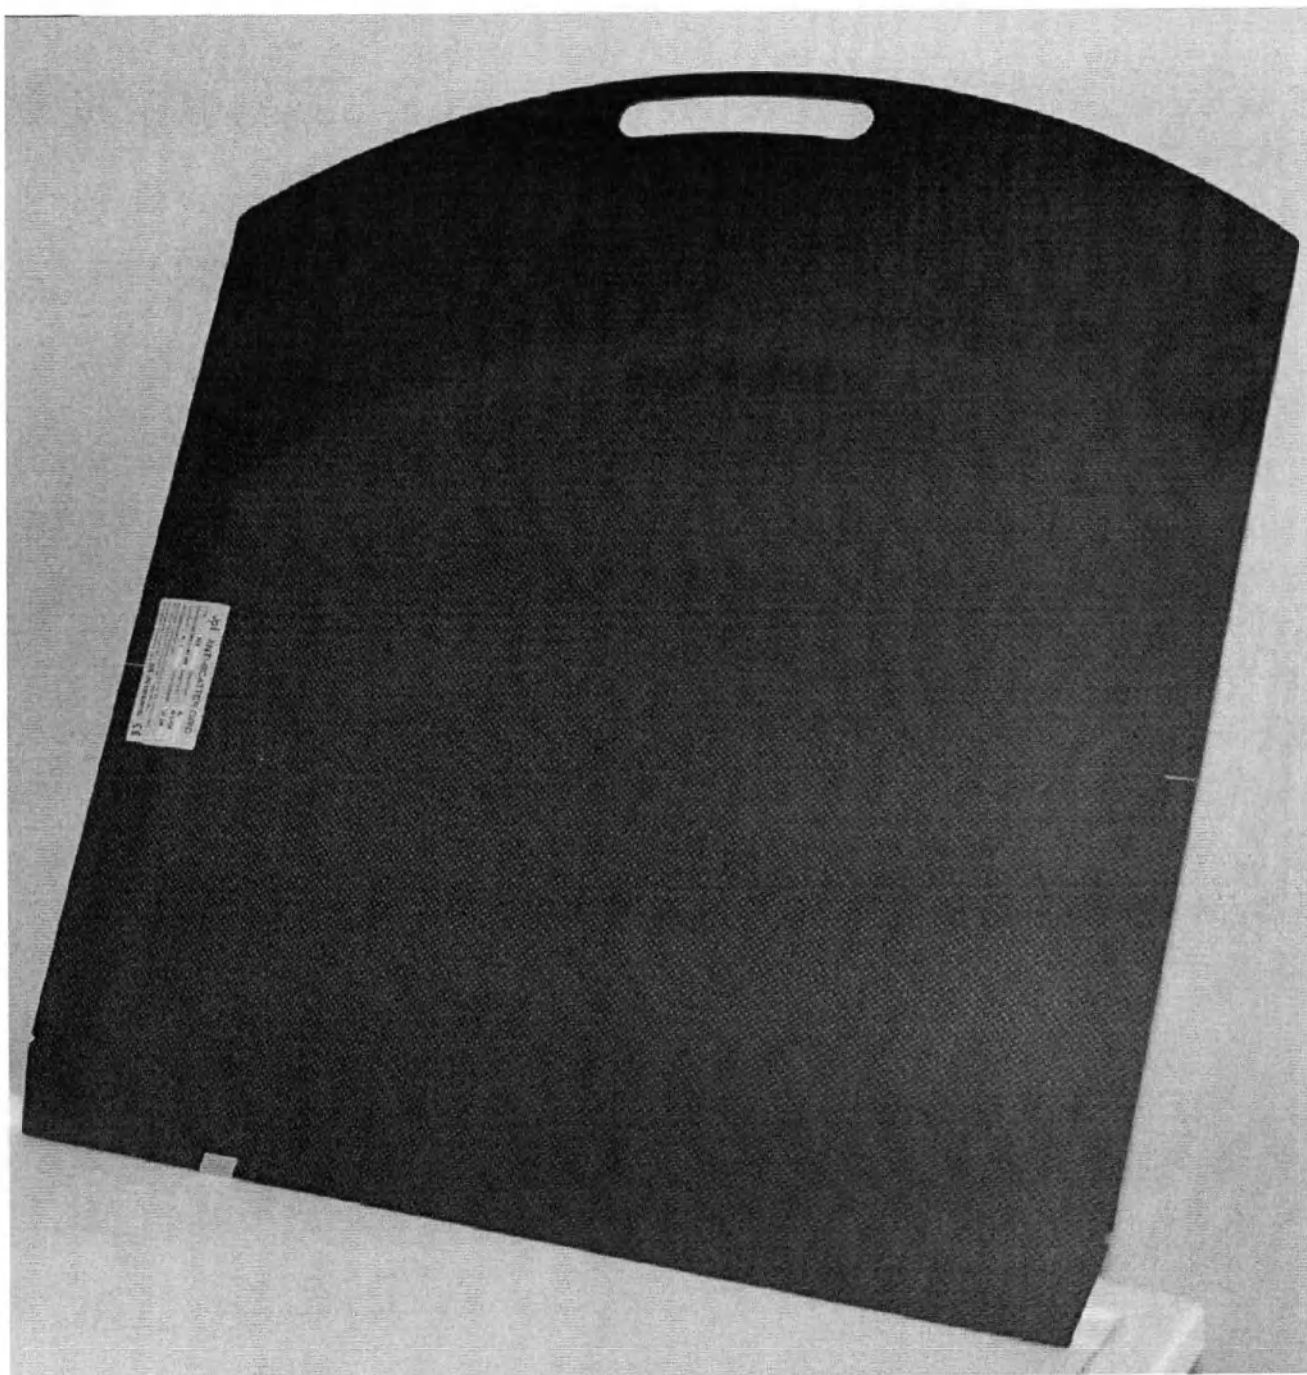


Растр рентгеновский отсеивающий JPI, производства JPI Healthcare Co., Ltd, Республика Корея

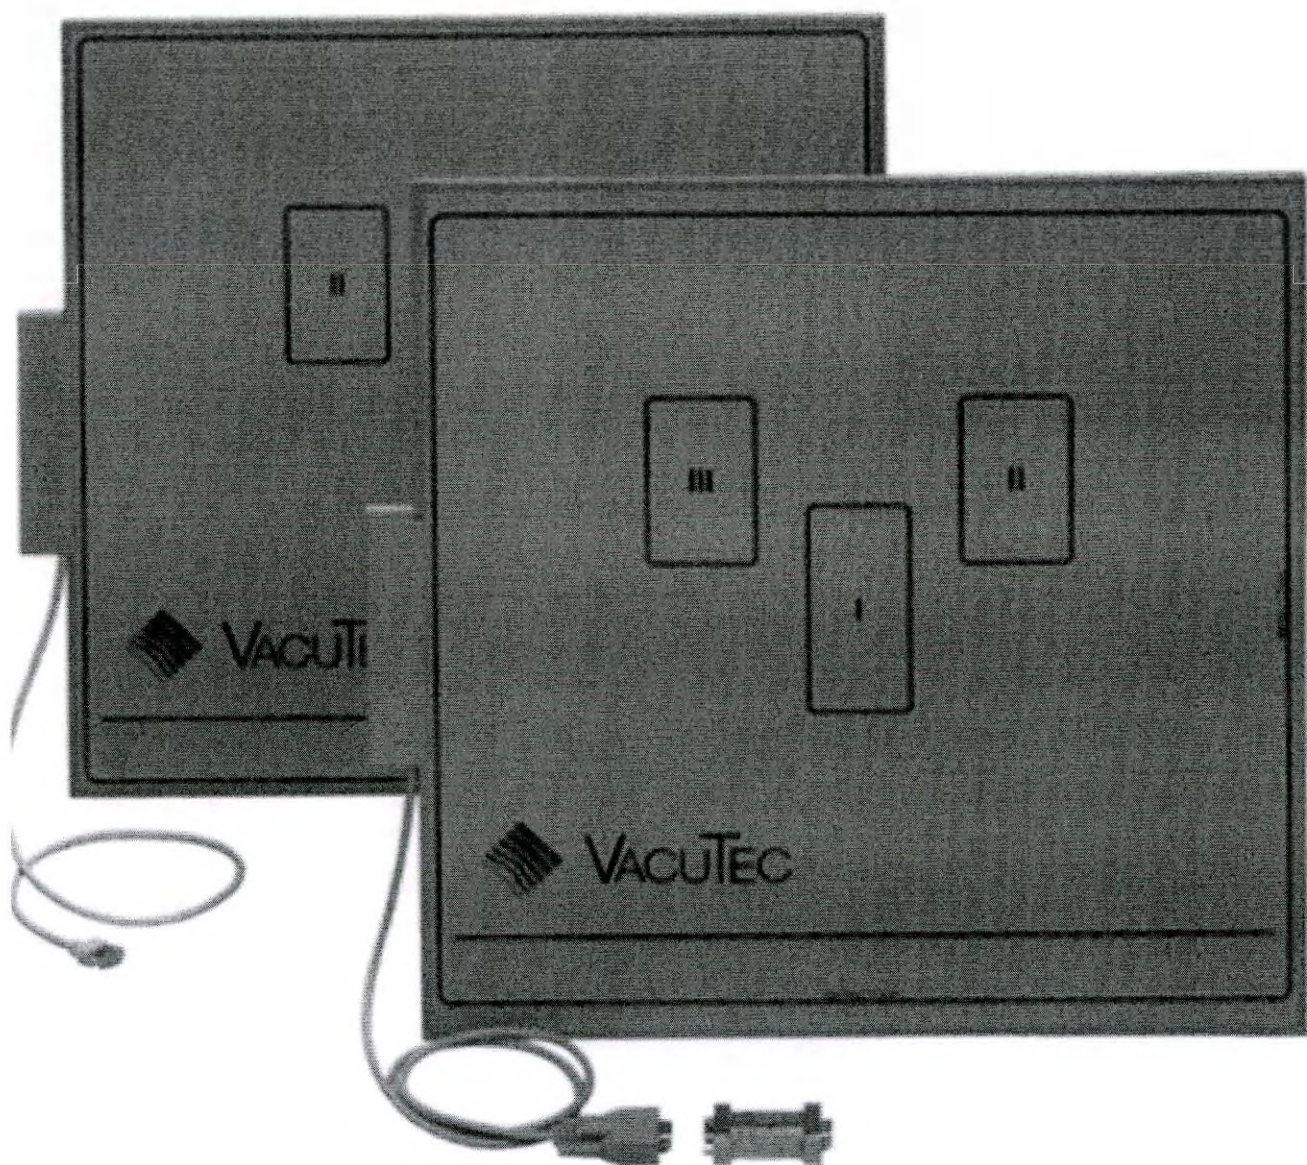

Ионизационная камера серии 70, производства VacuTec, Meßtechnik GmbH, Германия

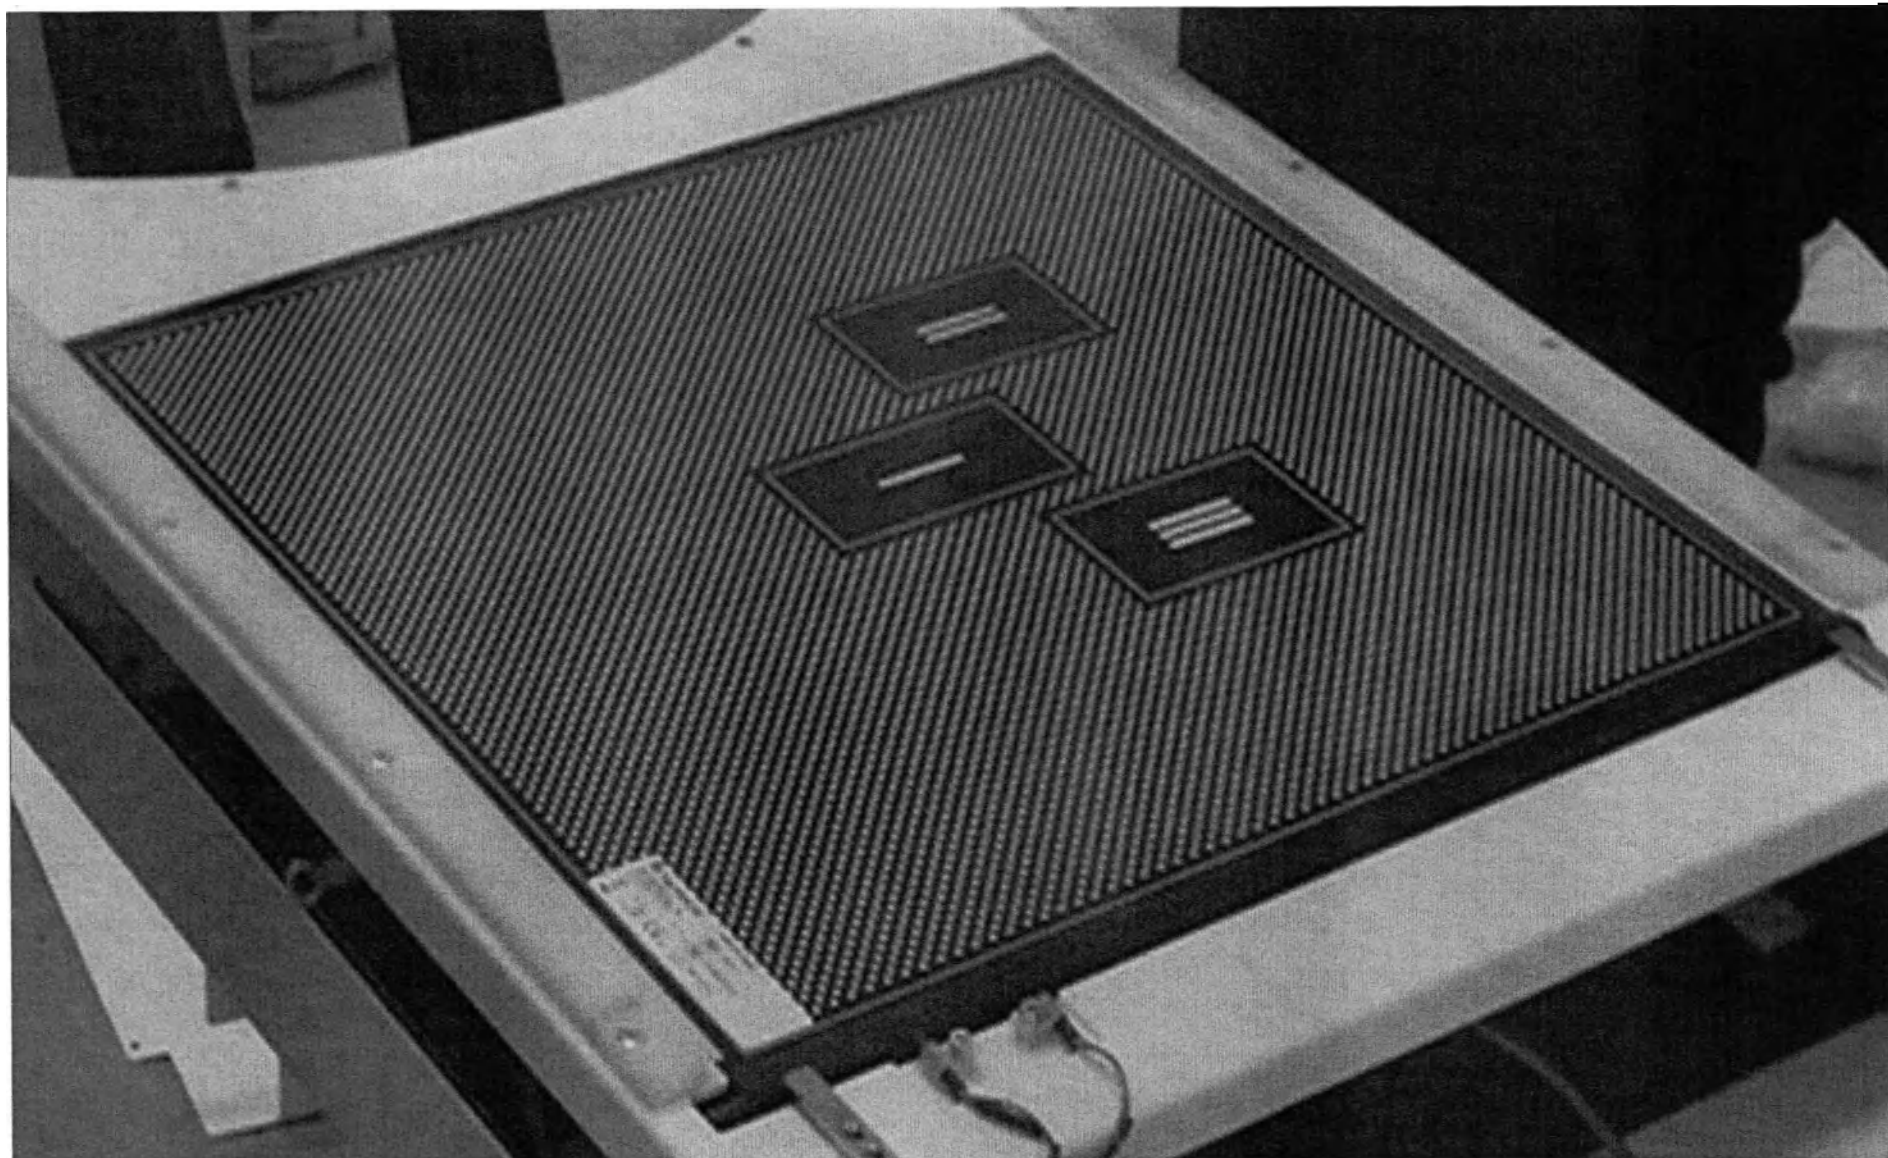


**Ионизационная камера серии SSMC, производства Varex Imaging Nederland B.V., Нидерланды или
Varex Imaging Corporation, США или Varex Imaging Corporation, Филиппины**

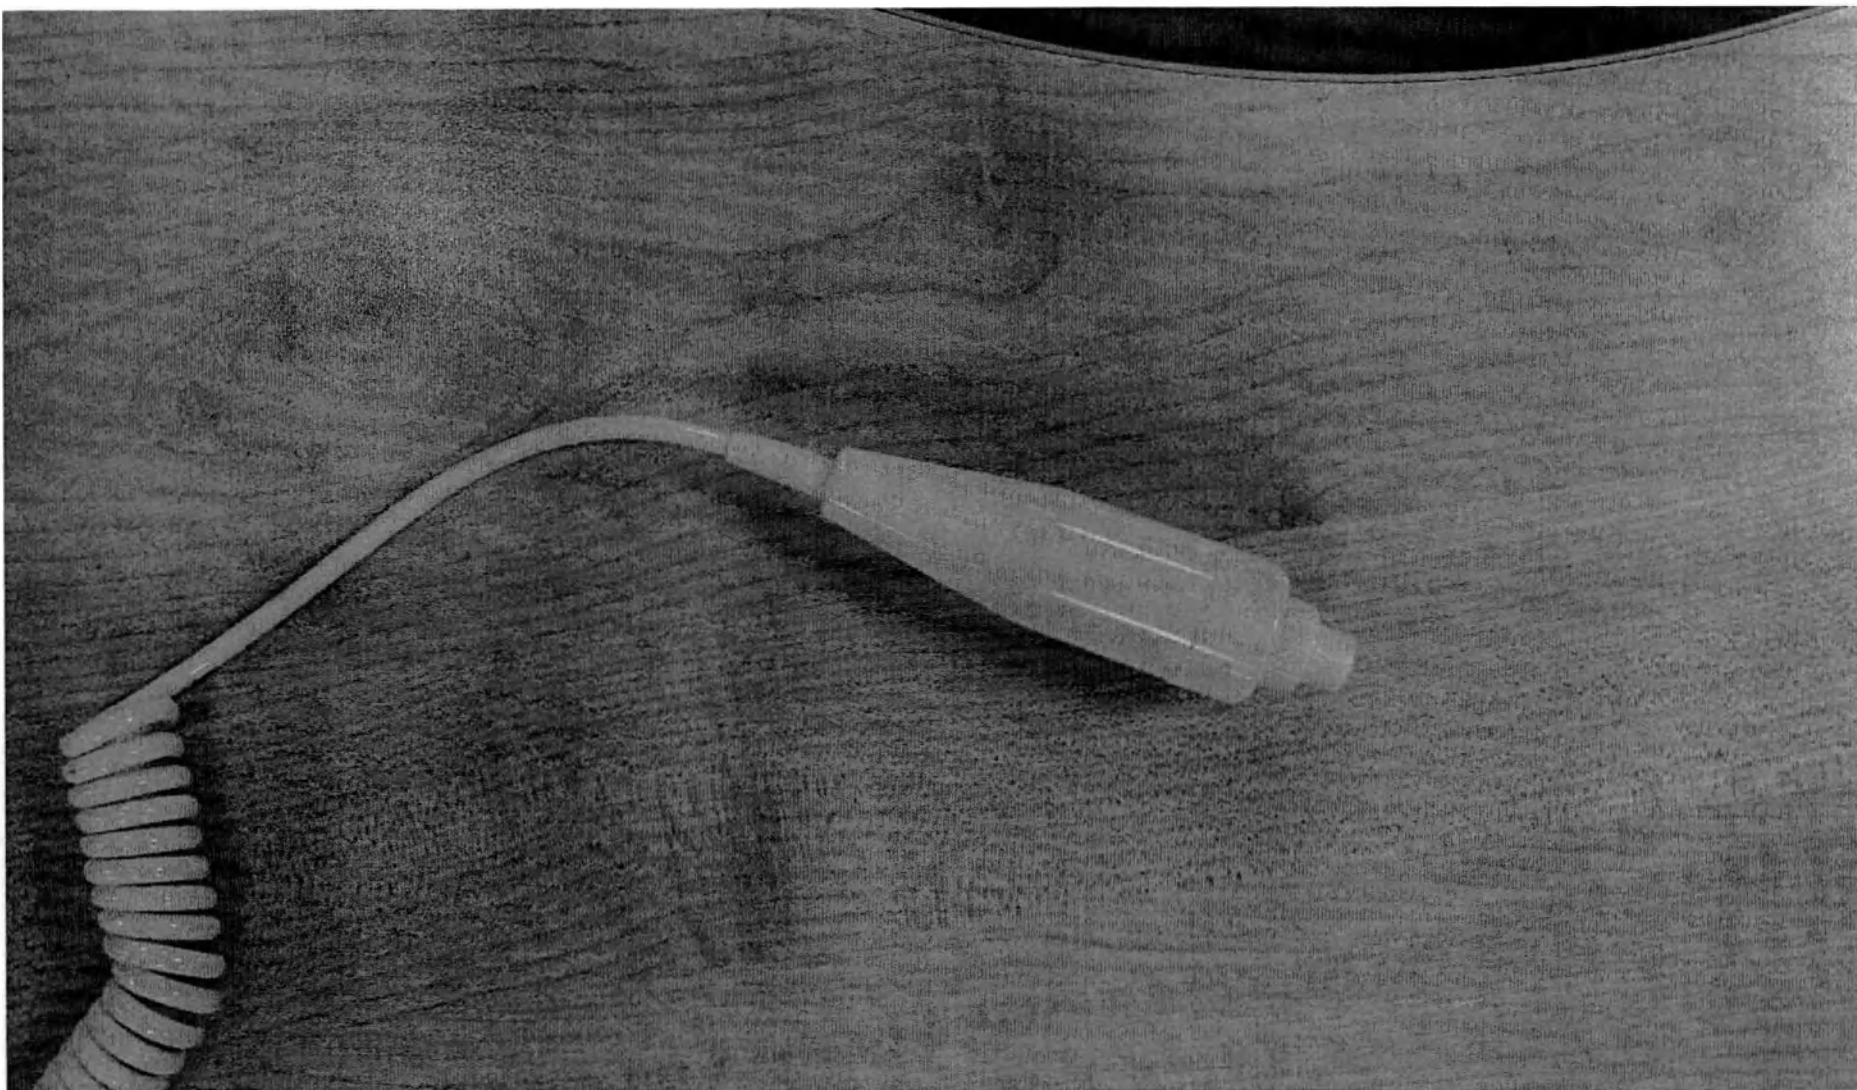

Устройство включения экспозиции, производства Dongzi Medical System Co., Китай или OMRON Corporation, Япония




Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога «ДИАРМ-МТ-Плюс», производства АО «МТЛ», Россия

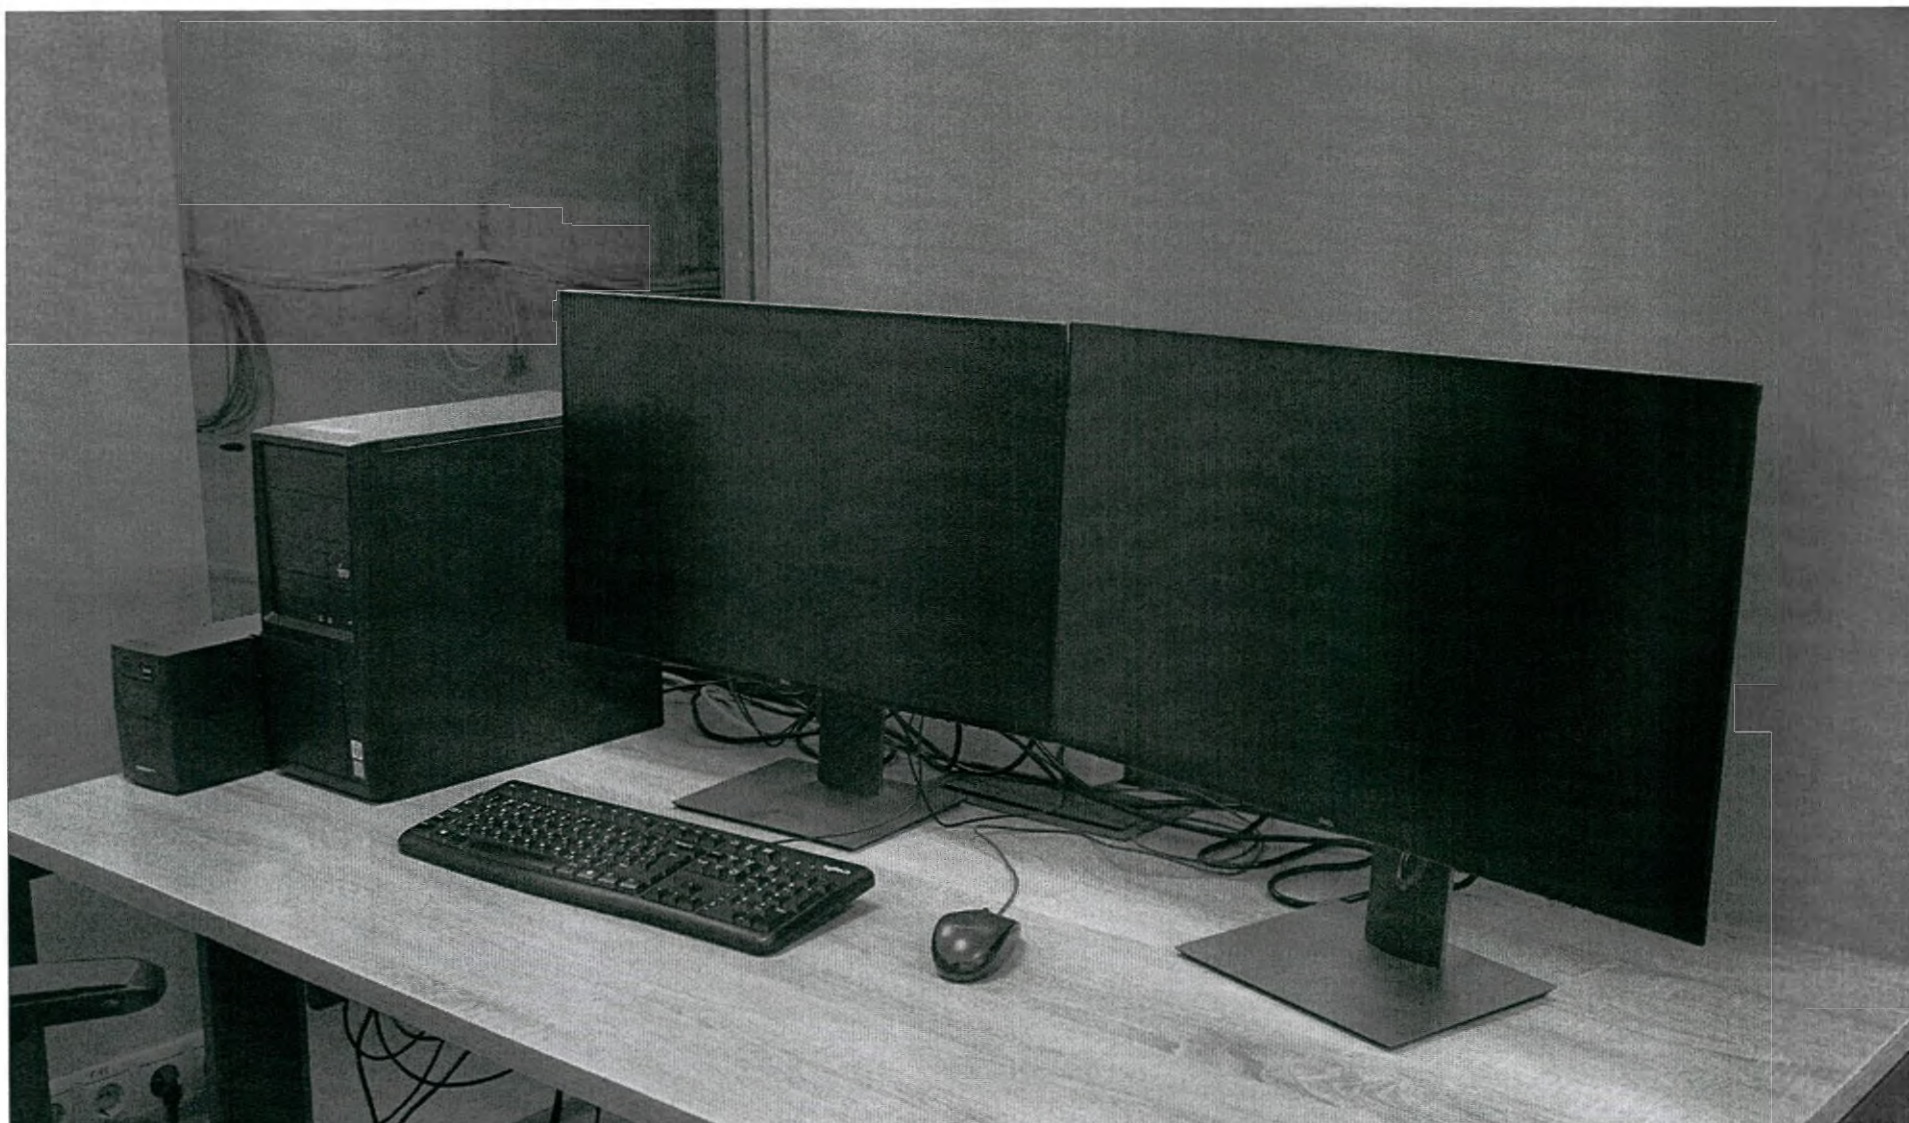

Комплексы аппаратно-программные для ввода, обработки и хранения диагностической информации в составе: АРМ врача-диагноста «Гамма Мультивокс Д1» и «Гамма Мультивокс Д2»; АРМ для просмотра изображений «Гамма Мультивокс П»; АРМ медицинской сестры/ рентгенлаборанта «Гамма Мультивокс Р» и сервер базы данных «Гамма Мультивокс С» по ТУ 9452-005-42879986-2006. производства ООО «МП НПФ «Гаммамед-П». Россия



Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии EM,
производства Tecnint HTE s.r.l., Италия

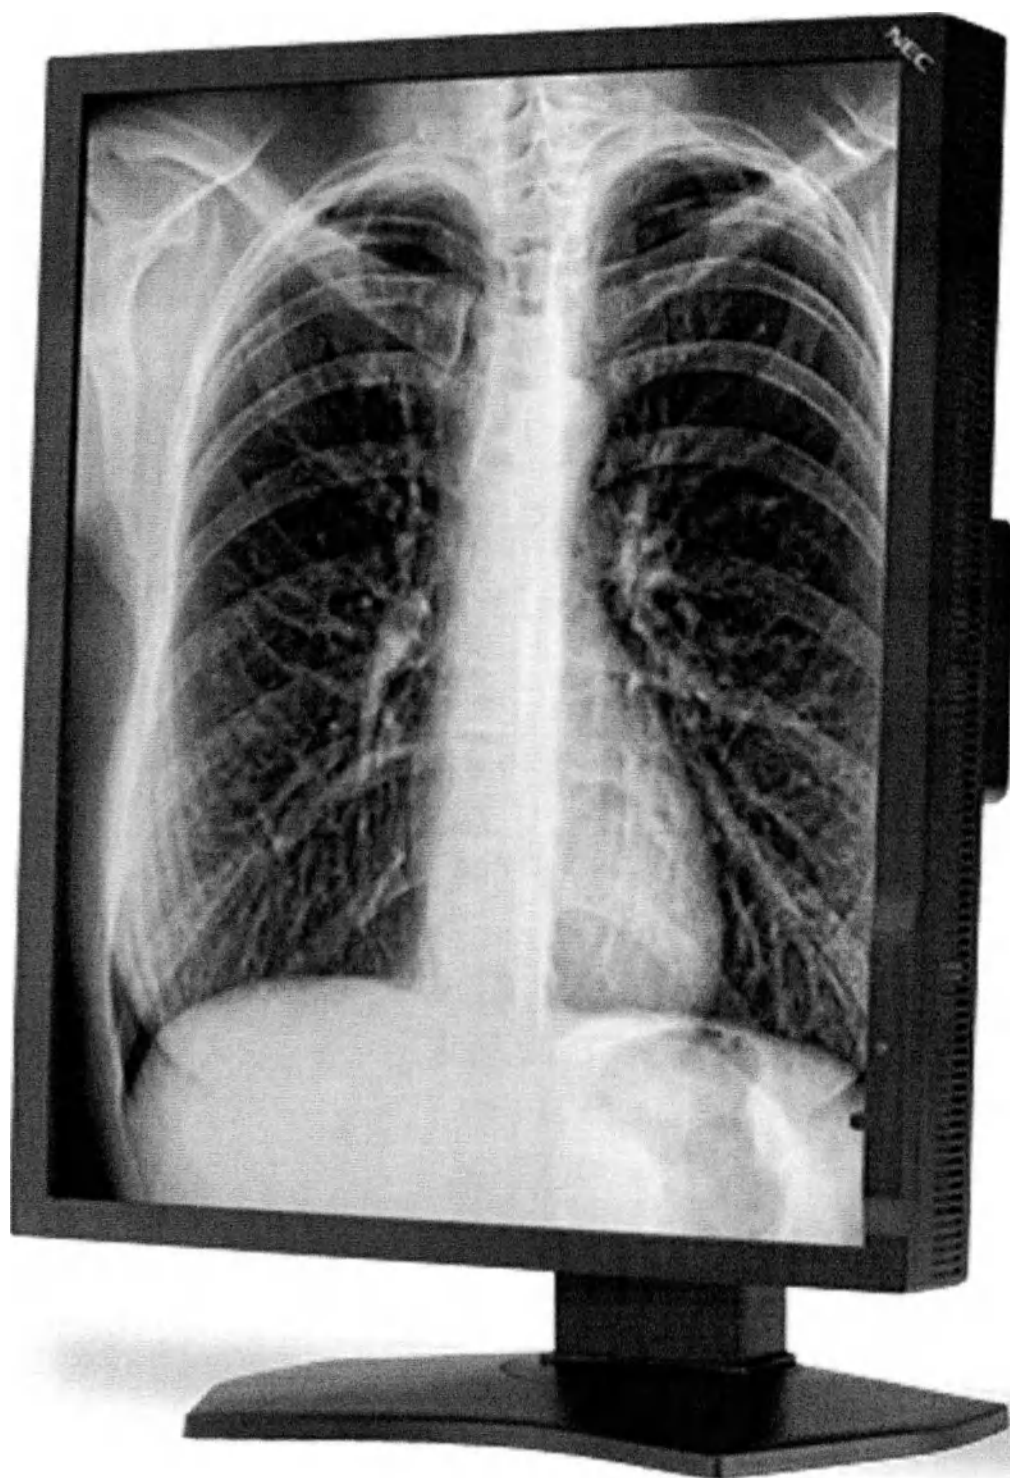


Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов NEC, производства NEC Display Solutions Ltd, Япония или Compal Electronics (China) Co., Ltd, Китай или Compal Display Electronics (Kunshan) Co., Ltd, Китай



Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии С или серии М или серии R, производства Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd, Китай




Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов серии Z, производства Hewlett-Packard Co., США или Wistron Corporation, Тайвань или Wistron Mexico S.A. de C.V, Мексика или Wistron InfoComm (Zhongshan) Corporation, Китай или All Technology (Zhongshan) Co. Ltd, Китай или Wistron InfoComm (Czech) s.r.o., Чешская Республика (на фото изображен монитор ЖК с диагональю 24 дюйма серии Z, производства Hewlett-Packard Co., США)

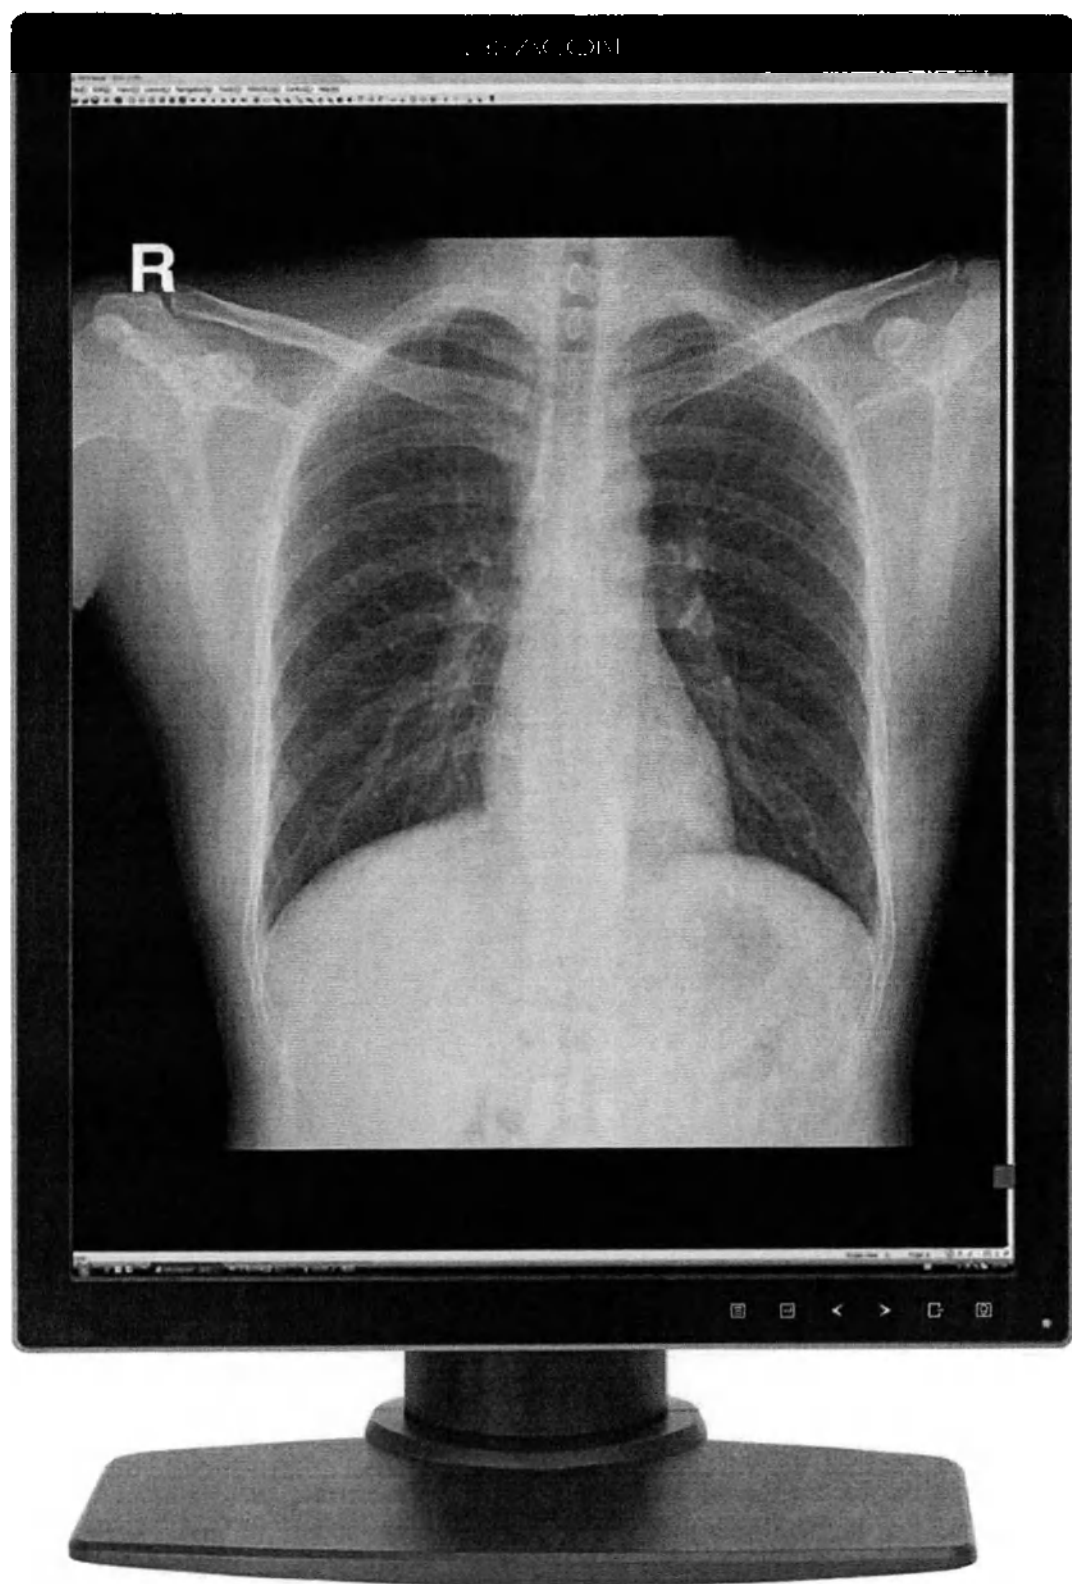

**Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Beacon,
производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd, Китай**



Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Barco, производства Barco N.V., Бельгия

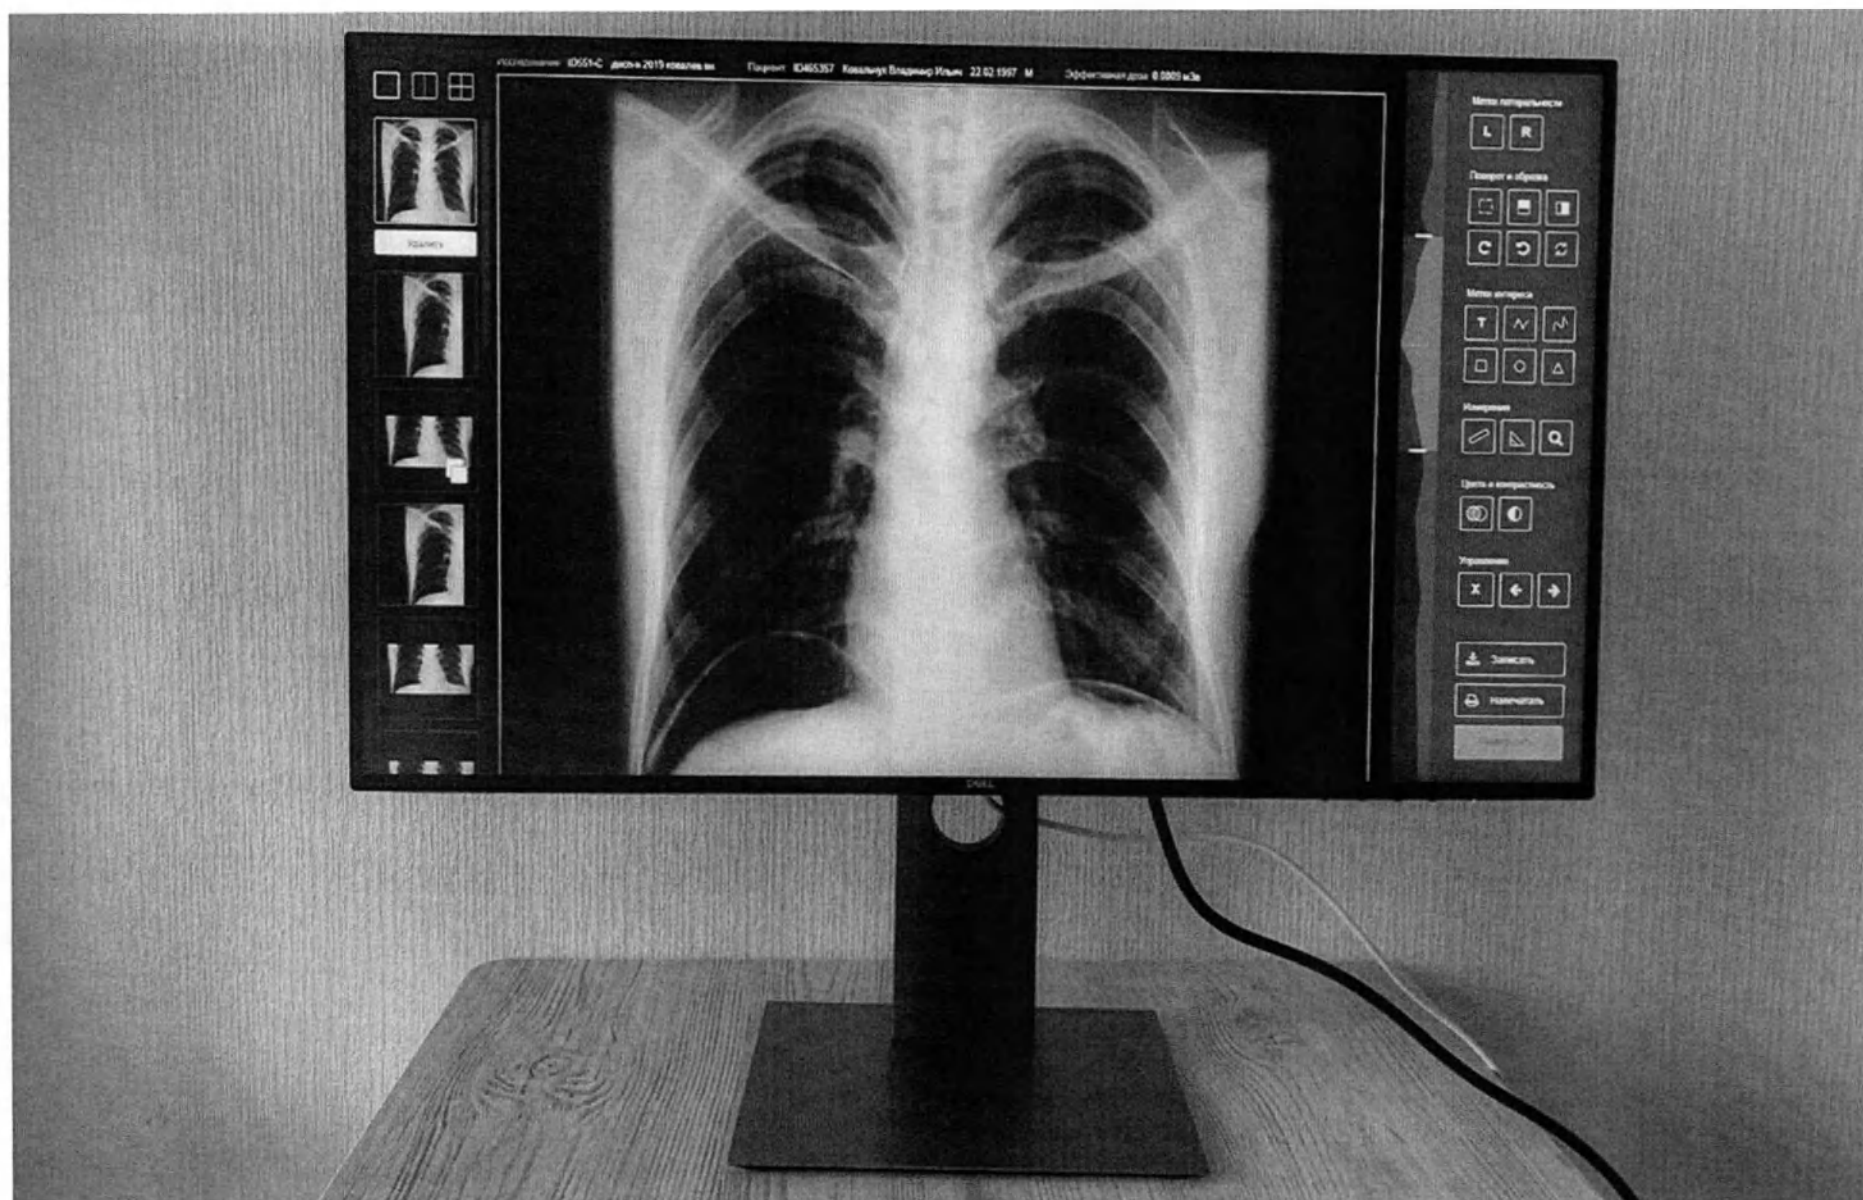

Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов DELL, производства DELL, Китай



Монитор ЖК с диагональю от 19 до 32 дюймов Samsung,
производства Samsung, Республика Корея



Радиологическая информационная система «ИнтеГРИС-МТ-Плюс»,
производства АО «МТЛ», Россия




Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 ДРК-1,
производства ООО НПП «Доза», Россия




Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012 ДРК-1М, производства ООО НПП «Доза», Россия



Дозимет клинический для контроля радиологических процедур
серии VacuDap System, производства VacuTec, Meßtechnik GmbH,
Германия.

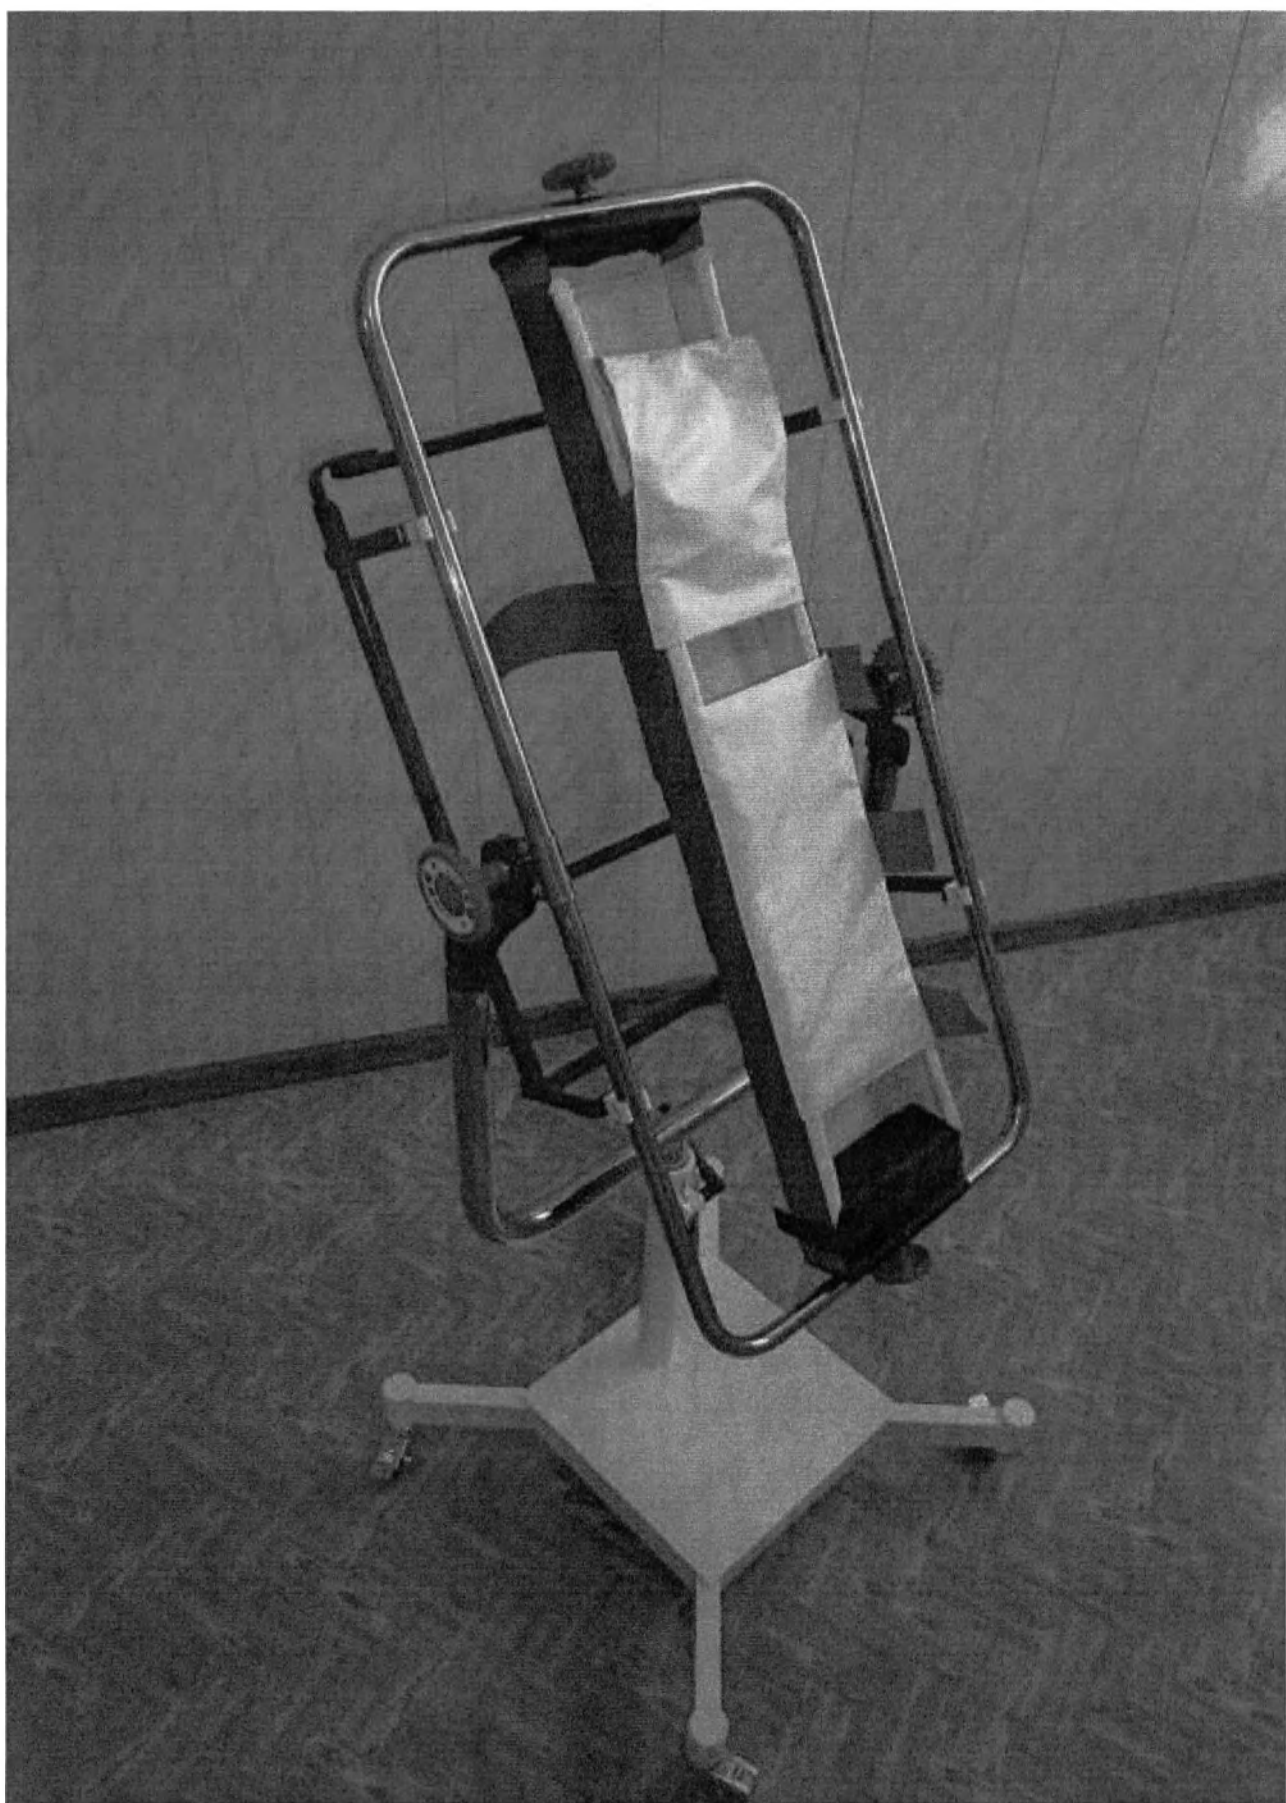


Крепление детское универсальное по ТУ 9452-001-80020198-2010,
производства ИП Давлетов Д.Я., Россия

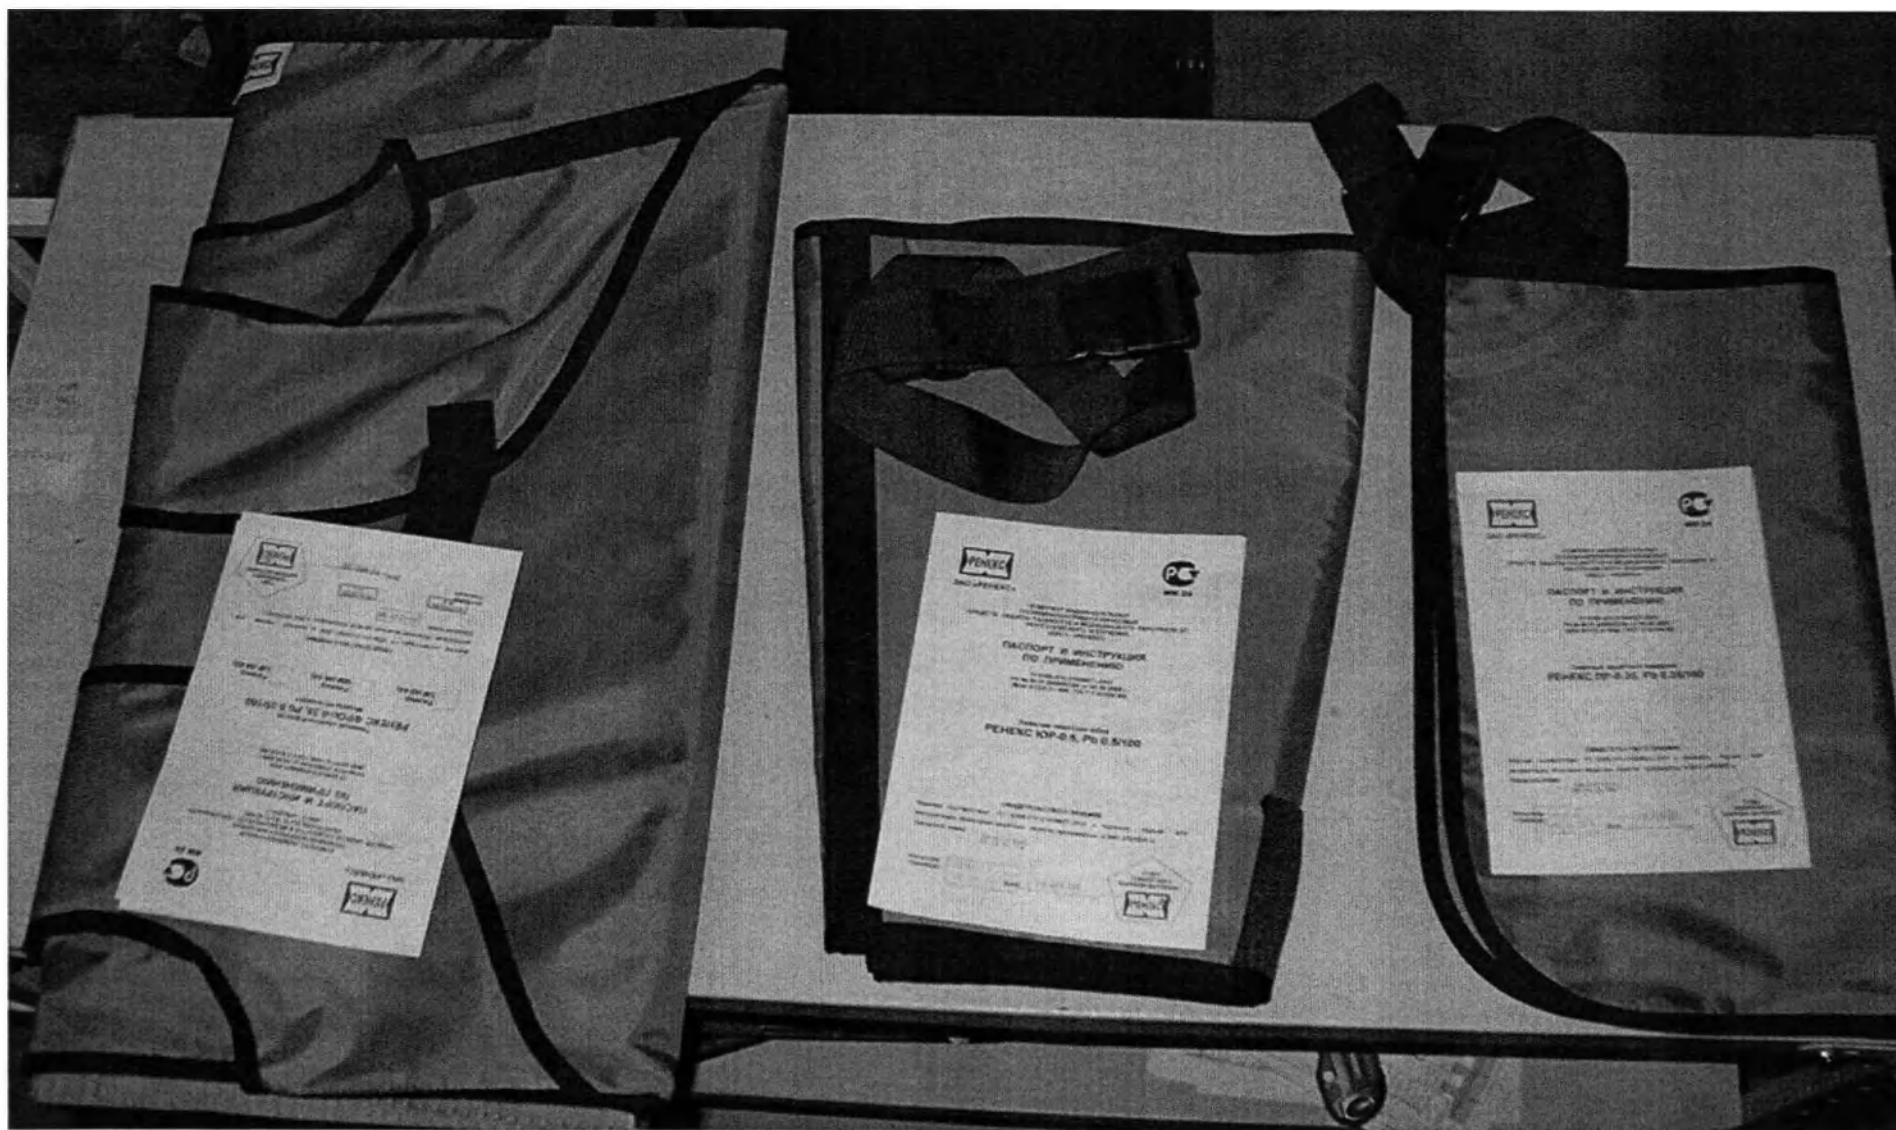


Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004, производства ЗАО «Ренекс», Россия



Комплекты рентгенозащитных средств из материала резиносвинцового для индивидуальной защиты врача, пациента и для использования в микропедиатрии при рентгенодиагностических исследованиях КСИЗ-РС и КСИЗмп-РС по ТУ 9452-001-42879986-2006, производства ООО «МП НПФ «Гаммамед-П», Россия

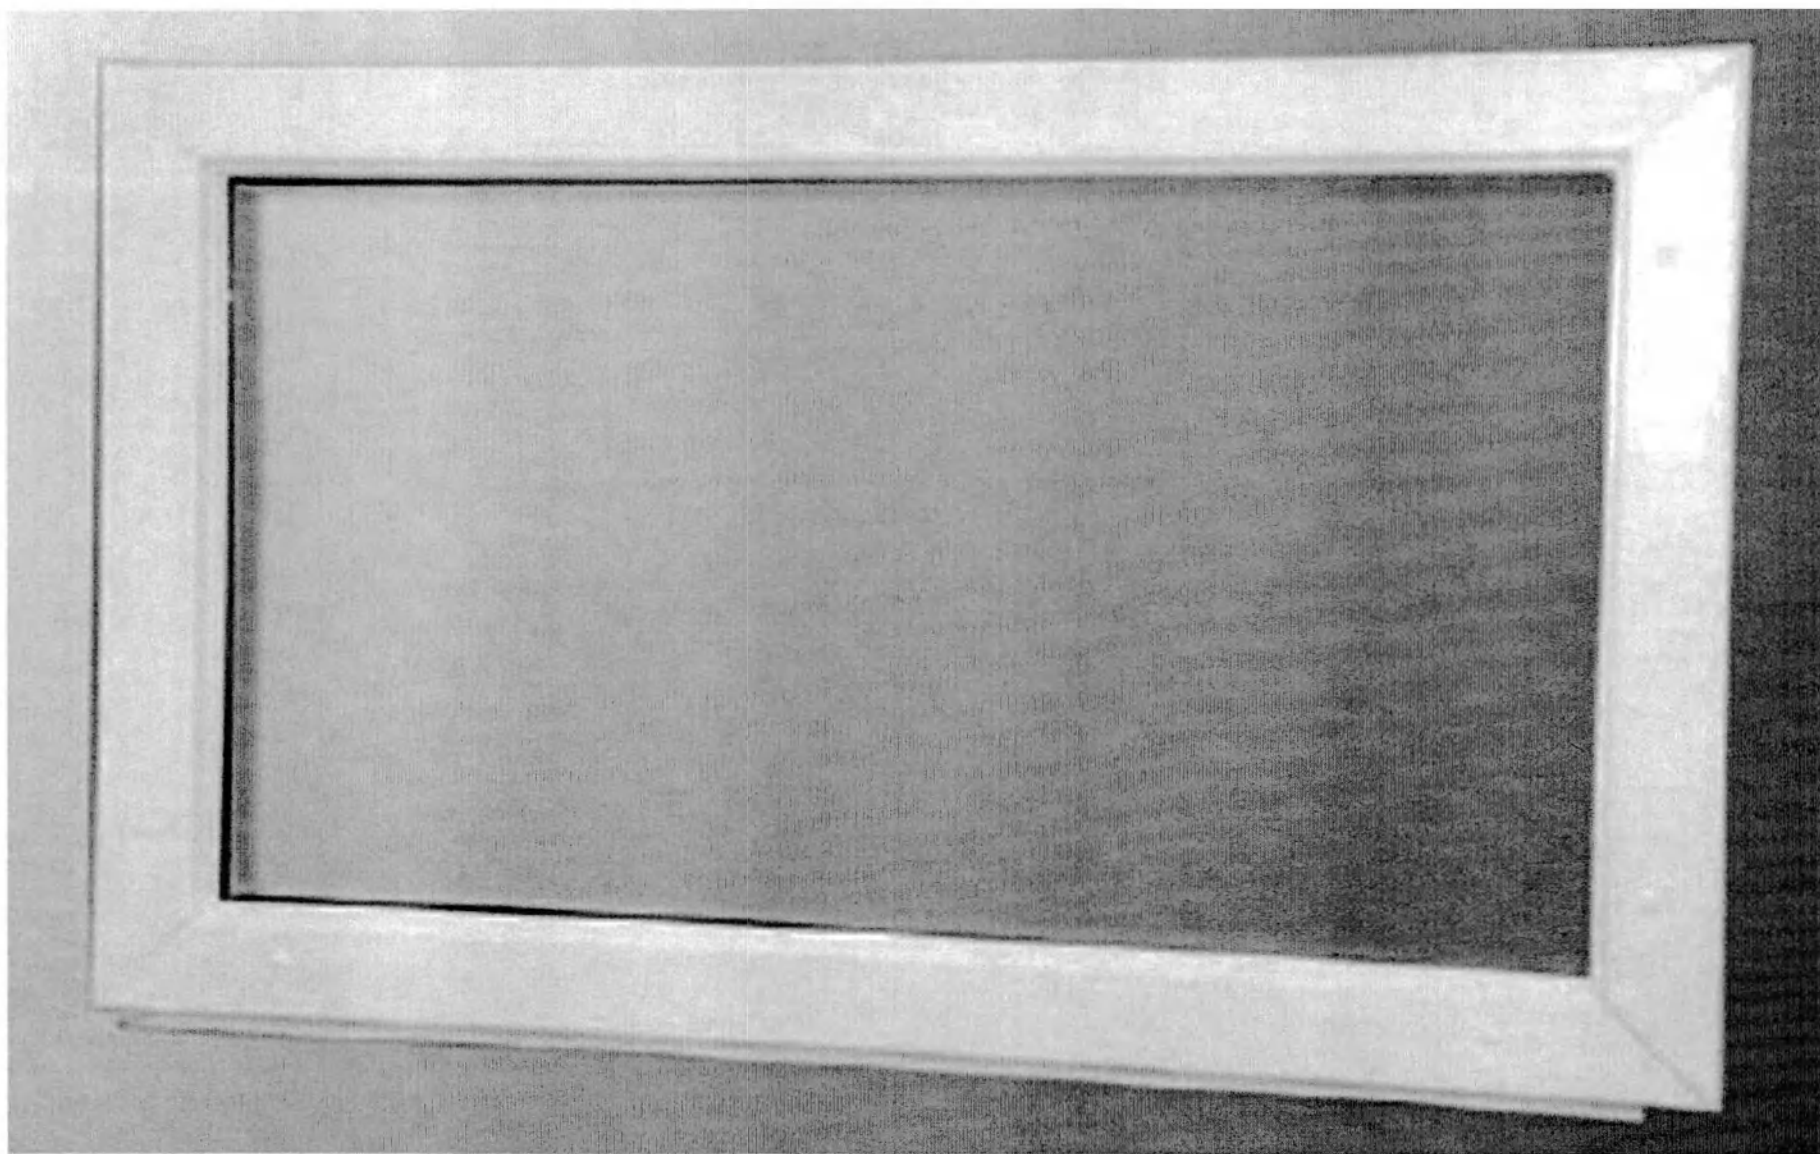

Окно рентгенозащитное серии MASO, производства Hans O.Mahn & Co. KG, Германия или
РЕНЕКС ОСРЗ, производства ЗАО «Ренекс», Россия

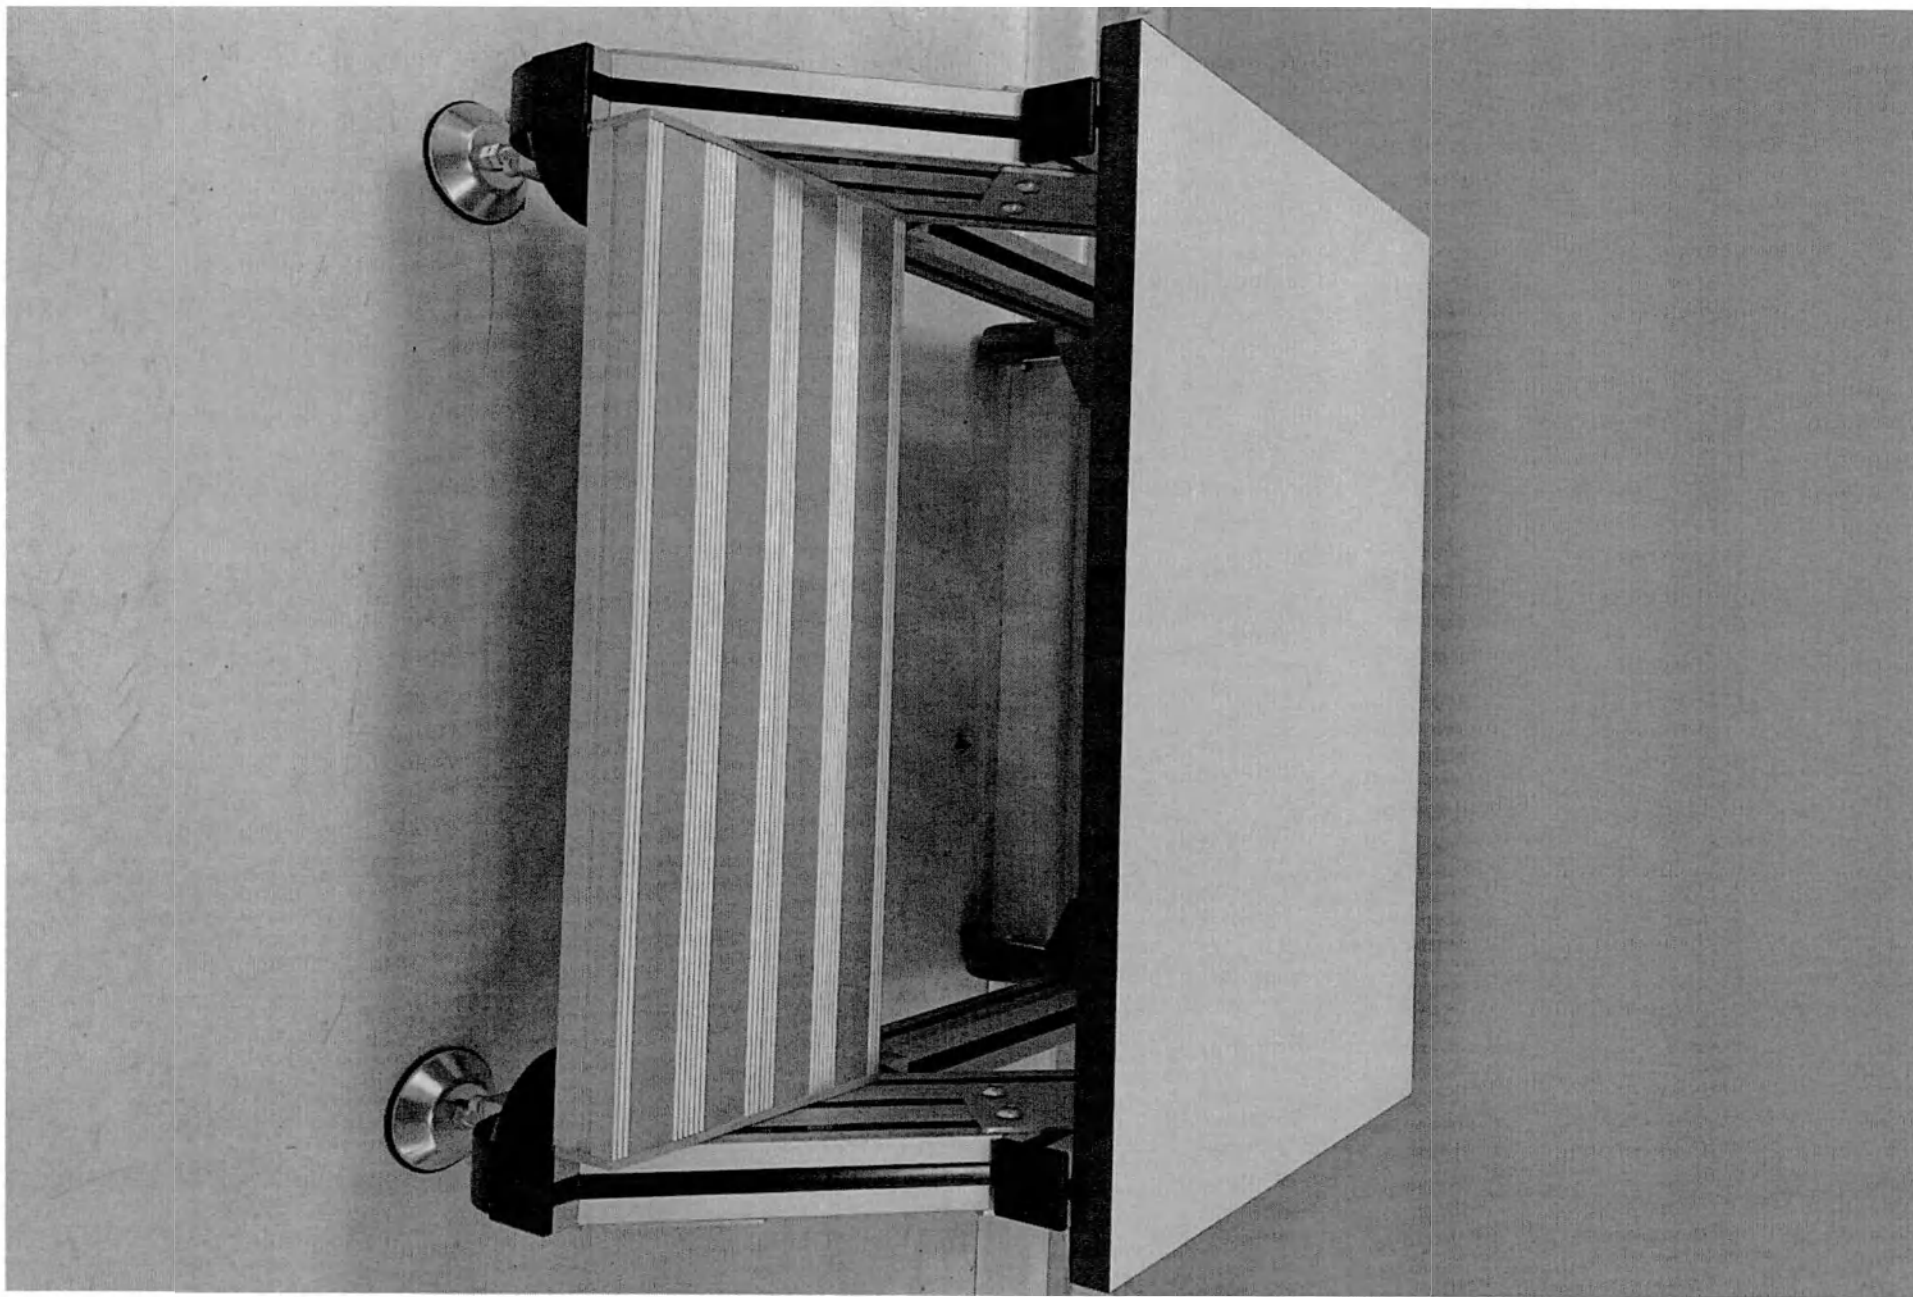

Устройство для съемки стоп Y1-C1250, производства ООО «ВКО Медпром», Россия


Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 50

(пятидесяти) листах



**Макет маркировки и
упаковки медицинского
изделия Комплекс
рентгеновский
диагностический
стационарный
Р-600 «Дуограф»**


**ООО
«ВКО Медпром»**

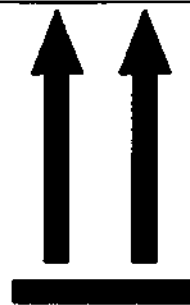

Комплекс рентгеновский диагностический стационарный Р-600 «Дуограф»

Серийный номер:

Год и месяц упаковывания:

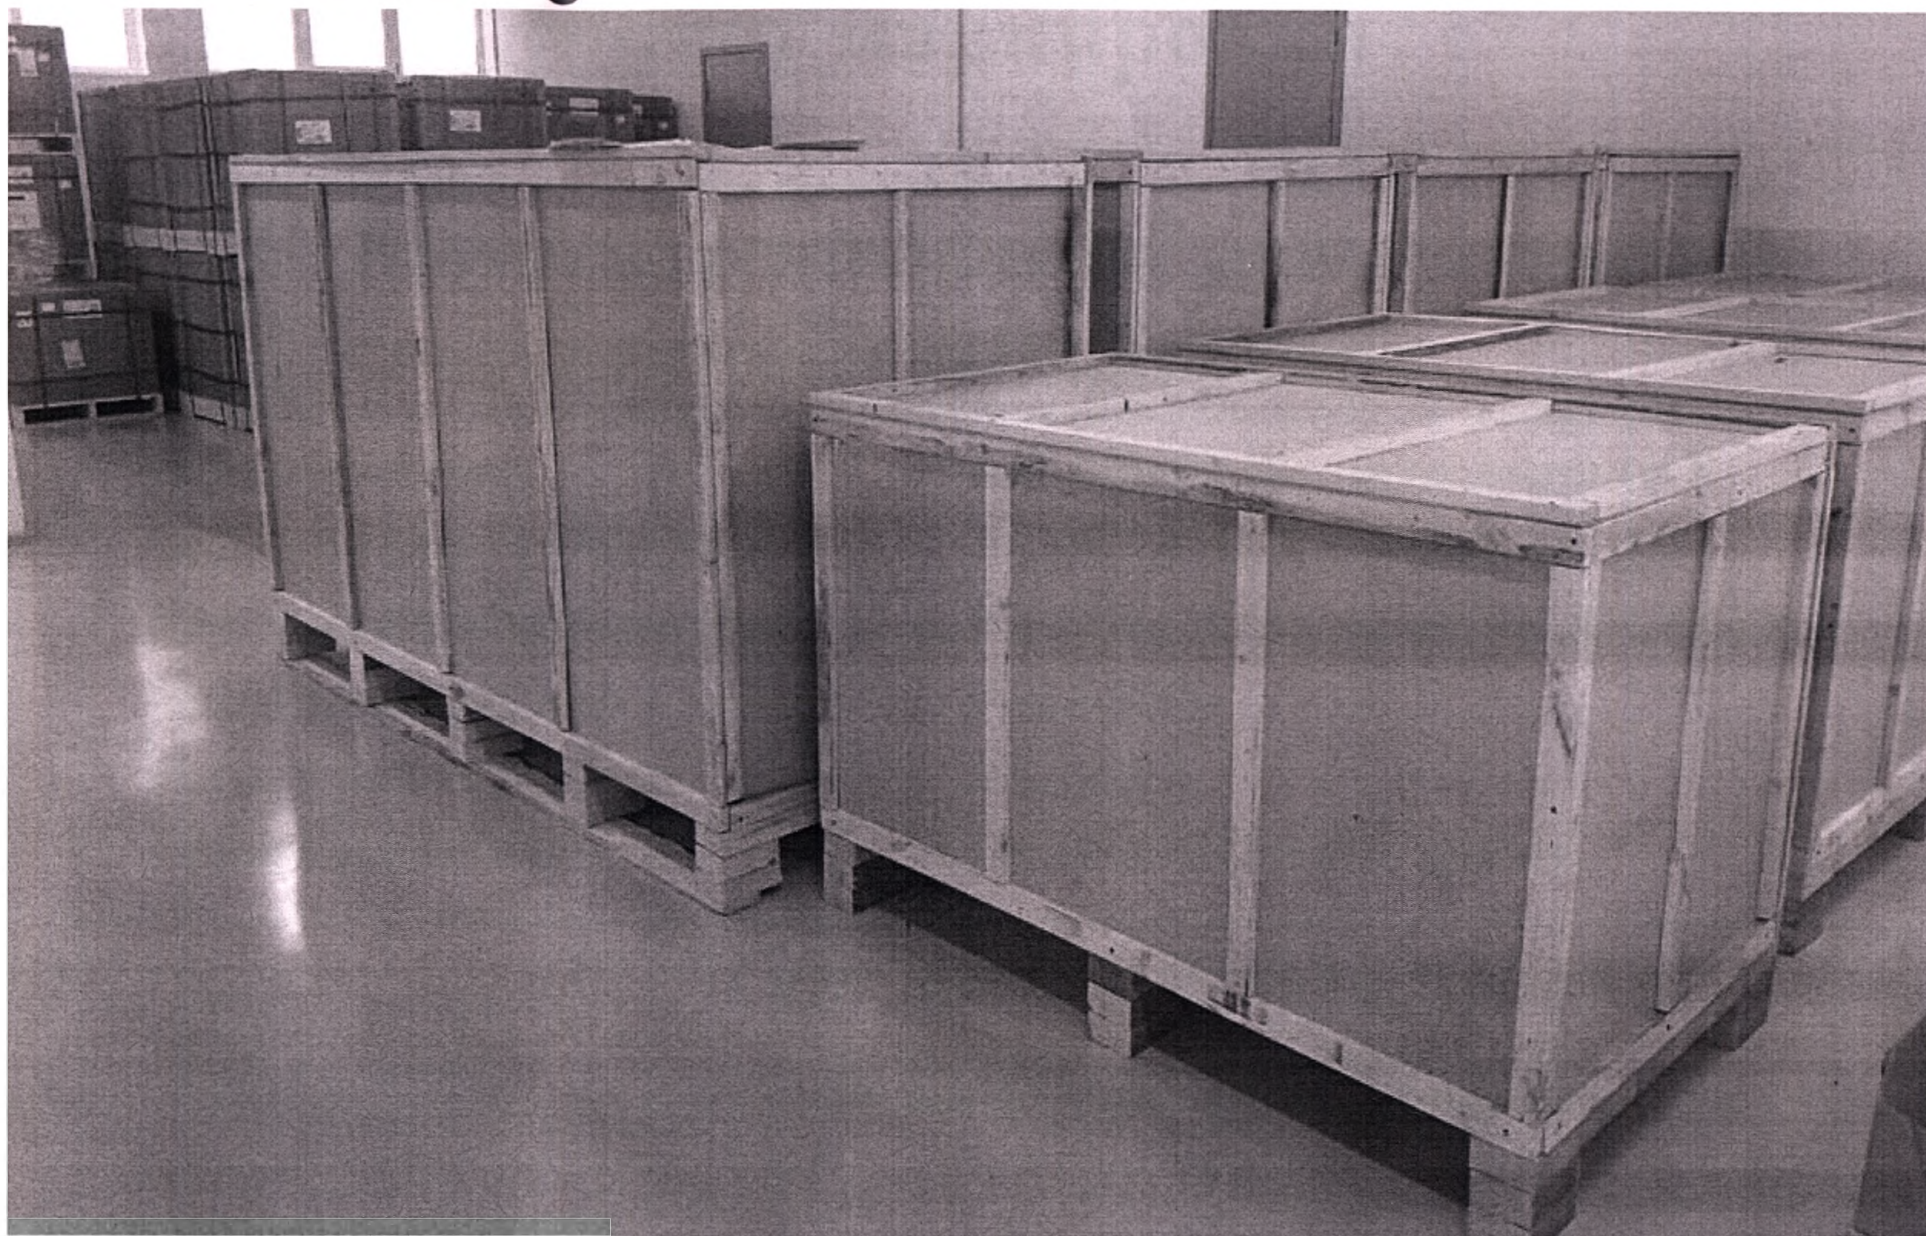

В зависимости от комплектации аппарат может быть упакован от 2 до 6 ящиков. В ящиках 3-6 расположены: АРМ врача, радиологическая информационная система, крепление для детей и другие изделия поставляемые по согласованию с заказчиком. Изделия поставляются в оригинальной упаковке производителей.

Макет маркировки



Комплекс рентгеновский диагностический стационарный Р-600 «Дуограф»

Обозначение

АХ-А0000-0Х, исполнение Х

Технические условия

26.60.11-007-67684634-2021

Рег. удостоверение №

ХХХ ХХХХ/ХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Серийный номер

Р-ХХ-ХХХ

Дата производства

ХХ.ХХХХ

Производитель

ООО «ВКО Медпром»



3N~ 380/400 В, 50 Гц, 100 кВ·А



Х – значения указываются при поставке и после получении Регистрационного удостоверения

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью на ли

(четырех) листах

Генеральный директор
ООО «ВКО Медпром»



Медеряков О.В.