


«УТВЕРЖДАЮ» / “APPROVE”

JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A. («Джей Джей
Джи Си Индустрия э Комерсио Де Материаис Дентариос С.А.»),
Brazil (Бразилия)

Regulatory Affairs Manager (Менеджер отдела нормативного
регулирувания)
(должность/position)

Thais Barboza (Таис Барбоза)
(имя/name)



Thais A. Barboza
(подпись/signature)

«01» 11 2023

Дата «ДД» ММ ГГГГ / Date “DD” MM YYYY

М.П. / Stamp

Operational documentation of the medical device


Dental screwdriver for contra-angle handpiece

JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A.

Эксплуатационная документация медицинского изделия

Отвертка стоматологическая для углового наконечника

Джей Джей Джи Си Индустрия э Комерсио Де Материаис Дентариос С.А.

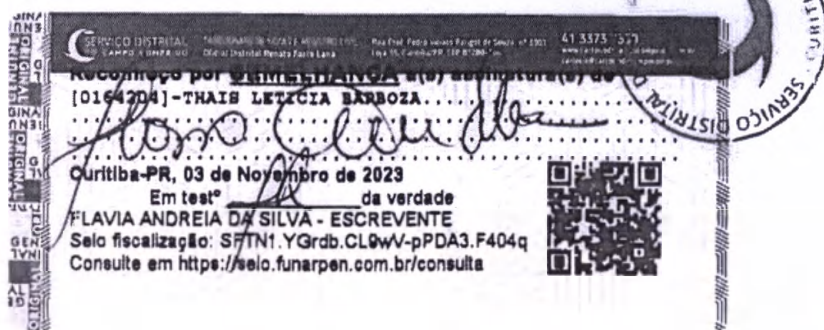

Эксплуатационная документация Медицинского Изделия (МИ)

*«Отвертка стоматологическая для углового
наконечника»*


Содержание

Инструкция по применению медицинского изделия (МИ): <i>Отвертка стоматологическая для углового наконечника:</i>	3
1. Описание	4
2. Техническое описание медицинского изделия	4
2.1 Возможность и способы интегрирования с другими медицинскими изделиями	4
2.2 Информация в соответствии с данными государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения о содержащихся в медицинском изделии	4
2.3 Содержание материалов животного и человеческого происхождения	4
3. Назначение	4
3.1 Указание возможности и особенностей применения медицинского изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания	4
3.2 Сведения о возможном влиянии использования медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами	5
3.3 Условия эксплуатации.	5
3.4 Сведения о потенциальных потребителях.	5
4. Показания	5
5. Области применения	5
6. Противопоказания	5
7. Способ применения	5
8. Основные параметры и характеристики медицинского изделия	6
9. Методы и средства дезинфекции и предстерилизационной очистки	8
10. Методы и условия стерилизации, сроки сохранения стерильности	11
11. Требования безопасности и меры предосторожности	12
12. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия	13
13. Сведения о техническом обслуживании, сведения о поверке	13
14. Условия транспортирования и хранения	13
15. Охрана окружающей среды	13
15.1 Требования к охране окружающей среды при применении медицинского изделия	13
15.2 Порядок осуществления утилизации и уничтожения, указание, при необходимости, специальных мер предосторожности при уничтожении медицинских изделий	14
16. Срок службы, срок годности	14
17. Сведения о программном обеспечении	14
18. Сведения об ЭМС	14
19. Требования к монтажу и установке	14
20. Гарантийные обязательства	14
21. Сведения о производителе медицинского изделия и уполномоченном представителе	17
21.1 Наименование и адрес производителя	17
21.2 Адрес места производства	17
21.3 Сведения об уполномоченном представителе. Рекламация	17

Инструкция по применению медицинского изделия (МИ): Отвертка стоматологическая для углового наконечника:

Варианты исполнения:

1. Отвертка стоматологическая для углового наконечника Нео короткая;
2. Отвертка стоматологическая для углового наконечника Нео, средняя;
3. Отвертка стоматологическая для углового наконечника Нео экстракороткая;
4. Отвертка стоматологическая для углового наконечника для ортопедических компонентов;
5. Отвертка стоматологическая для углового наконечника, тип соединения Нех, размер 0.9 мм/1.2 мм/1.6 мм;
6. Отвертка стоматологическая для углового наконечника, короткая, тип соединения Нех, размер 0.9 мм/1.2 мм;
7. Отвертка стоматологическая для углового наконечника Facility.

Символ	Расшифровка
	Изготовитель МИ
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Дата изготовления
	Использовать до
	Код партии
	Номер по каталогу (артикул)
	Не использовать при повреждении упаковки
	Не допускать воздействия солнечного света
	Беречь от влаги
	Верхняя граница температурного диапазона (до +40°C)
	Обратитесь к руководству по эксплуатации Электронная версия инструкции находится по адресу straumann.ru/ifu
	Соответствует Директиве Совета ЕС
	Материал
	Размер
	Количество
	Отпускается только по рецепту
	Нестерильно

Символ		Расшифровка
	MD	Медицинское изделие
	CH REP	Уполномоченный представитель в Швейцарии
	EC IMP	Импортёр в Европейское содружество

Эти устройства предназначены для специализированной процедуры, которая должна проводиться профессионалами, имеющими соответствующую подготовку в области зубных имплантатов. Для достижения оптимальных результатов, используйте изделие зная соответствующие методики. Всегда применяйте их при соответствующих условиях, в условиях операционной.

1. Описание

Отвертка стоматологическая для углового наконечника — это инструменты, предназначенные для соединения с угловым наконечником, используются для захвата, транспортировки и установки протезных компонентов. Они многоразовые, *поставляются нестерильными и поэтому должны быть стерилизованы перед использованием.

Отвертки для углового наконечника имеют цилиндрическую форму, изготовлены из нержавеющей стали. Рабочий конец имеет соответствующую геометрию для соединения с соответствующими протезными компонентами, а другой конец имеет фитинг для соединения с угловым наконечником.

2. Техническое описание медицинского изделия

2.1 Возможность и способы интегрирования с другими медицинскими изделиями

Отвертка стоматологическая для углового наконечника используется вместе с инструментами для установки дентальных имплантатов NEODENT, а также с другими изделиями производства NEODENT предназначенных для имплантирования.

2.2 Информация в соответствии с данными государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения о содержащихся в медицинском изделии

Не применимо

2.3 Содержание материалов животного и человеческого происхождения

Не применимо

3. Назначение

Предназначены для закручивания и/или откручивания различных компонентов с помощью углового наконечника.

3.1 Указание возможности и особенностей применения медицинского изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания

Данное изделие используется в соответствии с назначением врача. Его использование невозможно при наличии у пациента противопоказаний. Изделие может использоваться людьми всех возрастов, полов и этнических групп.

3.2 Сведения о возможном влиянии использования медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Медицинское изделие не оказывает влияние на способность пациента управлять транспортными средствами и другими механизмами.

3.3 Условия эксплуатации.

Таблица 1

Температура	от +15°C до +25°C
Относительная влажность	от 20% до 85% (без конденсации)
Высота над уровнем моря (атмосферное давление)	от 700 гПа до 1060 гПа

3.4 Сведения о потенциальных потребителях.

Настоящее изделие предназначено для специализированных процедур, выполняемых дипломированными специалистами в области стоматологической имплантации, ознакомленными с технологией направленной хирургии NEODENT. Для достижения оптимального результата следует работать с настоящим изделием, предварительно изучив соответствующие методики, в надлежащих условиях – ЛПУ, клиниках и прочих медицинских учреждениях.

4. Показания

МИ для проведения хирургических операций на костях верхней или нижней челюсти при соблюдении последовательности использования инструментов, что позволяет проводить безлоскутные операции по установке имплантатов в адентичных участках челюсти.

5. Области применения

Область применения - стоматология.

6. Противопоказания

Для продукции противопоказания не предусмотрены при условии надлежащего использования для целей применения, кроме случаев аллергии или гиперчувствительности пациента к нержавеющей стали.

7. Способ применения

Для захвата протезного компонента поместите рабочий конец отвертки в компонент. Убедитесь в правильной посадке, задайте движение бормашины по часовой стрелке для установки. Для извлечения задайте движение бормашины против часовой стрелки.

При необходимости прикрепите отвертку к угловому наконечнику. Поместите отвертку на винт / протезный компонент / имплантат, нажмите и вращайте. Рекомендуется, чтобы ось вращения отвертки совпадала с осью вращения винта / протезного компонента / имплантата. Необходимый показатель крутящего момента должен быть указан для соответствующего винта / протезного компонента / имплантата. Контроль крутящего момента при работе с угловым наконечником проводится посредством задания необходимого крутящего момента на бормашине (физиодиспенсере).

8. Основные параметры и характеристики медицинского изделия

Таблица 2

Каталожный номер	Описание МИ	Характеристики (на все значения распространяется допустимая погрешность $\pm 5\%$)
105.135	Отвертка стоматологическая для углового наконечника Нео, короткая <i>Назначение с учетом специфичности применения: применяется для фиксации ортопедических компонентов (включая винты, колпачки, абатменты, трансферы, маячки для сканирования, аналоги) линейки GM имплантационной системы NEODENT</i>	Общая длина, мм: 24; Диаметр жала, мм: 1,09-1,4; Масса, г: 0,575; Максимальный крутящий момент, Н·см: 20.
105.136	Отвертка стоматологическая для углового наконечника Нео, средняя <i>Назначение с учетом специфичности применения: применяется для фиксации ортопедических компонентов (включая винты, колпачки, абатменты, трансферы, маячки для сканирования, аналоги) линейки GM имплантационной системы NEODENT</i>	Общая длина, мм: 31; Диаметр жала, мм: 1,09-1,55; Масса, г: 0,809; Максимальный крутящий момент, Н·см: 20.
105.138	Отвертка стоматологическая для углового наконечника для ортопедических компонентов <i>Назначение с учетом специфичности применения: применяется со всеми прямыми абатментами Mini Conical и Micro Conical линейки GM для фиксации абатмента имплантационной системы NEODENT на имплантате</i>	Общая длина, мм: 27; Диаметр жала, мм: 0,97-2,01; Масса, г: 1,060; Максимальный крутящий момент, Н·см: 32.
105.146	Отвертка стоматологическая для углового наконечника Нео, экстракороткая <i>Назначение с учетом специфичности применения: применяется для фиксации ортопедических компонентов (включая винты, колпачки, абатменты, трансферы, маркеры, аналоги) линейки GM, имплантационной системы NEODENT</i>	Общая длина, мм: 16,5; Диаметр жала, мм: 1,09-1,31; Масса, г: 0,423; Максимальный крутящий момент, Н·см: 20.

Каталожный номер	Описание МИ	Характеристики (на все значения распространяется допустимая погрешность $\pm 5\%$)
105.066	Отвертка стоматологическая для углового наконечника, тип соединения Hex 0.9 мм <u>Назначение с учетом специфичности применения:</u> применяется для фиксации абатментов с антиротационным индексом Exact линейки CM имплантационной системы NEODENT на имплантате	Общая длина, мм: 27,2; Диаметр жала, мм: 2 - 1,4; Масса, г: 0,670; Тип соединения: Внешнее шестигранное (Hex 0,9 мм) Максимальный крутящий момент, Н·см: 15.
105.010	Отвертка стоматологическая для углового наконечника, тип соединения Hex 1.2 мм <u>Назначение с учетом специфичности применения:</u> применяется для фиксации абатментов с антиротационным индексом Exact линейки CM имплантационной системы NEODENT на имплантате	Общая длина, мм: 27,2; Диаметр жала, мм: 2 - 1,4; Масса, г: 0,674; Тип соединения: Внешнее шестигранное (Hex 1,2 мм) Максимальный крутящий момент, Н·см: 32.
105.012	Отвертка стоматологическая для углового наконечника, тип соединения Hex 1.6 мм <u>Назначение с учетом специфичности применения:</u> применяется для фиксации абатментов линейки CM abutment имплантационной системы NEODENT на имплантате	Общая длина, мм: 26; Диаметр жала, мм: 1,98; Масса, г: 0,735; Тип соединения: Внешнее шестигранное (Hex 1,6 мм) Максимальный крутящий момент, Н·см: 32.
105.118	Отвертка стоматологическая для углового наконечника, короткая, тип соединения Hex 0.9 мм <u>Назначение с учетом специфичности применения:</u> применяется для фиксации абатментов с антиротационным индексом Exact линейки CM на имплантате	Общая длина, мм: 23,2; Диаметр жала, мм: 1,4; Масса, г: 0,573; Тип соединения: Внешнее шестигранное (Hex 0,9 мм) Максимальный крутящий момент, Н·см: 15.
105.119	Отвертка стоматологическая для углового наконечника, короткая, тип соединения Hex 1.2 мм <u>Назначение с учетом специфичности применения:</u> применяется для фиксации абатментов с антиротационным индексом Exact линейки CM на имплантате	Общая длина, мм: 23,2; Диаметр жала, мм: 1,4; Масса, г: 0,577; Тип соединения: Внешнее шестигранное (Hex 1,2 мм) Максимальный крутящий момент, Н·см: 32.

Каталожный номер	Описание МИ	Характеристики (на все значения распространяется допустимая погрешность $\pm 5\%$)
105.104	Отвертка стоматологическая для углового наконечника Facility <i>Назначение с учетом специфичности применения: применяется для установки всех имплантатов Facility имплантационной системы NEODENT</i>	Общая длина, мм: 36; Диаметр жала, мм: 2,05-2,7; Масса, г: 1,269; Тип соединения: Внешнее трехгранное (R0,40 (3x)) Максимальный крутящий момент, Н·см: 35.

9. Методы и средства дезинфекции и предстерилизационной очистки (Рекомендации производителя)

Необходимо проводить надлежащую очистку данного изделия после каждого использования.

Для проведения очистки необходимо выполнить следующие действия:

1-ый шаг: полностью погрузить изделие в ферментное моющее средство (соблюдать концентрации, указанные производителем).

2-ой шаг: промывать в ультразвуковом очистителе в течение 10-15 минут.

3-ий шаг: промыть в достаточном количестве дистиллированной воды до полного удаления остатков раствора. Допускается использовать нейлоновые щетки.

4-ый шаг: высушить чистой сухой тканью или сжатым воздухом.

5-ый шаг: осмотреть на предмет появления каких-либо поломок в процессе очистки. Если инструмент очистился не полностью, опустить его еще раз в моющее средство, как указано в шаге 1, а затем при необходимости провести очистку нейлоновой щеткой. Повторить процедуру промывки и сушки.

6-ой шаг: выбрать упаковку в соответствии с процессом стерилизации. Рекомендуется использовать бумажную самоклеивающуюся упаковку хирургической степени чистоты с ламинированной пленкой.

ВНИМАНИЕ: не использовать средства, образующие пену, и не сушить детали, содержащие остатки чистящих растворов, поскольку это приводит к окислению изделий. Применение стальных щеток не рекомендуется.

Выполните следующие процедуры:

Очистка и дезинфекция ручным способом

Очистка

1. По возможности разберите инструменты (см. специальные инструкции по разборке).

2. Замочите разобранные инструменты не менее чем на 1 мин. в чистящем растворе (САЙДЕЗИМ, 1,6 % объемного содержания), полностью погрузив их в раствор. Следите за тем, чтобы инструменты не соприкасались друг с другом. Для более эффективной очистки тщательно очистите их мягкой щеткой. Поворачивайте подвижные детали несколько раз во время чистки.

При необходимости: при помощи одноразового шприца (минимальный объем – 10 мл) и соответствующей промывочной насадки промойте все полости инструментов не менее пяти раз перед замачиванием.

3. Замочите разобранные инструменты на 15 минут в чистящем растворе (САЙДЕЗИМ, 1,6 % объемного содержания) с ультразвуковой обработкой, полностью погрузив их в раствор. Следите за тем, чтобы инструменты не соприкасались друг с другом.

4. Затем извлеките инструменты из чистящего раствора и далее тщательно промойте их не менее 3 раз (в течение не менее 1 минуты) под проточной водой.

При необходимости: при помощи одноразового шприца (минимальный объем – 10 мл) и соответствующей промывочной насадки промойте все полости инструментов не менее пяти раз.

Дезинфекция

1. Замочите разобранные инструменты не менее чем на 15 минут в чистящем растворе (неразбавленном растворе ортофталевого альдегида САЙДЕКС ОПА), полностью погрузив их в раствор. Следите за тем, чтобы инструменты не соприкасались друг с другом. Поворачивайте подвижные детали несколько раз во время дезинфекции. При необходимости: при помощи одноразового шприца (минимальный объем – 10 мл) и соответствующей промывочной насадки промойте все полости инструментов не менее пяти раз перед замачиванием и после замачивания.

2. Извлеките инструменты из дезинфицирующего раствора и далее промойте их в соответствии с инструкциями производителя раствора ортофталевого альдегида САЙДЕКС ОПА.

В таблице ниже указаны методические указания, по дезинфекции, с подбором длительности выдержки МИ в растворе, в зависимости от видов инфекций.

Таблица 3

Вид инфекции	Концентрация раствора, %	Время выдержки, мин	Применение
Вирусные	Без разведения	15	Для изделий из стекла, металлов, пластмасс, резин, в том числе эндоскопов, инструментов к ним, стоматологических инструментов
Бактериальные		15	
Туберкулез		90	
Кандидозы		90	
Дерматофитии		90	

- Режимы дезинфекции химическим методом даны в пяти вариантах:
 - 1-я строка – при вирусных гепатитах, ВИЧ-инфекции, энтеровирусных, ротавирусных инфекциях;
 - 2-я строка - следует применять для предупреждения гнойных заболеваний, кишечных и капельных инфекций бактериальной этиологии, острых респираторных вирусных инфекций (грипп, аденовирусные заболевания и др.);
 - 3-я строка - при туберкулезе;
 - 4-я строка - при кандидозах;
 - 5-я строка – при дерматофитиях. В случаях, когда в таблице приведен один вариант (средства КолдСпор, Деконекс денталь ББ и др.), он распространяется на все виды возбудителей.

- При отсутствии обоснованных показаний к проведению дезинфекции по режимам для инфекций бактериальной этиологии (исключая туберкулез), дезинфекцию проводят по режимам для вирусных инфекций.
- Изделия медицинского назначения, применяемые в стоматологии, отличаются разнообразием по конструкции, по составу входящих в них материалов, по назначению и поэтому требуют тщательного выбора метода и средства дезинфекции.

Инструкции по промывке

- Вынув изделие медицинского назначения из раствора ортофталевого альдегида САЙДЕКС ОПА, тщательно промойте его, полностью погрузив в большой объем воды. Если питьевая вода непригодна, используйте стерильную воду.
 - Полностью погрузите изделие не менее чем на 1 минуту, если изготовителем изделия многократного использования не указано более длительное время.
 - Вручную промойте все полости в больших объемах (не менее 100 мл) промывочной воды, если производителем изделия не указано иное.
 - Извлеките изделие и вылейте промывочную воду. Для каждого промывания используйте только свежую воду. Не используйте эту воду повторно для промывания или для любой другой цели.
 - Повторите процедуру еще 2 раза, в общей сложности произведя 3 ПРОМЫВАНИЯ большими объемами свежей воды для удаления остатков раствора ортофталевого альдегида САЙДЕКС ОПА. Остатки раствора могут вызывать серьезные побочные эффекты.
3. Проверьте и упакуйте инструменты сразу после извлечения.
Механизированный способ очистки/дезинфекции (МД машина (моюще-дезинфицирующая машина))

Использование раствора Неодишер МедиЗим.

1. По возможности разберите инструменты.
2. Переложите разобранные инструменты в МД машину (следите за тем, чтобы инструменты не соприкасались друг с другом).
3. Запустите программу.
4. По окончании программы извлеките инструменты из МД машины.
5. Проверьте и упакуйте инструменты сразу после извлечения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. При выборе МД машины обратите внимание на следующее:
 - обязательно утвержденные эксплуатационные качества МД машины (например, маркировка CE в соответствии с EN ISO 15883 или DGHM (Немецкое общество гигиены и микробиологии), либо разрешение/одобрение/регистрация Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA));
 - возможность применения утвержденной программы термической дезинфекции (значение $A_0 > 3000$ или – для более старых изделий – не менее 5 мин. при 90 °C/194 °F; при химической дезинфекции – риск оседания остатков дезинфицирующего средства на инструментах);
 - обязательная пригодность программы для инструментов, а также достаточное количество операций промывания в программе;
 - дальнейшее промывание только стерильной или низкозагрязненной водой не более 10 бактерий/мл 0,25 единиц эндотоксинов/мл), например, очищенной/сверхочищенной водой;
 - использование только фильтрованного воздуха (без примеси масла, с низким уровнем загрязнения микроорганизмами и частицами) для сушки;

- регулярное техническое обслуживание и проверка/калибровка МД машины.
2. Запрещается чистить инструменты с помощью металлических щеток или стальной мочалки.
 3. Проверьте все инструменты после очистки или очистки/дезинфекции на наличие коррозии, поврежденных поверхностей и загрязнений. Следует прекратить дальнейшее использование поврежденных инструментов. Необходимо провести повторную очистку и дезинфекцию инструментов, на которых еще присутствует загрязнение.
 4. Упаковка: сложите очищенные и продезинфицированные инструменты в соответствующие стерилизационные лотки и упакуйте их в одноразовые стерилизационные тары (одинарную или двойную тару) и/или стерилизационные контейнеры, отвечающие следующим требованиям (материал/процесс):
 - EN ISO/ANSI (Американский национальный институт стандартов) AAMI (Ассоциация содействия развитию медицинской техники) ISO 11607 (для США: разрешение FDA);
 - пригодность для стерилизации паром;
 - надлежащая защита инструментов, а также стерилизационных тар от механического повреждения;
 - регулярное техническое обслуживание в соответствии с инструкциями производителя (контейнер для стерилизации).
 5. Удалите крупные загрязнения с инструментов сразу же после их использования, производя предварительную обработку перед очисткой и дезинфекцией (в течение не более 2 часов).

Предварительная обработка производится перед очисткой и дезинфекцией как ручным, так и механизированным способом.

 - a. По возможности разберите инструменты;
 - b. Промывайте инструменты под проточной водой в течение не менее 1 минуты (при температуре <35 °C/ 95 °F); пять раз при помощи одноразового шприца (минимальный объем – 10 мл). Поворачивайте подвижные детали несколько раз во время предварительной обработки;
 - d. Удалите вручную все видимые загрязнения с помощью чистой и мягкой щетки (или чистой, мягкой и безворсовой ткани), только они подходят для этой работы; не используйте металлические щетки или стальную мочалку;
 - e. Промойте еще раз под проточной водой в течение не менее 1 минуты.

При невозможности применения вышеуказанных чистящих/дезинфицирующих средств используйте аналогичные им средства. Владелец несет ответственность за замену чистящих средств.

Первостепенное значение перед хранением и стерилизацией имеет просушивание деталей, поскольку скопление влаги на изделиях может вызвать повреждения и окисление.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Во время санитарной обработки избегайте контакта между режущими инструментами и другими инструментами, во избежание снижения их режущей способности.

10. Методы и условия стерилизации, сроки сохранения стерильности

Изделие помещено в блистерную упаковку (бумага и пленка хирургической степени чистоты). Инструмент поставляется в индивидуальной блистерной упаковке (хирургической бумаге и пленке) в нестерильном виде. Для стерилизации выбирать только стерилизацию паром в соответствии со следующими характеристиками:

Таблица 4

	Фракционное вакуумирование/ динамическое удаление воздуха	Гравитационный метод откачки воздуха
Время стерилизации	Не менее 4 минут	Не менее 15 минут
Температура стерилизации	132±2 °C	132±2 °C
Время сушки	Не менее 20 минут	Не менее 20 минут
Давление пара в стерилизационной камере, МПа (кгс/см²)	0,20±0,02 МПа/ (2,0±0,2) кгс/см ²	0,20±0,02 МПа/ (2,0±0,2) кгс/см ²

- 1) Не менее трех этапов вакуумирования
- 2) При возможности осуществления метода фракционного вакуумирования не следует применять менее эффективный гравитационный метод откачки воздуха.
- 3) Максимальная температура стерилизации – 134 °C (273 °F).
- 4) Объективно требуемое время сушки напрямую зависит от параметров, находящихся в зоне исключительной ответственности пользователя (конфигурация загрузки и плотность, параметры стерилизатора), и таким образом определяется пользователем. Тем не менее, время сушки не должно составлять менее 20 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ.

- 1) Храните инструменты после стерилизации в стерилизационных таргах в сухом и непыльном месте.
- 2) Запрещено применять процедуру экспресс-стерилизации/стерилизации непосредственно перед использованием.
- 3) Не производите стерилизацию сухим жаром, лучевую стерилизацию, стерилизацию формальдегидом и окисью этилена, а также плазменную стерилизацию.

11. Требования безопасности и меры предосторожности

- Будьте внимательны к пациентам, у которых проявляются признаки аллергии или гиперчувствительности к материалу: хирургической нержавеющей стали.
- Рекомендуется держать отвертку по оси устанавливаемого изделия для приложения момента затяжки.
- Наклон отвертки во время применения крутящего момента может привести к повреждению и/или поломке.
- При использовании отверток для установки имплантатов следует проверить скорость установки и крутящий момент для каждого имплантата в соответствующих инструкциях по эксплуатации. Перед перемещением имплантата в хирургическое ложе следует убедиться, что он правильно размещается на соединении.
- Чрезмерное применение силы может привести к повреждению изделия, что, в свою очередь, может привести к невозможности проведения процедуры.
- Рекомендуется, чтобы продукция NEODENT для направленной хирургии использовалась только квалифицированными специалистами со знанием методик направленной хирургии NEODENT.
- Ненадлежащее планирование хирургических и/или ортодонтических работ может поставить под угрозу характеристики сборки имплантатов/протезов, что может привести к сбоям системы, таким как потеря или разрушение имплантата, ослабление или разрушение абатментов и/или винтов для протезирования.
- Не используйте изделие, если целостность упаковки была нарушена.

- Не используйте продукт с истекшим сроком годности.
- Настоящее изделие должно использоваться после стерилизации
- Перед каждой процедурой убедитесь, что детали установлены надлежащим образом.
- Убедитесь, что пациент не проглотил и не вдохнул детали.
- Перед каждой процедурой проверяйте параметры хирургических инструментов NEODENT, всегда учитывая их срок годности. При наличии повреждений, удаленной маркировки, затупления, деформации и следов износа замените инструменты.
- Перед использованием вставки для динамометрического ключа проверьте наличие и целостность его ретенционного кольца.
- Лучшие результаты достигаются при использовании линейки изделий NEODENT. Применение инструментов и/или компонентов протезирования других производителей не гарантирует идеальную работу Системы имплантатов NEODENT и исключает любую гарантию на изделие.
- Профессиональная ответственность заключается в применении изделий NEODENT в соответствии с инструкциями по использованию.

12. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

Если изделие используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации, побочных эффектов не ожидается, кроме случаев возможной аллергии или гиперчувствительности к нержавеющей стали и/или титану.

13. Сведения о техническом обслуживании, сведения о поверке

Послеоперационные меры предосторожности и техническое обслуживание

Следует проинструктировать пациента о необходимости профессионального медицинского наблюдения после операции и соблюдении рекомендаций в отношении мер предосторожности, гигиены и назначения лекарственных средств. Ответственность за указанные рекомендации несет лечащий врач.

14. Условия транспортирования и хранения

Таблица 5

	Условия хранения	Условия транспортирования
Температура	от 0°C до +40°C	от -20°C до +60°C
Относительная влажность	от 10% до 90% (без конденсации)	от 10% до 95% (без конденсации)
Высота над уровнем моря (атмосферное давление)	от 600 гПа до 1060 гПа	

Данное изделие следует хранить в чистом и сухом месте, и защищать от прямых солнечных лучей.

15. Охрана окружающей среды

15.1 Требования к охране окружающей среды при применении медицинского изделия

Каждое изделие и расходные материалы, используемые во время операции по установке зубных имплантатов и ортопедических компонентов, представляет опасность для здоровья лиц, производящих их обработку после использования. Перед утилизацией в

окружающую среду рекомендуется ознакомиться с действующим законодательством и соблюдать его.

15.2 Порядок осуществления утилизации и уничтожения, указание, при необходимости, специальных мер предосторожности при уничтожении медицинских изделий

Изделие подлежит утилизации в соответствии с местным законодательством и больничной практикой.

Данное изделие не содержит опасных материалов.

Неиспользованные изделия с истекшим сроком годности утилизируются как отходы класса А в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

После контакта с организмом пациента изделие утилизируются как отходы класса Б в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

16. Срок службы, срок годности

Срок службы: Рекомендованный срок эксплуатации настоящего изделия составляет до 30 применений при условии соблюдения режима использования.

Независимо от количества использований инструмента специалист должен всегда проверять характеристики изделия после каждого использования.

Срок годности: 5 лет.

17. Сведения о программном обеспечении

Не применимо.

18. Сведения об ЭМС

Не применимо.

19. Требования к монтажу и установке

Не применимо.

20. Гарантийные обязательства

Объем гарантии

NEODENT гарантирует стоматологам, пользователям его изделий, замену хирургических инструментов, имеющими дефекты или неблагоприятные события, в соответствии с периодами гарантии, при условии, что они приобрели оригинальные изделия NEODENT в соответствии с инструкциями по применению, предоставляемыми компанией NEODENT, и с учетом условий и ограничений гарантий, описанных ниже. Эта гарантия распространяется только на обмен изделий NEODENT; Другие затраты, связанные с лечением, не покрываются, включая материалы и само лечение.

Настоящая гарантия требует:

- a) законное приобретение стоматологом оригинальных изделий NEODENT без комбинации изделий с другими брендами;
- b) Тщательный отбор пациента с клиническими показаниями для протезирования дентальными имплантатами и правильное использование;
- c) Информированное согласие пациента с надлежащим руководством и разъяснением стоматолога в отношении вариантов протезирования, рисков и преимуществ;
- d) Что у пациента нет противопоказаний, описанных в инструкциях по применению до, во время или после установки имплантата / ортопедического элемента;
- e) Использование изделия было выполнено в строгом соответствии с рекомендациями и рекомендациями в инструкции по применению для каждого изделия;
- f) Соблюдение осторожности до и после операции, а также правильная и регулярная гигиена полости рта пациента;
- g) Документированные последующие посещения;
- h) Что ортопедический компонент (протез), установленный на имплантате (или подлежащий замене), позволяет правильную окклюзию между дугами.
- i) Форма гарантийного обеспечения полностью заполнена дистрибьюторам NEODENT в течение 30 дней после возникновения.

Гарантия предоставляется исключительно профессиональному стоматологу хирургу, явно исключая какое-либо право на третьи стороны, пациентов или промежуточных поставщиков.

В случае несоответствия условий, описанных в настоящей Политике гарантий, местному законодательству, положения этого положения будут иметь преимущественную силу.

Гарантийные условия

Для применения описанных здесь условий профессионалы должны проявлять максимальную заботу до, во время и после использования изделий, изготовленных NEODENT.

NEODENT рекомендует стоматологу соблюдать показания и противопоказания для каждого пациента, следуя рекомендациям, содержащимся в инструкциях по применению.

NEODENT просит профессионального стоматолога обеспечить надлежащую гигиену полости рта у пациента и регулярное наблюдение и документирование консультаций.

NEODENT должен только изучить изделие после получения формы гарантии, которую может получить у уполномоченного представителя производителя / регионального представителя, должным образом заполненная, в течение тридцати (30) дней обнаружения дефекта, но не позднее окончания срока хранения инструмента.

Замена продукта происходит только после получения формы и в течение 30 (тридцати) дней, описанных выше.

Исключения из этой гарантии

Настоящая гарантия не распространяется на:

Изделие NEODENT, которое не использовалось в соответствии с инструкциями производителя по применению;

Изделие NEODENT, которое получило какое-либо загрязнение, вызванное профессионалом или третьими лицами;

Изделие NEODENT, которое было модифицировано или комбинировано с продуктами третьих сторон, не произведенными NEODENT;

Наличие противопоказаний, указанных в инструкциях по применению;

Неправильное обращение с изделием профессиональным стоматологом;

Неисправность или дефект продукта, возникший в результате несчастного случая, травмы или любой причины, связанной с ответственностью пациента, профессиональных или третьих лиц;

Общие ограничения и потеря гарантии

Гарантия, изложенная в настоящем документе, является единственной гарантией, предоставляемой компанией NEODENT.

NEODENT не принимает на себя ответственности за профессионального стоматолога за потерю бизнеса, доходов или упущенной выгоды, а также признает, что единственная связь между ними является меркантильной в результате покупки и продажи продукции, произведенной NEODENT, и указано, что Продукты NEODENT являются вкладом в занятие стоматолога.

NEODENT не несет ответственности за выполнение или отсутствие стоматологической практики, признанной в научной литературе, и не несет ответственности за убытки, которые непосредственно связаны с такой практикой.

Приобретая имплантаты NEODENT и участвуя в программе гарантий, профессиональный стоматолог принимает условия и положения, изложенные в настоящем документе.

Как осуществлять обмен Изделий в соответствии с настоящей гарантией

Для запроса технического отчета изделия, приобретенные у уполномоченного представителя производителя или регионального представителя, должны направляться исключительно на обмен изделия, если будет принято квалифицированное решение о дефекте изделия:

Отправка изделий.

Изделие должно быть отправлено должным образом дезинфицированное и стерилизованное в сопровождении следующих документов:

Заявление Стерилизация, сопровождающая форму гарантии, заполненная клиентом, включая необходимую информацию, такую как: номер партии продукта, номер счета-фактуры, номер цикла стерилизации, дата и ответственность за стерилизацию;

Копия счета на покупку изделия;

Полностью заполненная форма с указанием всех необходимых данных;

Примечание. Для стран, в которых законодательство не допускает информацию о пациентах, эти данные не применяются.

Изделия, которые не очищаются и стерилизуются, не будут приняты для замены в соответствии с этой гарантией:

- Не принимаются при получении;

- Стоматолог берет на себя всю ответственность за расходы по возможному найму субподрядчиков для стерилизации продуктов, отправленных без соблюдения вышеуказанных пунктов.

Подготовка технического отчета NEODENT производится в течение сорока пяти (45) рабочих дней при условии соблюдения всех описанных здесь условий.

NEODENT обеспечивает конфиденциальность клинической информации пациента.

Изменения и прекращение гарантии

Компания NEODENT оставляет за собой право изменять гарантийные периоды в любое время, полностью или частично. Модификация этой Гарантийной политики не повлияет на продукты, размещенные до внесения в них изменений.

21. Сведения о производителе медицинского изделия и уполномоченном представителе

21.1 Наименование и адрес производителя

JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A.

(Джей Джей Джи Си Индустриа э Комерсио Де Материалис Дентариос С.А.), Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3291, Cidade Industrial, Curitiba, Pr., 81.270-200, Brazil (Бразилия).

21.2 Адрес места производства

1. JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A., Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3291, 81270200, Curitiba- Paraná, Pr, Brazil (Бразилия)
2. JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A., Site 4401, Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3715 81270200 Curitiba, Pr., Brazil (Бразилия).

21.3 Сведения об уполномоченном представителе. Рекламация

Общество с ограниченной ответственностью «Штрауманн» (ООО «Штрауманн»).

Адрес: Российская Федерация, 119571 г. Москва, Ленинский проспект, д.119А.

Телефон: +7 495 139 74 74

Адрес электронной почты: info.ru@straumann.com

Сайт: www.straumann.ru

ШТАМП В ВИДЕ СТРЕЛКИ: СЛУЖБА РАЙОНА
КАМПО КОМПРИДО
КУРИТИБА – ШТАТ ПАРАНА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕЧАТЬ:

СЛУЖБА РАЙОНА КАМПО КОМПРИДО	НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА И ЗАГС Служащий Ренато Фарто Лано	Ул. проф. Педро Вириято Паригот де Соуза, № 3901, оф. 15, Куритиба/Штат Парана Почтовый индекс 81280-330	41 3373 7330 www.cartoriiodocampo.comprido.com.br cartorio@cartoriiodocampocomprido.com.br
Я удостоверяю подпис(ь)и [0164204] – ТАИС ЛЕТИСИЯ БАРБОЗА<i>Подпись</i>..... Куритиба – Штат Парана, 03 ноября 2023 года. Заверяю <i>Подпись</i> ФЛАВИЯ АНДРЕЙЯ ДА СИЛВА – СЛУЖАЩАЯ Печать: SFTN1.YGrdb.CL9wV-pPDA3.F404q Обратитесь на сайт https://selo.funarpen.com.br.consulta ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЕЗ ДОБАВЛЕНИЙ И ПОМАРОК			
			QR КОД

КРУГЛАЯ ПЕЧАТЬ:
СЛУЖБА РАЙОНА КАМПО КОМПРИДО
КУРИТИБА – ШТАТ ПАРАНА

Перевод данного текста выполнен переводчиком Кинах Валентиной Петровной.



Российская Федерация

Город Москва

Четырнадцатого декабря две тысячи двадцать третьего года


Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Кинах Валентины Петровны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2023-

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Ф.А. Квитко

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью 19 лист(а)(ов)

Нотариус

