

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «РЕГИКОМ»

Козлов И.

« 14 / 11 2023 г.



Фотографические изображения

«Материал стоматологический реставрационный светоотверждаемый выделяющий фтор, различных вариантов исполнения, с принадлежностями»

Производитель: SHOFU INC. (ШОФУ ИНК.), Япония
11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983 Япония

1. Материал стоматологический реставрационный светоотверждаемый выделяющий фтор BEAUTIFIL II



2. Материал стоматологический реставрационный светоотверждаемый выделяющий фтор BEAUTIFIL II
Tips



BEAUTIFIL II A3

Tips 0.25g x 20 pcs

- (en) Fluoride Releasing Restorative Material
- (de) Fluoridfreisetzendes Füllungsmaterial
- (fr) Matériau de restauration à libération de fluor
- (nl) Fluoride afgevend restauratiemateriaal
- (es) Material de restauración con liberación de fluor
- (it) Materiale ricostruttivo a rilascio di fluor
- (ru) Выделяющий фтор реставрационный материал
- (pl) Uwalniający fluor materiał wypełnieniowy
- (ro) Material de restaurare cu degajare de fluor
- (sv) Fluoravgivande kompositmaterial
- (el) Υλικό αποκατάστασης με απελευθέρωση φθορίου

REF 1754

Official partner



Minimally Invasive
Cosmetic Dentistry



CE 0123

MD

Rx only



Radio-opaque

MADE IN JAPAN

www.shofu.com



10°C
34°F
min

30°C
86°F
max

Polymer-based
dental restorative material

A0052-01.0

SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine,
Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan



2024-03-31

LOT 042103

SHOFU DENTAL CORPORATION

1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD.

10 Science Park Road, #03-12, The Alpha Science Park II,
Singapore 117684

EC REP SHOFU DENTAL GmbH

An der Pöhl 70, 40885 Ratingen, Germany

SHOFU INC.


3. Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Flowable




4. Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Flowable
Tips



5. Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Restorative

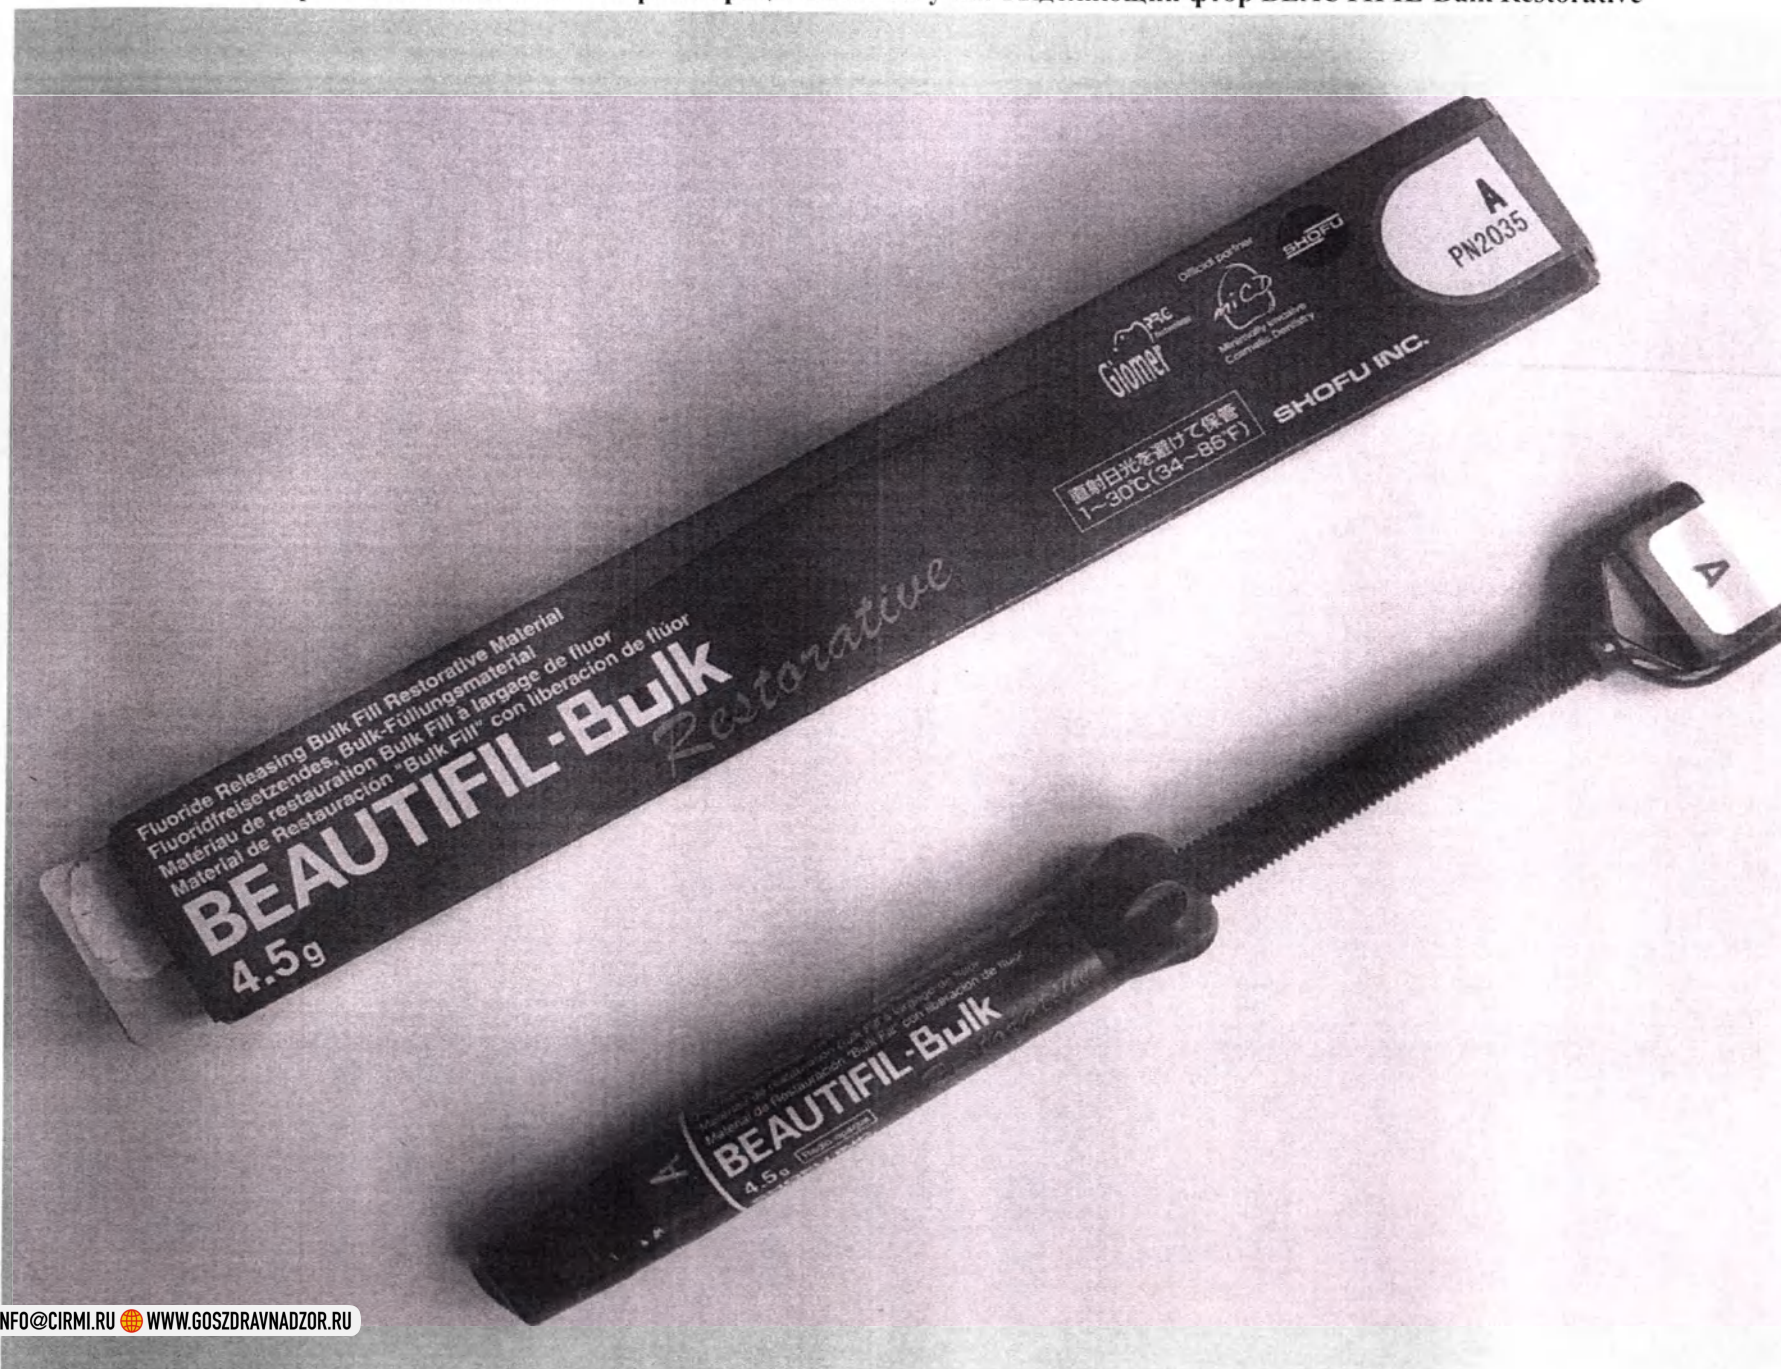

6. Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Restorative Tips

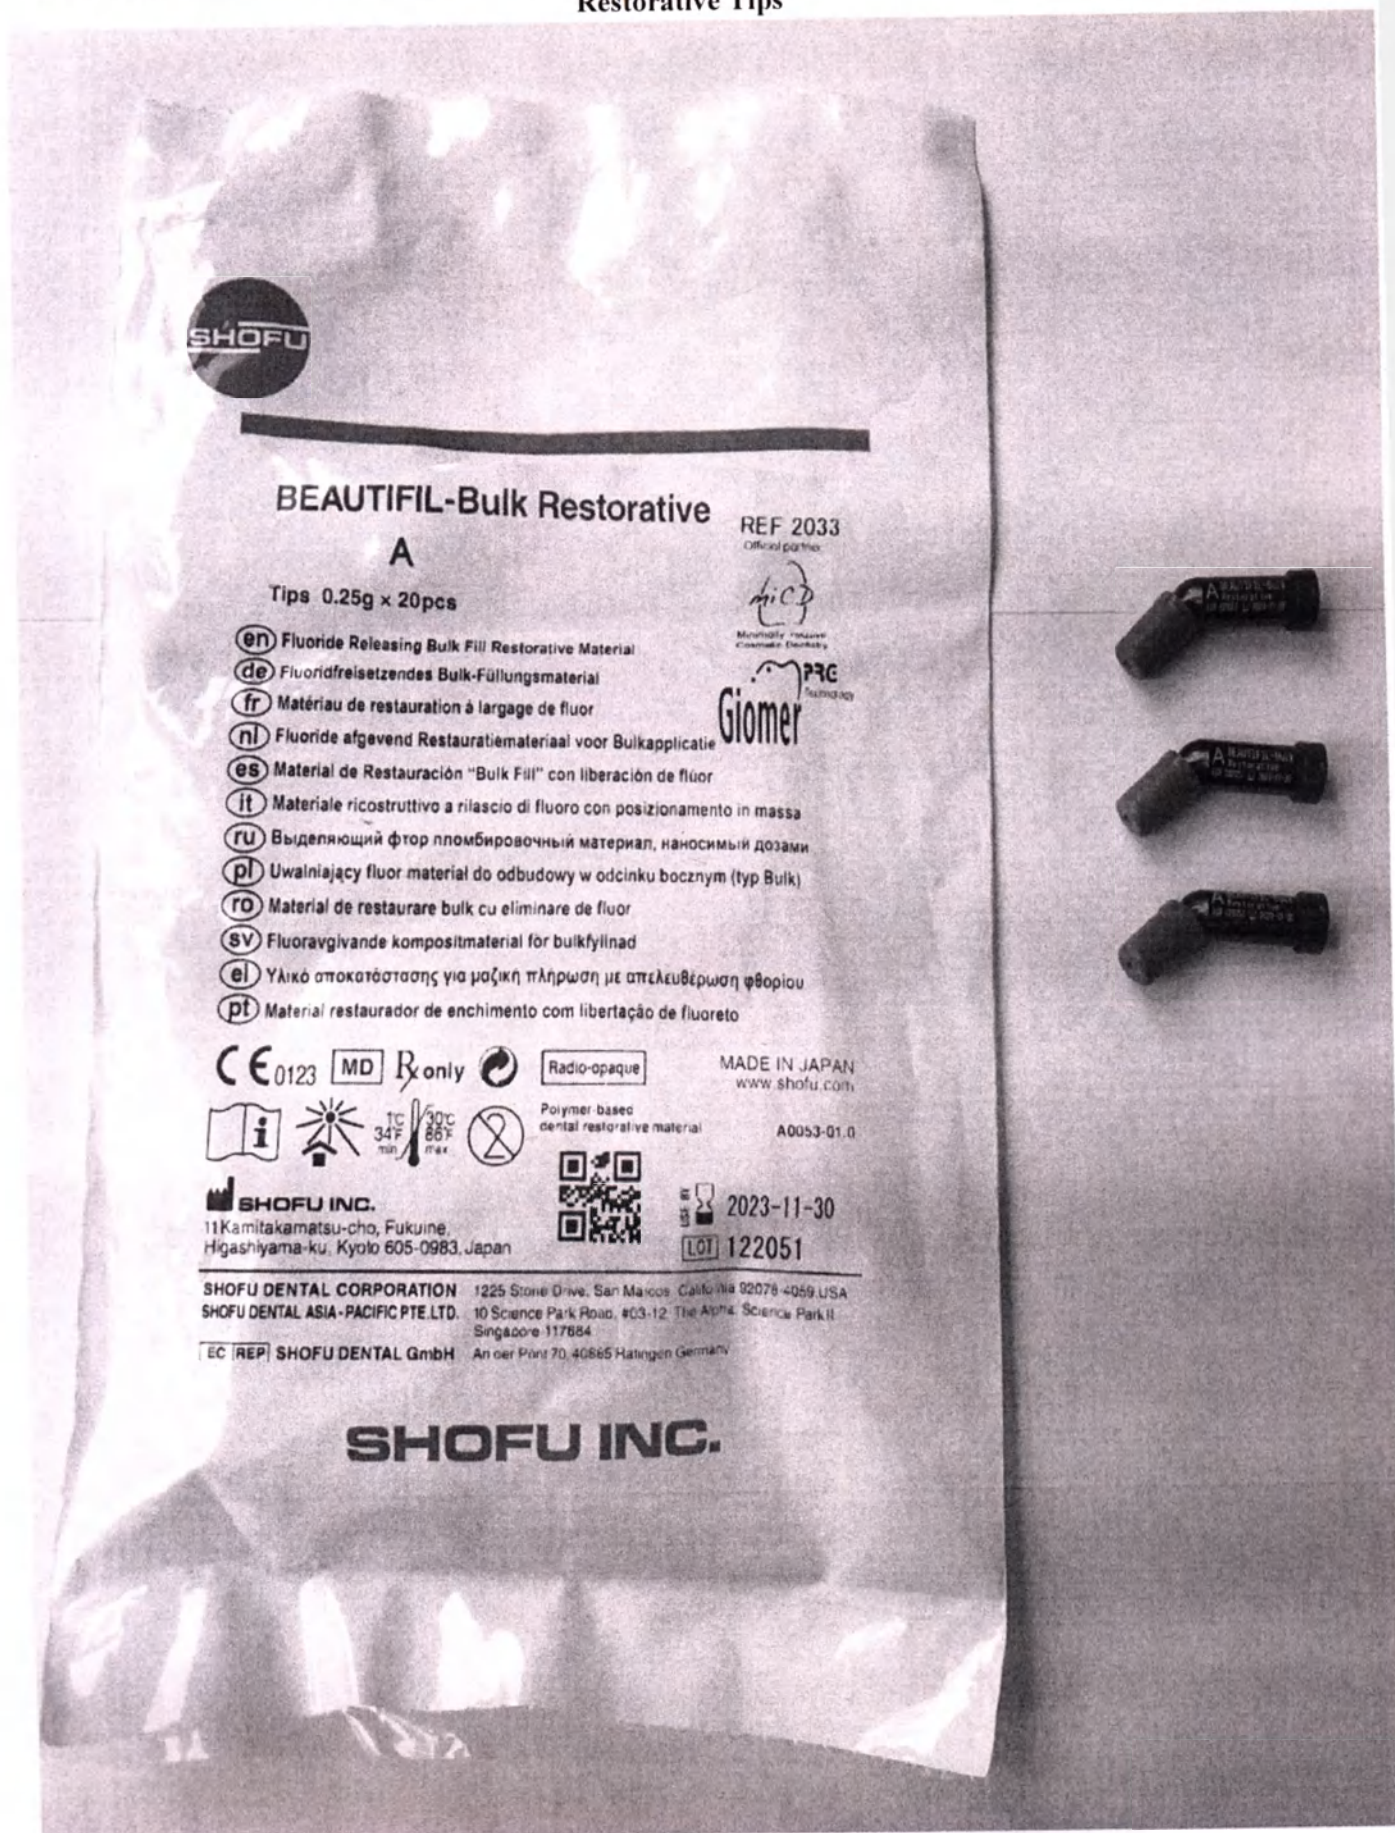

7. Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL Flow Plus F00





9. Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL Flow Plus F00
Tips



BEAUTIFIL Flow Plus

F00 A3

Tips 0.21g x 20 pcs

- (en) Fluoride Releasing Flowable Restorative Material
- (de) Fluoridfreisetzendes, fließfähiges Füllungsmaterial
- (fr) Matériau de restauration à largage de fluor
- (nl) Fluoride afgevend Flowable Restauratiemateriaal
- (es) Material de Restauración Fluido con liberación de fluor
- (it) Materiale scorrevole a rilascio di fluoro per ricostruzioni
- (ru) Выделяющий фтор, текучий пломбировочный материал
- (pl) Uwalniający fluor płynny materiał do odbudowy
- (ro) Material de restaurare cu viscozitate redusă cu degajare de fluor
- (sv) Fluoravgivande flytbart kompositmaterial
- (el) Υλικό αποκατάστασης ρευστής ρητίνης με απελευθέρωση φθορίου



REF 2203
Official partner



Minimally Invasive
Cosmetic Dentistry



Giomer




MADE IN JAPAN
www.shofu.com



Polymer-based
dental restorative material

A0050-01.0



11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine,
Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan



2024-03-31



042170

SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92075-4059, USA
SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE.LTD. 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park II,
Singapore 117684

EC (REP) SHOFU DENTAL GmbH An der Pont 70, 40885 Ratingen, Germany

SHOFU INC.

10. Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL Flow Plus F0
Tips



Проект текста маркировки на медицинское изделие «Материал стоматологический реставрационный светоотверждаемый выделяющий фтор BEAUTIFIL II» для обращения на территории Российской Федерации

Наименование медицинского изделия: Материал стоматологический реставрационный светоотверждаемый выделяющий фтор BEAUTIFIL II:

1. Материал стоматологический реставрационный светоотверждаемый выделяющий фтор BEAUTIFIL II в шприце по 4.5 г. – 1 шт. в упаковке (цветовой оттенок: XXX)

2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

Серийный номер (номер по каталогу): См. упаковку

Наименование производителя: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Место производства: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, Россия,

г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11

Код партии (серии): См. упаковку

Использовать до: См. упаковку

Условия хранения и транспортировки: от +1 °C до +30 °C

Нестерильно.

Нетоксично.

Только для использования в стоматологии.

Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Проект текста маркировки на медицинское изделие «Материал стоматологический реставрационный светоотверждаемый выделяющий фтор BEAUTIFIL II Tips» для обращения на территории Российской Федерации

Наименование медицинского изделия: Материал стоматологический реставрационный светоотверждаемый выделяющий фтор BEAUTIFIL II Tips:

1. Материал стоматологический реставрационный светоотверждаемый выделяющий фтор BEAUTIFIL II Tips в капсулах по 0.25 г – 20 шт. в упаковке (цветовой оттенок: XXX)

2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

Серийный номер (номер по каталогу): См. упаковку

Наименование производителя: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Место производства: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, Россия,

г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11

Код партии (серии): См. упаковку

Использовать до: См. упаковку

Условия хранения и транспортировки: от +1 °C до +30 °C

Нестерильно.

Нетоксично.

Только для использования в стоматологии.

Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Проект текста маркировки на медицинское изделие «Материал стоматологический реставрационный текущий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Flowable» для обращения на территории Российской Федерации

Наименование медицинского изделия: Материал стоматологический реставрационный текущий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Flowable:

1. Материал стоматологический реставрационный текущий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Flowable в шпатель 2.4 г. – 1 шт. в упаковке (цветовой оттенок: Universal)

2. Насадки – 5 шт.

3. Эксплуатационная документация – 1 шт.

Серийный номер (номер по каталогу): См. упаковку

Наименование производителя: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Место производства: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, Россия,

г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11

Код партии (серии): См. упаковку

Использовать до: См. упаковку

Условия хранения и транспортировки: от +1 °C до +30 °C

Нестерильно.

Нетоксично.

Только для использования в стоматологии.

Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Наименование медицинского изделия: Материал стоматологический реставрационный текущий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Flowable:

1. Материал стоматологический реставрационный текущий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Flowable в шпатель 2.4 г. – 1 шт. в упаковке (цветовой оттенок: Dentin)

2. Насадки – 5 шт.

3. Эксплуатационная документация – 1 шт.

Серийный номер (номер по каталогу): См. упаковку

Наименование производителя: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Место производства: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, Россия,

г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11

Код партии (серии): См. упаковку

Использовать до: См. упаковку

Условия хранения и транспортировки: от +1 °C до +30 °C

Нестерильно.

Нетоксично.

Только для использования в стоматологии.

Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Проект текста маркировки на медицинское изделие «Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Flowable Tips» для обращения на территории Российской Федерации

Наименование медицинского изделия: Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Flowable Tips:

1. Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Flowable Tips в капсулах по 0.23 г – 20 шт. в упаковке (цветовой оттенок: Universal)

2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

Серийный номер (номер по каталогу): См. упаковку

Наименование производителя: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Место производства: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, Россия,

г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11

Код партии (серии): См. упаковку

Использовать до: См. упаковку

Условия хранения и транспортировки: от +1 °C до +30 °C

Нестерильно.

Нетоксично.

Только для использования в стоматологии.

Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Наименование медицинского изделия: Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Flowable Tips:

1. Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Flowable Tips в капсулах по 0.23 г – 20 шт. в упаковке (цветовой оттенок: Dentin)

2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

Серийный номер (номер по каталогу): См. упаковку

Наименование производителя: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Место производства: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, Россия,

г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11

Код партии (серии): См. упаковку

Использовать до: См. упаковку

Условия хранения и транспортировки: от +1 °C до +30 °C

Нестерильно.

Нетоксично.

Только для использования в стоматологии.

Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Проект текста маркировки на медицинское изделие «Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Restorative» для обращения на территории Российской Федерации

Наименование медицинского изделия: Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Restorative:
1. Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Restorative в шприце 4.5 г. – 1 шт. в упаковке (цветового оттенка: Universal)
2. Эксплуатационная документация – 1 шт.
Серийный номер (номер по каталогу): См. упаковку
Наименование производителя: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan (11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)
Место производства: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan (11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, Россия, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11
Код партии (серии): См. упаковку
Использовать до: См. упаковку
Условия хранения и транспортировки: от +1 °C до +30 °C
Нестерильно.
Нетоксично.
Только для использования в стоматологии.
Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Наименование медицинского изделия: Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Restorative:
1. Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Restorative в шприце 4.5 г. – 1 шт. в упаковке (цветового оттенка: А)
2. Эксплуатационная документация – 1 шт.
Серийный номер (номер по каталогу): См. упаковку
Наименование производителя: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan (11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)
Место производства: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan (11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)
Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, Россия, г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11
Код партии (серии): См. упаковку
Использовать до: См. упаковку
Условия хранения и транспортировки: от +1 °C до +30 °C
Нестерильно.
Нетоксично.
Только для использования в стоматологии.
Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Проект текста маркировки на медицинское изделие «Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Restorative» для обращения на территории Российской Федерации

Наименование медицинского изделия: Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Restorative Tips:

1. Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Restorative Tips в капсулах по 0,25 г – 20 шт. в упаковке (цветовой оттенок: Universal)

2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

Серийный номер (номер по каталогу): См. упаковку

Наименование производителя: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Место производства: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, Россия,

г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11

Код партии (серии): См. упаковку

Использовать до: См. упаковку

Условия хранения и транспортировки: от +1 °C до +30 °C

Нестерильно.

Нетоксично.

Только для использования в стоматологии.

Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Наименование медицинского изделия: Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Restorative Tips:

1. Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL-Bulk Restorative Tips в капсулах по 0,25 г – 20 шт. в упаковке (цветовой оттенок: А)

2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

Серийный номер (номер по каталогу): См. упаковку

Наименование производителя: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Место производства: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, Россия,

г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11

Код партии (серии): См. упаковку

Использовать до: См. упаковку

Условия хранения и транспортировки: от +1 °C до +30 °C

Нестерильно.

Нетоксично.

Только для использования в стоматологии.

Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Проект текста маркировки на медицинское изделие «Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL Flow Plus F00» для обращения на территории Российской Федерации

Наименование медицинского изделия: Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL Flow Plus F00:

1. Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL Flow Plus F00 в шприце 2.2 г – 1 шт. в упаковке (цветовой оттенок: XXX)

2. Насадки - 5 шт.

3. Эксплуатационная документация – 1 шт.

Серийный номер (номер по каталогу): См. упаковку

Наименование производителя: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Место производства: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РЕГ ИКОМ», 123290, Россия,

г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11

Код партии (серии): См. упаковку

Использовать до: См. упаковку

Условия хранения и транспортировки: от +1 °C до +30 °C

Нестерильно.

Нетоксично.

Только для использования в стоматологии.

Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Проект текста маркировки на медицинское изделие «Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL Flow Plus F03» для обращения на территории Российской Федерации

Наименование медицинского изделия: Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL Flow Plus F03:

1. Материал стоматологический реставрационный текучий выделяющий фтор BEAUTIFIL Flow Plus F03 в шприце по 1 или 2.2 г – 1 шт. в упаковке (цветовой оттенок: XXX)

2. Насадки - 5 шт.

3. Эксплуатационная документация – 1 шт.

Серийный номер (номер по каталогу): См. упаковку

Наименование производителя: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Место производства: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РЕГ ИКОМ», 123290, Россия,

г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11

Код партии (серии): См. упаковку

Использовать до: См. упаковку

Условия хранения и транспортировки: от +1 °C до +30 °C

Нестерильно.

Нетоксично.

Только для использования в стоматологии.

Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Проект текста маркировки на медицинское изделие «Материал стоматологический реставрационный, текущий выделяющий фтор BEAUTIFIL Flow Plus F00 Tips» для обращения на территории Российской Федерации

Наименование медицинского изделия: Материал стоматологический реставрационный текущий выделяющий фтор BEAUTIFIL Flow Plus F00 Tips:

1. Материал стоматологический реставрационный текущий выделяющий фтор BEAUTIFIL Flow Plus F00 Tips в капсулах по 0.21 г – 20 шт. в упаковке (цветовой оттенок: XXX)

2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

Серийный номер (номер по каталогу): См. упаковку

Наименование производителя: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Место производства: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, Россия,

г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11

Код партии (серии): См. упаковку

Использовать до: См. упаковку

Условия хранения и транспортировки: от +1 °C до +30 °C

Нестерильно.

Нетоксично.

Только для использования в стоматологии.

Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Проект текста маркировки на медицинское изделие «Материал стоматологический реставрационный, текущий выделяющий фтор BEAUTIFIL Flow Plus F03 Tips» для обращения на территории Российской Федерации

Наименование медицинского изделия: Материал стоматологический реставрационный текущий выделяющий фтор BEAUTIFIL Flow Plus F03 Tips:

1. Материал стоматологический реставрационный текущий выделяющий фтор BEAUTIFIL Flow Plus F03 Tips в капсулах по 0.21 г – 20 шт. в упаковке (цветовой оттенок: XXX)

2. Эксплуатационная документация – 1 шт.

Серийный номер (номер по каталогу): См. упаковку

Наименование производителя: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Место производства: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, Россия,

г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11

Код партии (серии): См. упаковку

Использовать до: См. упаковку

Условия хранения и транспортировки: от +1 °C до +30 °C

Нестерильно.

Нетоксично.

Только для использования в стоматологии.

Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Проект текста маркировки «Шкала оттенков BEAUTIFIL II SHADE GUIDE для материала стоматологического реставрационного светоотверждаемого выделяющий фтор» для обращения на территории Российской Федерации

Шкала оттенков BEAUTIFIL II SHADE GUIDE для материала стоматологического реставрационного светоотверждаемого выделяющий фтор

Серийный номер (номер по каталогу): См. упаковку

Наименование производителя: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Место производства: «SHOFU INC.» («ШОФУ ИНК.»), Япония

11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto, 605-0983 Japan

(11 Камитакамацу-Чо, Фукуине, Хигашиям-ку, Киото 605-0983, Япония)

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «РЕГИКОМ», 123290, Россия,

г. Москва, вн.тер.г. м.о. Пресненский, Шмитовский пр-д, д. 39, к. 2, кв. 10, тел.: + 7 926 385-56-11

Код партии (серии): См. упаковку

Нестерильно.

Нетоксично.

Только для использования в стоматологии.

Регистрационное удостоверение: № XXX XXXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Прошито и пронумеровано
19 листов

Генеральный директор
И. Козлов

