


Макет маркировки на медицинское изделие
Калибратор для обеспечения правильности качественного
определения антител к вирусу гепатита С
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Анти-HCV
Калибратор (Alinity i Anti-HCV Calibrator)"



REF

08P06-02

IVD



Калибратор для обеспечения правильности качественного определения антител к вирусу гепатита С иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Анти-HCV Калибратор (Alinity i Anti-HCV Calibrator)"


в составе:

- Калибратор 1 (Alinity i Anti-HCV CAL 1) -1 флакон х 3,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott GmbH (Эбботт ГмбХ), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) /Страна происхождения: Германия.

РУ № РЗН 2019/9403 от XX.XX.202Xг. Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты. Инструкцию по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU. Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81.



H07 805P01



08P0602

www.corelaboratory.abbott/IFU

CAL 1 1 x 3.0 mL

CONTAINS: AZIDE

Abbott

Alinity i Anti-HCV Calibrator

Alinity i Anti-HCV Calibrator

Abbott




Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

IVD




0123

Anti-HCV Cal



PRODUCT OF GERMANY



REF

08P06-02

IVD



Калибратор для обеспечения правильности качественного определения антител к вирусу гепатита С иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Анти-HCV Калибратор (Alinity i Anti-HCV Calibrator)"

в составе:

- Калибратор 1 (Alinity i Anti-HCV CAL 1) - 1 флакон х 3,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott GmbH (Эбботт ГмбХ), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / Страна происхождения: Германия.

РУ № РЗН 2019/9403 от XX.XX.202Xг. Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты. Инструкцию по применению на русском языке: www.corelaboratory.abbott/IFU. Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1, Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81.

H07805RD01

LOT



08P0602

REF

www.corelaboratory.abbott/IFU

CAL 1 1 x 3.0 mL

CONTAINS AZIDE

Abbott

Alinity i Anti-HCV Calibrator

Alinity i Anti-HCV Calibrator

Abbott



Abbott GmbH
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-680


PRODUCT OF GERMANY

IVD




0123

Anti-HCV Cal



Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия

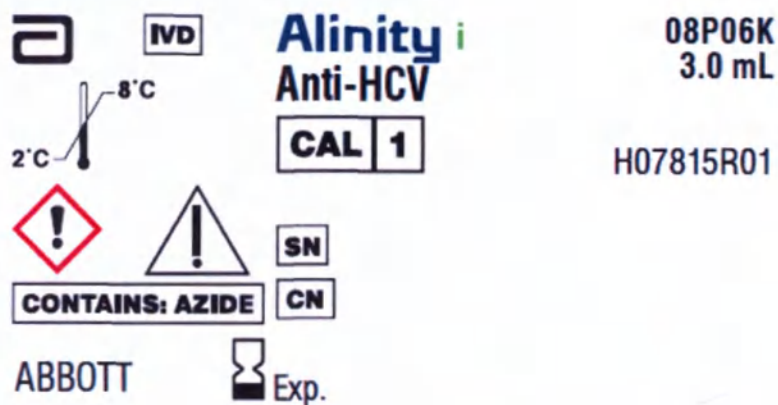

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> . Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования.
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка) – Часть 2: Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.


Расшифровка символов представлена в инструкции.



Подпись

[Handwritten signature]

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие
Калибратор для обеспечения правильности качественного определения
антител к вирусу гепатита С иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических
анализаторах Alinity i "Анти-НСV Калибратор (Alinity i Anti-HCV
Calibrator)"
(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

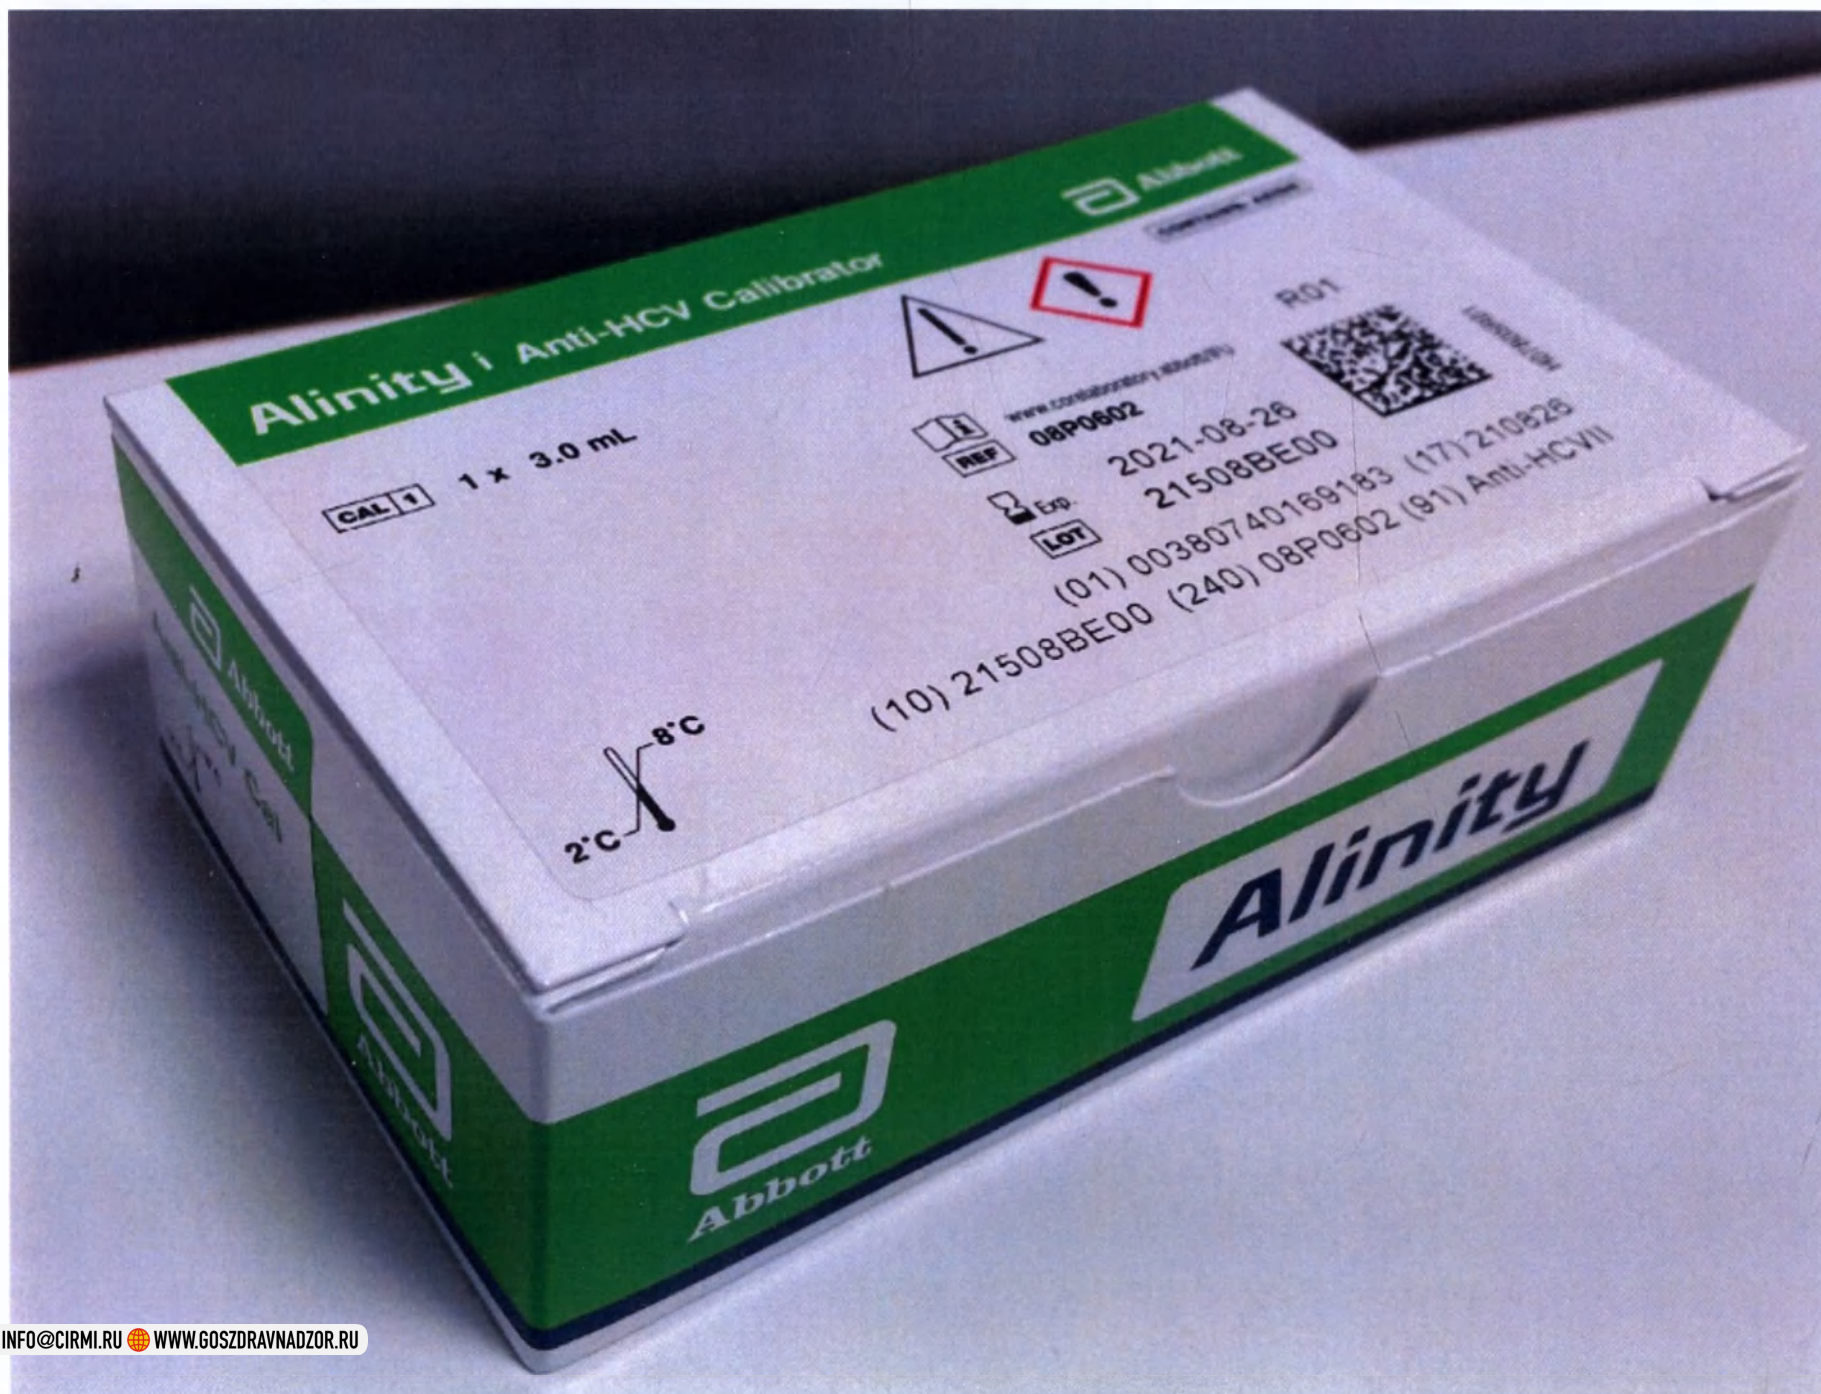





Фотографическое изображение открытой упаковки Анти-НСV Калибратор (Alinity i Anti-HCV Calibrator)



Фотографическое изображение флакона Анти-HCV Калибратор (Alinity i Anti-HCV Calibrator)

