

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Дилуэнт NaCl 9 % для разведения пробы при выполнении тестов на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (NACL /Diluent NaCl 9 % cobas c systems), в вариантах исполнения

Дилуэнт NaCl 9 % для разведения пробы при выполнении тестов на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas с (NACL/Diluent NaCl 9 % cobas с systems), в вариантах исполнения:

Вариант 1. Дилуэнт NaCl 9 % (NACL/Diluent NaCl 9 % cobas с systems), 50 мл

Общий вид



Дилуэнт NaCl 9 % для разведения пробы при выполнении тестов на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas с (NACL/Diluent NaCl 9 % cobas c systems), в вариантах исполнения:

Вариант 1. Дилуэнт NaCl 9 % (NACL/Diluent NaCl 9 % cobas c systems), 50 мл.

Макет маркировки на русском языке

Дилуэнт NaCl 9 % для разведения пробы при выполнении тестов на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas с (NACL/Diluent NaCl 9 % cobas c systems), в вариантах исполнения:

Вариант 1. Дилуэнт NaCl 9 % (NACL/Diluent NaCl 9 % cobas c systems), 50 мл

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/11728 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com


Кат. номер 04489357190

Вариант 1. Дилуент NaCl 9 % (NACL/Diluent NaCl 9 % cobas c systems), 50 мл.


Маркировка кассеты

Маркировка боковой стороны кассеты

Маркировка лицевой стороны кассеты

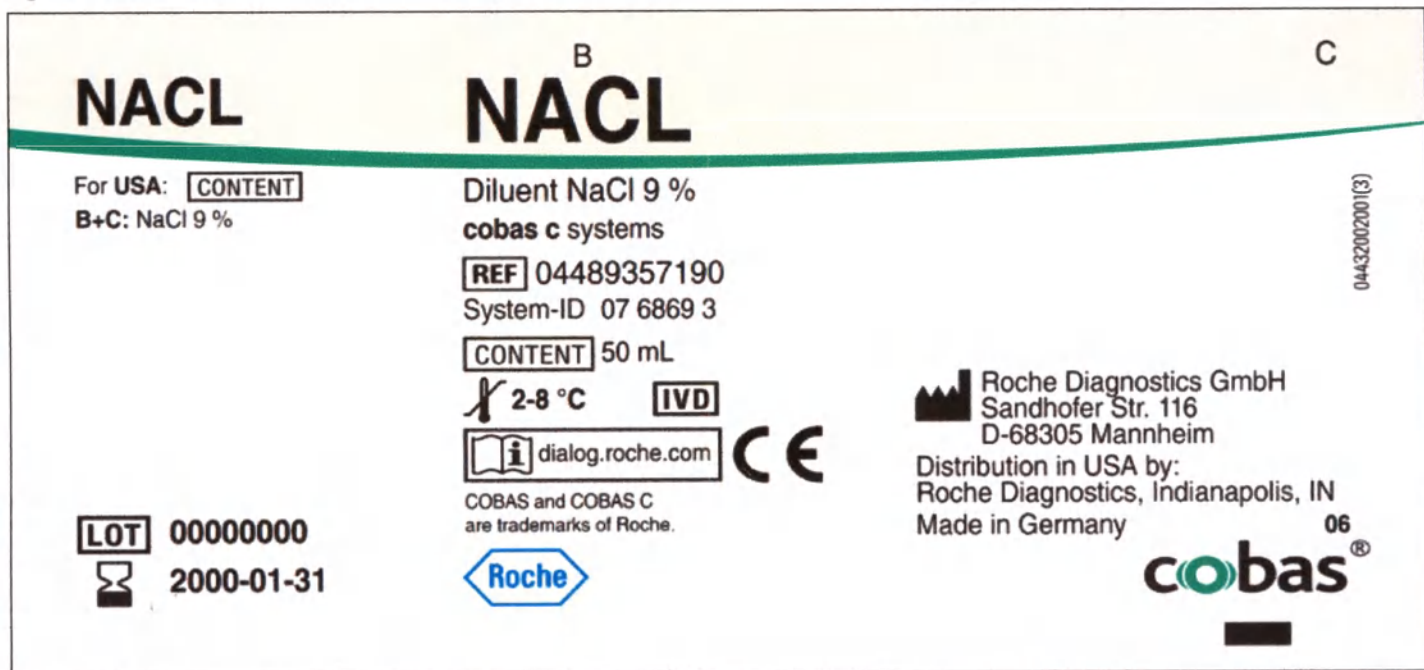

Маркировка оборотной стороны кассеты

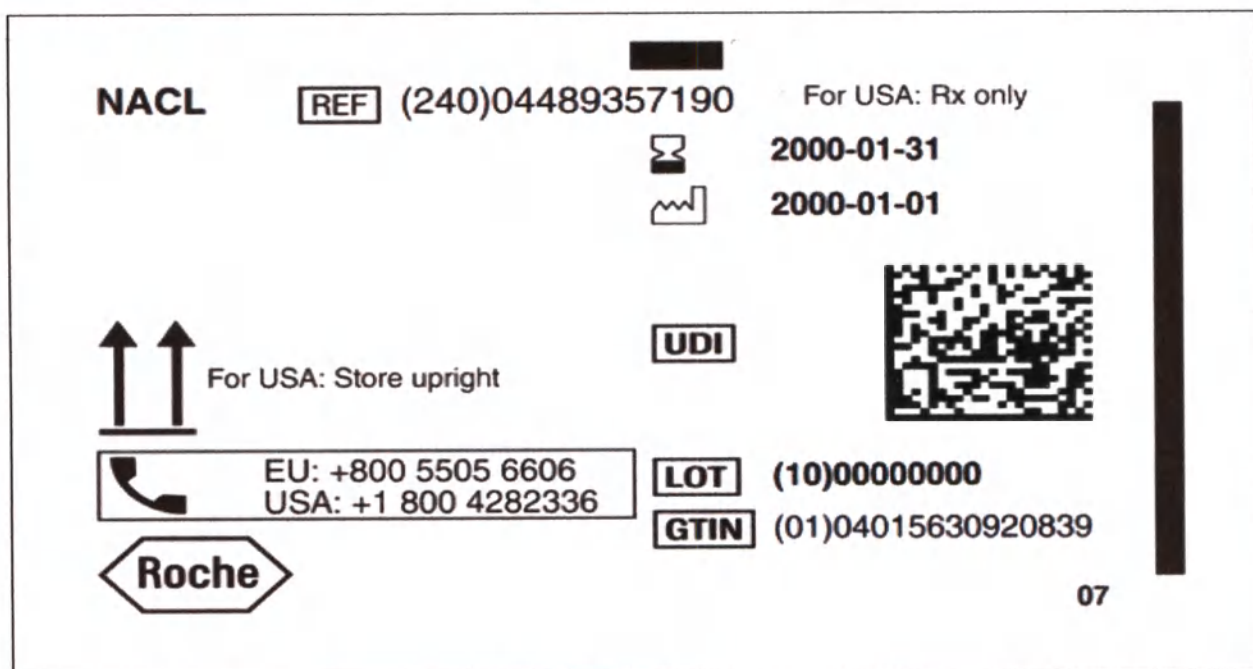

Дилуэнт NaCl 9 % для разведения пробы при выполнении тестов на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas с (NACL/Diluent NaCl 9 % cobas c systems), в вариантах исполнения:
Вариант 2. Дилуэнт NaCl 9 % (NACL/Diluent NaCl 9 % cobas c systems), 123 мл

Общий вид



Дилуэнт NaCl 9 % для разведения пробы при выполнении тестов на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas с (NACL/Diluent NaCl 9 % cobas с systems), в вариантах исполнения:

Вариант 2. Дилуэнт NaCl 9 % (NACL/Diluent NaCl 9 % cobas с systems), 123 мл

Макет маркировки на русском языке

Дилуэнт NaCl 9 % для разведения пробы при выполнении тестов на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas с (NACL/Diluent NaCl 9 % cobas с systems), в вариантах исполнения:

Вариант 2. Дилуэнт NaCl 9 % (NACL/Diluent NaCl 9 % cobas с systems), 123 мл

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/11728 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 08063494190

Дилуэнт NaCl 9 % для разведения пробы при выполнении тестов на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (NACL/Diluent NaCl 9 % cobas c systems), в вариантах исполнения:

Вариант 2. Дилуэнт NaCl 9 % (NACL/Diluent NaCl 9 % cobas c systems), 123 мл

Маркировка кассеты

Маркировка боковая
стороны кассеты

Маркировка лицевой
стороны кассеты

NACL

For USA: **CONTENT**
B+C: NaCl 9 %

LOT 00000000
2000-01-31

B

NACL

Diluent NaCl 9 %
cobas c systems
REF 08063494190
System-ID 29 0600 1
CONTENT 123 mL
2-8 °C **IVD**
 dialog.roche.com
COBAS and COBAS C
are trademarks of Roche.



C

04432002001(3)

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Germany

cobas[®] 02

Маркировка оборотной стороны кассеты

NACL

REF (240)08063494190

LOT (10)00000000
2000-01-31
2000-01-01

For USA: Rx only

UDI



GTIN (01)07613336122785

For USA: Store upright



EU: +800 5505 6606
USA: +1 800 4282336



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
4 листа (ов)



по доверенности
от 30.01.2023 г.

Всетава Н. Г.