



Научно-производственное предприятие

"ТЕХНОМЕДИКА"

Общество с ограниченной ответственностью

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО НПП «ТЕХНОМЕДИКА»



Ованесов Н.Е.

23.03 2022 г.

ФОТО

медицинского изделия

«Анализатор гипербилирубинемии фотометрический


АГФ-02 по ТУ 9443-002-11254896-2002»

с принадлежностями

Производитель ООО НПП «ТЕХНОМЕДИКА»

Москва


2022

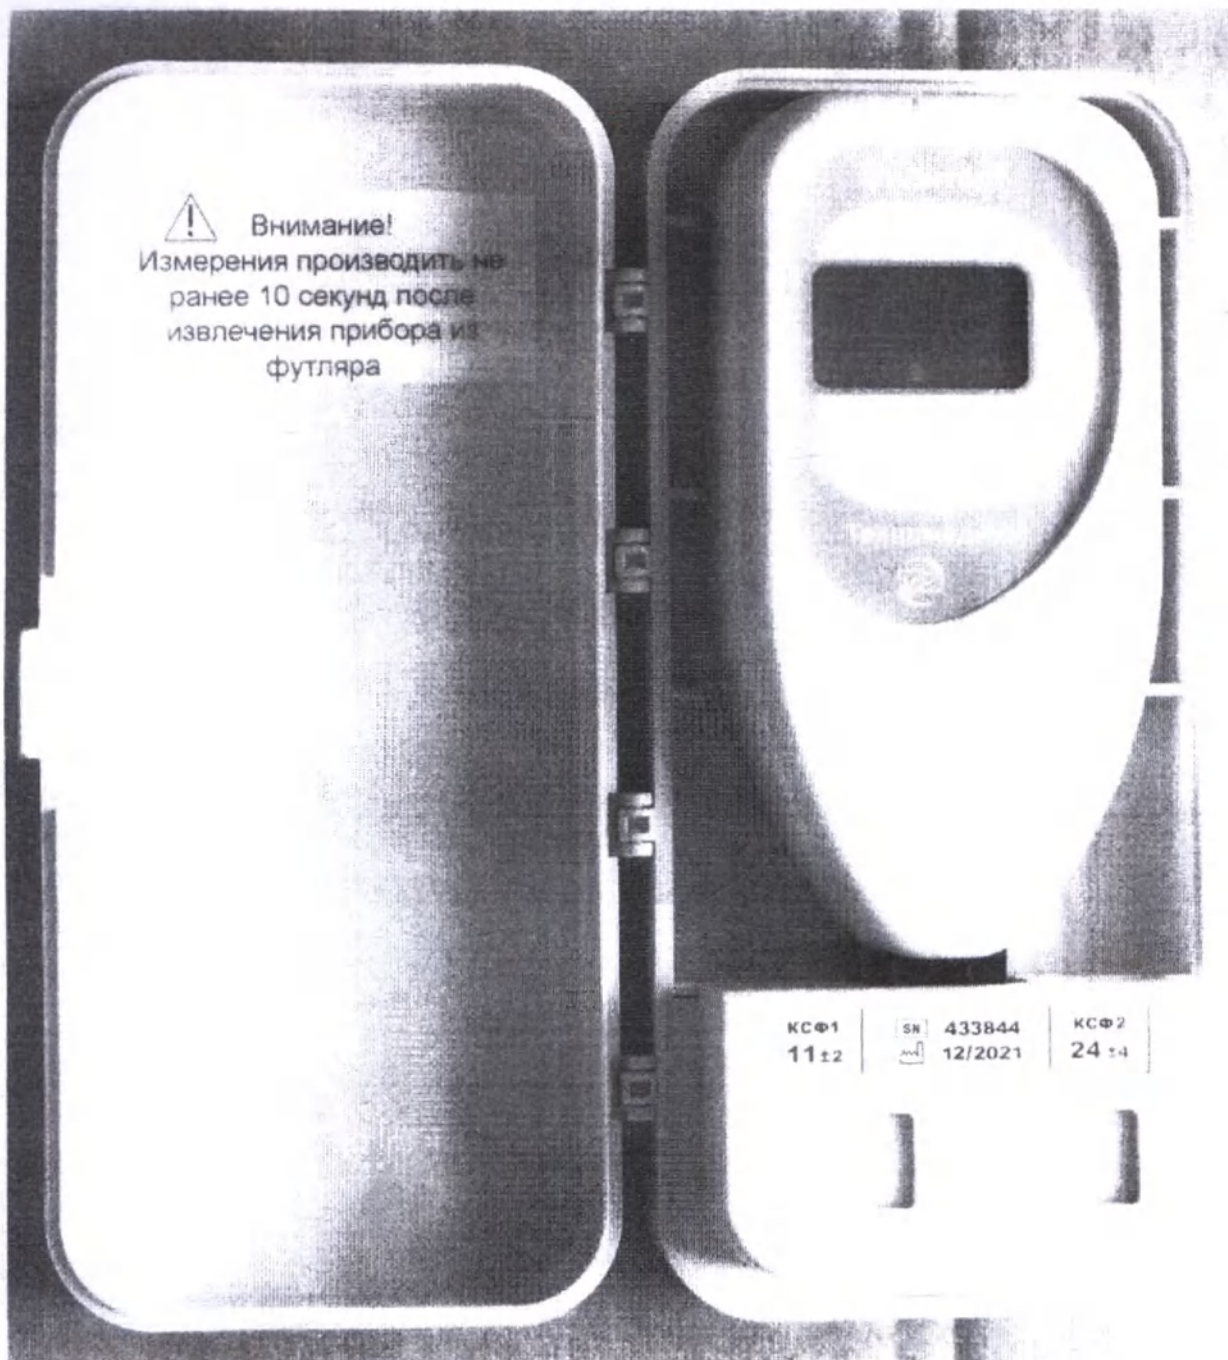

Прибор в футляре со встроенными контрольными светофильтрами КСФ1 и КСФ2




Прибор (вид спереди)

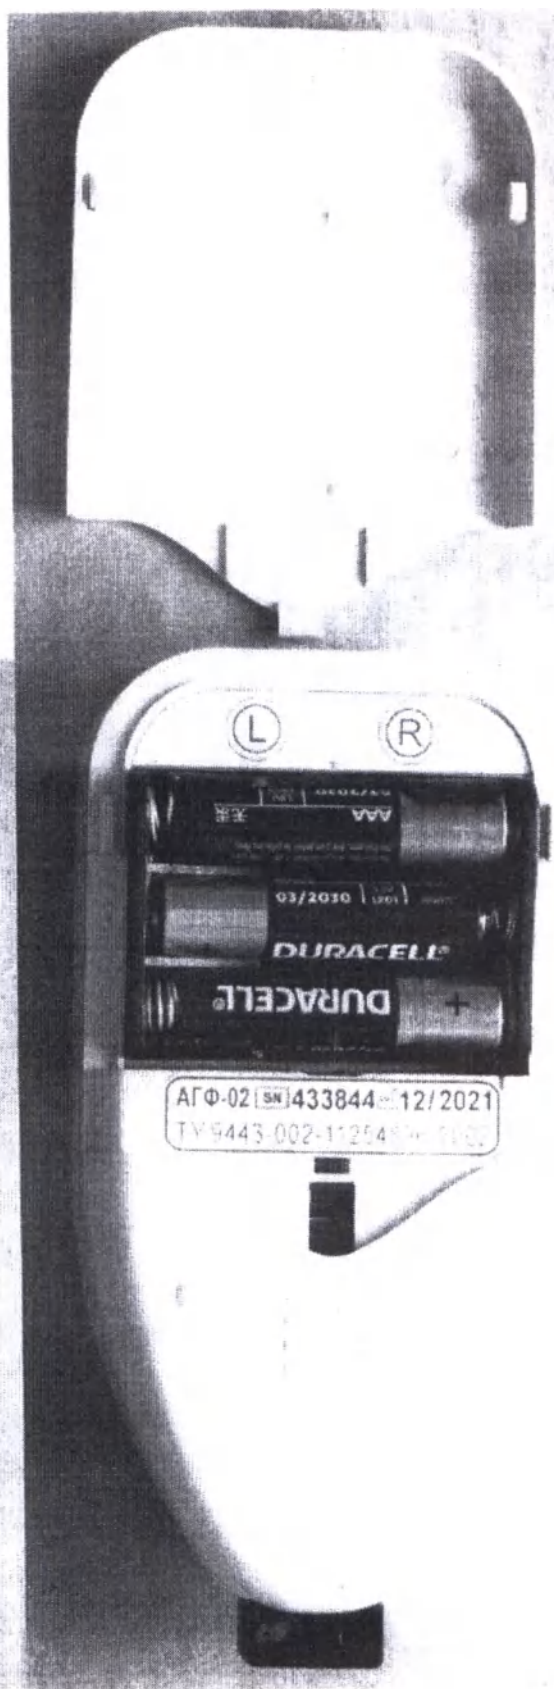

Прибор (вид сзади) с элементами питания
постоянного
напряжения 1,5, типа AAA или LR03 (3 шт).



Футляр с прибором (вид спереди)

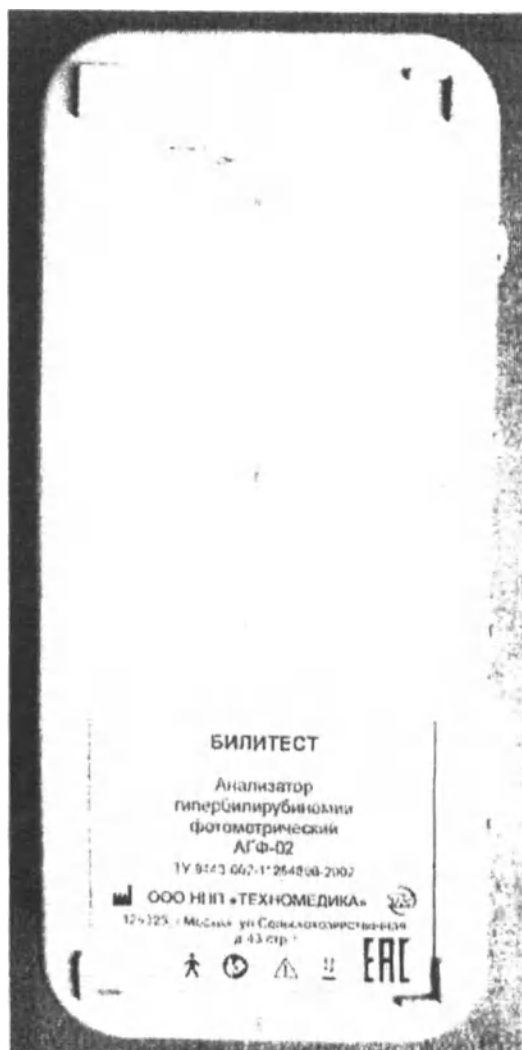

Футляр с прибором (вид сзади)
с этикеткой



БИЛИТЕСТ



Анализатор гипербилирубинемии
фотометрический
АГФ-02

ТУ 9443-002-11254896-2002



ООО НПФ «ТЕХНОМЕДИКА»
127081, Москва, а/я 1
www.technomedica.ru

Сделано в России

Серийный номер

Упаковщик

Дата упаковки

Штамп ОТК



Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

Условия хранения: 1 по ГОСТ 15150.

Транспортировать при температуре от -40 °C до +50 °C
при влажности не более 90%.

Маркировка упаковки