


Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ» одноразовый в составе:

- 1 Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ»
- 2 Выключающий 3-х ходовой запорный клапан
- 3 Инструкция по применению

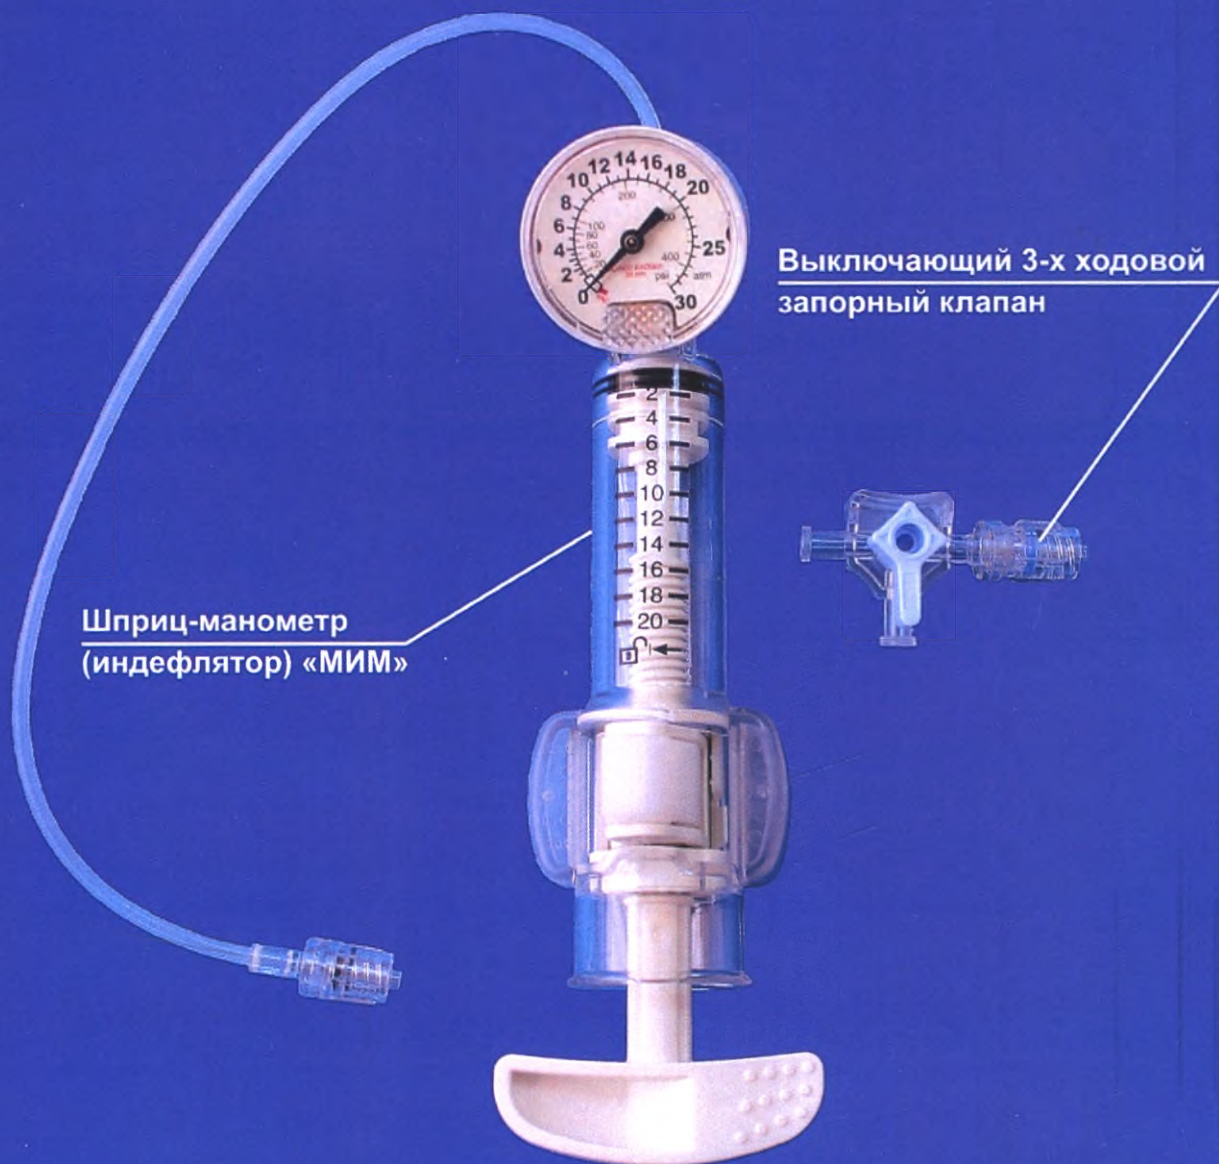

ТЮМЕНЬ ООО «МИМ»

ООО «МИМ» Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, стр. 1,
тел. +7 (904) 493-69-68

Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ» одноразовый,
в составе:

- 1 Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ»
- 2 Выключающий 3-х ходовой запорный клапан ☐
- 3 Интродьюсер проводника ☐
- 4 Муфта стяжная (пластиковая) ☐
- 5 Push-click Y коннектор с удлинителем ☐
- 6 Соединительная трубка ☐
- 7 Инструкция по применению


ТВНЛ.942319.027 ТУ РУ №

Срок годности **2024-11** стерильно апиrogenно нетоксично
(годен до)

Дата выпуска **2019-11**

Партия **19001**

STERILE EO   

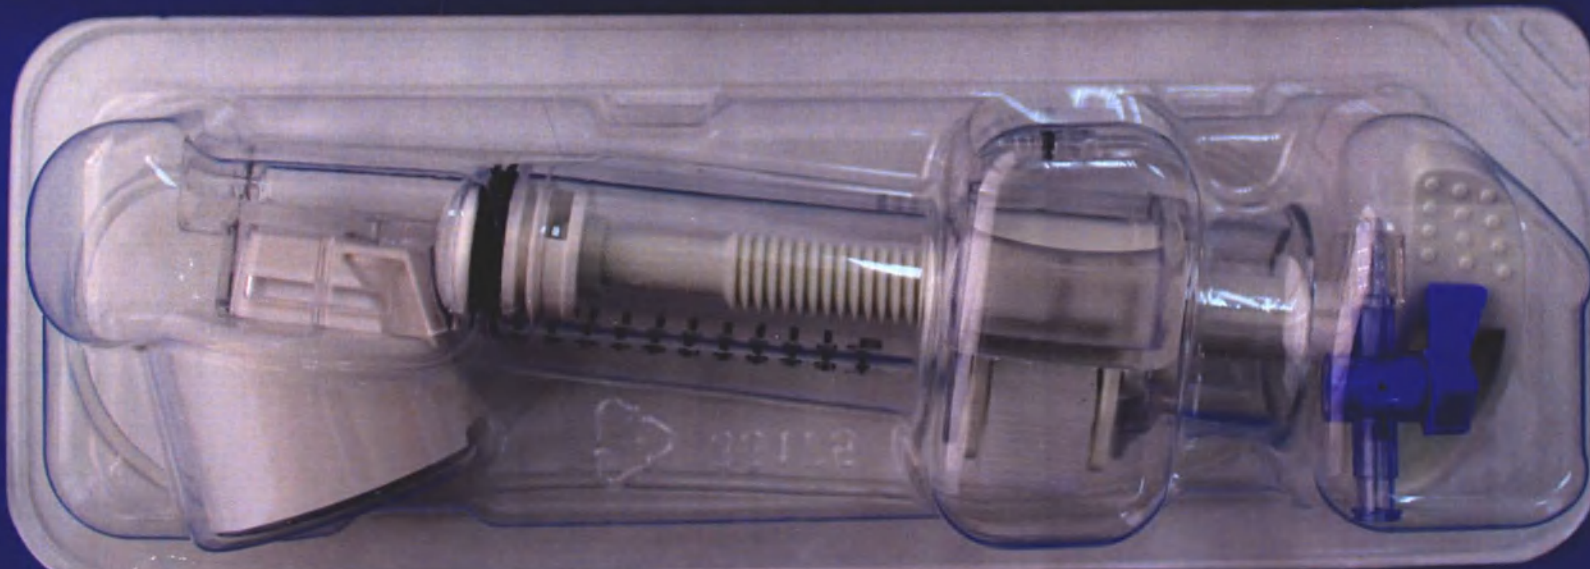

ТЮМЕНЬ ООО "МИМ"

ООО «МИМ» Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, стр. 1,
тел. +7 (904) 493-69-68

Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ» одноразовый,
в составе:


- 1 Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ»
- 2 Выключающий 3-х ходовой запорный клапан
- 3 Интродьюсер проводника
- 4 Муфта стяжная (пластиковая)
- 5 Push-click Y коннектор с удлинителем
- 6 Соединительная трубка
- 7 Инструкция по применению

ТВНЛ.942319.027 ТУ РУ №

Срок годности 2024-11 стерильно апиrogenно нетоксично
(годен до)

Дата выпуска 2019-11

Партия 19001



ТЮМЕНЬ ООО "МИМ"

ООО «МИМ» Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, стр. 1,
тел. +7 (904) 493-69-68

Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ» одноразовый,
в составе:


- 1 Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ»
- 2 Выключающий 3-х ходовой запорный клапан
- 3 Интродьюсер проводника
- 4 Муфта стяжная (пластиковая)
- 5 Push-click Y коннектор с удлинителем
- 6 Соединительная трубка
- 7 Инструкция по применению

ТВНЛ.942319.027 ТУ РУ №

Срок годности 2024-11 стерильно апиrogenно нетоксично
(годен до)

Дата выпуска 2019-11

Партия 19001



Прошито и пронумеровано 3

три листов

Генеральный директор ООО «МИМ»

В.А. Чикризов



Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ» одноразовый в составе:

- 1 Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ»
- 2 Выключающий 3-х ходовой запорный клапан
- 3 Интродьюсер проводника
- 4 Муфта стяжная (пластиковая)
- 5 Push-click Y коннектор с удлинителем
- 6 Соединительная трубка
- 7 Инструкция по применению

Push-click Y коннектор
с удлинителем

Выключающий 3-х ходовой
запорный клапан

Шприц-манометр
(индефлятор) «МИМ»

Муфта стяжная
(пластиковая)

Соединительная
трубка

Интродьюсер
проводника



ООО «ММ» Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Хополдинская, д. 85, стр. 1,
тел. +7 (904) 493-68-68

Щитов-манометр (индифлятор) «ММ» одноразовый,
в составе:

- 1 Щитов-манометр (индифлятор) «ММ»
- 2 Выходы-уключи 3-х ходовой запорный клапан
- 3 Инъектор-соединитель проводника
- 4 Муфта стяжная (пластиковая)
- 5 Push-кнопка У коннектор с удлинителем
- 6 Соединительная трубка
- 7 Инструкция по применению

ТВНЛ.942319.027 Ту Ру №

Срок годности 2024-11 стерильно апирино неогосично
(годен до)

Дата выпуска 2019-11

Партия 19001

STERILE



ТЮМЕНЬ ООО "МИМ"

ООО «МИМ» Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, стр. 1,
тел. +7 (904) 493-69-68

Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ» одноразовый,
в составе:

- 1 Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ»
- 2 Выключающий 3-х ходовой запорный клапан
- 3 Интродьюсер проводника
- 4 Муфта стяжная (пластиковая)
- 5 Push-click Y коннектор с удлинителем
- 6 Соединительная трубка
- 7 Инструкция по применению




ТВНЛ.942319.027 ТУ РУ №

Срок годности **2024-11** стерильно апиrogenно нетоксично
(годен до)

Дата выпуска **2019-11**

Партия **19001**



ТЮМЕНЬ ООО "МИМ"

ООО «МИМ» Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, стр. 1,
тел. +7 (904) 493-69-68

Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ» одноразовый,
в составе:

- 1 Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ»
- 2 Выключающий 3-х ходовой запорный клапан
- 3 Интродьюсер проводника
- 4 Муфта стяжная (пластиковая)
- 5 Push-click Y коннектор с удлинителем
- 6 Соединительная трубка
- 7 Инструкция по применению




ТВНЛ.942319.027 ТУ РУ №

Срок годности **2024-11** стерильно апиrogenно нетоксично
(годен до)

Дата выпуска **2019-11**

Партия **19001**



Прошито и пронумеровано 3

Стр. _____ листов


Генеральный директор ООО «МИМ»

В.А. Чикризов



Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ» одноразовый в составе:

- 1 Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ»
- 2 Выключающий 3-х ходовой запорный клапан
- 3 Интродюсер проводника
- 4 Муфта стяжная (пластиковая)
- 5 Push-click Y коннектор с удлинителем
- 6 Инструкция по применению

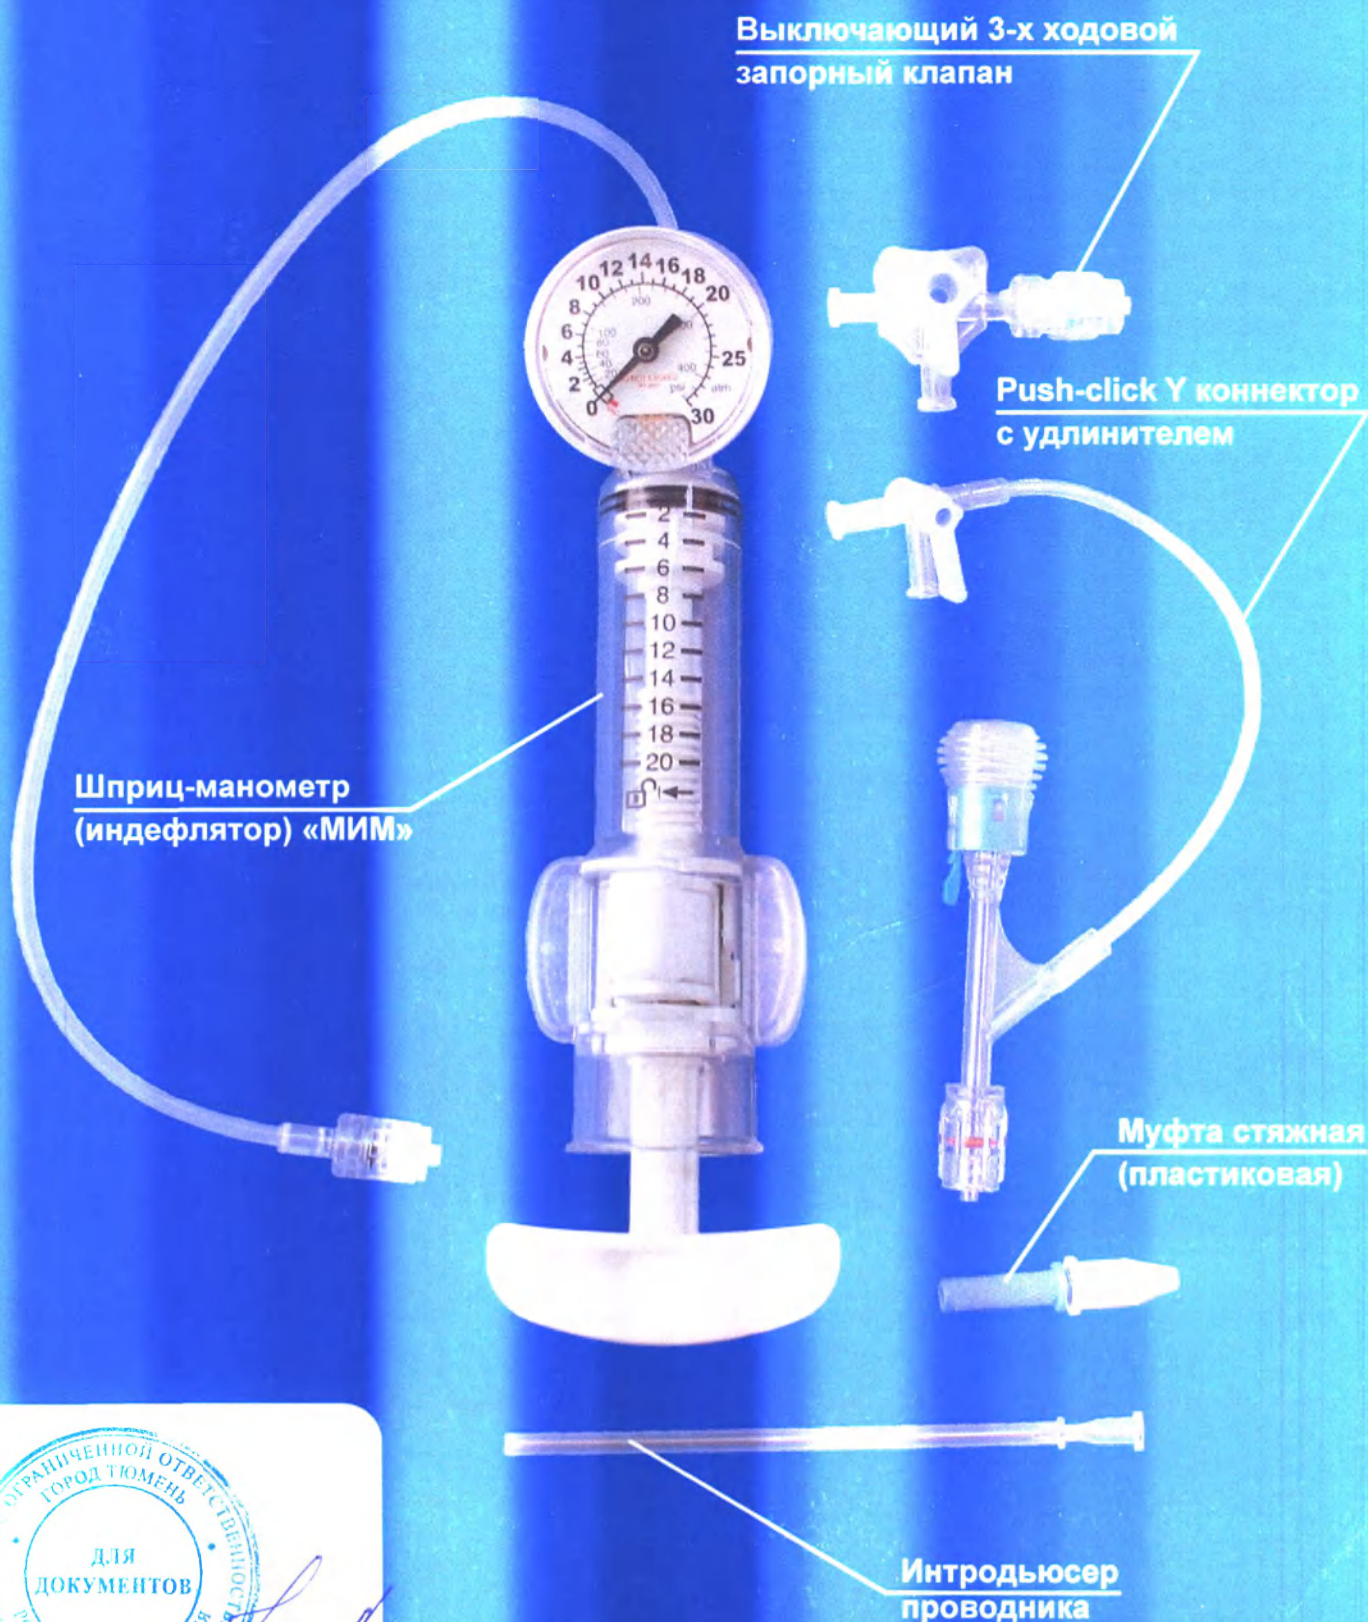

ТЮМЕНЬ ООО "МИМ"

ООО «МИМ» Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Хоподильная, д. 85, стр. 1,
тел. +7 (904) 493-69-68

Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ» одноразовый,
в составе:

- 1 Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ»
- 2 Выключающий 3-х ходовой запорный клапан
- 3 Интродьюсер проводника
- 4 Муфта стяжная (пластиковая)
- 5 Push-click Y коннектор с удлинителем
- 6 Соединительная трубка
- 7 Инструкция по применению



ТВНЛ.942319.027 ТУ РУ №

Срок годности 2024-11 стерильно апиrogenно нетоксично
(годен до) 2019-11

Дата выпуска 19001

STERILE EO

Сделано в России

КЛИНИ ПЛАК

Поврежденную упаковку не использовать!

ПЛАЗМА

ЖЕЛТЫЙ
«ПРОСТЕРИЛИЗОВАНО»



150 мм x 70 мм

ФОРМ

ЗЕЛЕНый
«ПРОСТЕРИЛИЗОВАНО»


30

КОРИЧНЕВый
«ПРОСТЕРИЛИЗОВАНО»

150 мм x 70 мм

ФОРМ

ЗЕЛЕНый
«ПРОСТЕРИЛИЗОВАНО»

ТЮМЕНЬ ООО "МИМ"
 ООО «МИМ» Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, стр. 1,
 тел. +7 (904) 493-69-68
 Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ» одноразовый,
 в составе:
 1 Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ»
 2 Выключающий 3-х ходовой запорный клапан☒
 3 Интродьюсер проводника☒
 4 Муфта стяжная (пластиковая)☒
 5 Push-click Y коннектор с удлинителем☒
 6 Соединительная трубка☐
 7 Инструкция по применению☐
 ТВНЛ.942319.027 ТУ РУ №
 Срок годности **2024-11** стерильно апиrogenно нетоксично
 (годен до) **2019-11**
 Дата выпуска
 Партия **19001** 

ТЮМЕНЬ ООО "МИМ"
 ООО «МИМ» Россия, 625026, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, стр. 1,
 тел. +7 (904) 493-69-68
 Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ» одноразовый,
 в составе:
 1 Шприц-манометр (индефлятор) «МИМ»
 2 Выключающий 3-х ходовой запорный клапан☒
 3 Интродьюсер проводника☒
 4 Муфта стяжная (пластиковая)☒
 5 Push-click Y коннектор с удлинителем☒
 6 Соединительная трубка☐
 7 Инструкция по применению☐
 ТВНЛ.942319.027 ТУ РУ №
 Срок годности **2024-11** стерильно апиrogenно нетоксично
 (годен до) **2019-11**
 Дата выпуска
 Партия **19001** 