[redacted]

PHILIPS

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель отдела нормативного

регулирования ООО «ФИЛИПС»

_____ А.А. Град

«14» февраля 2024г

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая Zenition 30 с принадлежностями»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

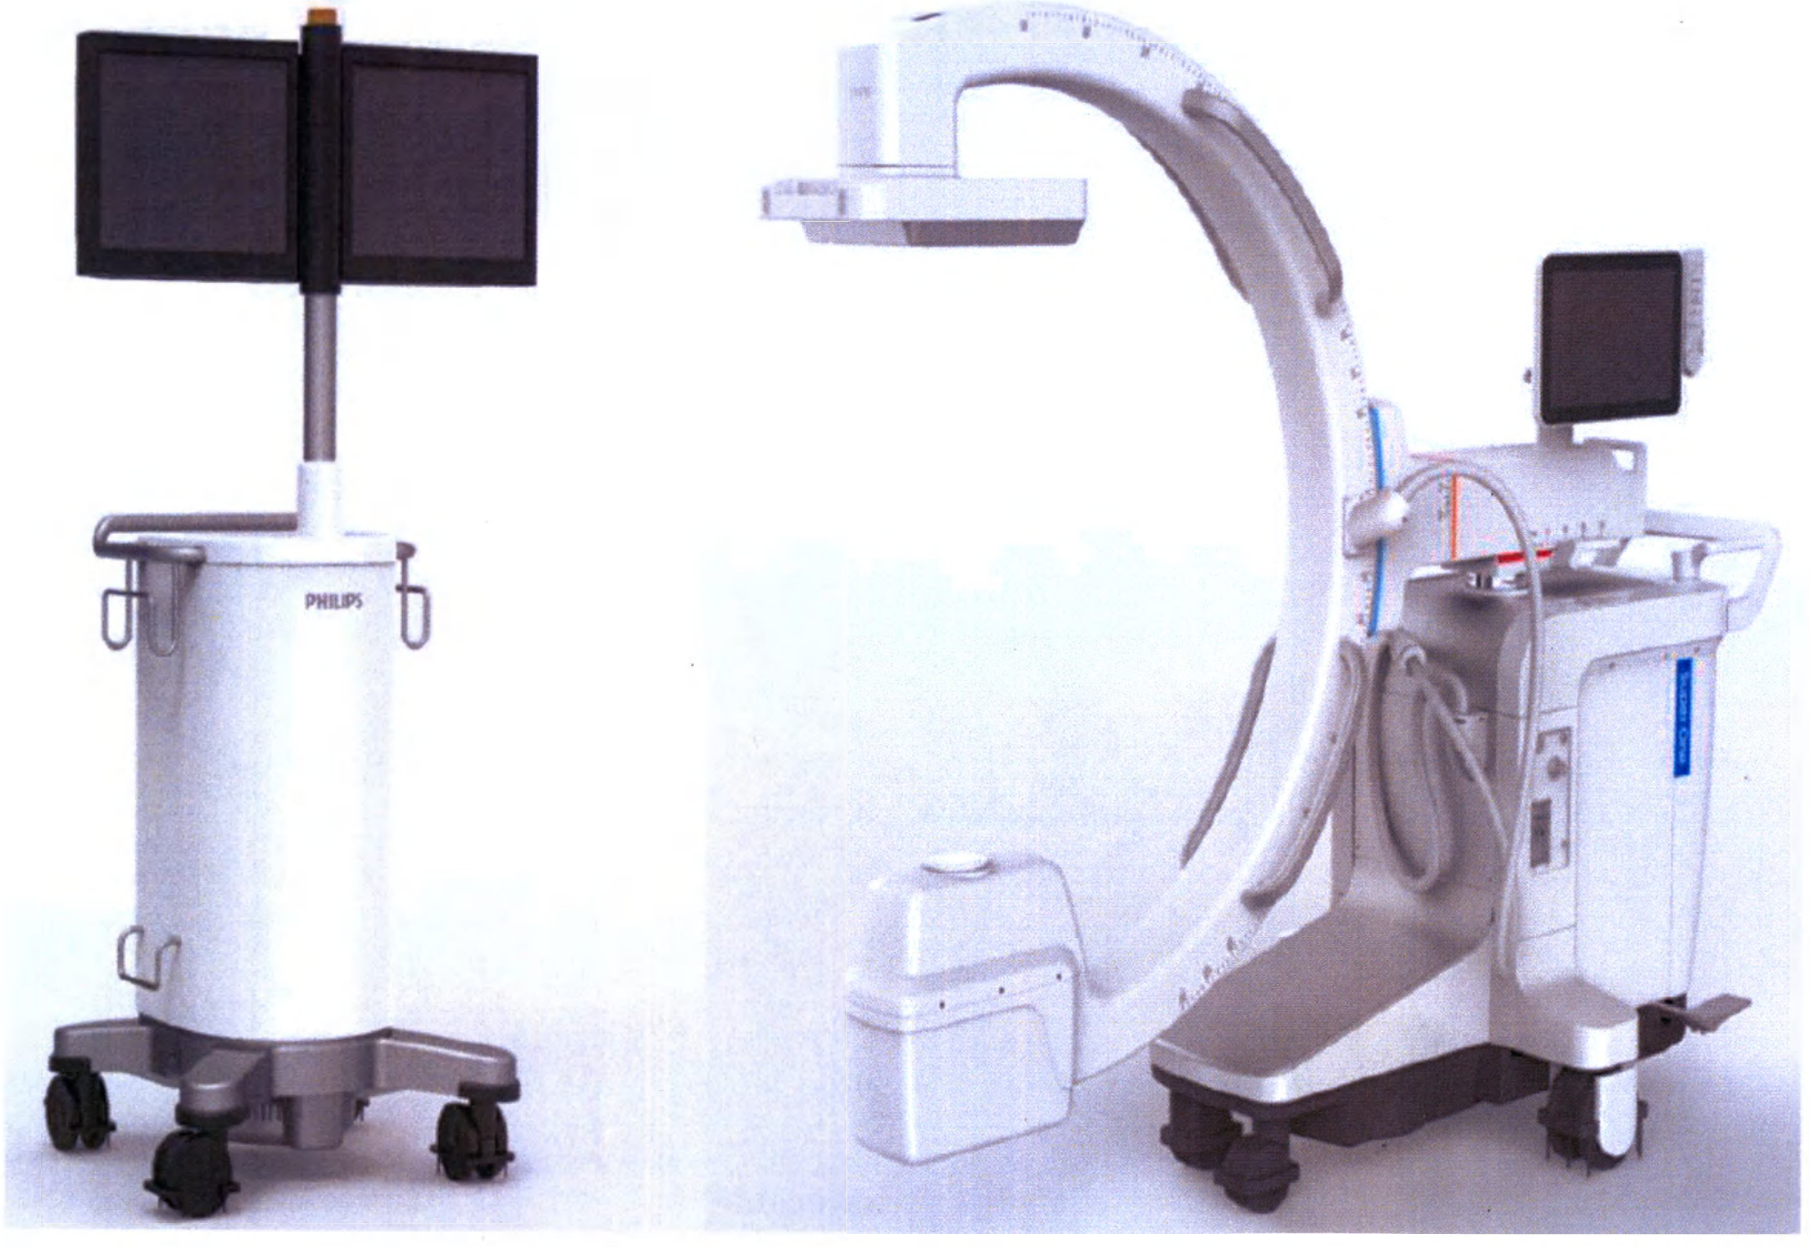

Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая Zenition 30 с принадлежностями. Общий вид.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. Базовый блок с С-дугой в составе.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. Базовый блок с С-дугой, в составе: 1.1. Стойка С-дуги

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. Базовый блок с С-дугой, в составе: 1.2. С-дуга

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

. Базовый блок с С-дугой, в составе: 1.3. Блок источника рентгеновского излучения

1. Базовый блок с С-дугой, в составе: 1.4. Коллиматор

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

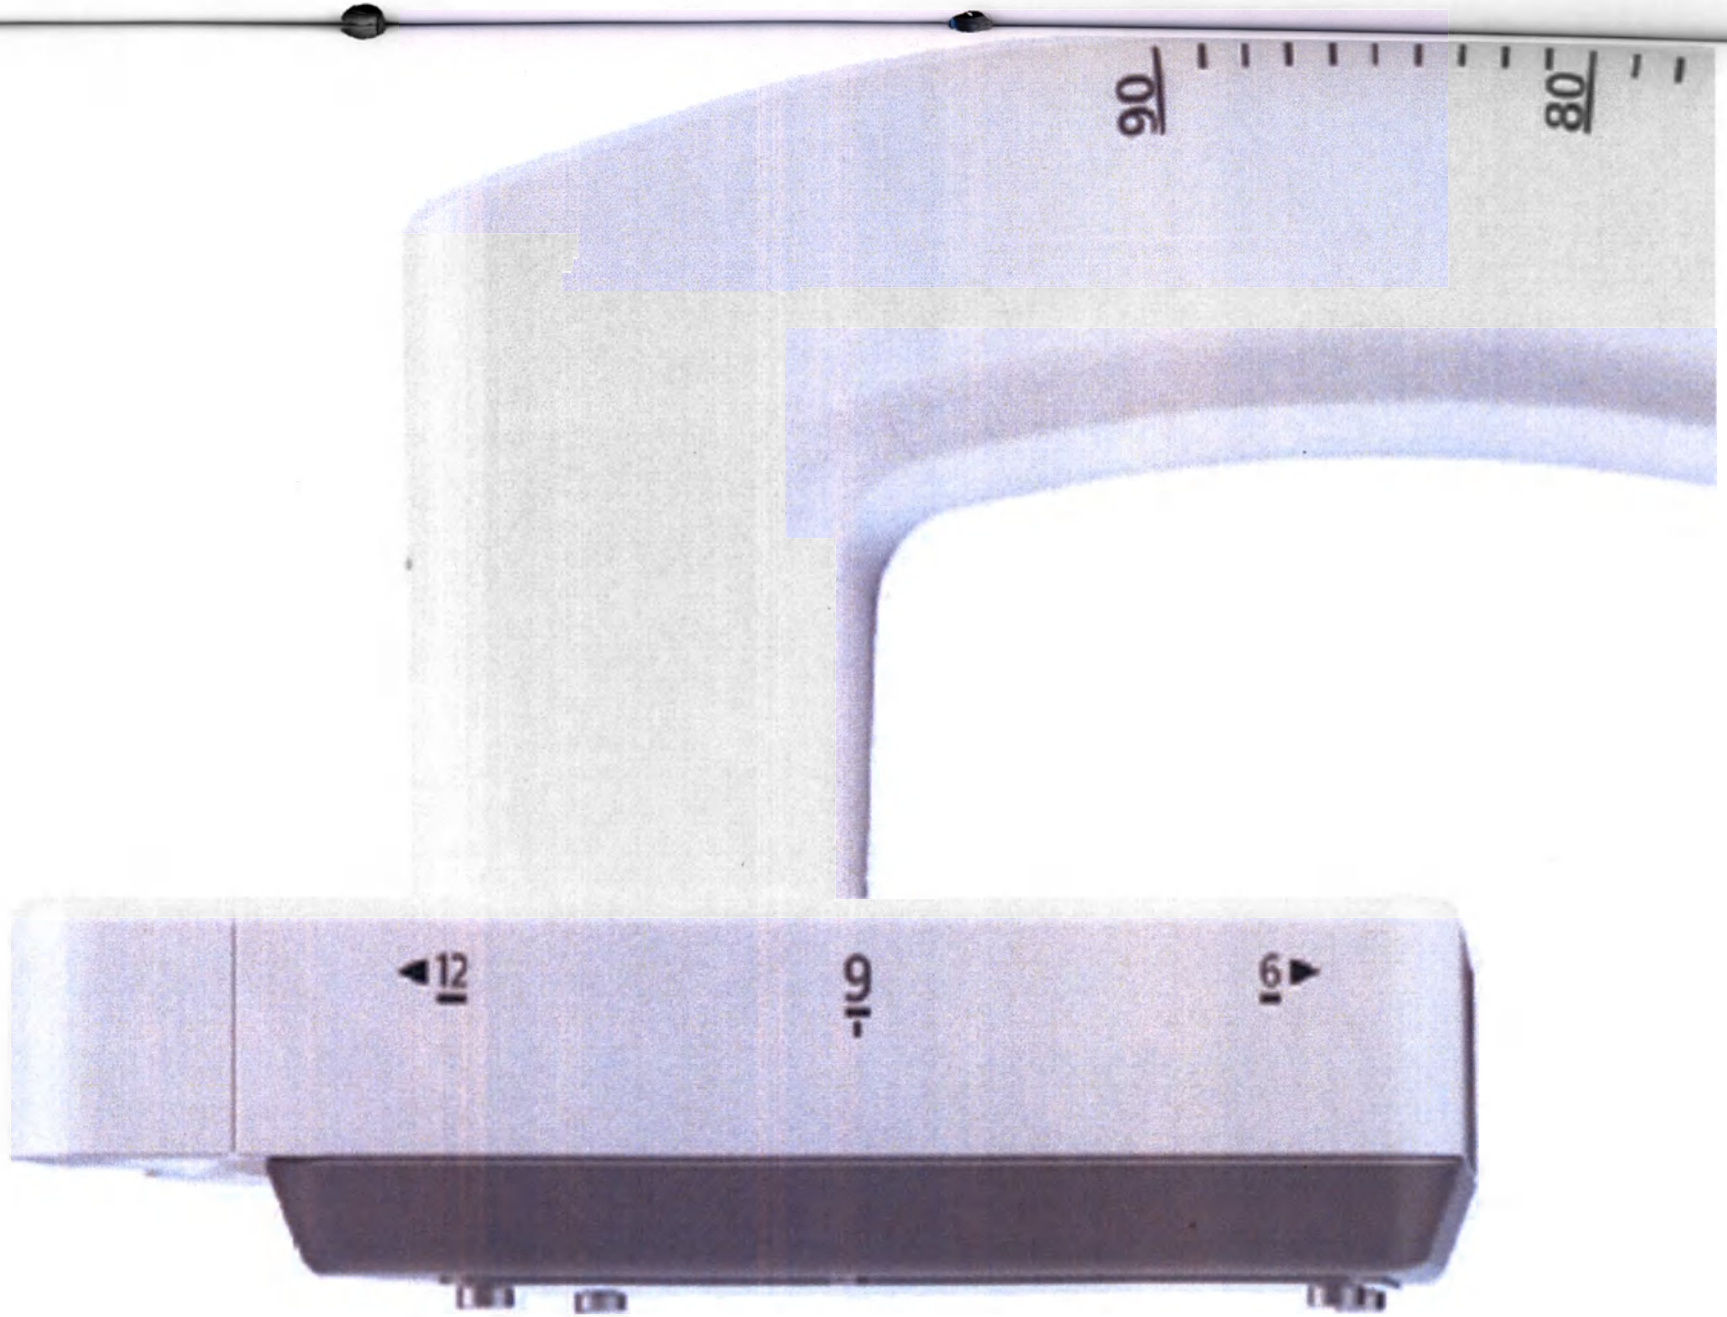

1. Базовый блок с С-дугой, в составе: 1.5. Детектор

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

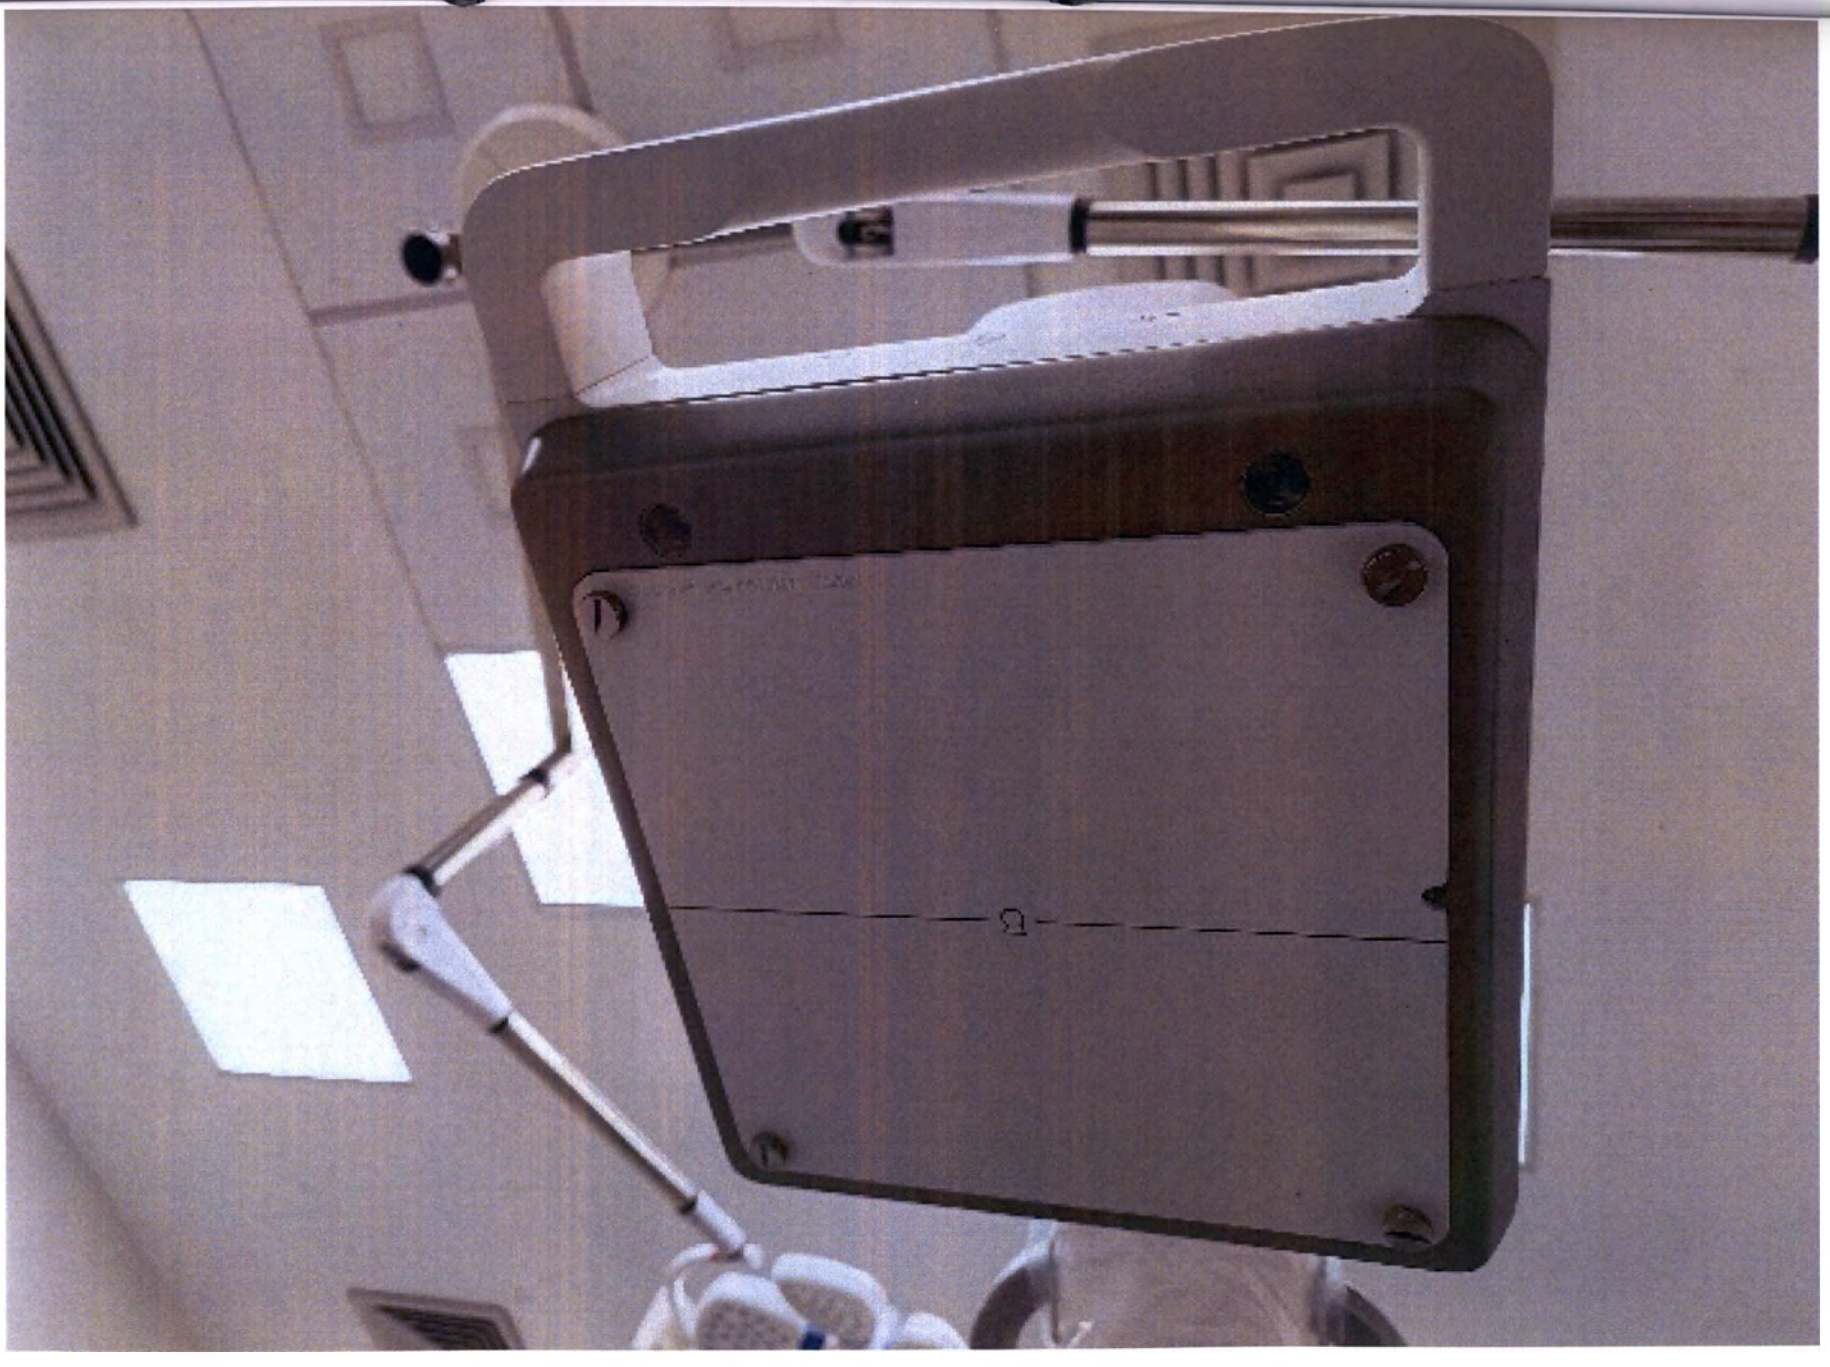

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. Базовый блок с С-дугой, в составе: 1.6. Отсеивающая решетка

1. Базовый блок с С-дугой, в составе: 1.7. Сенсорный экран стойки С-дуги

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

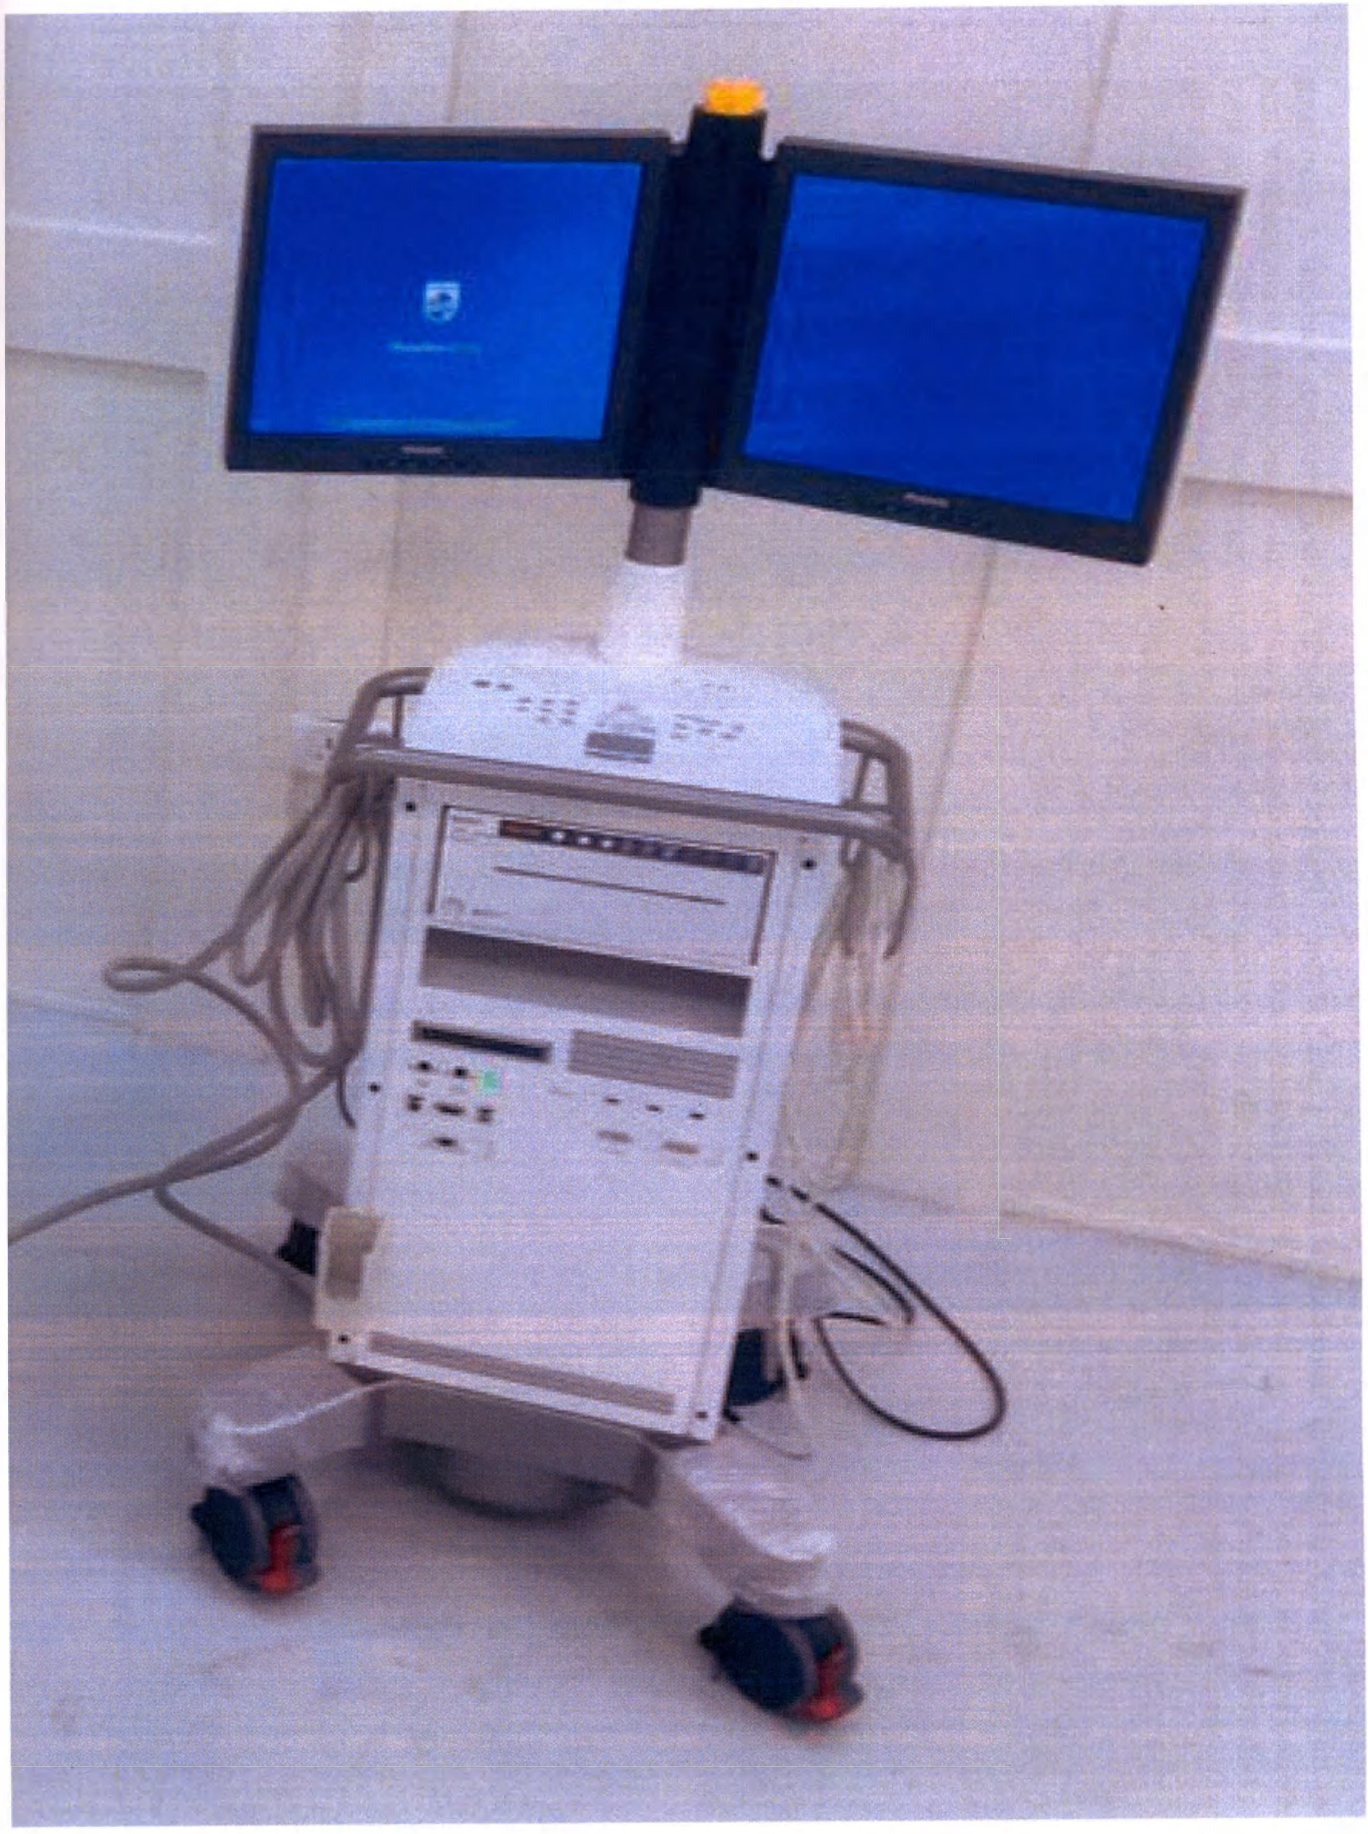

2. Передвижная станция просмотра в составе

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2. Передвижная станция просмотра в составе: 2.1 Монитор для исследований, варианты исполнения: монитор для исследований типа стандартной яркости, 1 шт., и/или - монитор для исследований типа высокой яркости, 1 шт., и/или - монитор для исследования типа стандартной яркости с функцией сенсорного экрана, 1 шт., и/или - монитор для исследований высокой яркости с функцией сенсорного экрана, 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

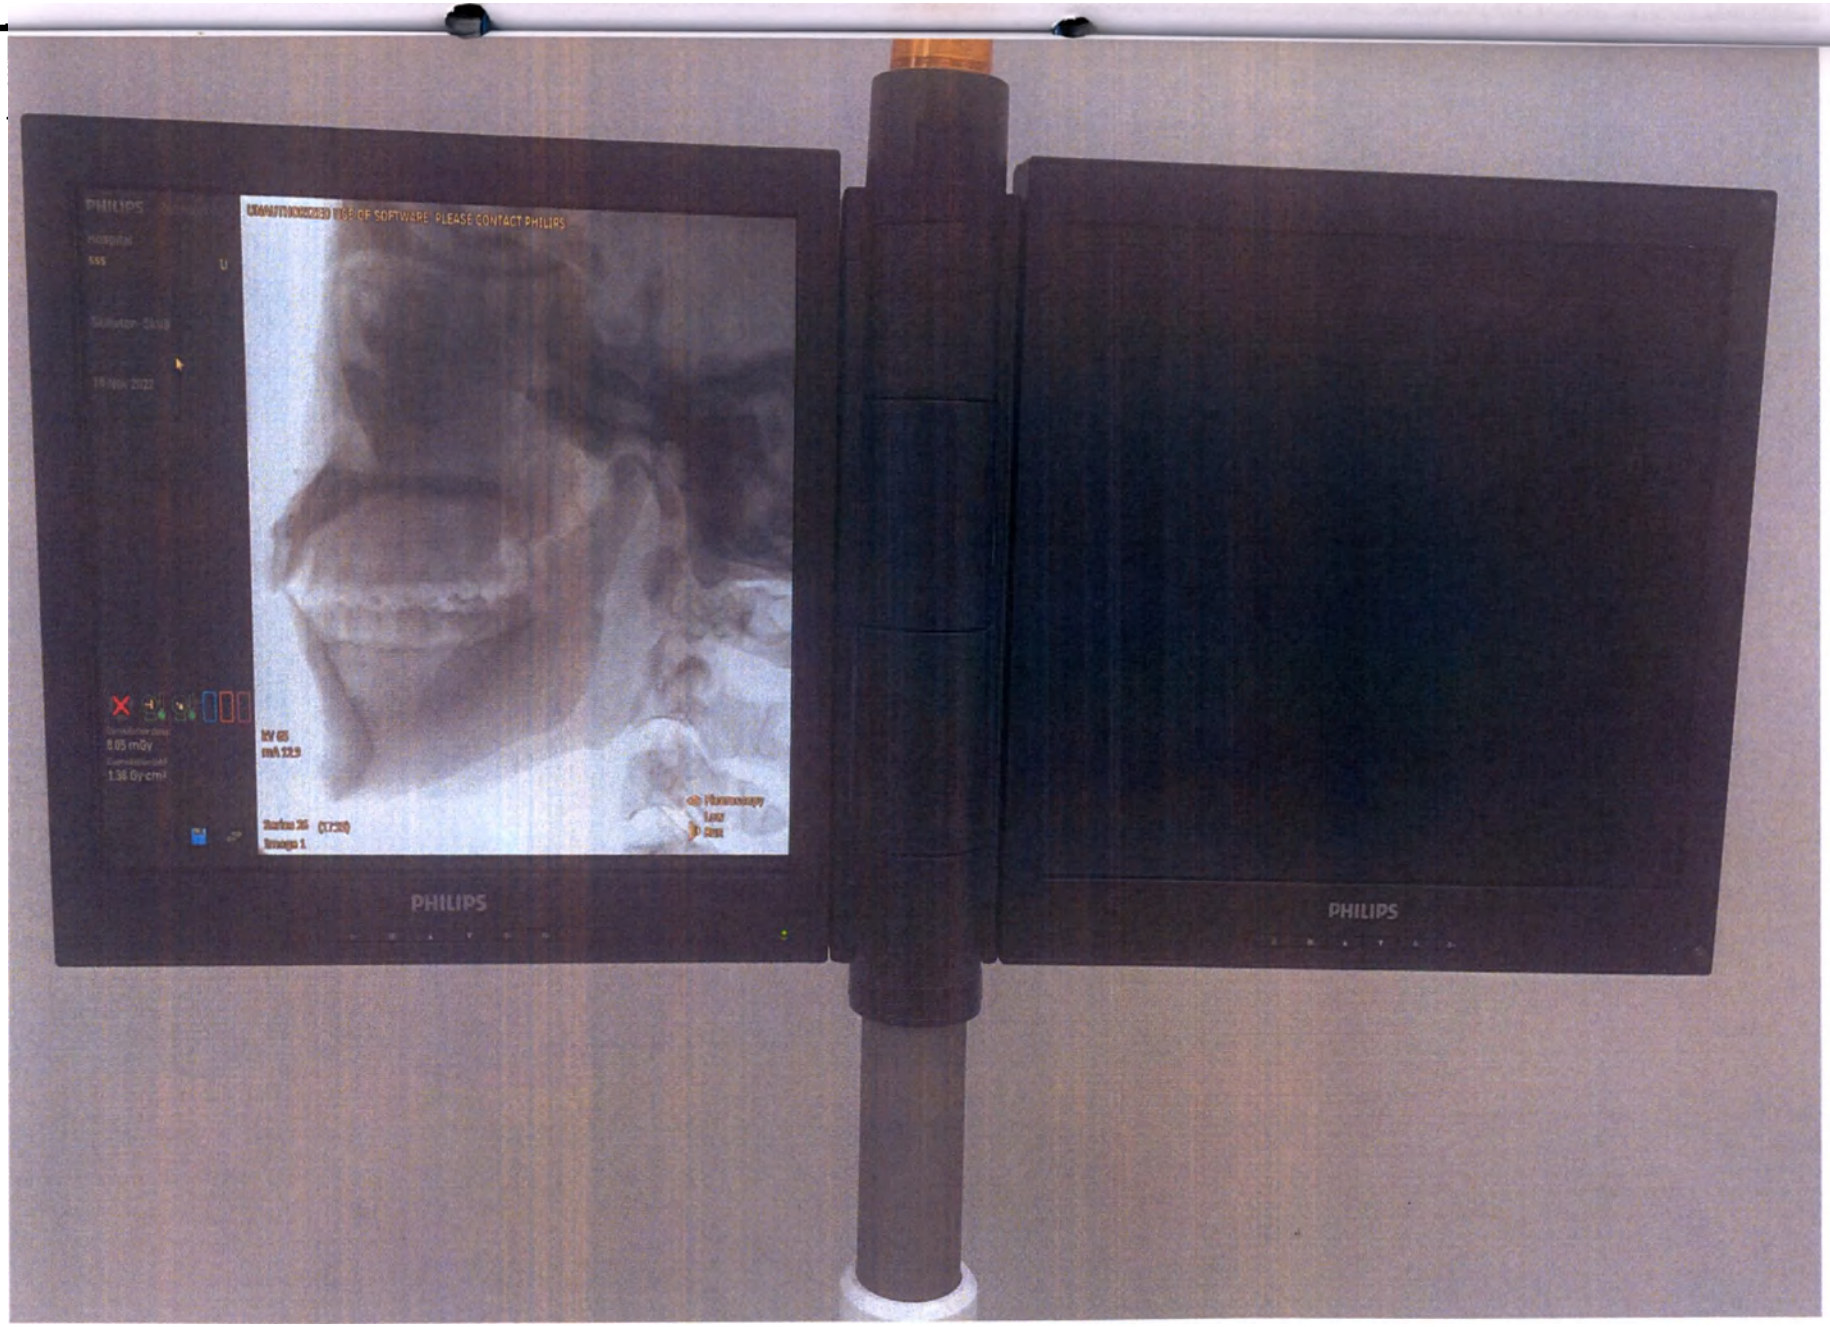

2. Передвижная станция просмотра, в составе: 2.2. Контрольный монитор, варианты исполнения: - контрольный монитор стандартной яркости, 1 шт., и/или - контрольный монитор высокой яркости, 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

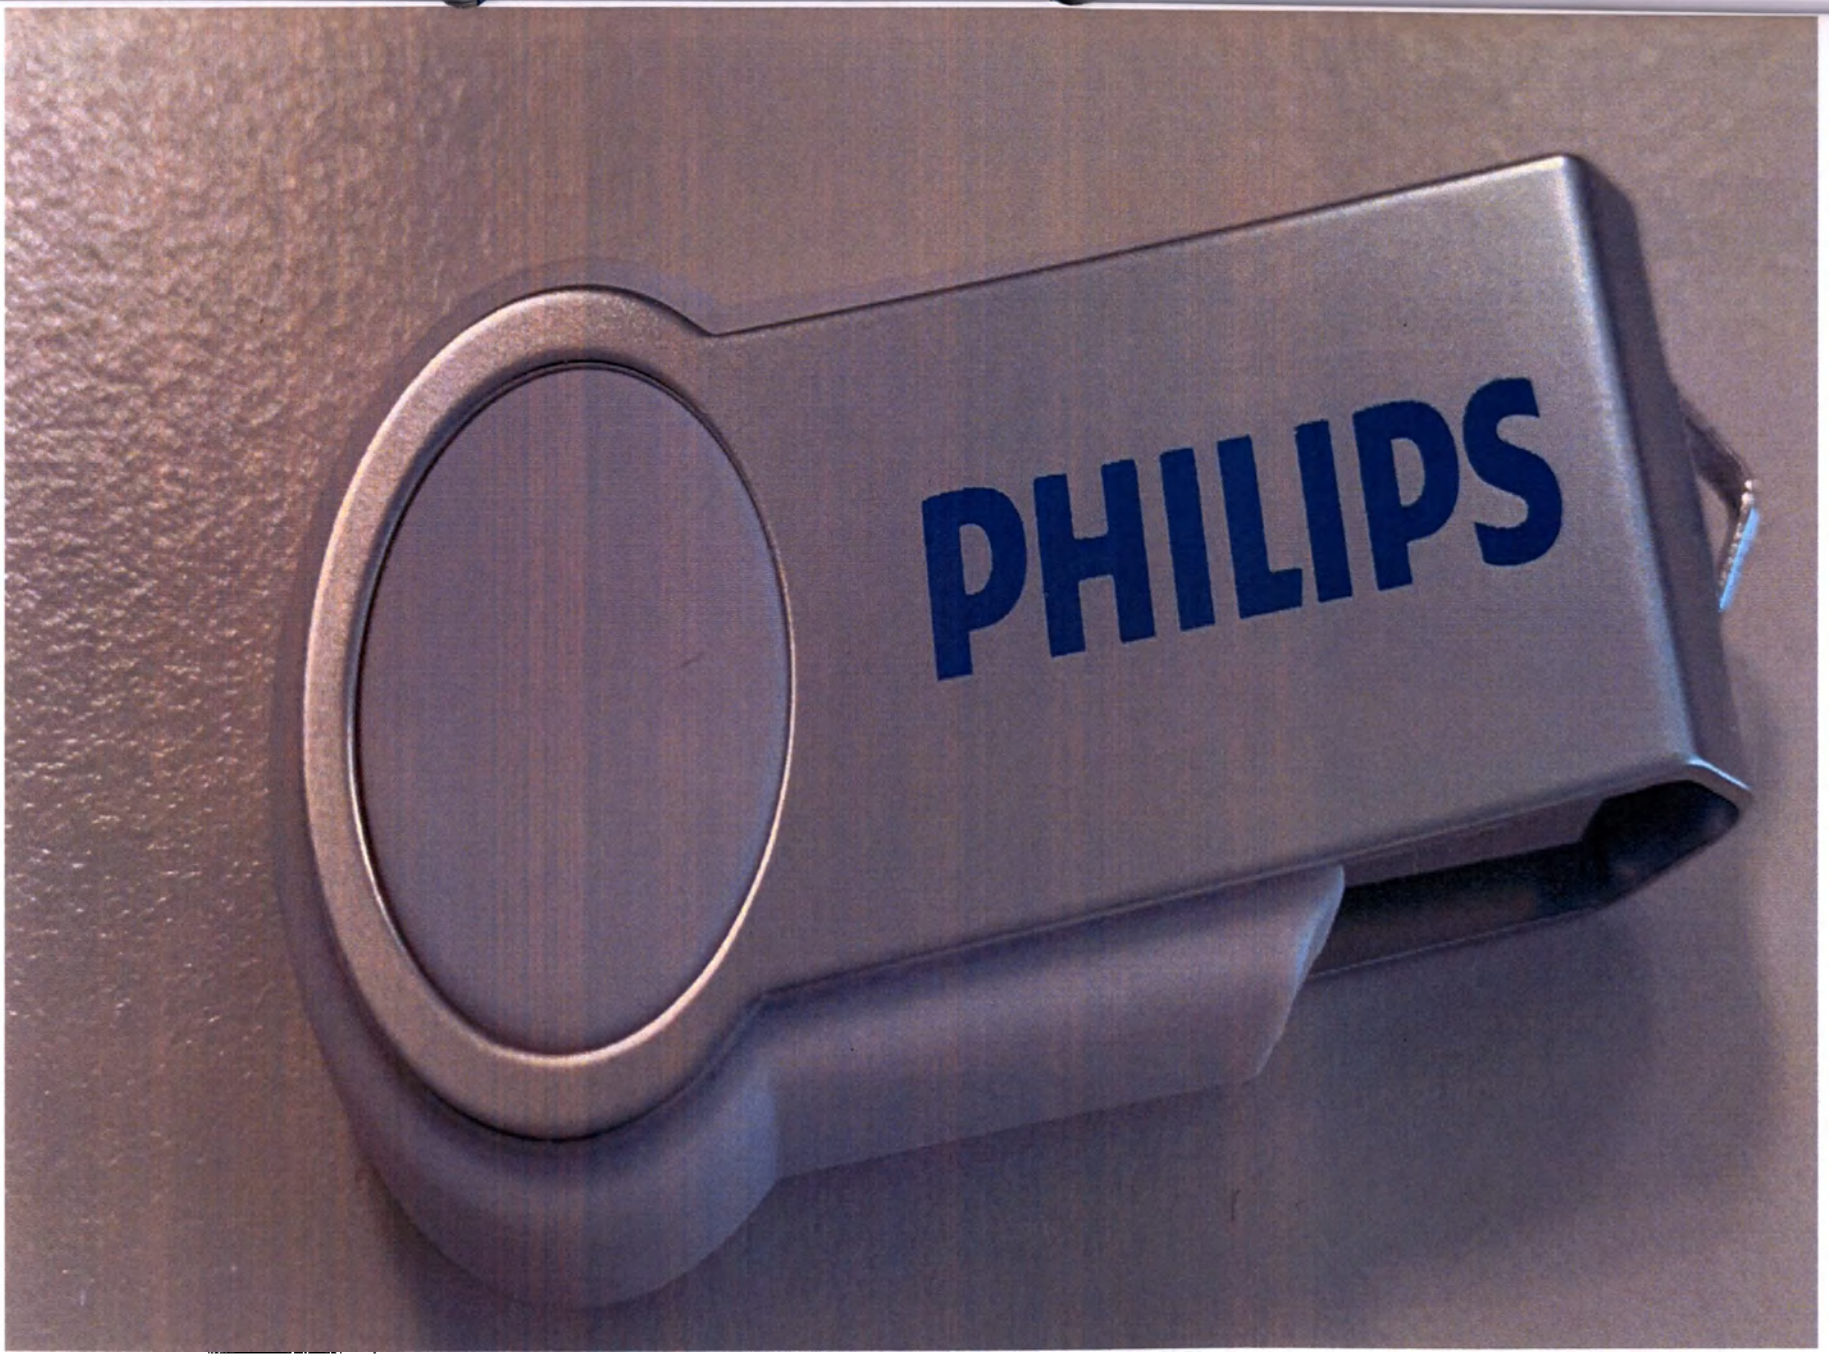

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

печение для обработки изображений на электронных и/или оптических и/или виртуальных носителях

4. Ручной переключатель

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. Проводной ножной переключатель

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6. Кабель питания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7. Источник бесперебойного питания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

PHILIPS

Руководство по эксплуатации

Русский

3000 096 33441

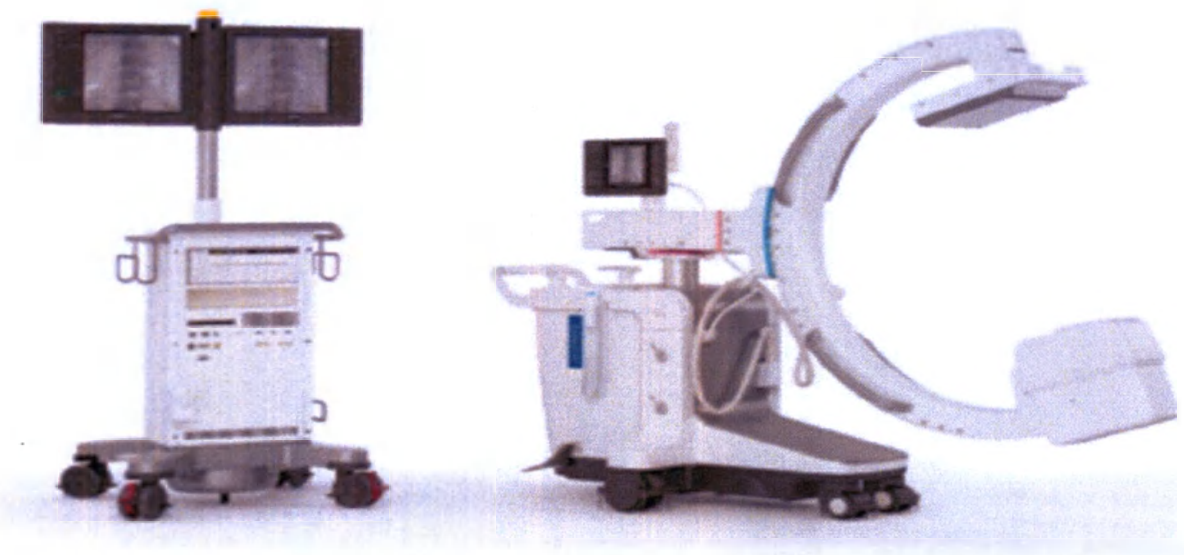

Philips Zenition 30

Версия 1.0

8. Руководство по эксплуатации на электронном и/или бумажном и/или виртуальном носителе и/или оптический

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Принадлежности

1. Пульт дистанционного управления

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

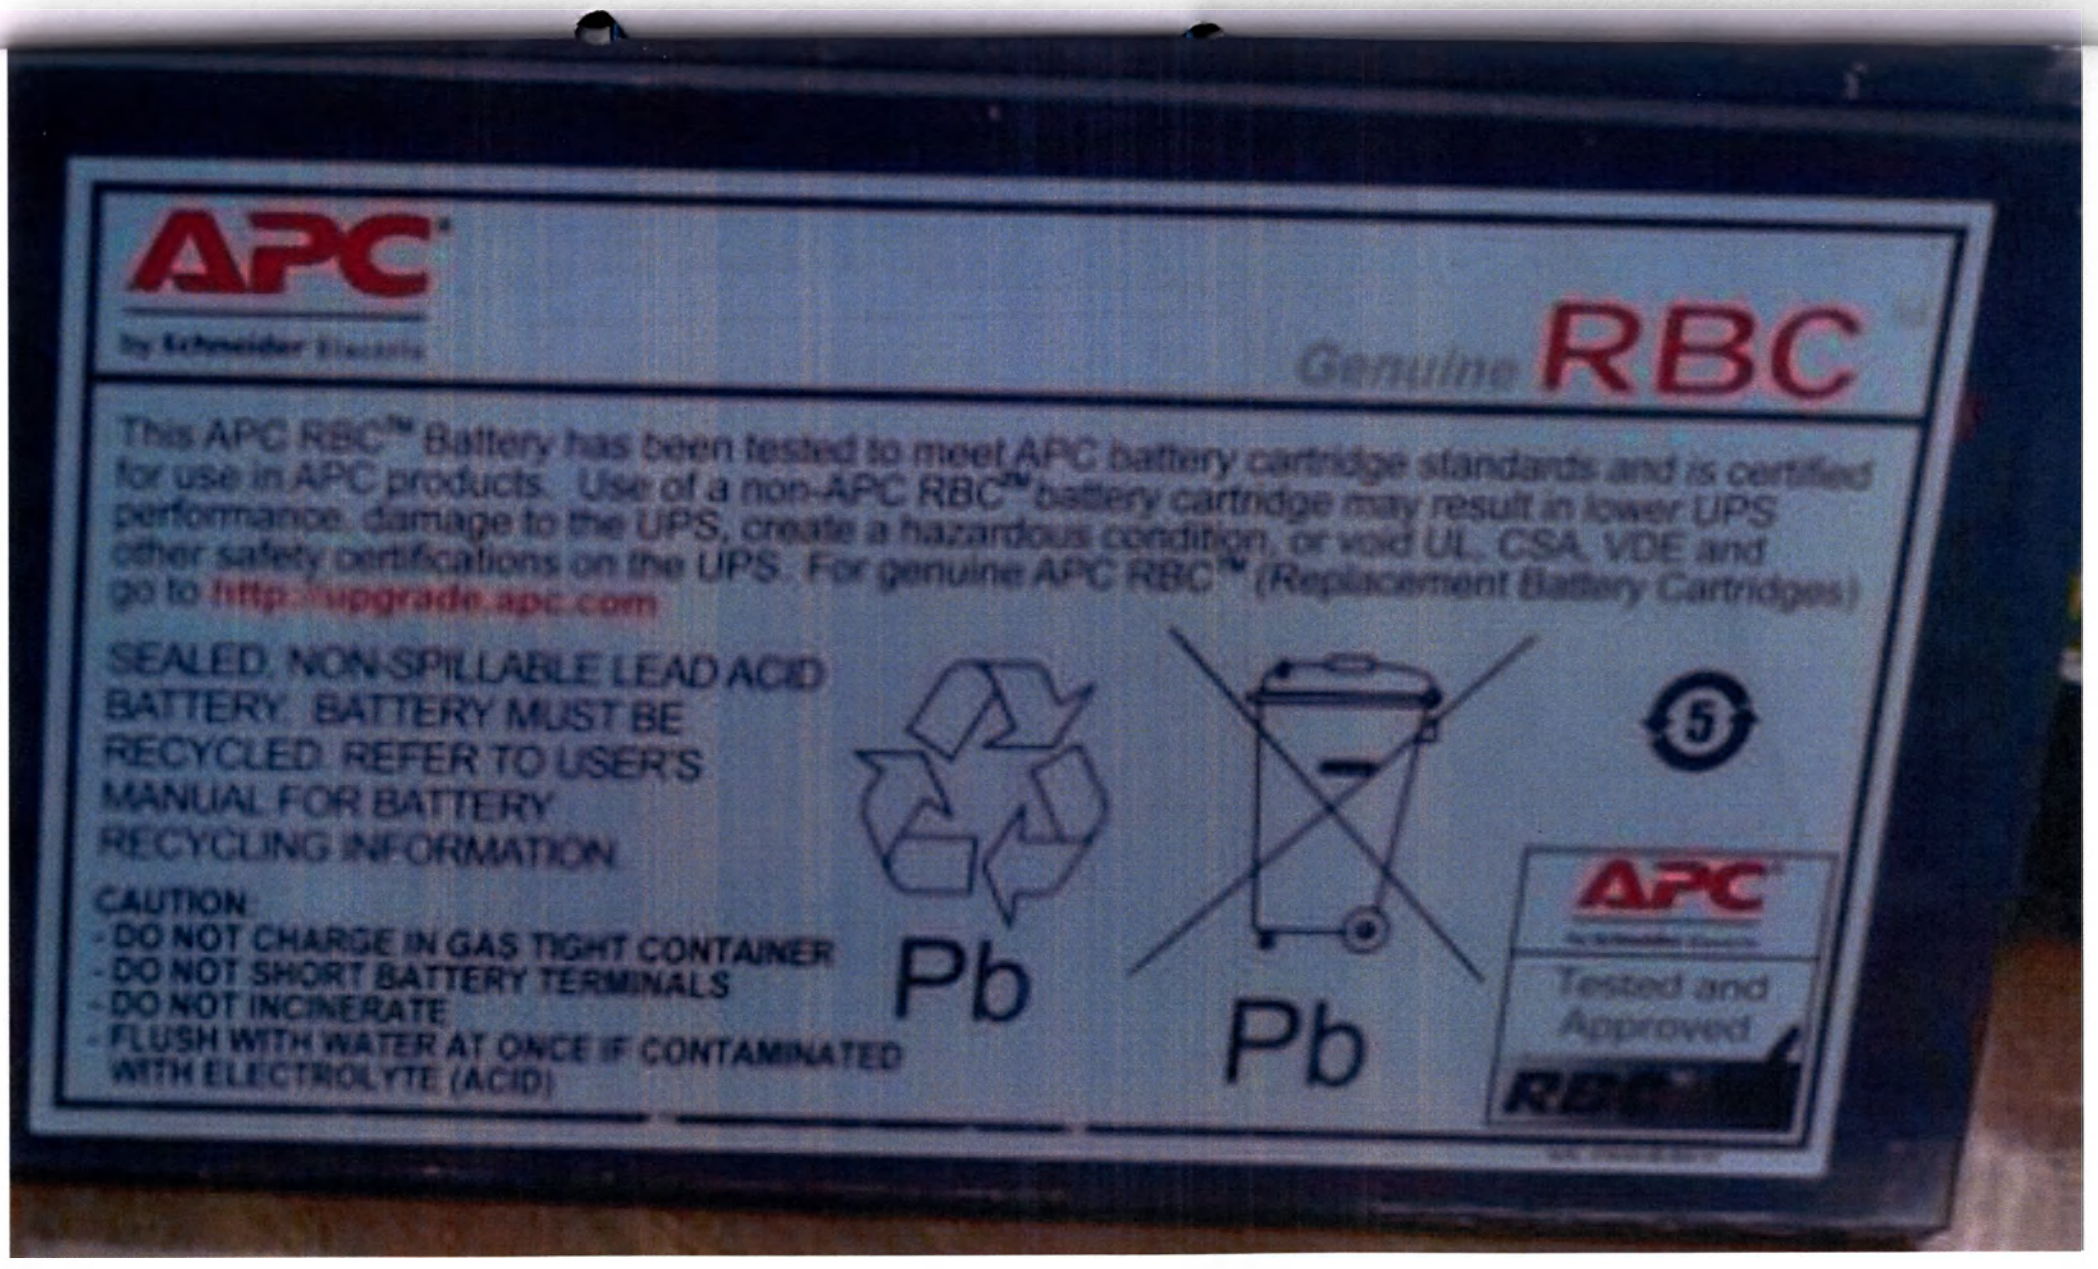

2. Аккумулятор источника бесперебойного питания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

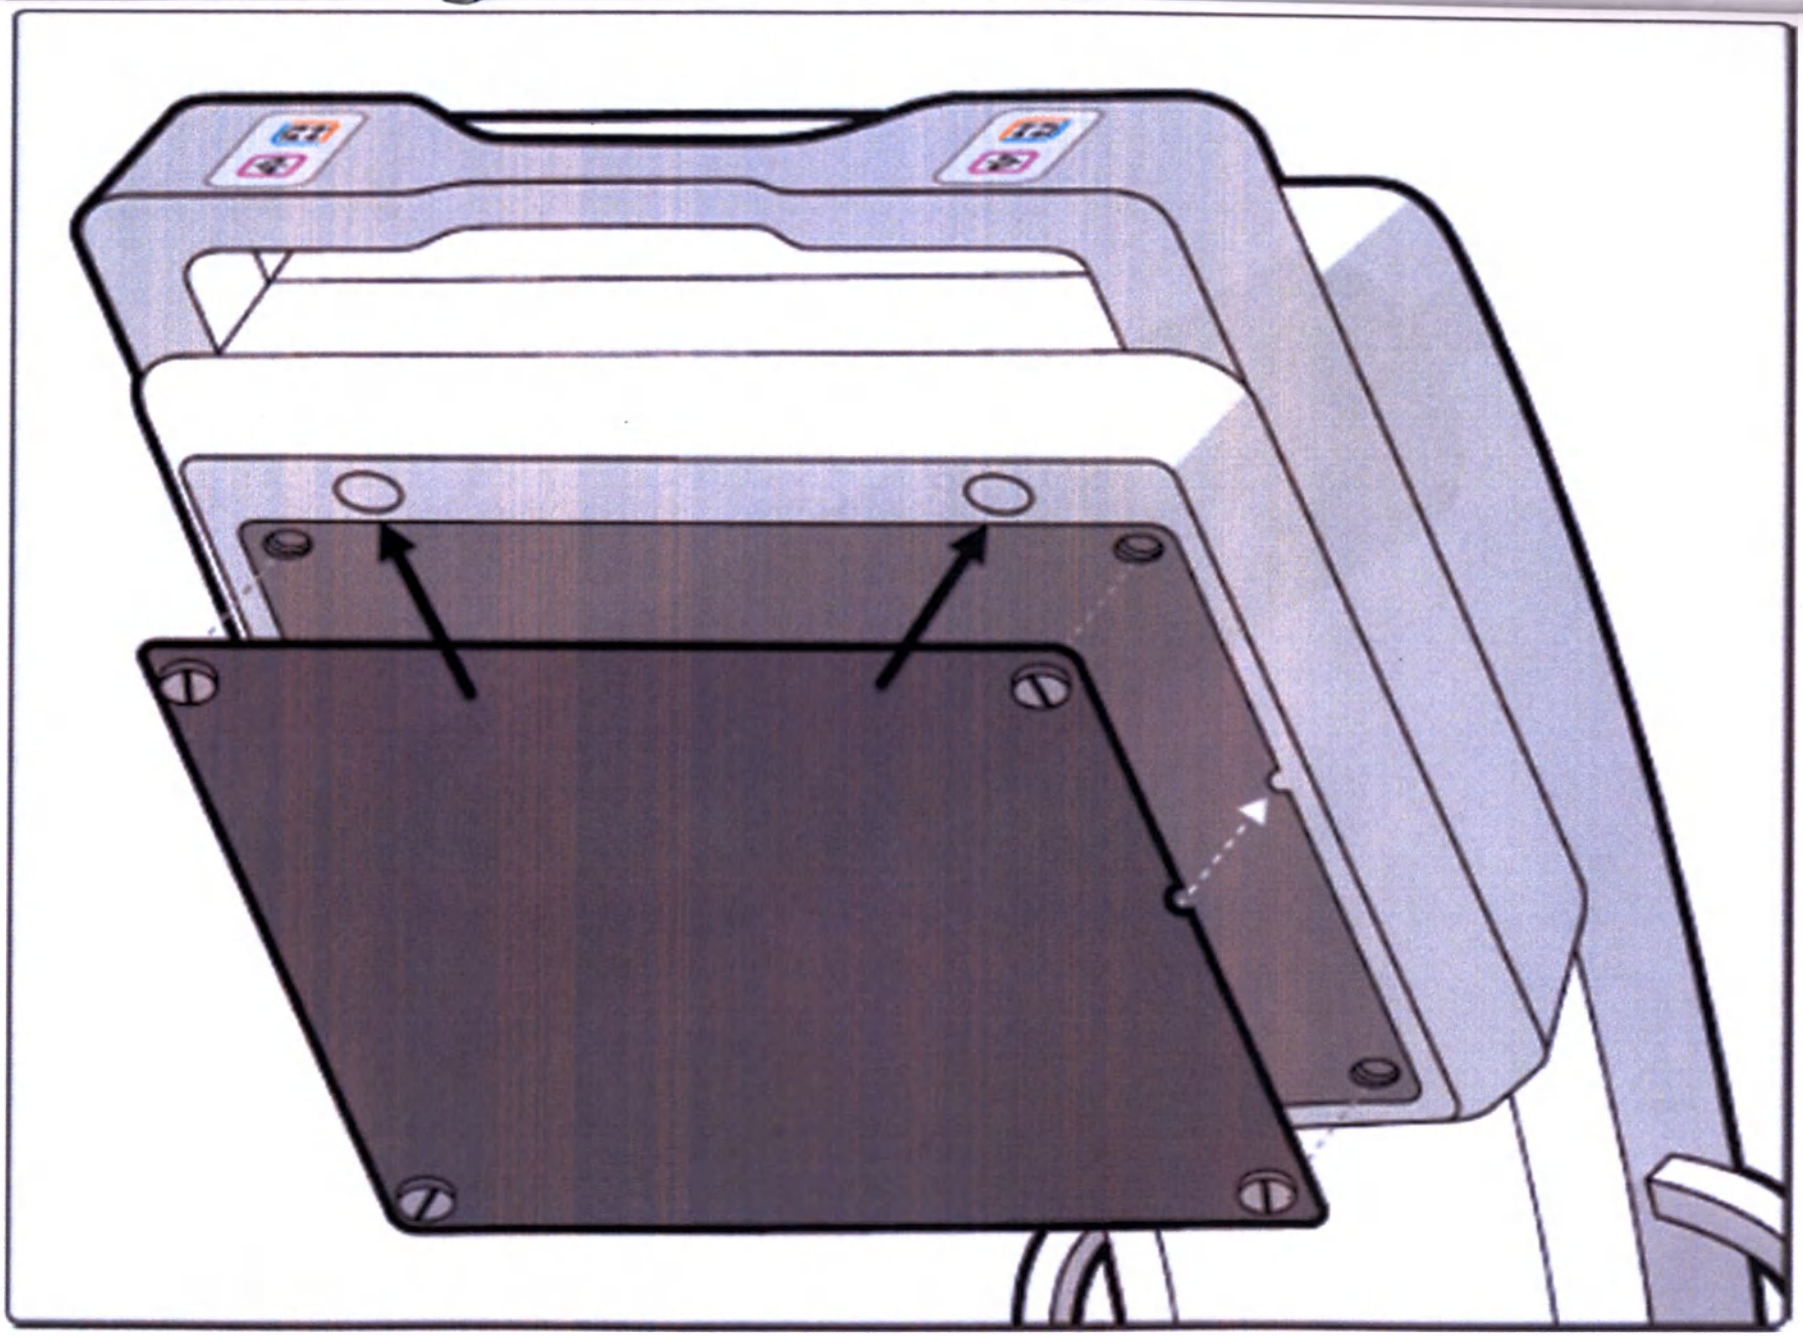

3. Лазерный прицел детектора

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Лазерный прицел трубки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

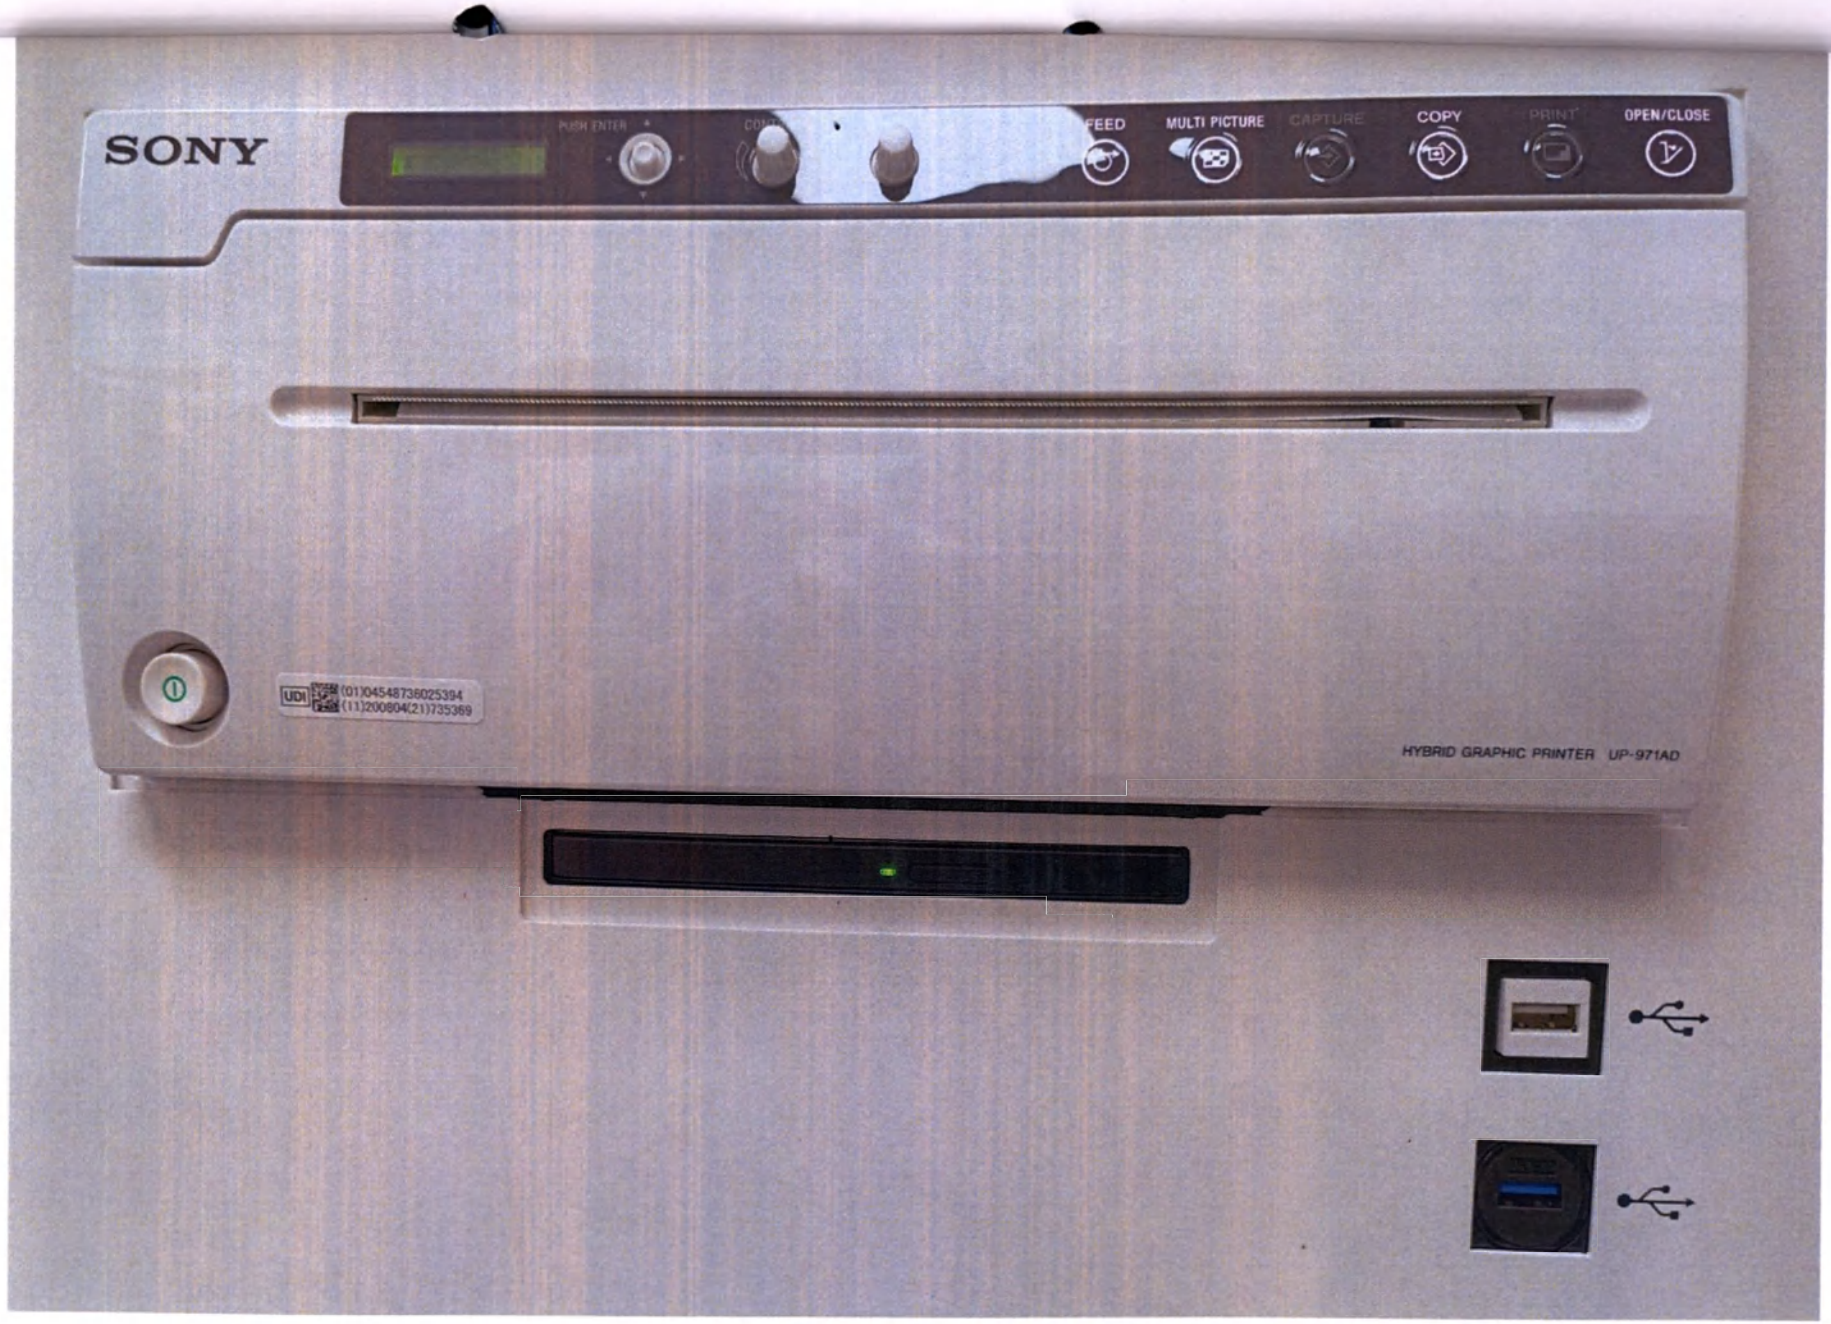

5. Медицинский принтер Sony UP-971AD

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6. Медицинский принтер Sony UP-991AD

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

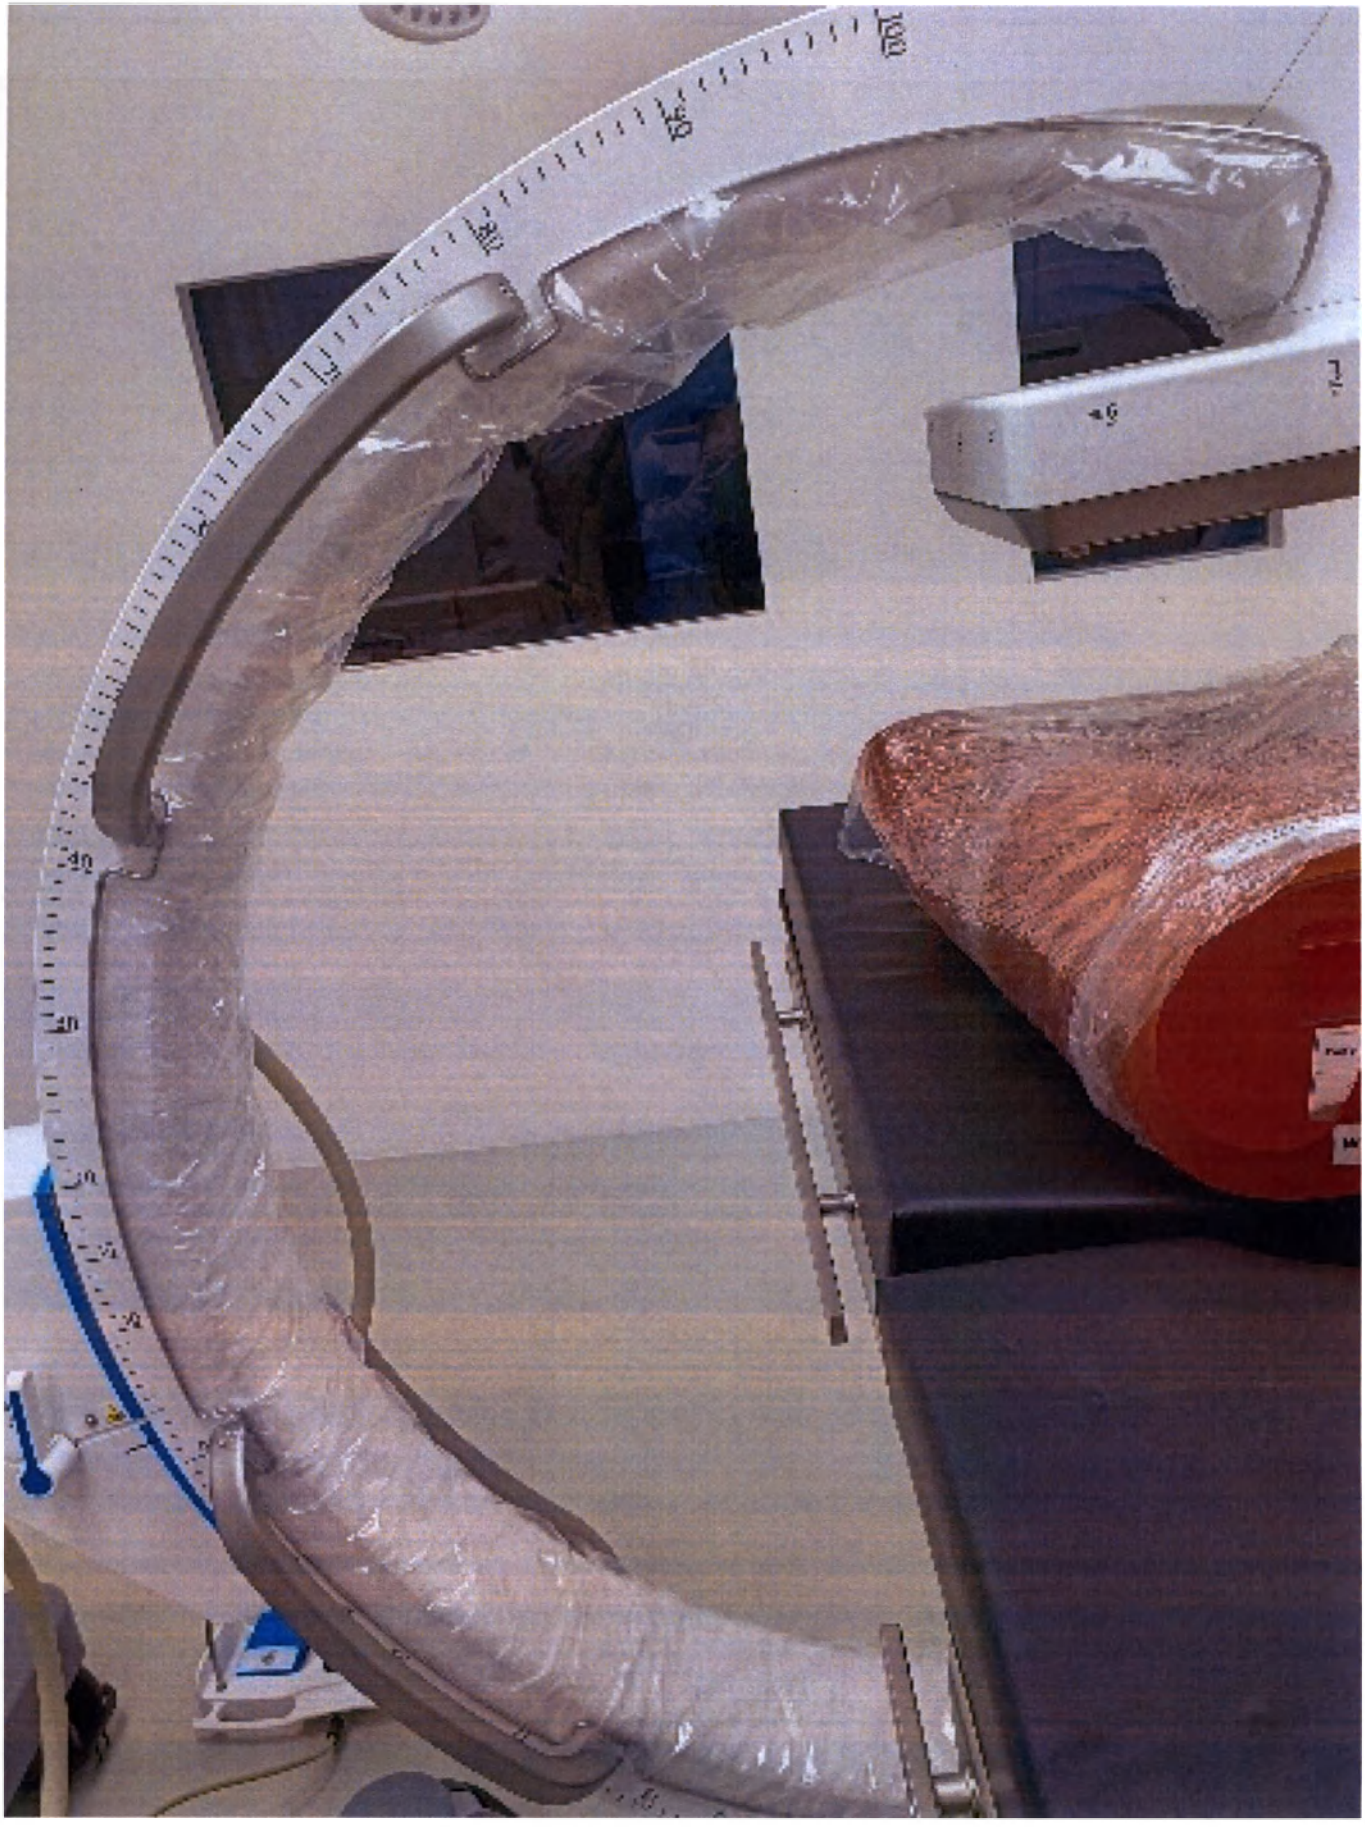

7. Подпружиненная дуга для чехлов С-дуги

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

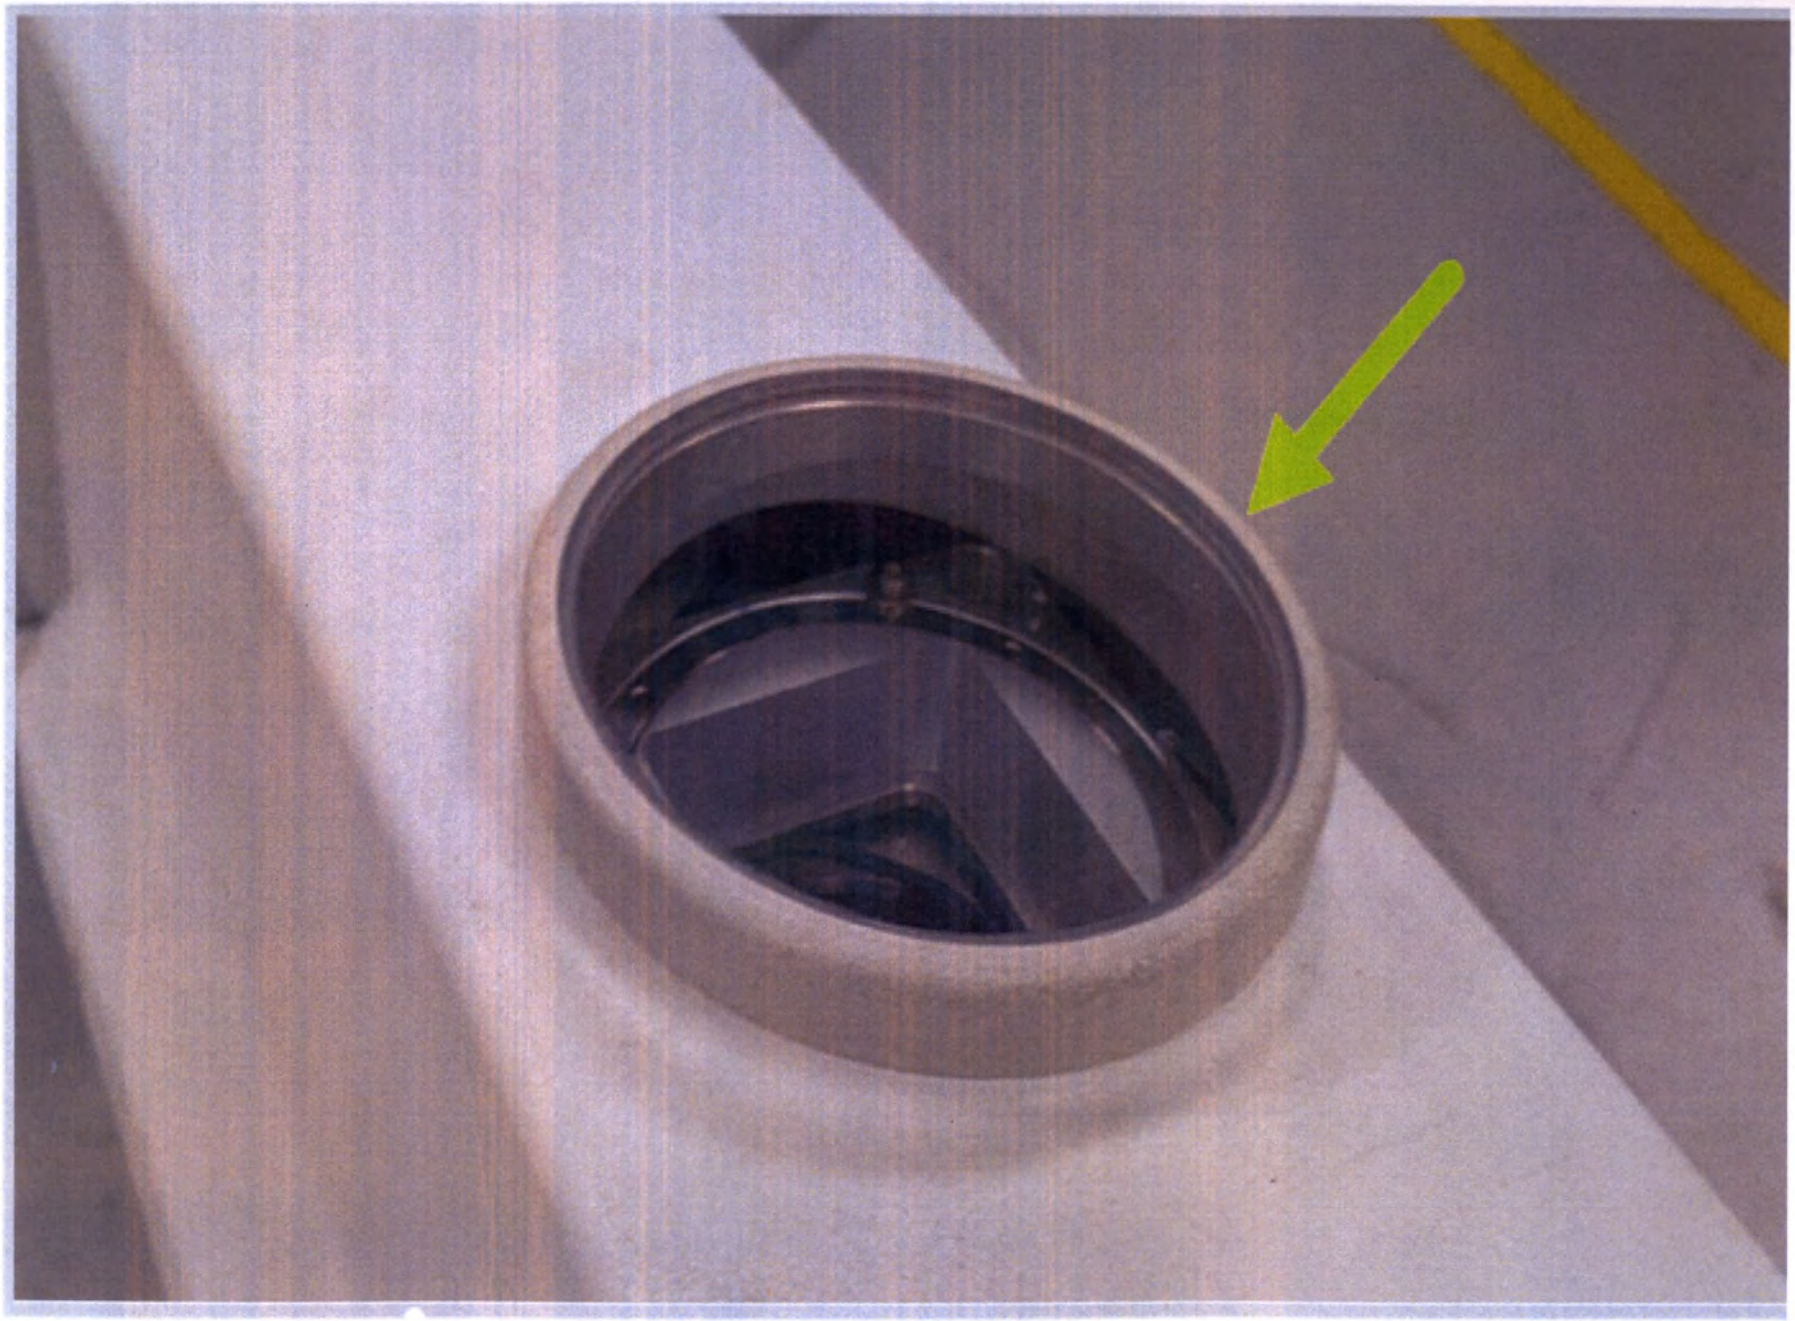

8.1 Насадка размером 20 см

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

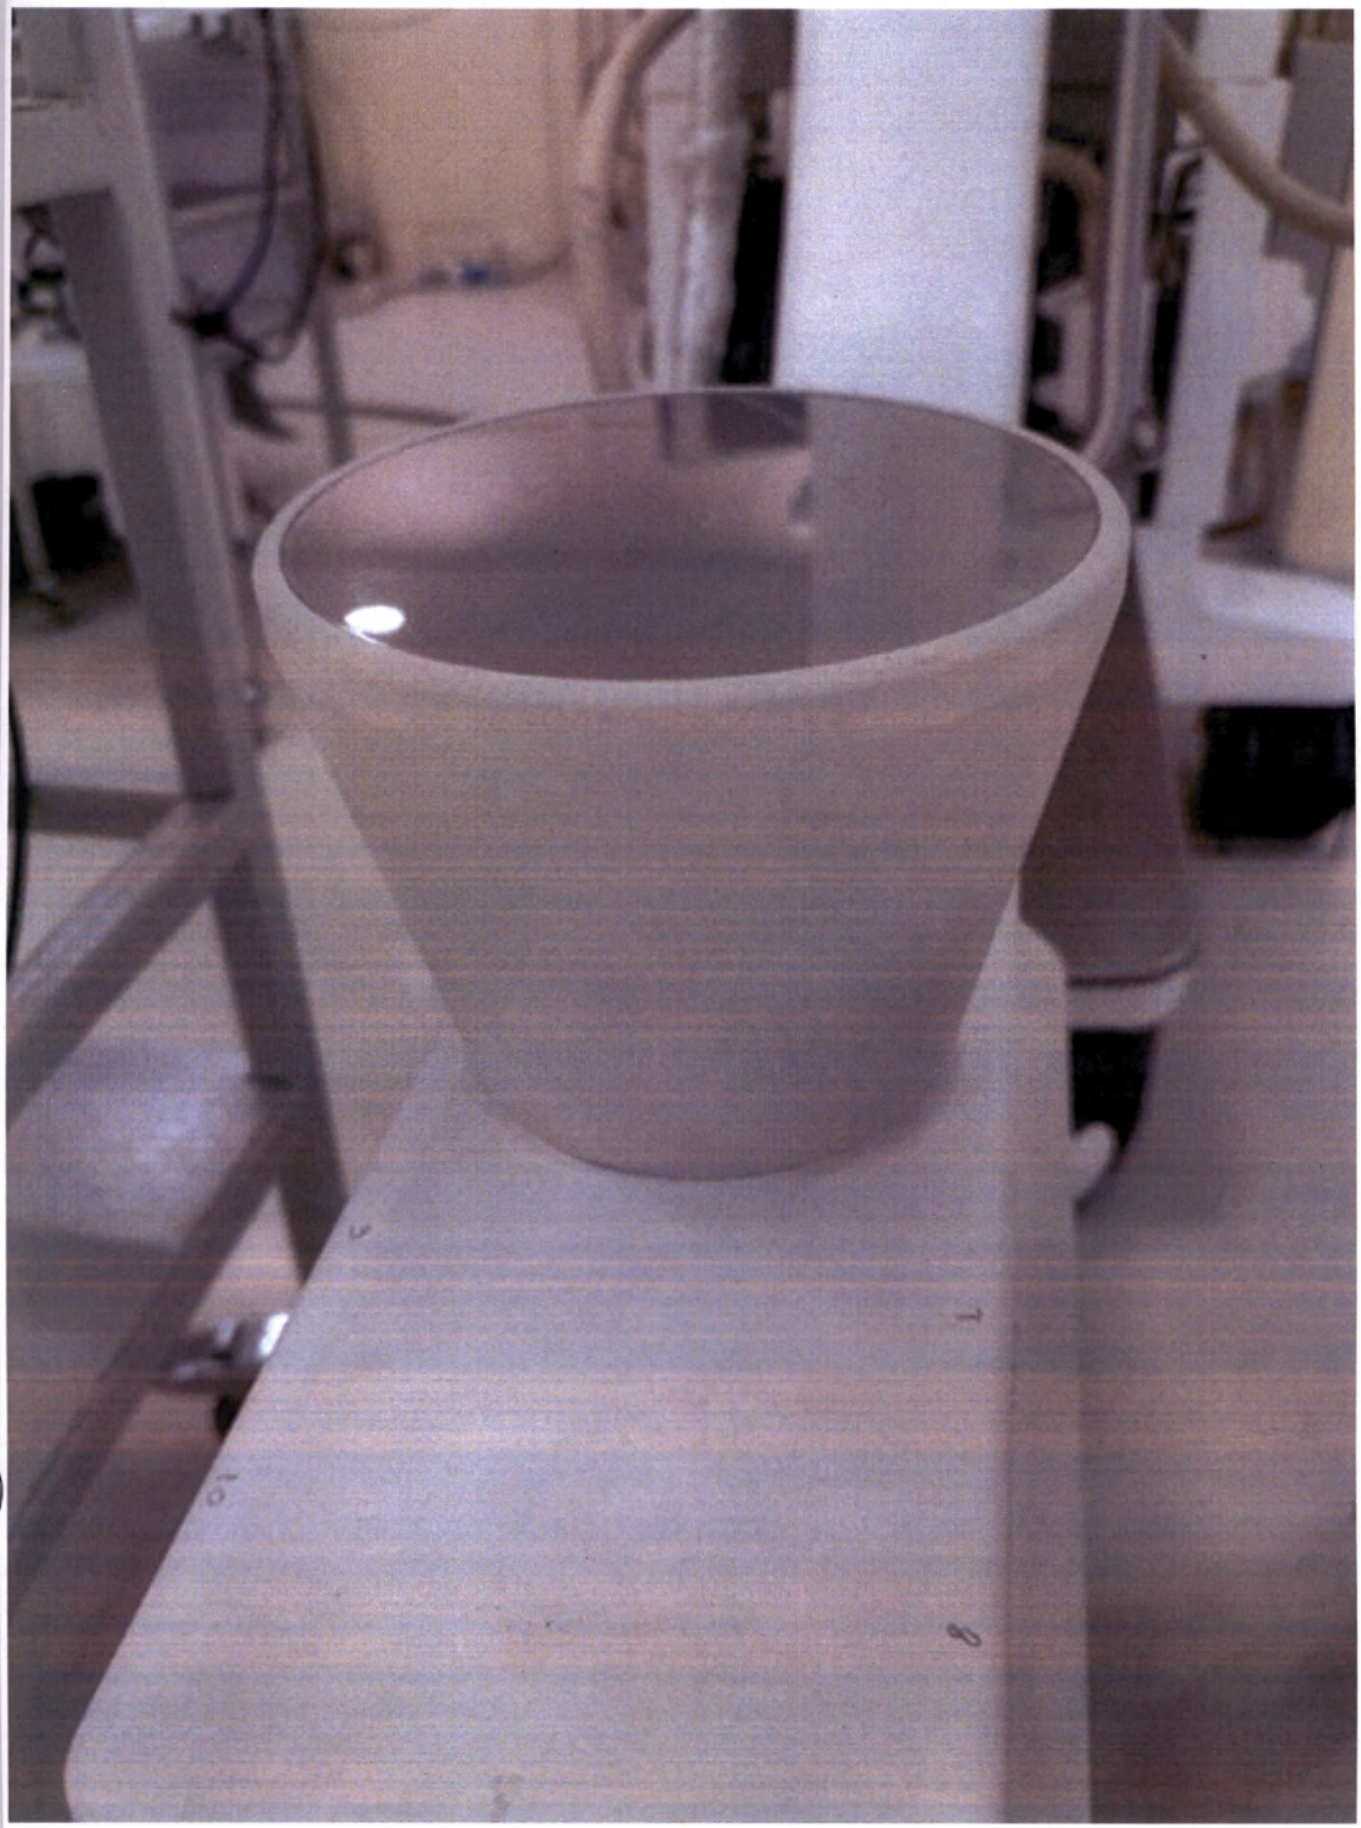

8.2 Насадка размером 20 см

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

9. Чехлы тканевые.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

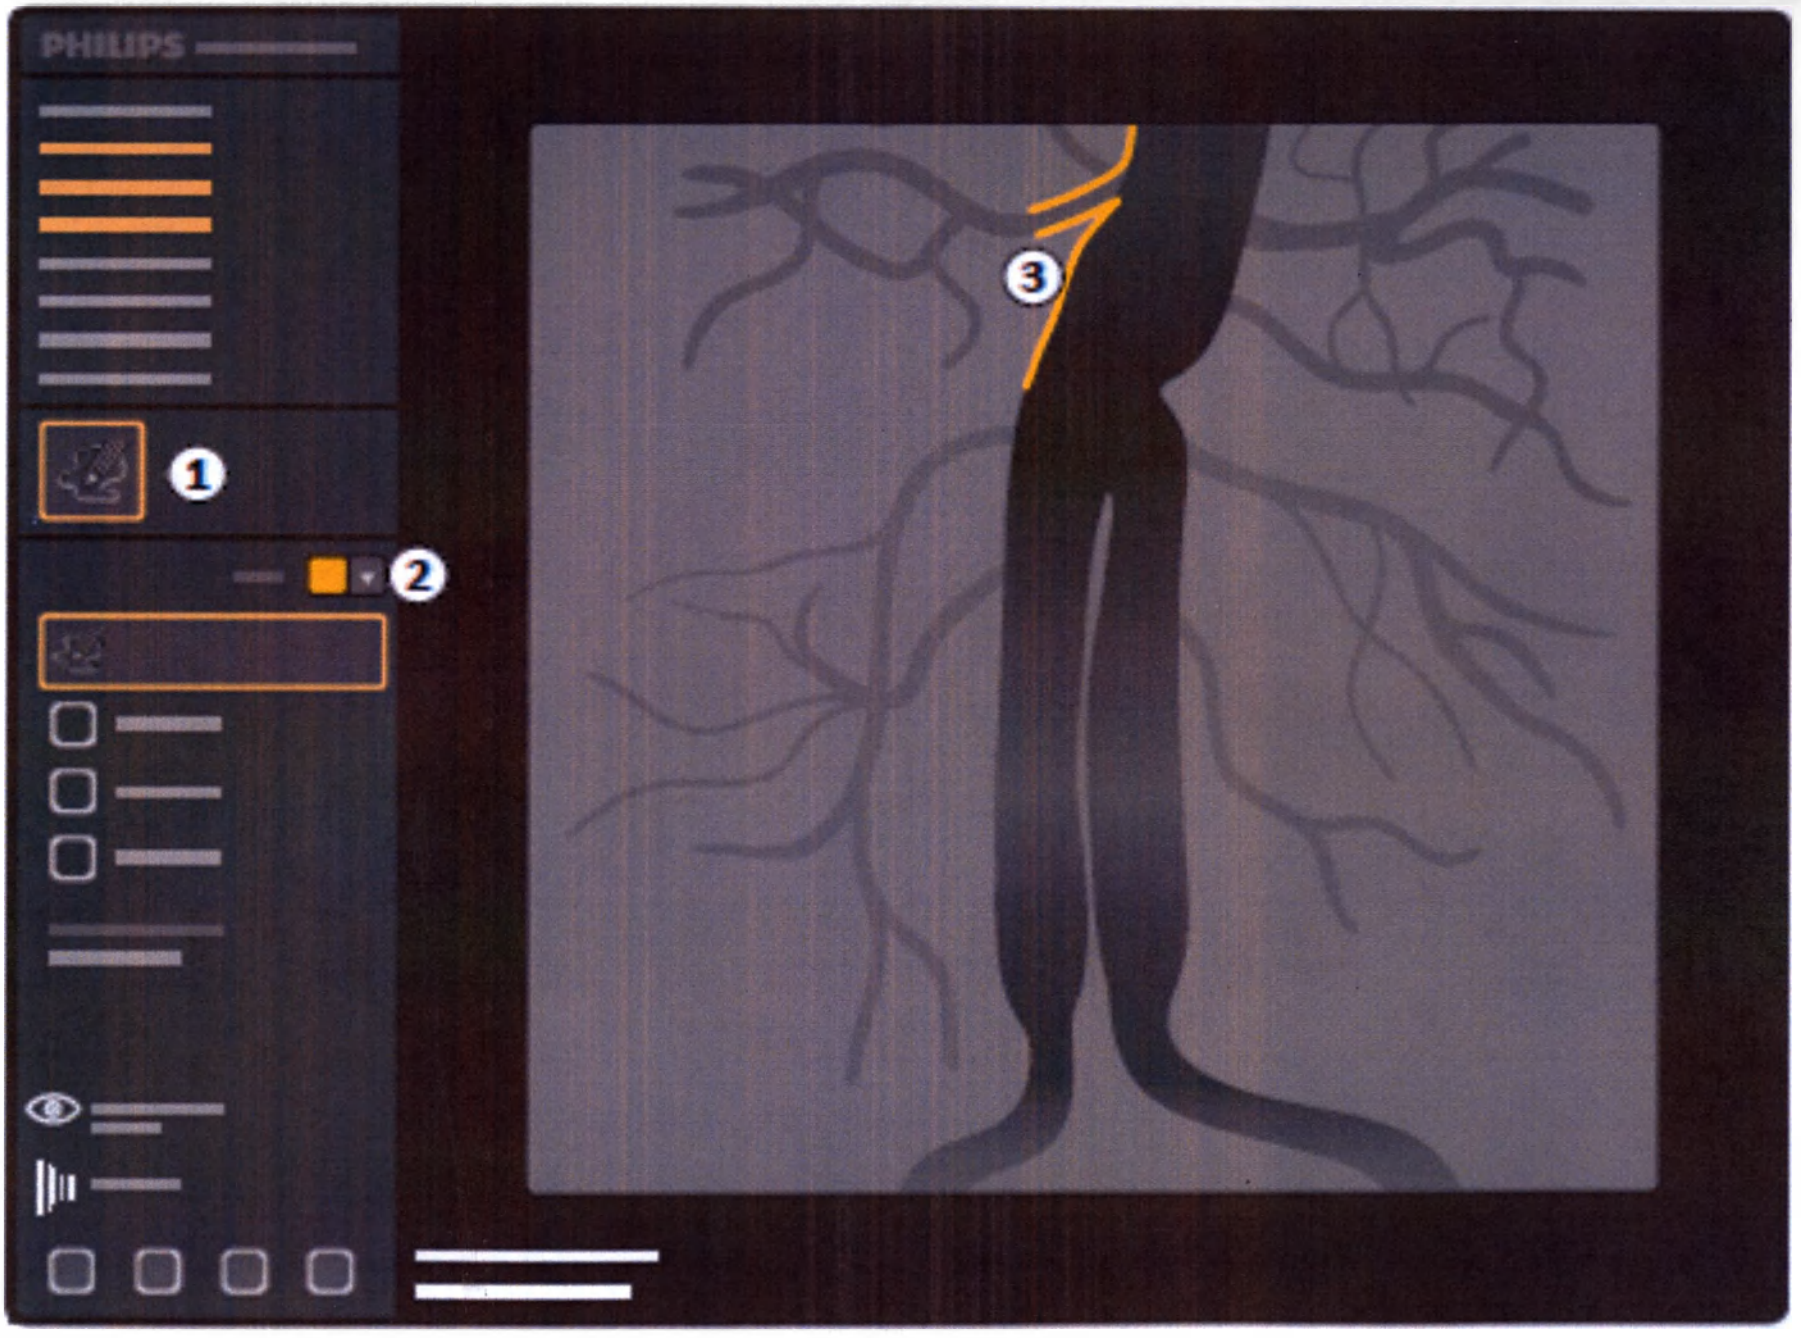

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

10.1 Модуль программный на электронных и/или оптических и/или виртуальных носителях: Инструмент очерчивания

10.3 Модуль программный на электронных и/или оптических и/или виртуальных носителях: Расширенное исследование болевого синдрома

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

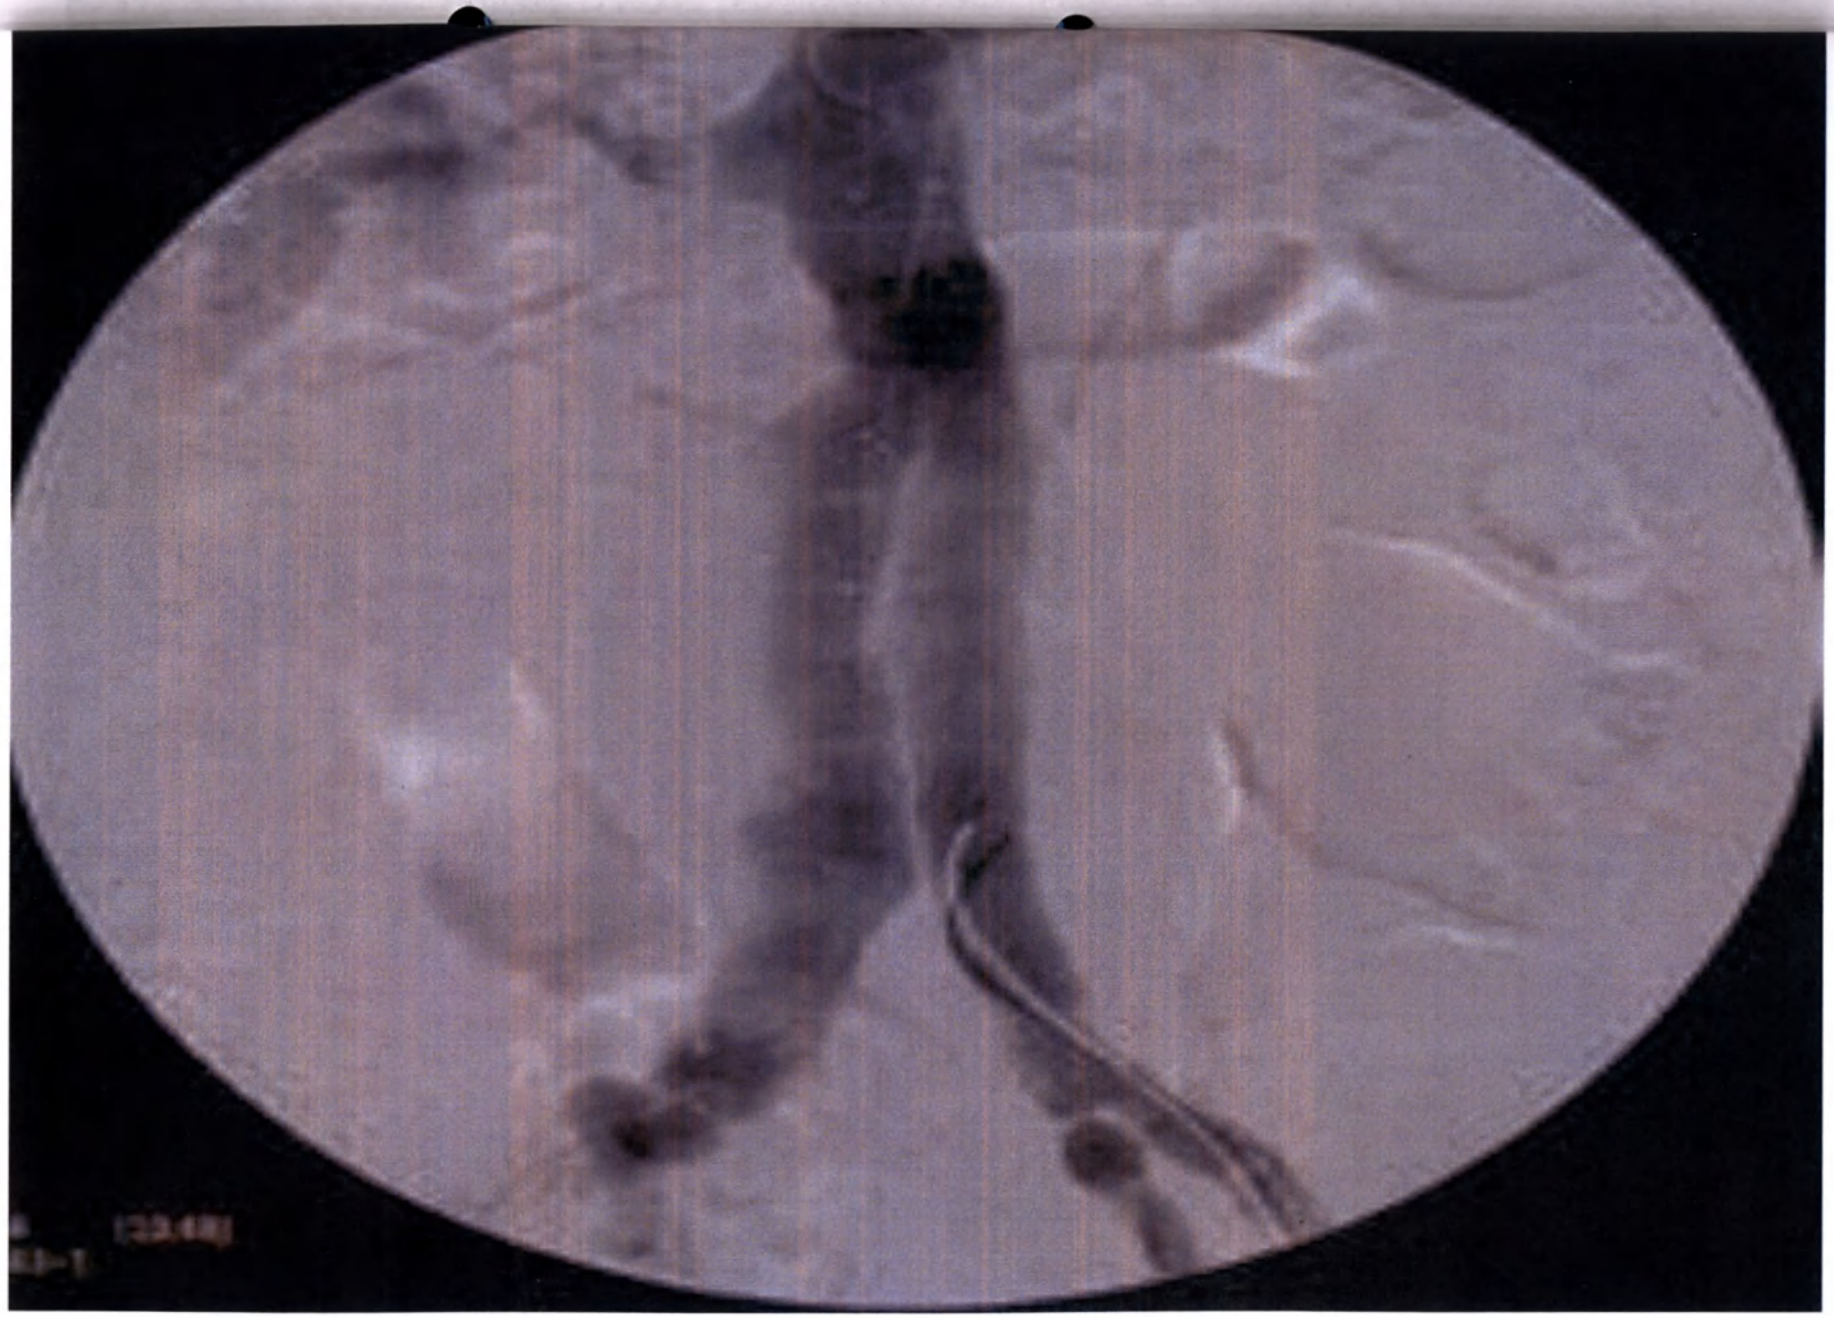

10.4 Модуль программный на электронных и/или оптических и/или виртуальных носителях: Расширенная визуализация сосудов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12. Блок для сохранения и передачи данных

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

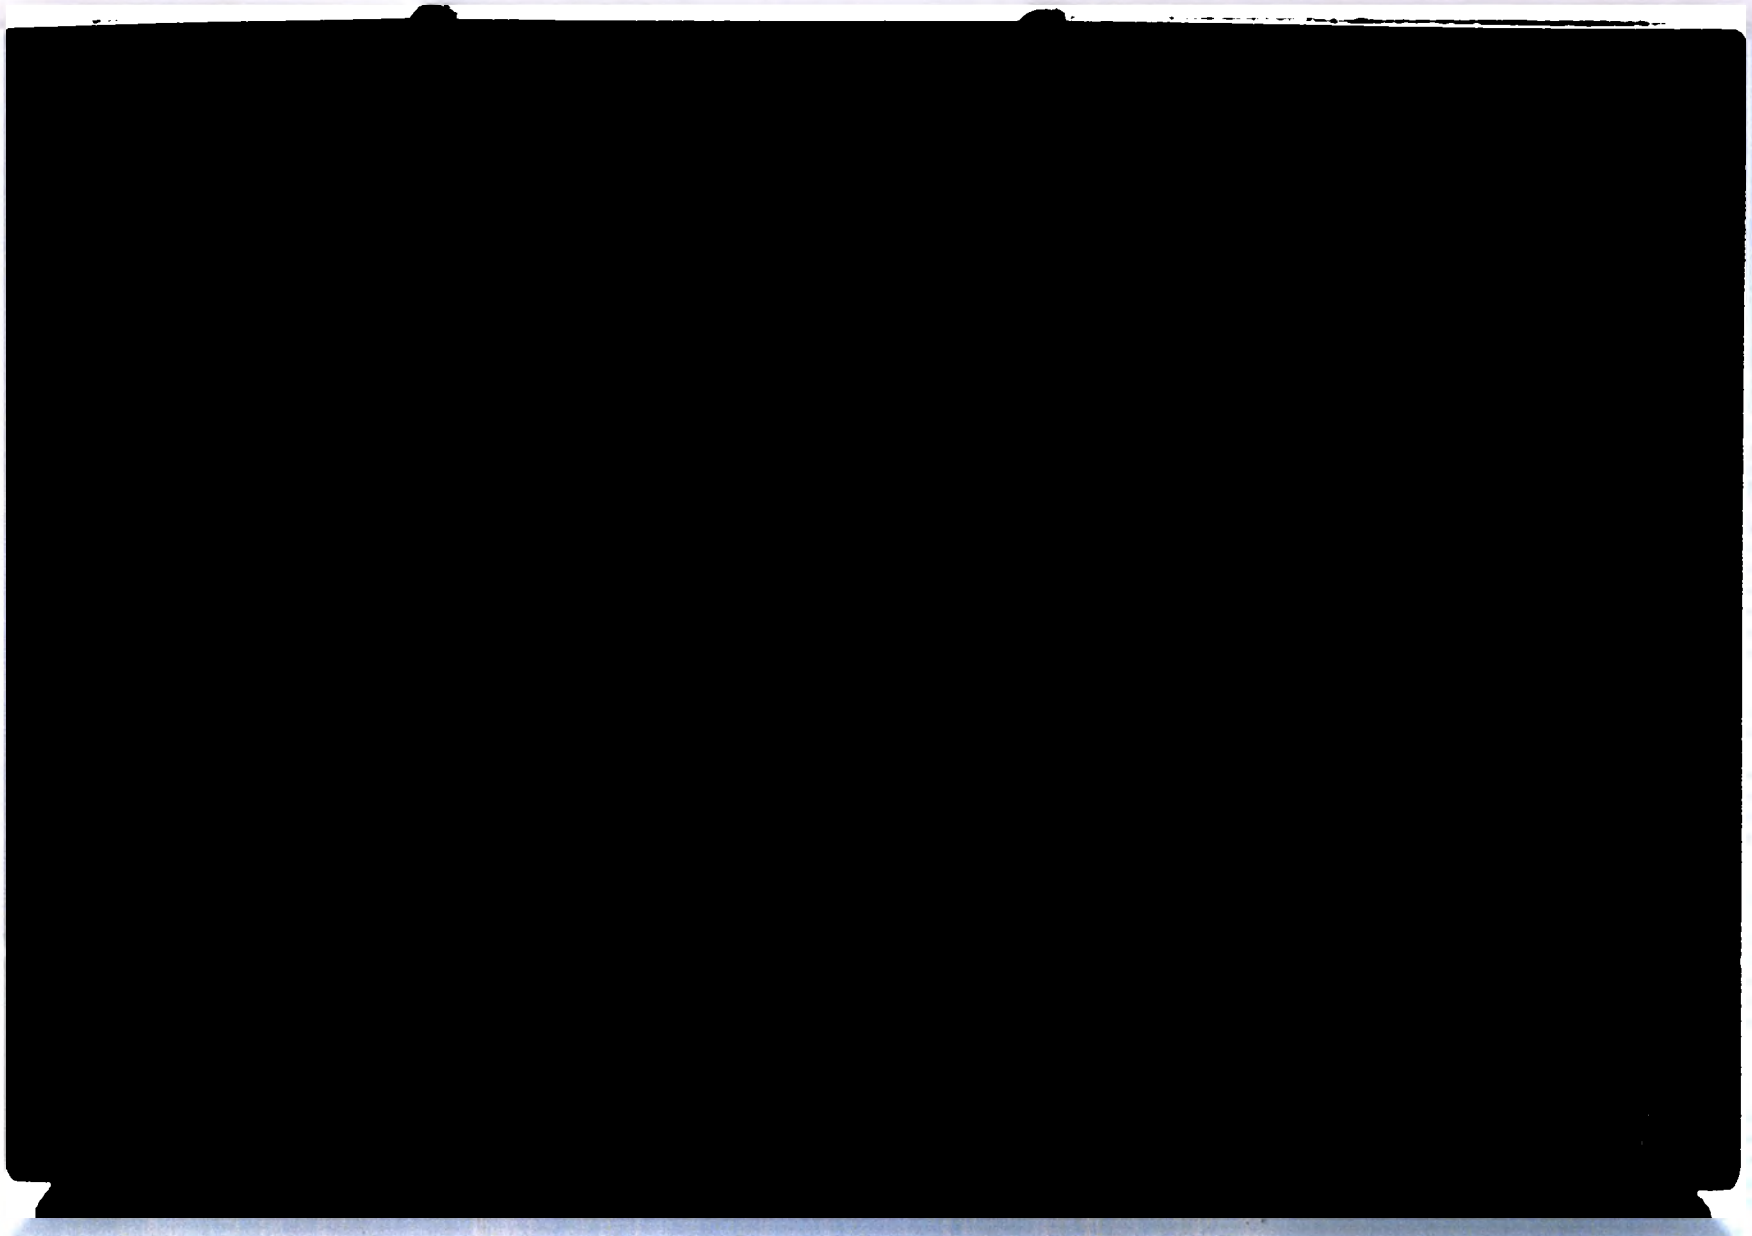

13. Модуль сохранения на DVD-диск DICOM.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

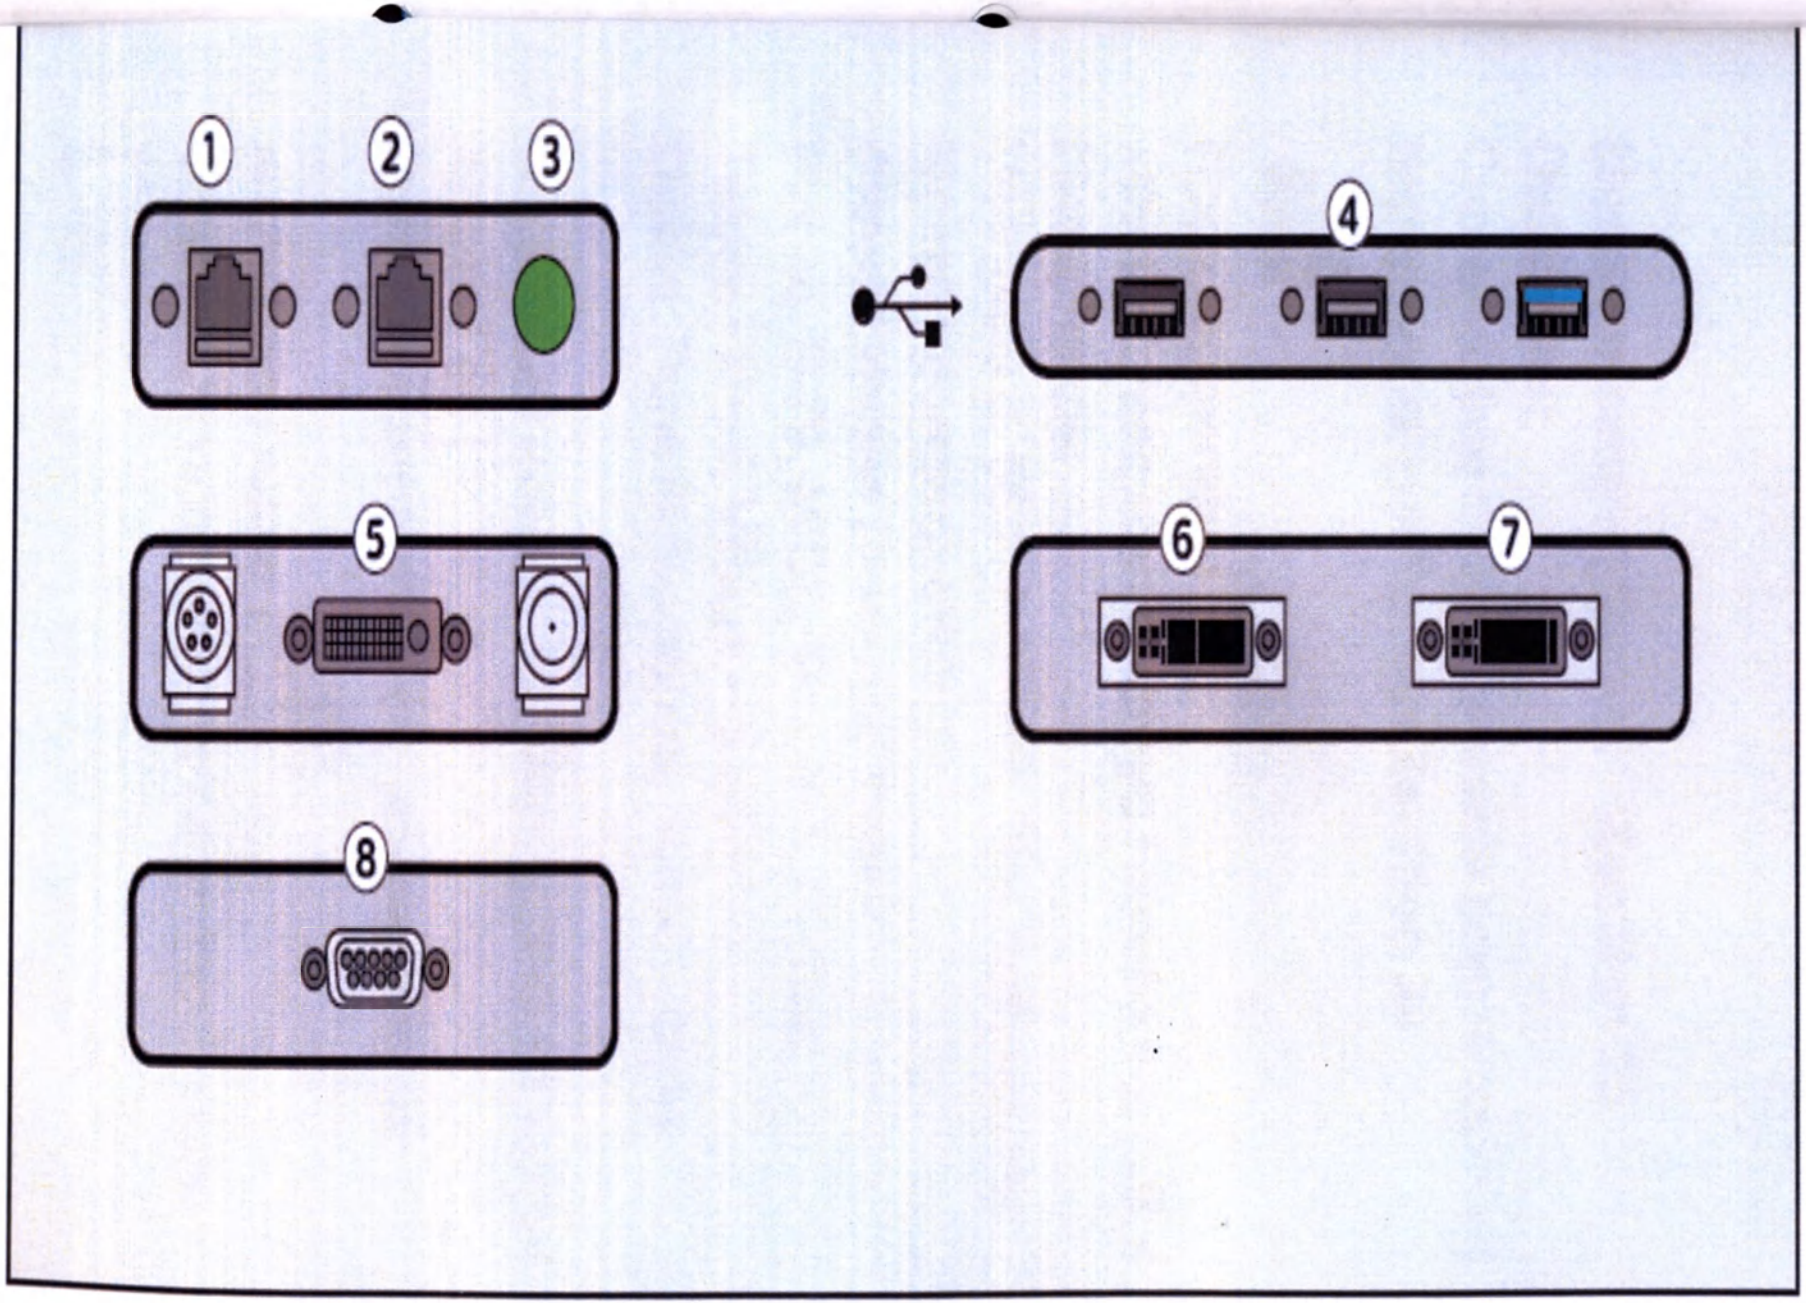

14. Видеовыход DVI

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Медицинское изделие: **Zenition 30**

Описание:

Система флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая **Zenition 30**

Производитель:

«Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.»
Нидерланды
Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Место производства:

Филипс Индия Лимитед, Индия
Plot no. B-79, MIDC, Phase-II, Chakan
Taluka - khed, Village – Savardari
District: Pune Maharashtra, 410501, India

Серийный номер: см. маркировку на английском языке SN

Дата производства: см. маркировку на английском языке 

Основные технические характеристики:

Меры предосторожности:

Регистрационное удостоверение: XXXXXX

Макет маркировки на русском языке

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 36 листа (ов)

ООО «Филипс»

"ФИЛИПС"

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU