

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Айно-М»



Габриэлов И. Б.

«21» августа 2023г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат искусственной вентиляции легких портативный Oxivent


1. Общий вид медицинского изделия

1.1. Аппарат искусственной вентиляции легких портативный Oxivent, в составе:


1.1.1. Аппарат ИВЛ Oxi4 Plus – основной блок




1.1.2. Шланг кислородного баллона

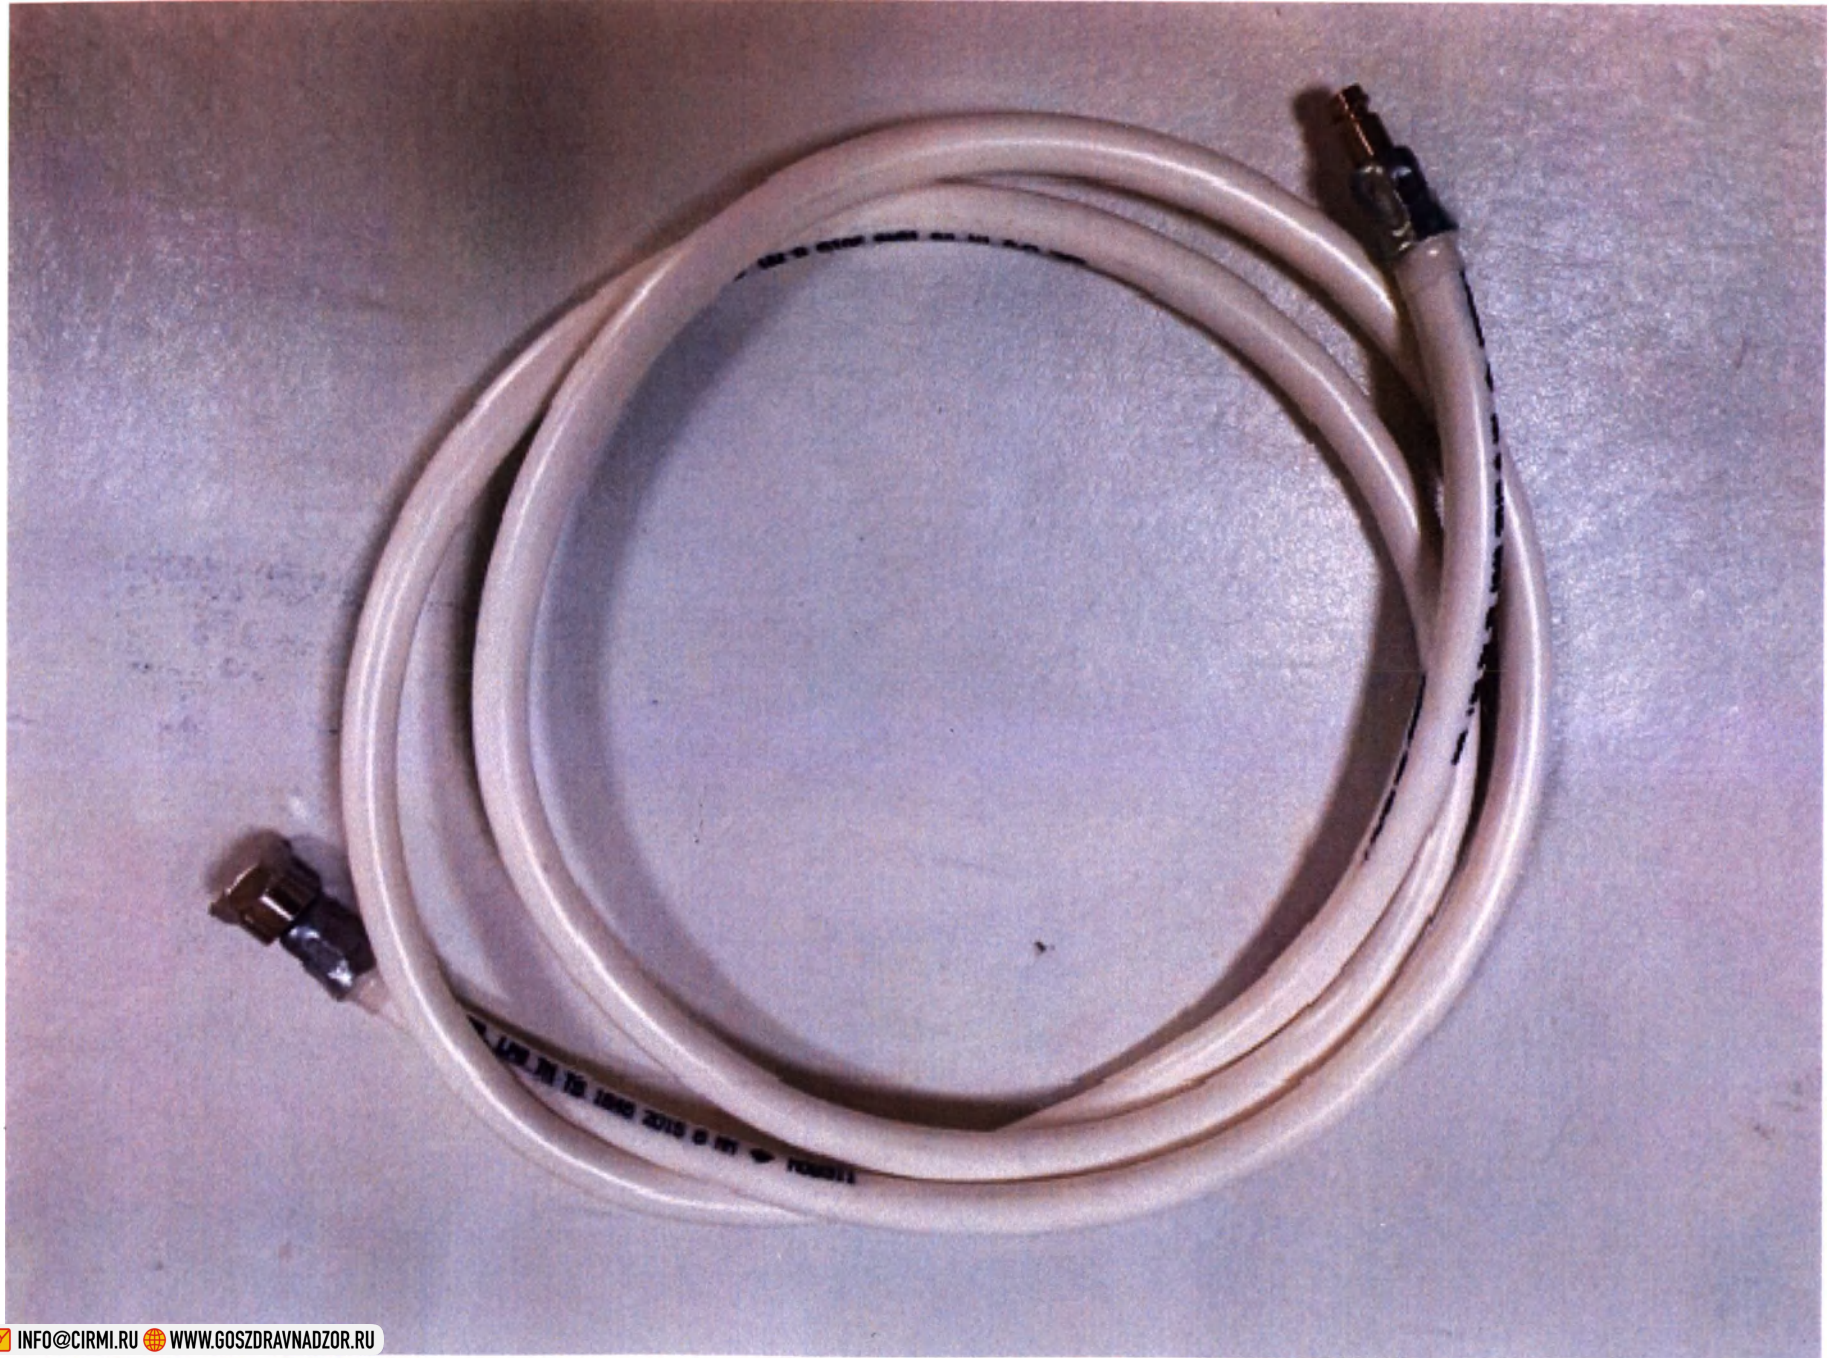


1.1.3. Кислородный шланг

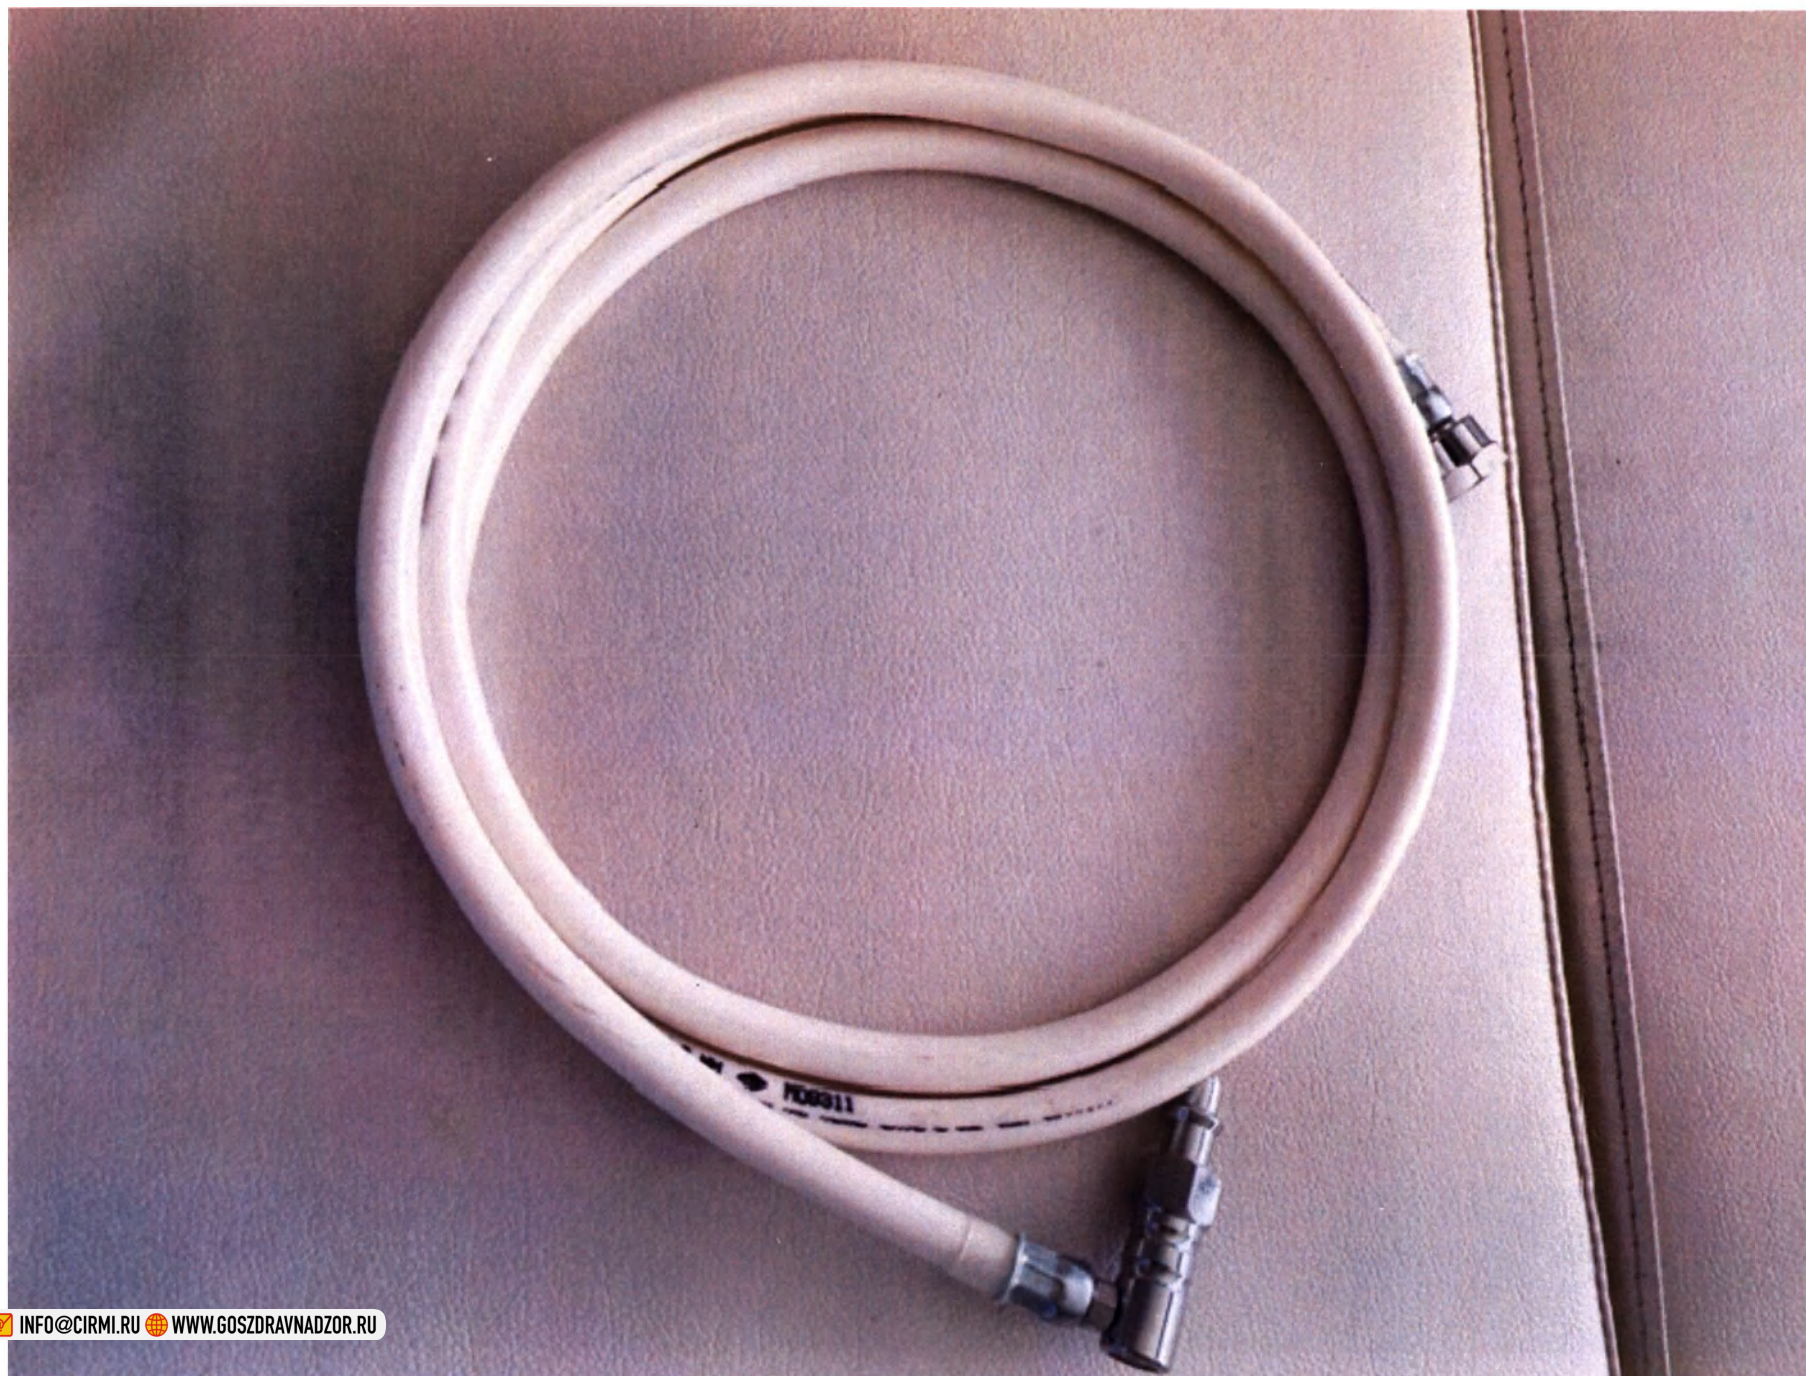

1.1.4. Клапан выдоха

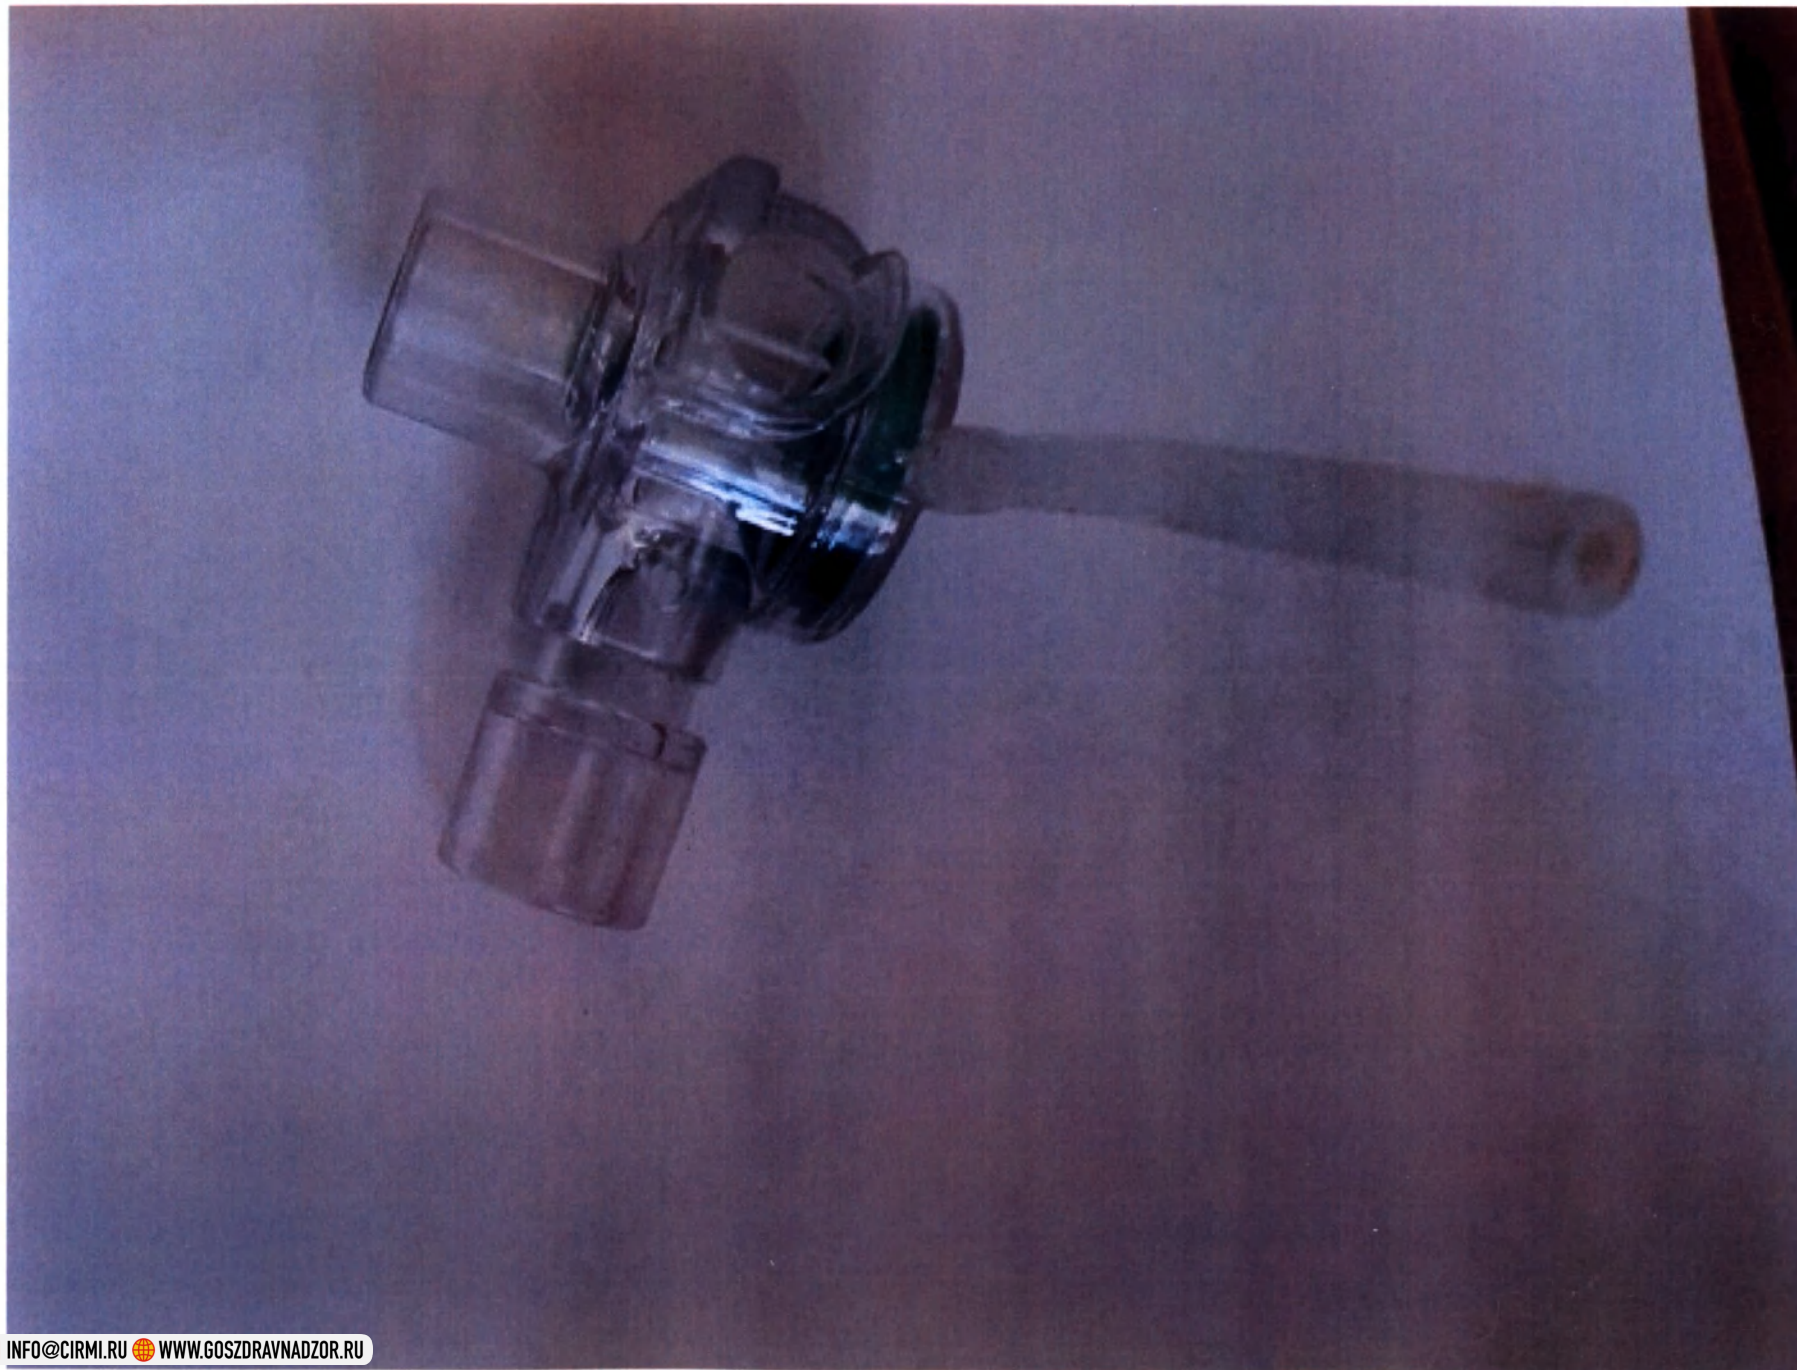

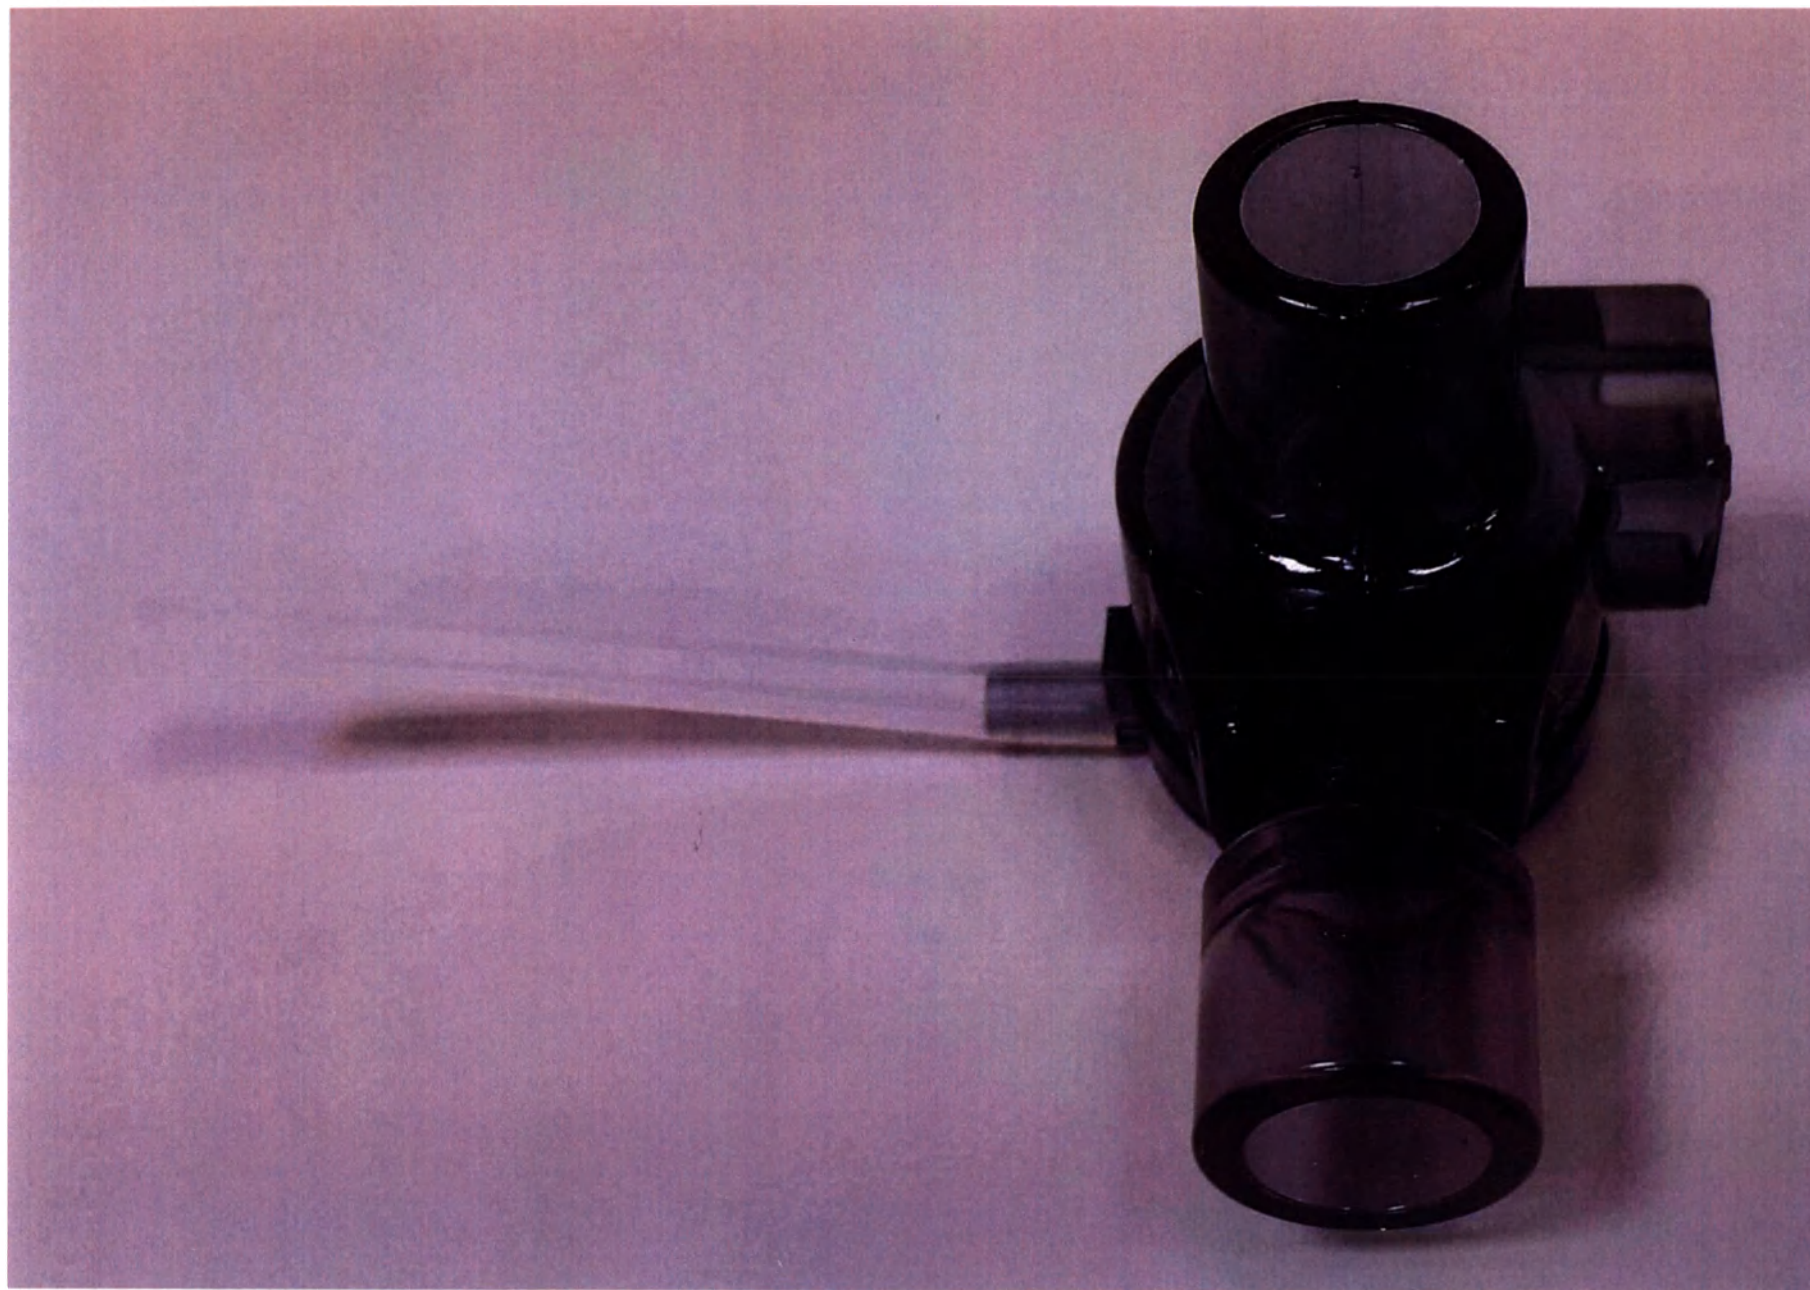





1.1.8. Кабель датчика потока взрослый (дистальный)




1.1.9. Кабель датчика потока неонатальный (проксимальный)




1.1.10. Датчик кислорода



1.1.11. Адаптер дыхательный (Удлинительная трубка для клапана выхода)

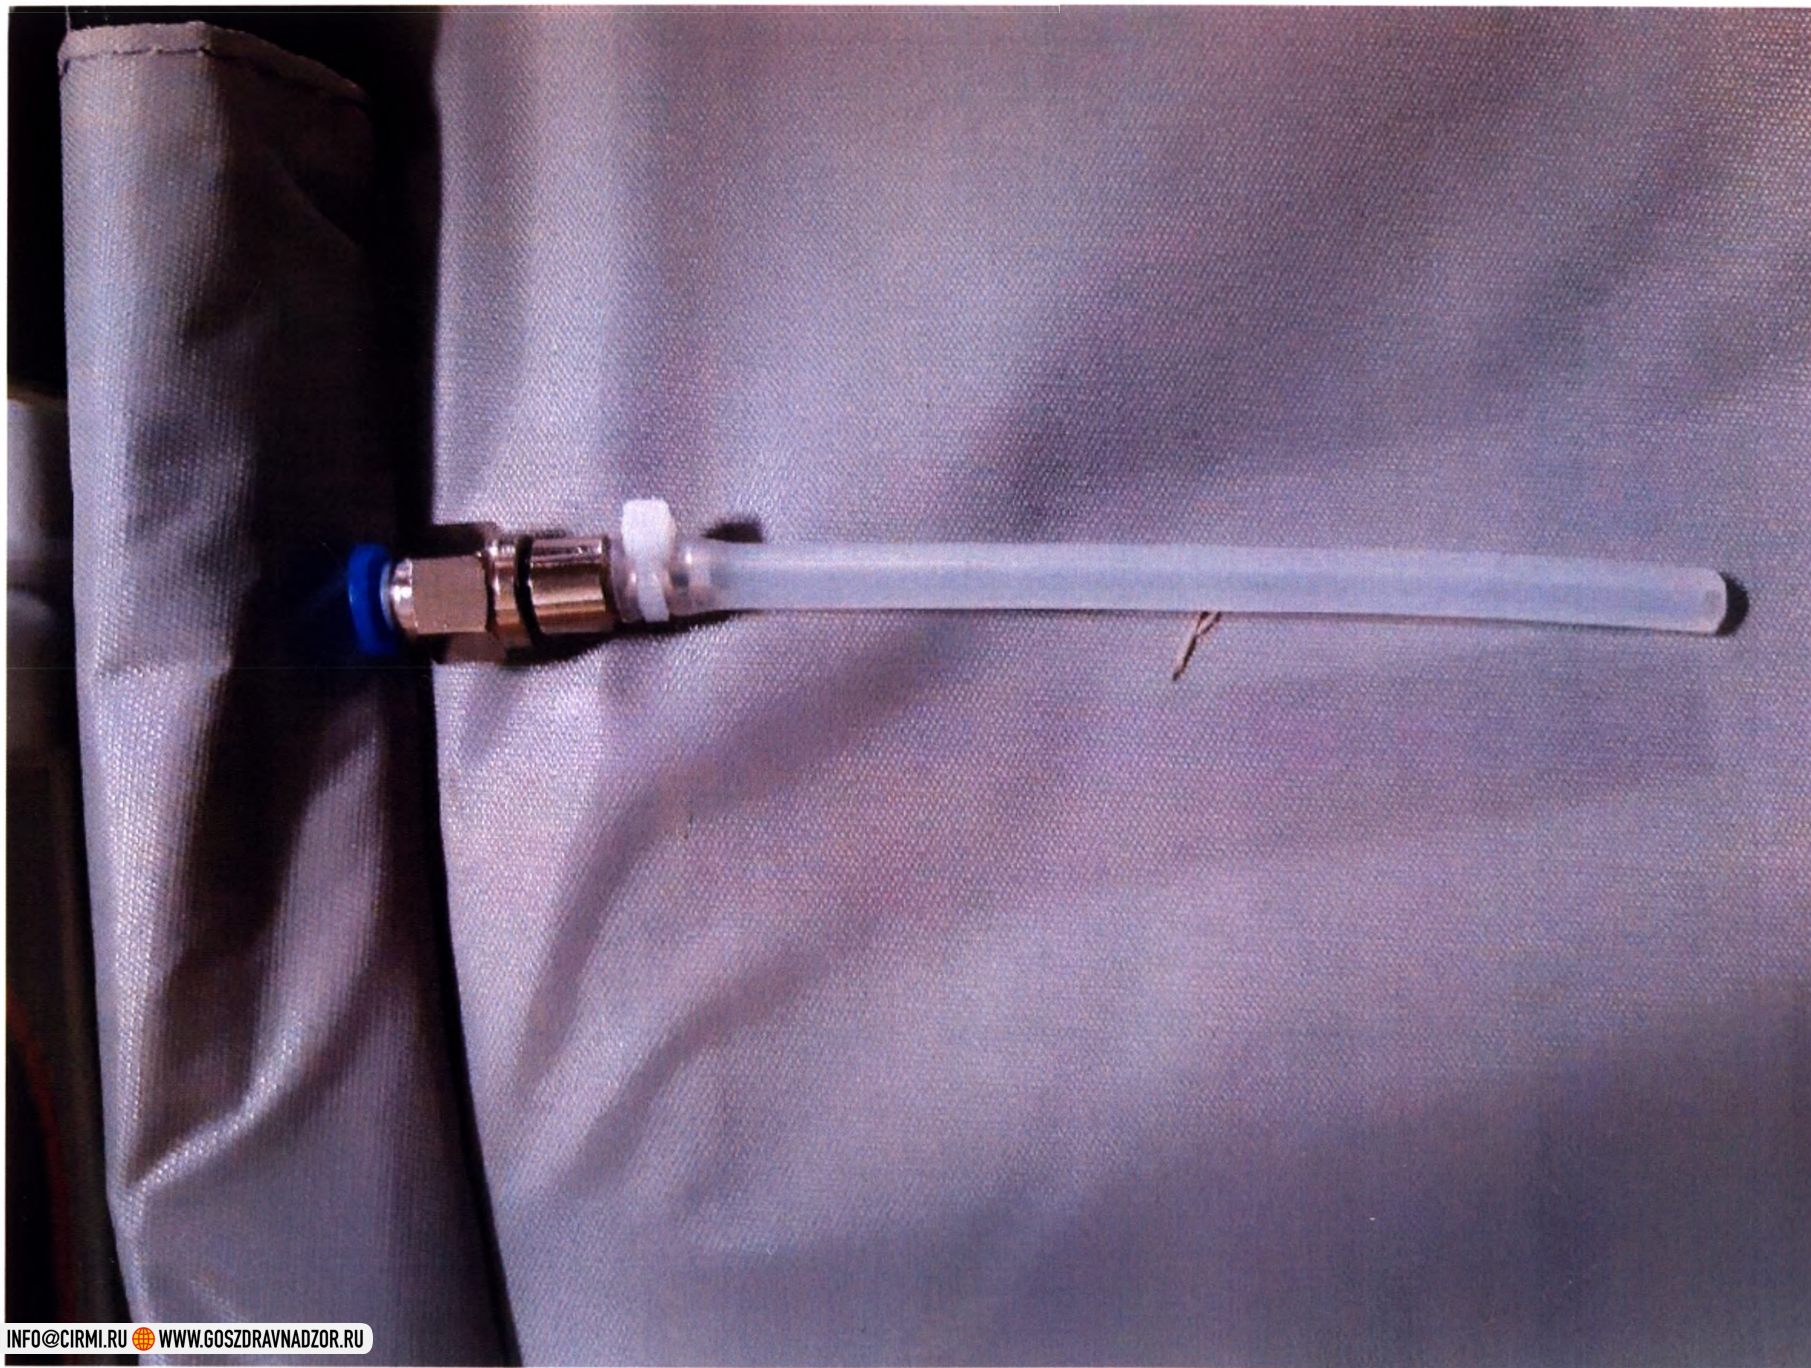

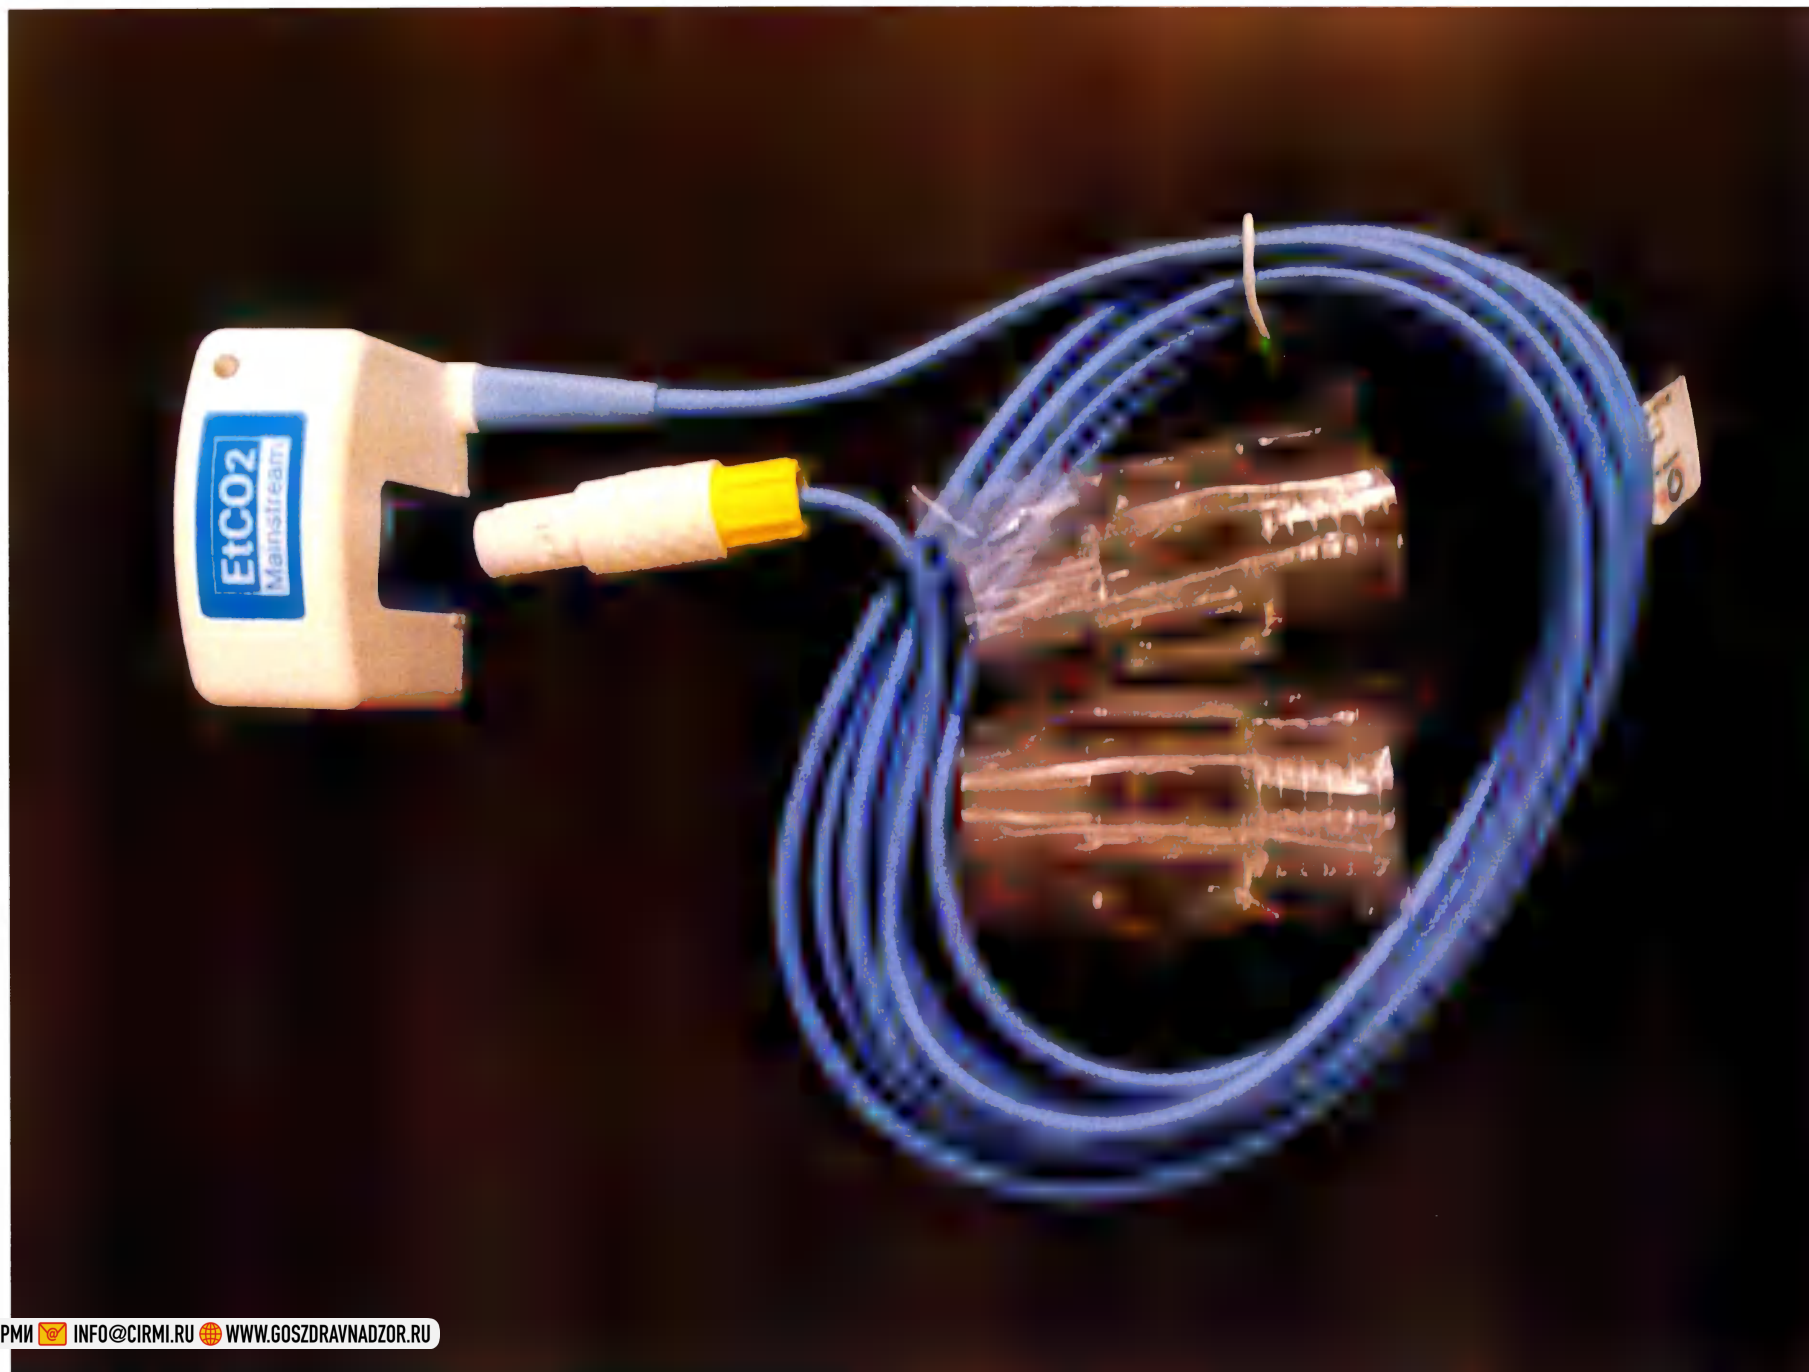


1.2. Принадлежности

1.2.1. Зарядное устройство 220В-12В



1.2.2. Зарядное устройство от бортовой сети

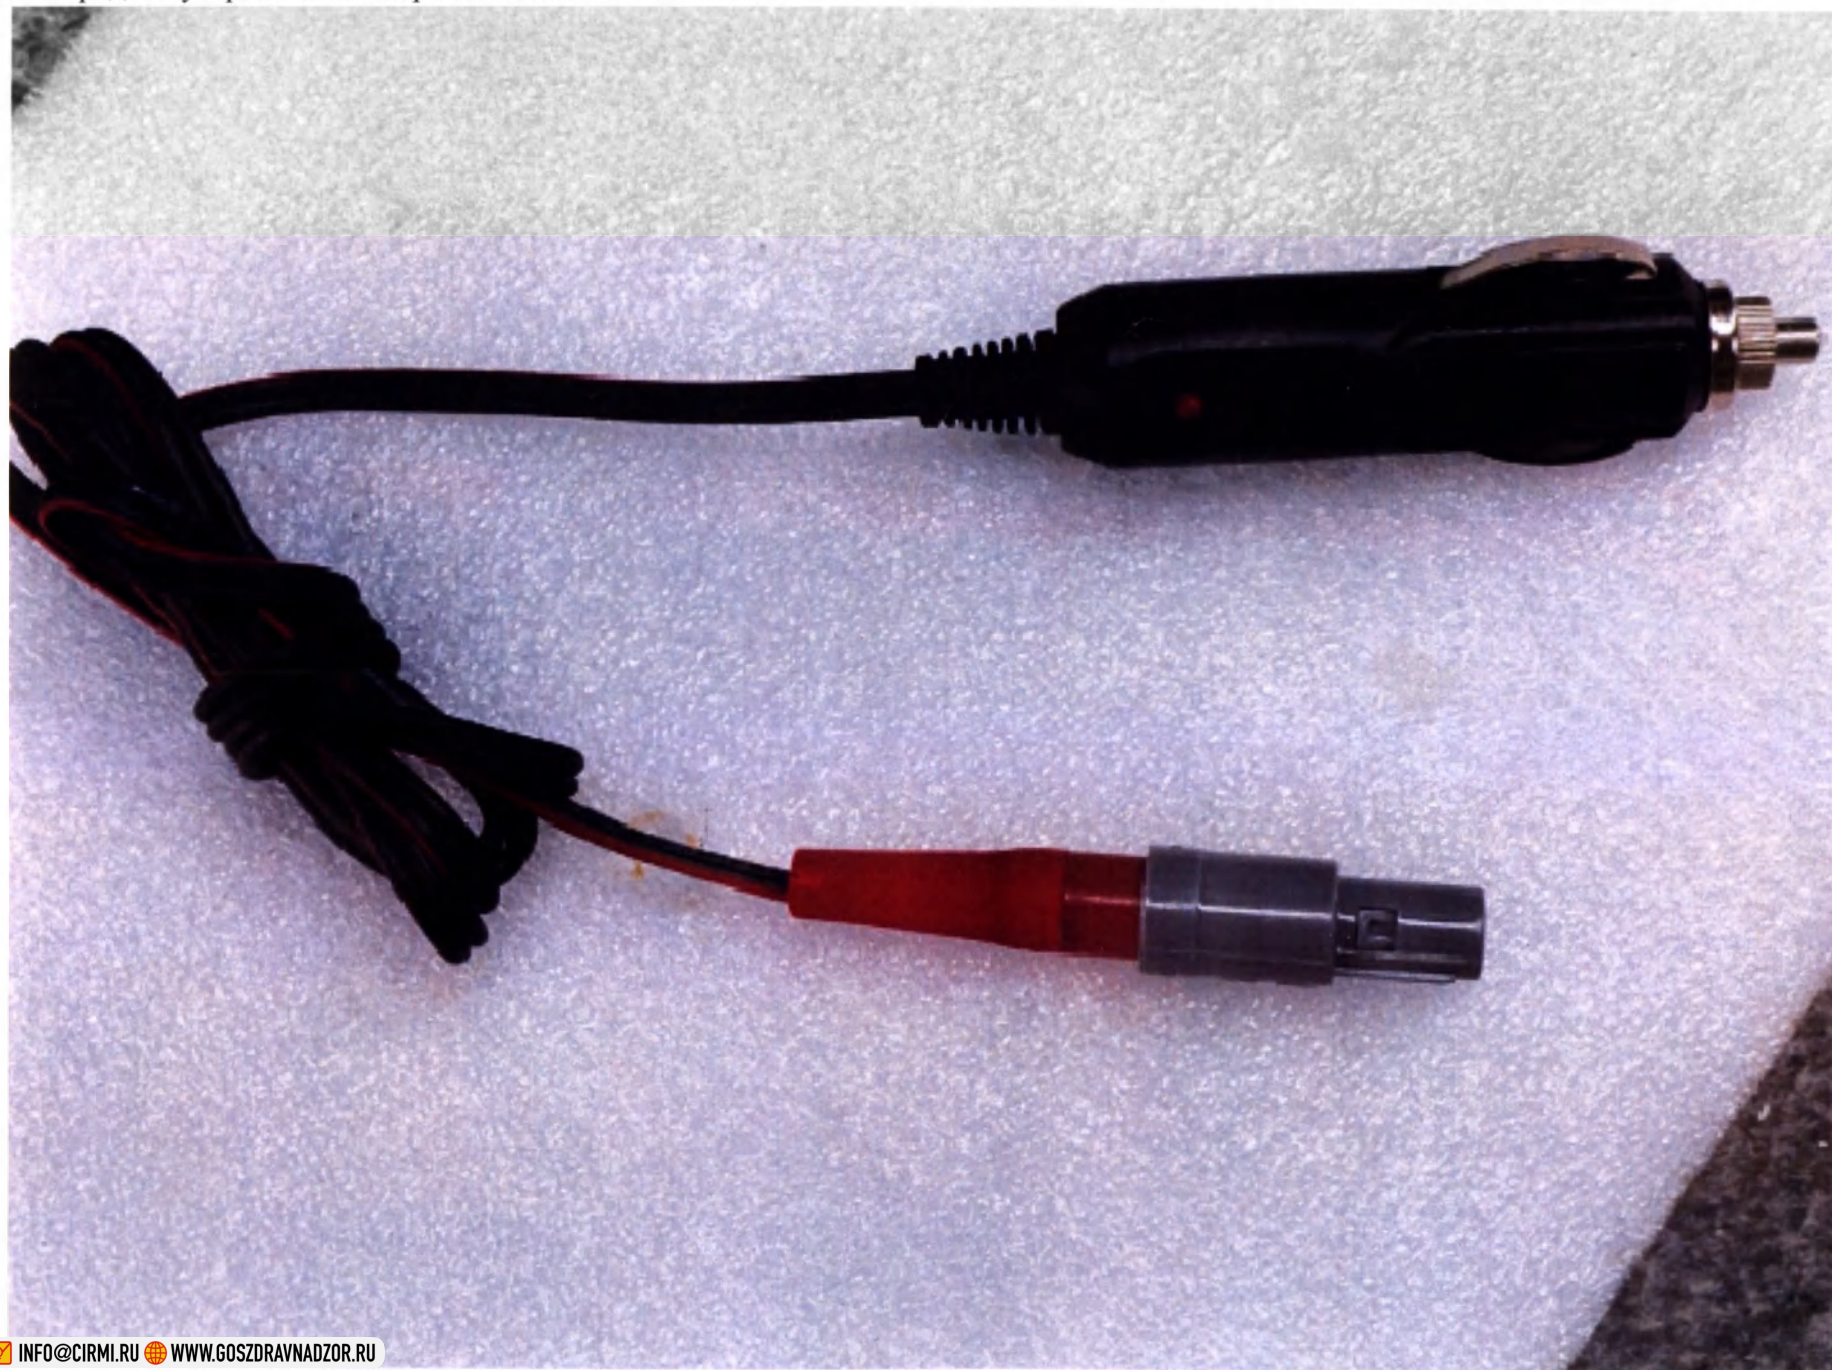

1.2.3. Сумка для переноски





1.2.4. Сумка для переноски жесткая





1.2.6. Крепление для аппарата

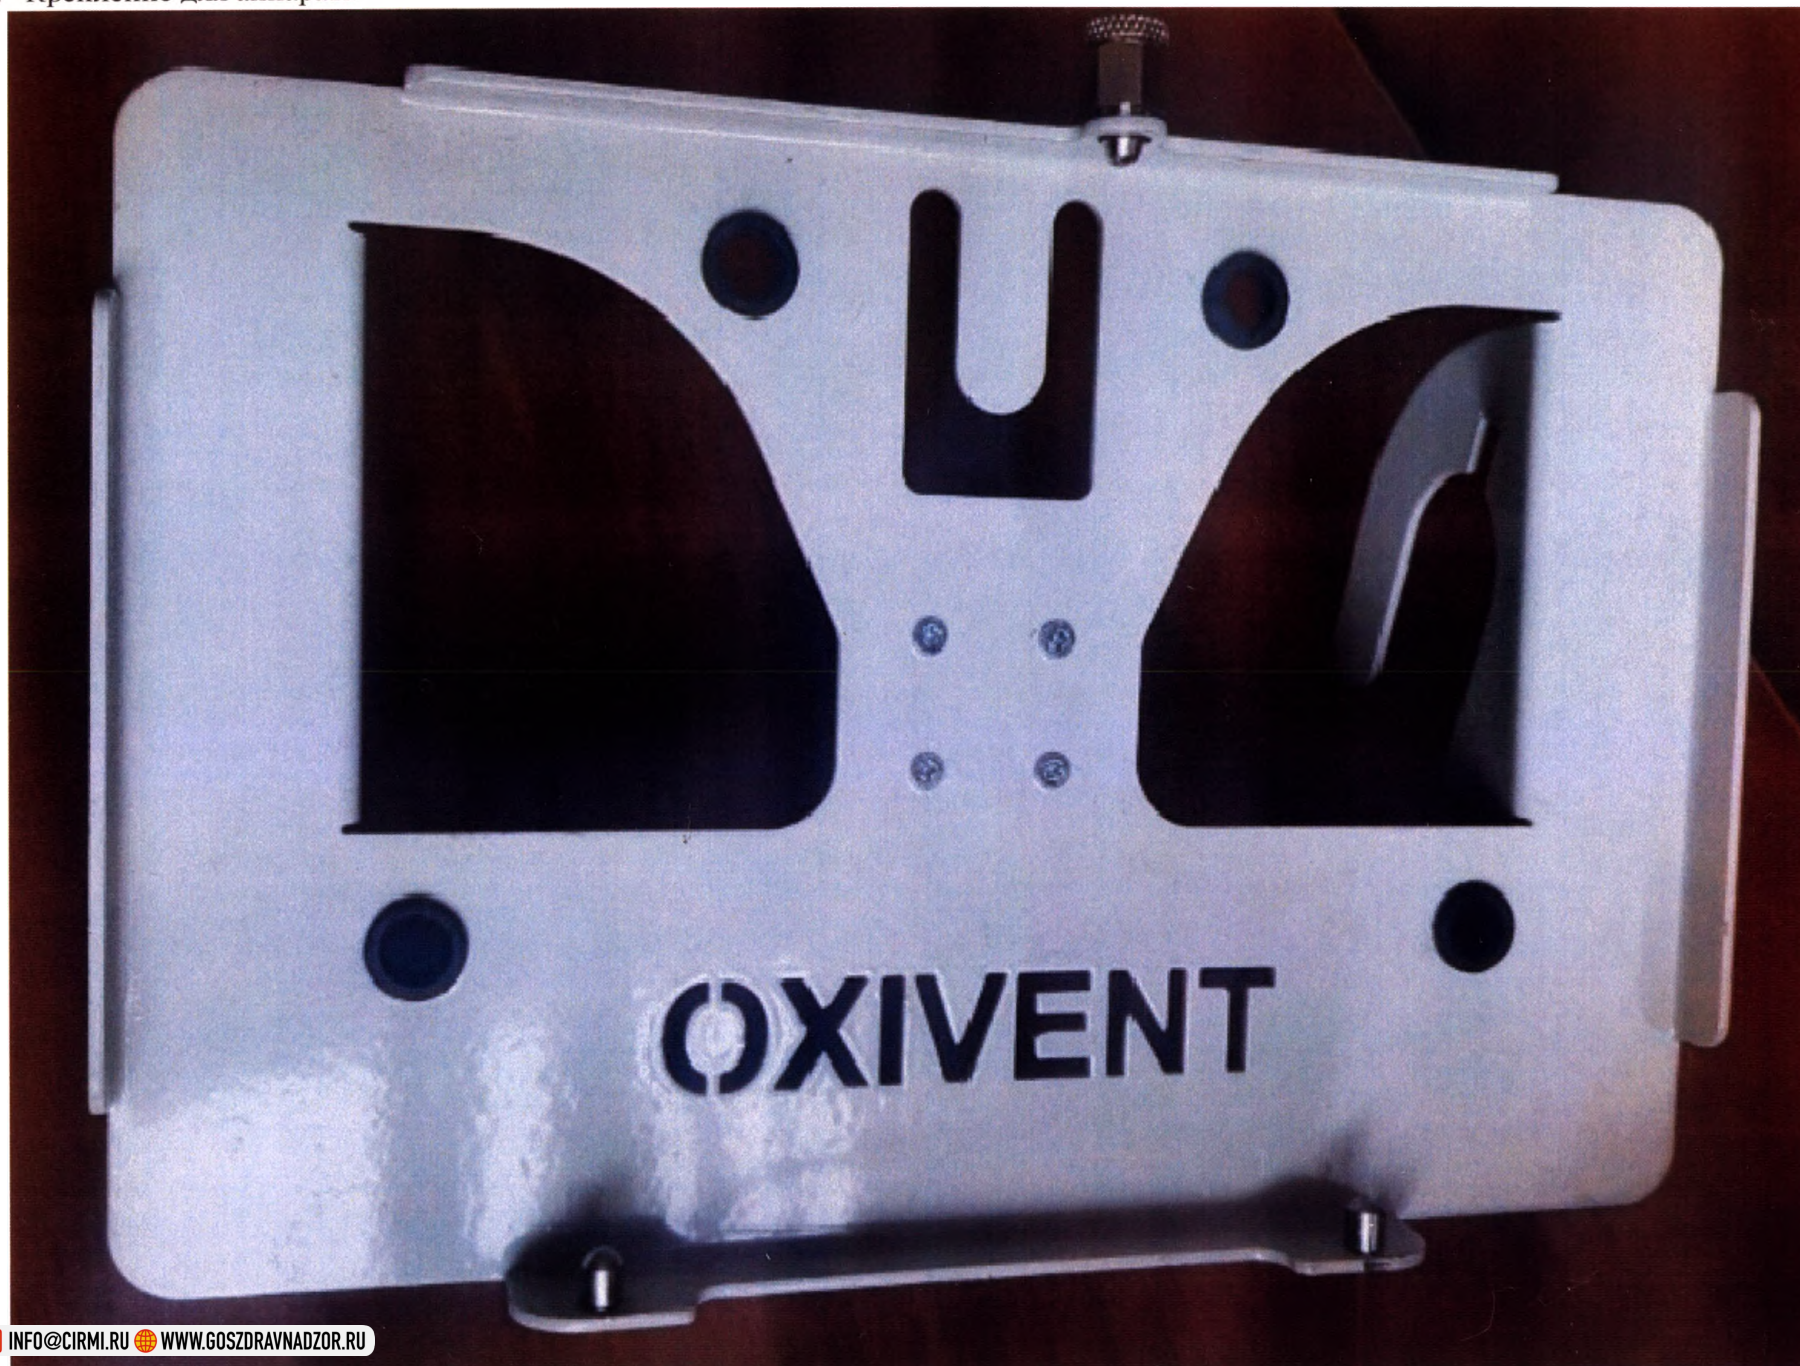

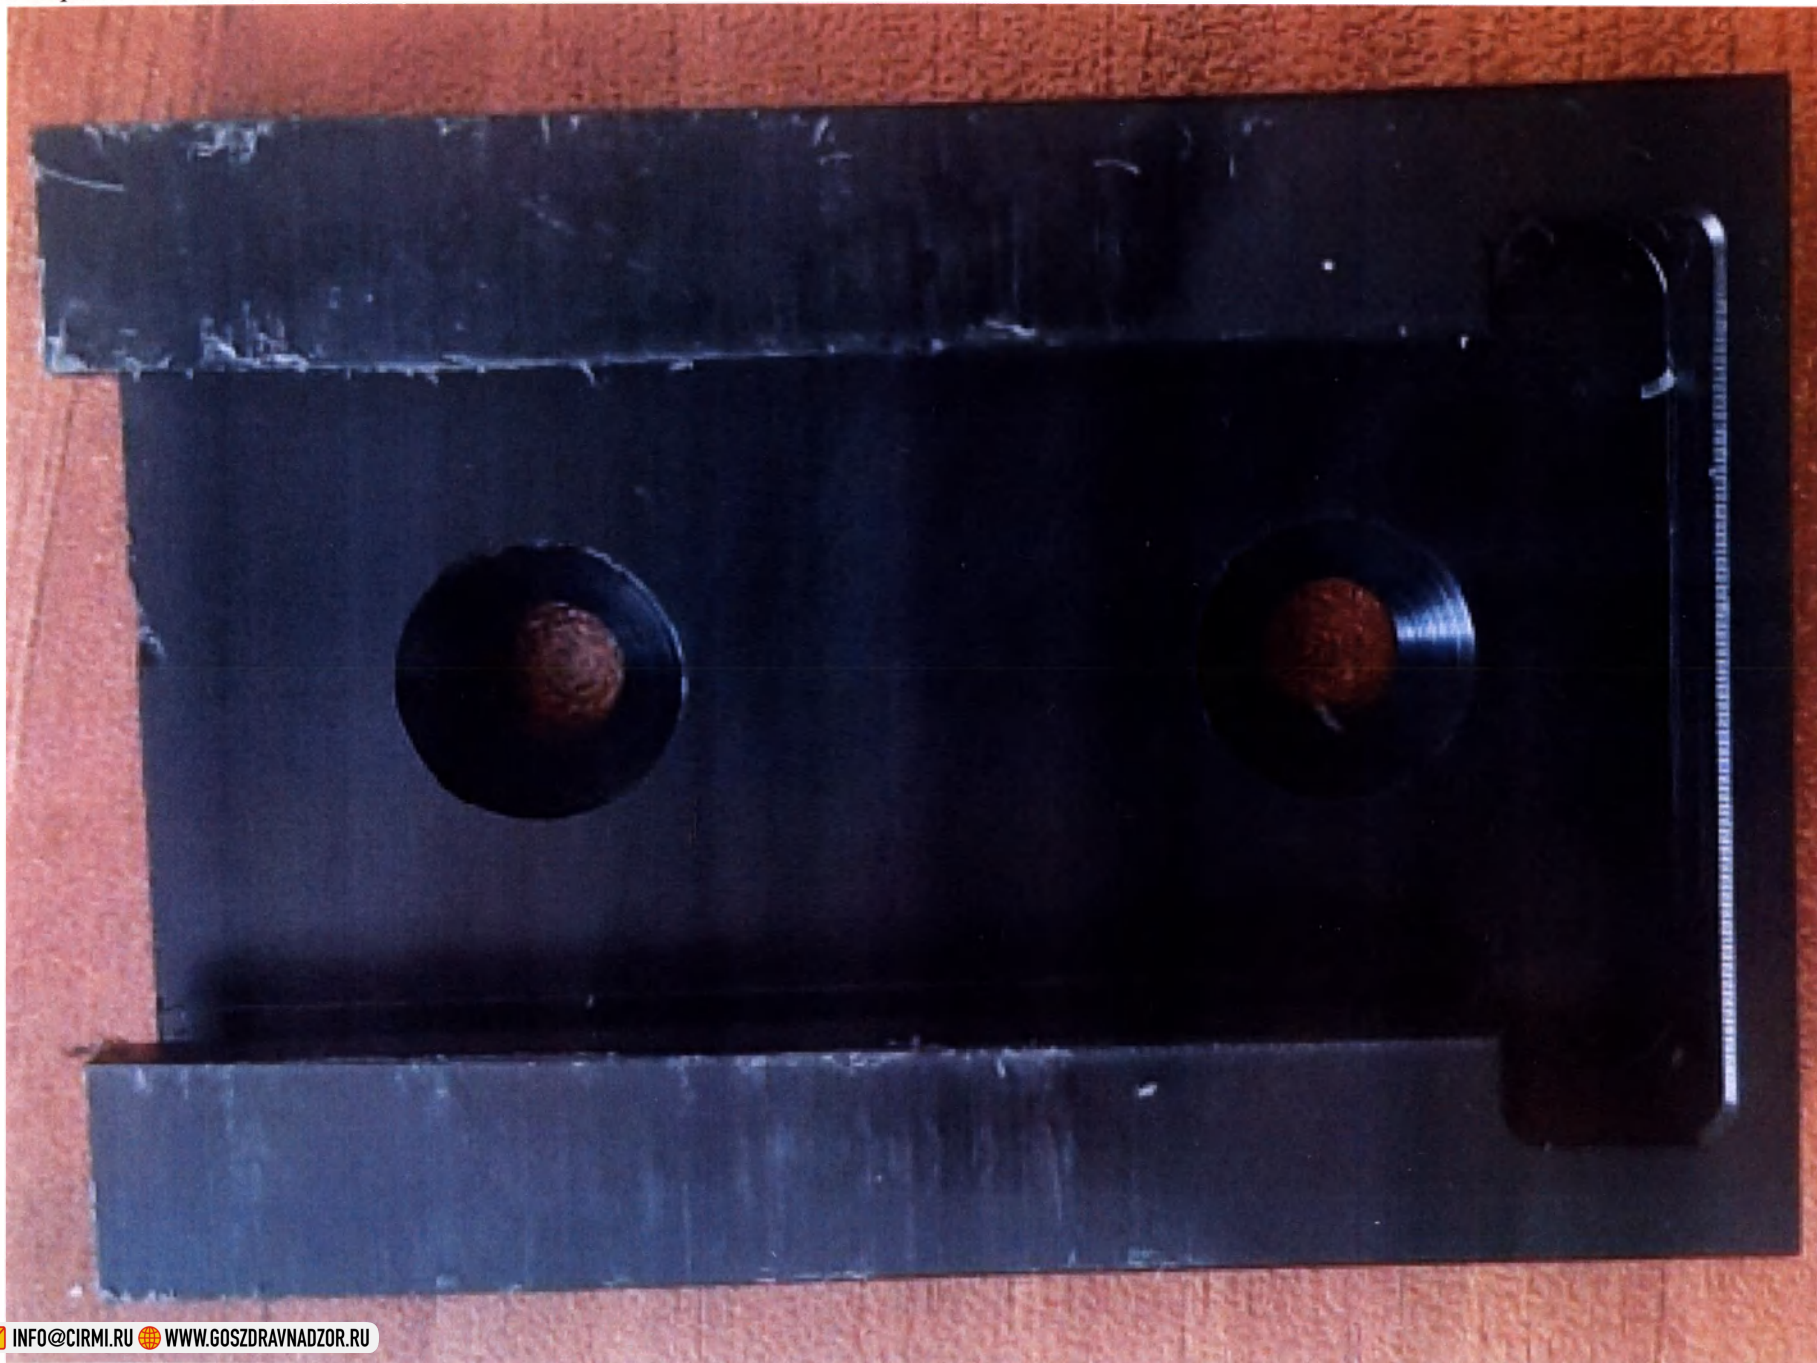

1.2.8. Держатель контура




1.2.9. Тележка




1.2.10. Батарея резервного питания



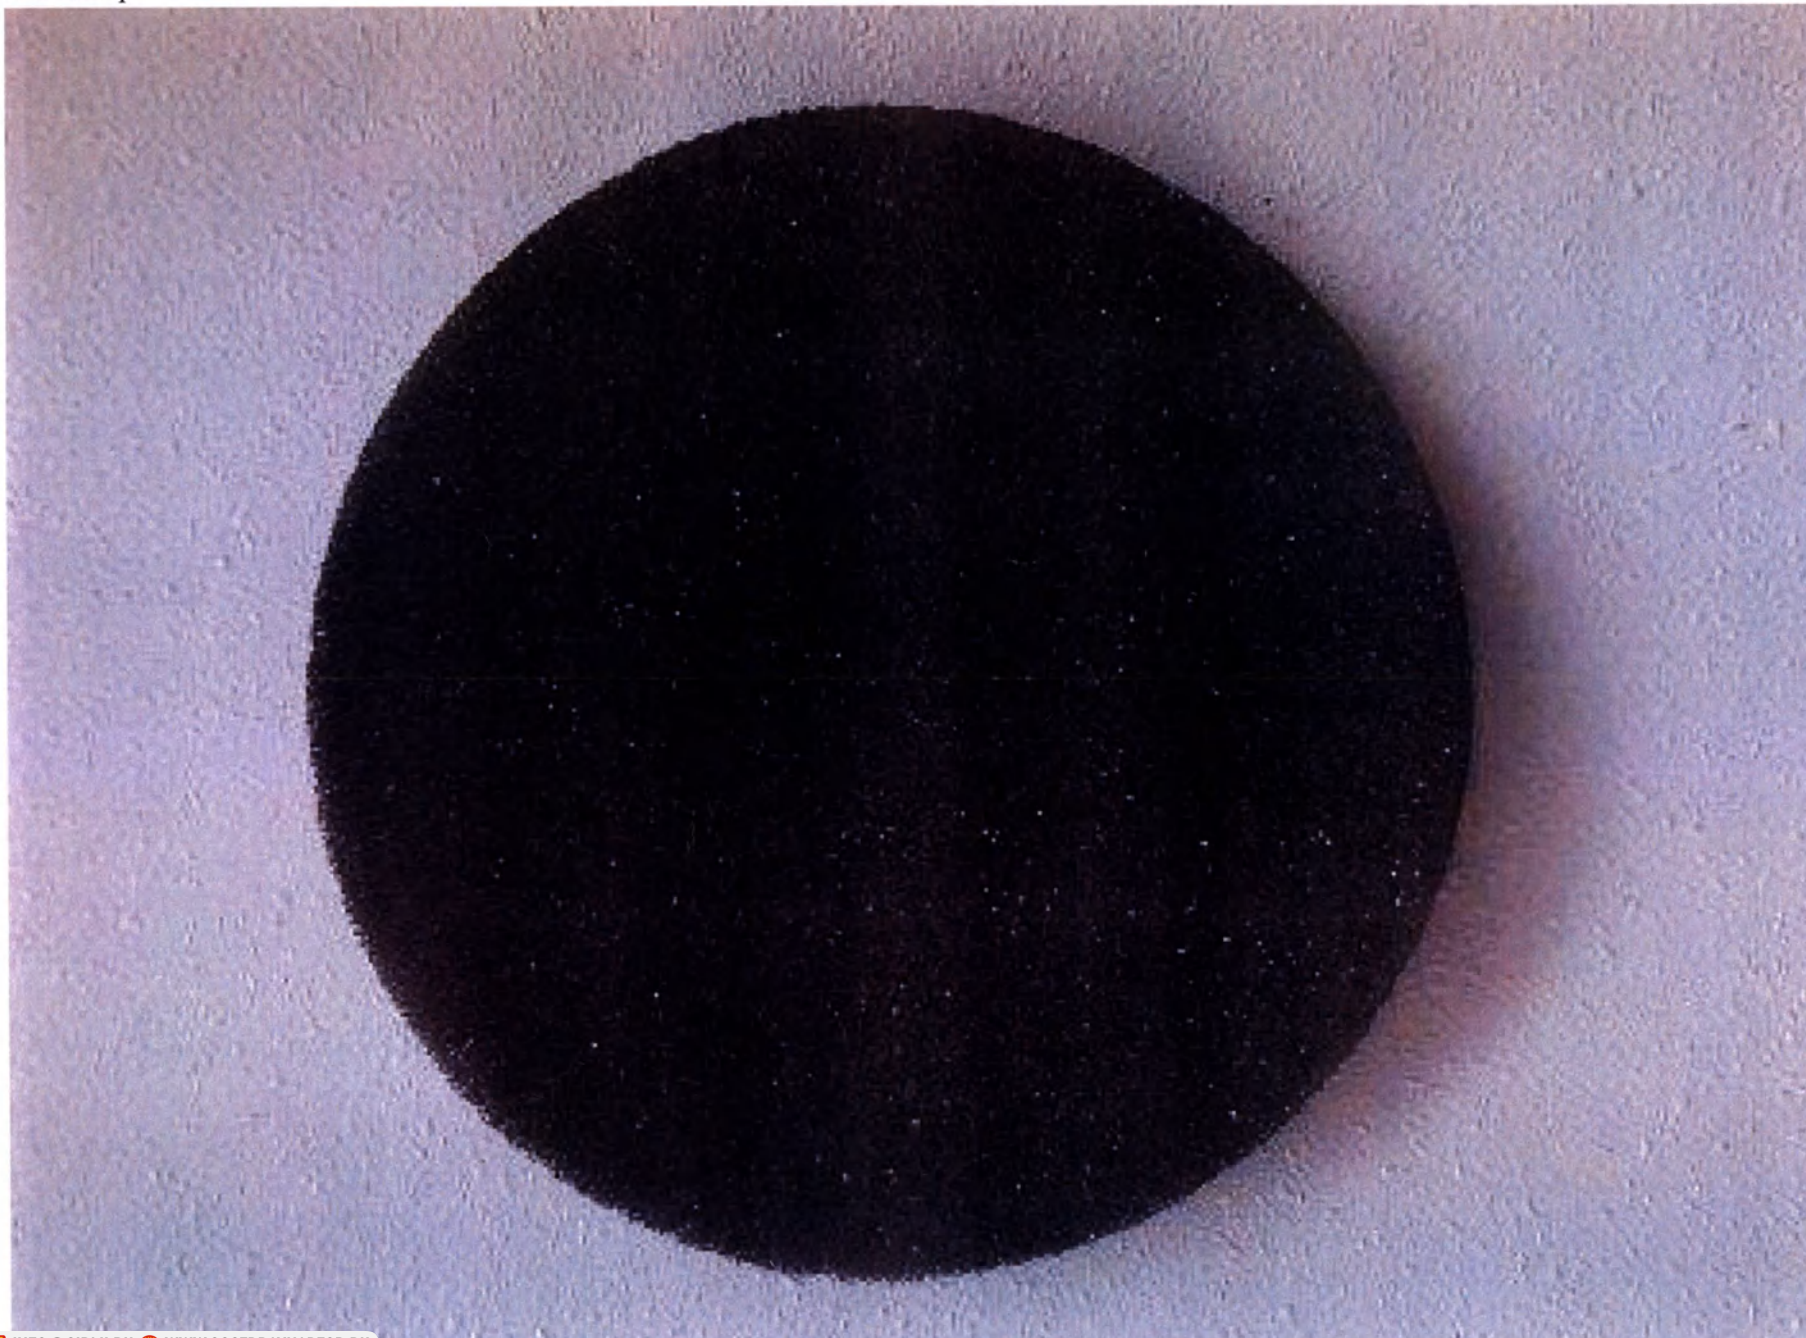



1.2.12. Мембрана клапана выдоха

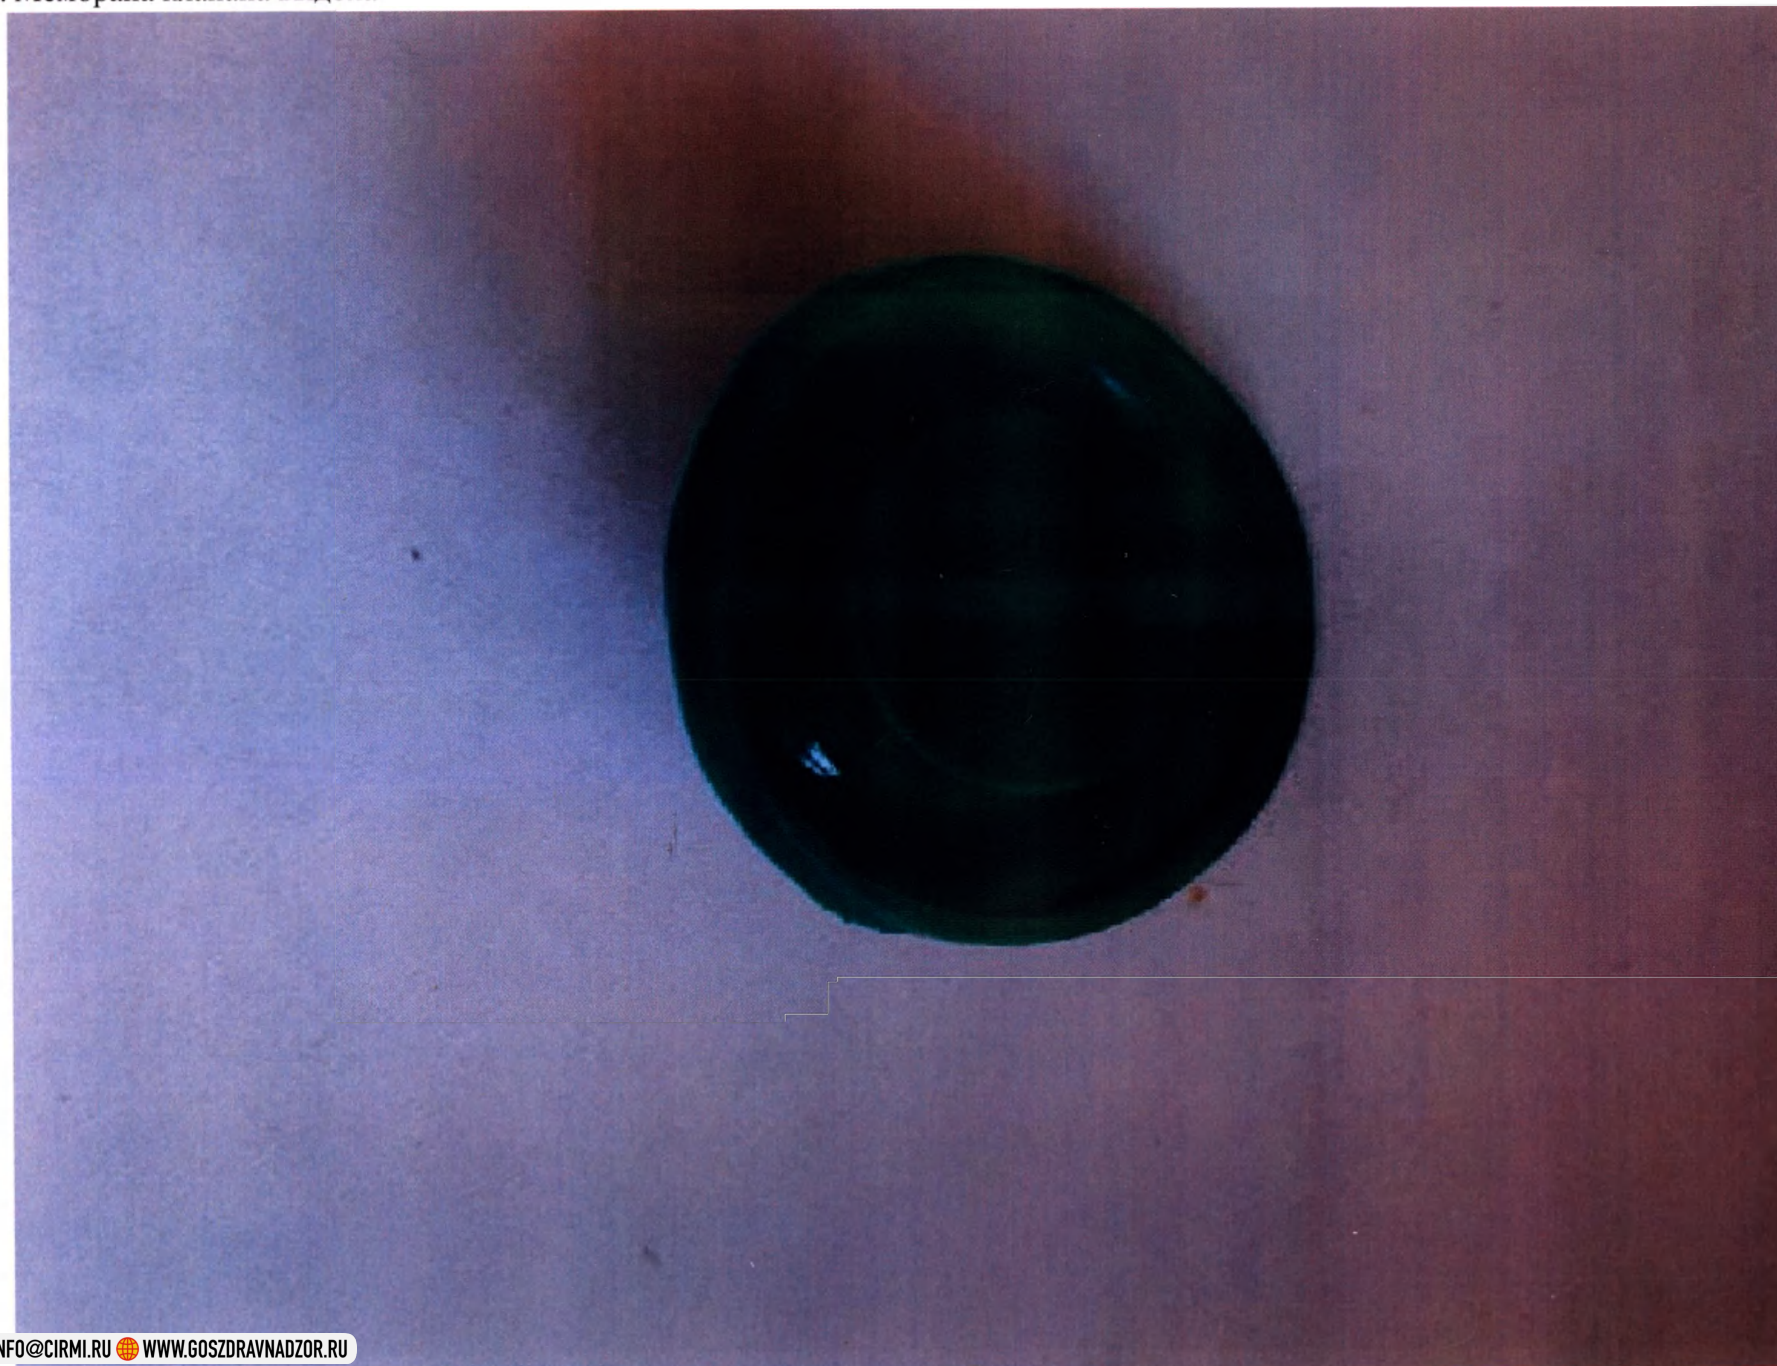


1.2.13. Панель управления




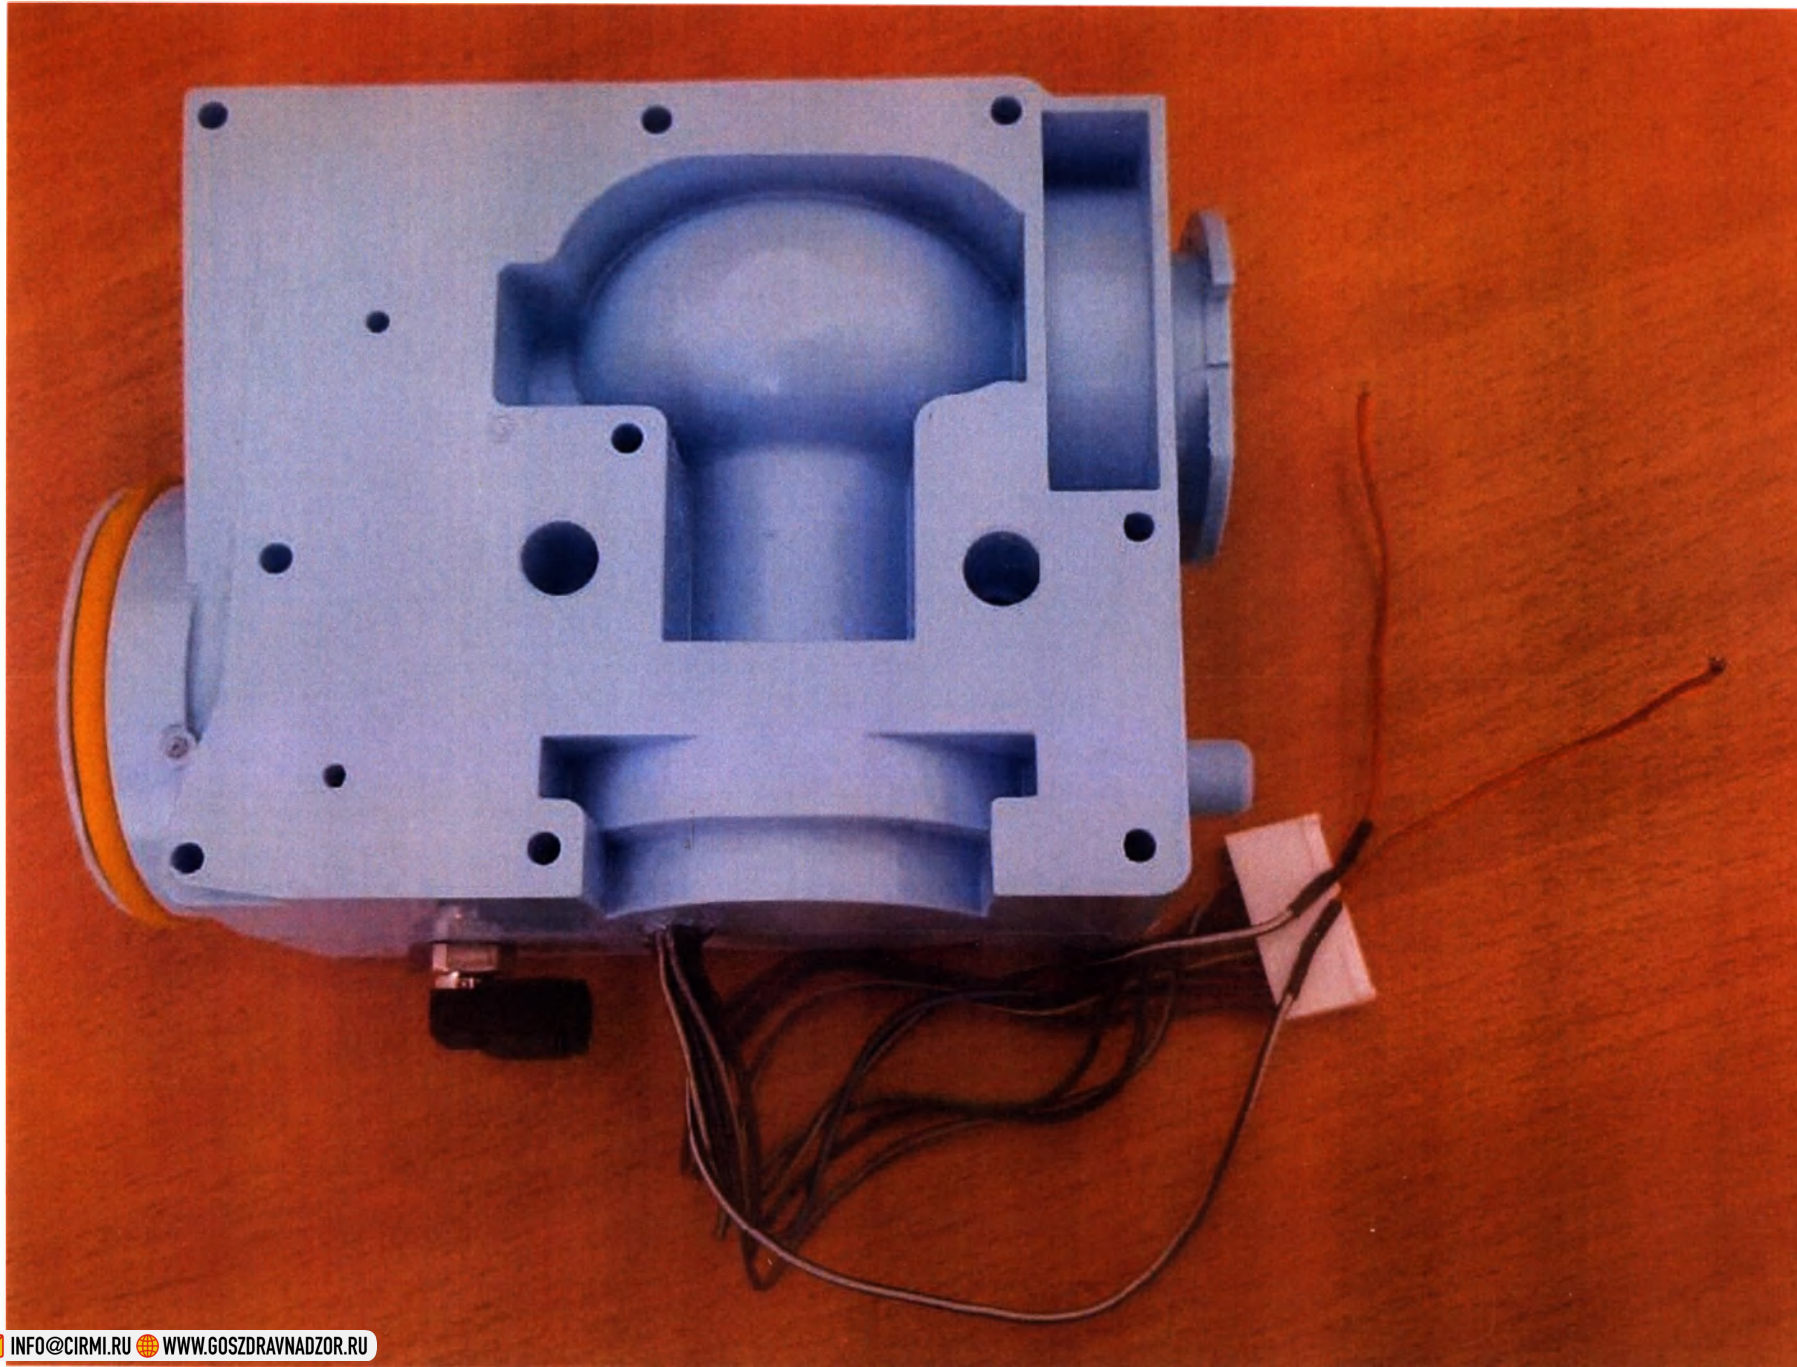

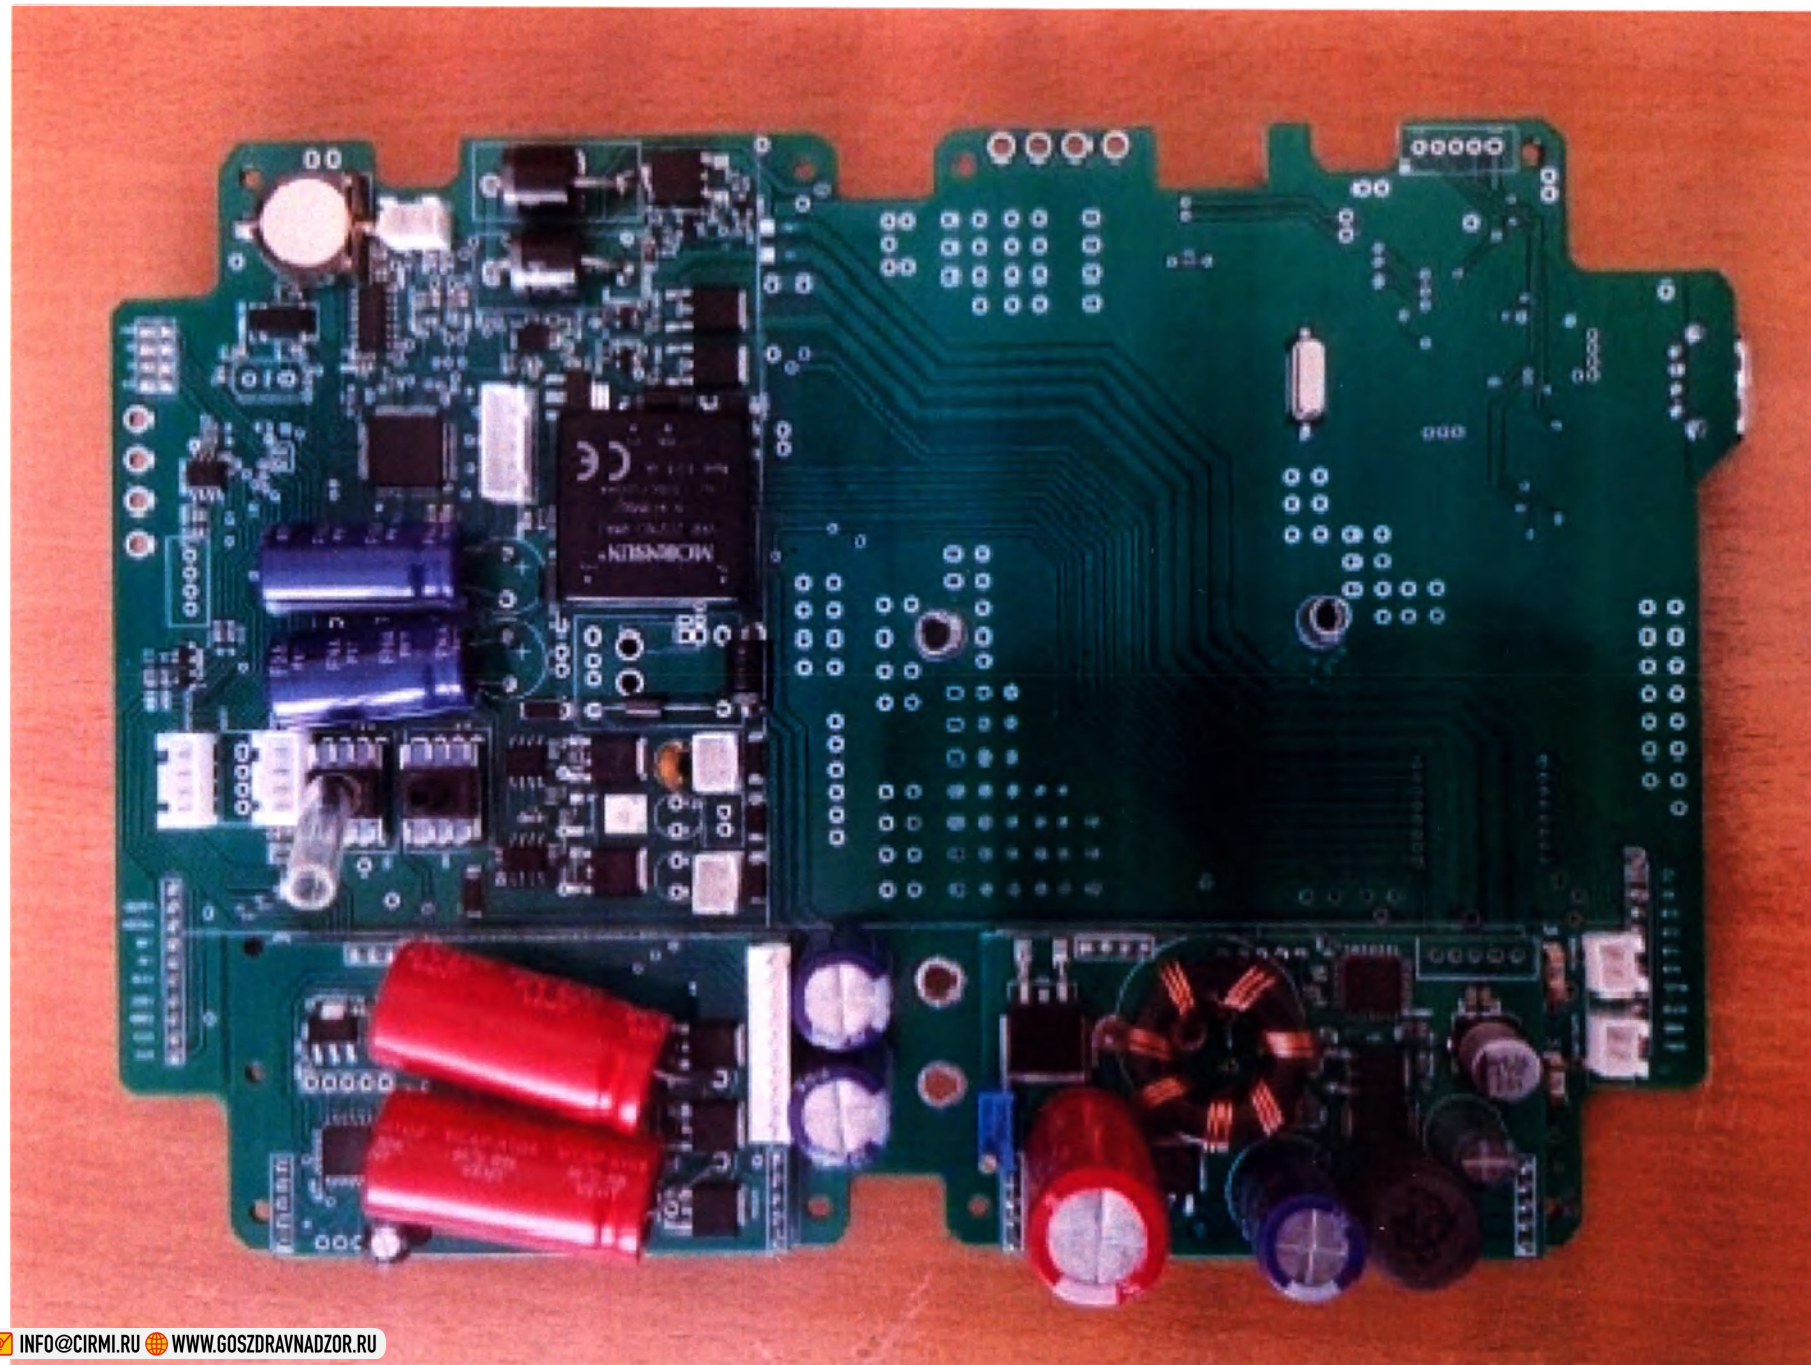


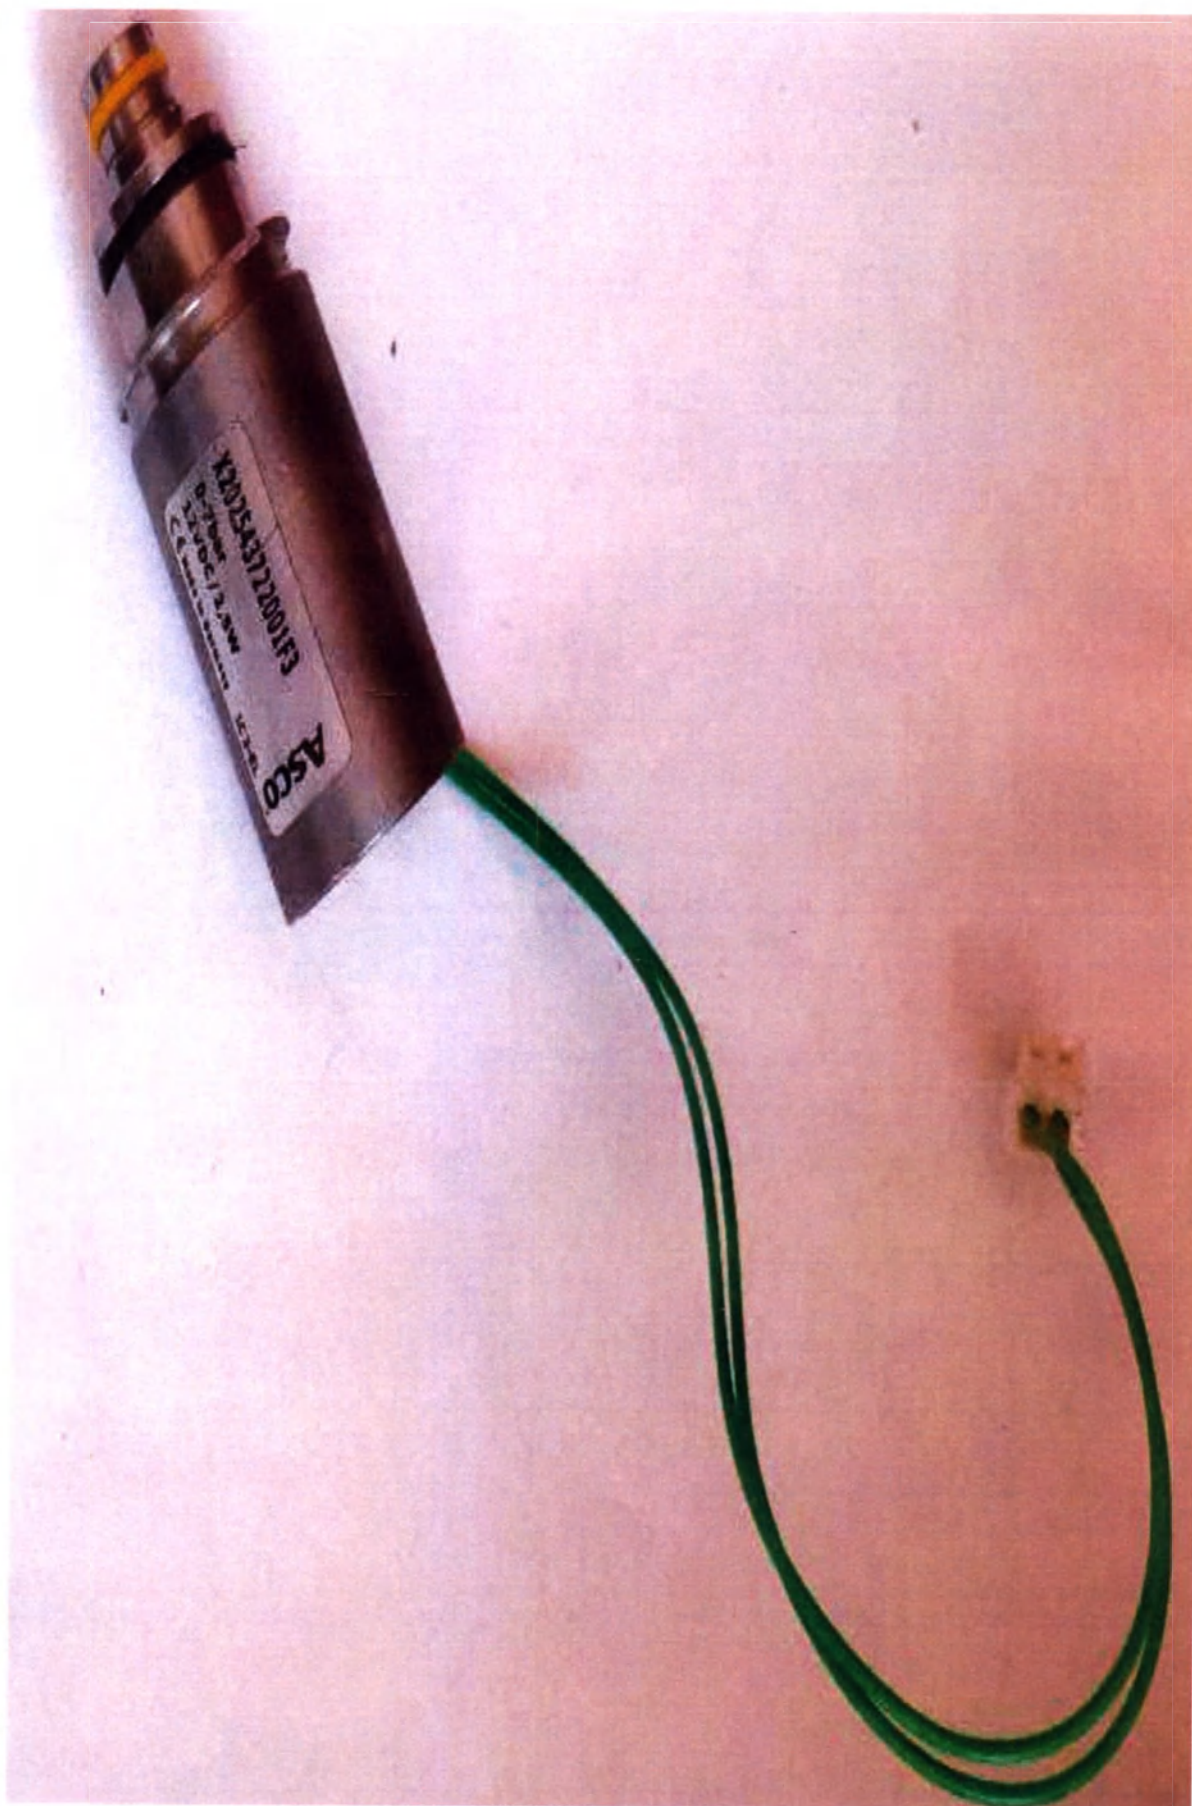


1.2.17. Регулятор давления

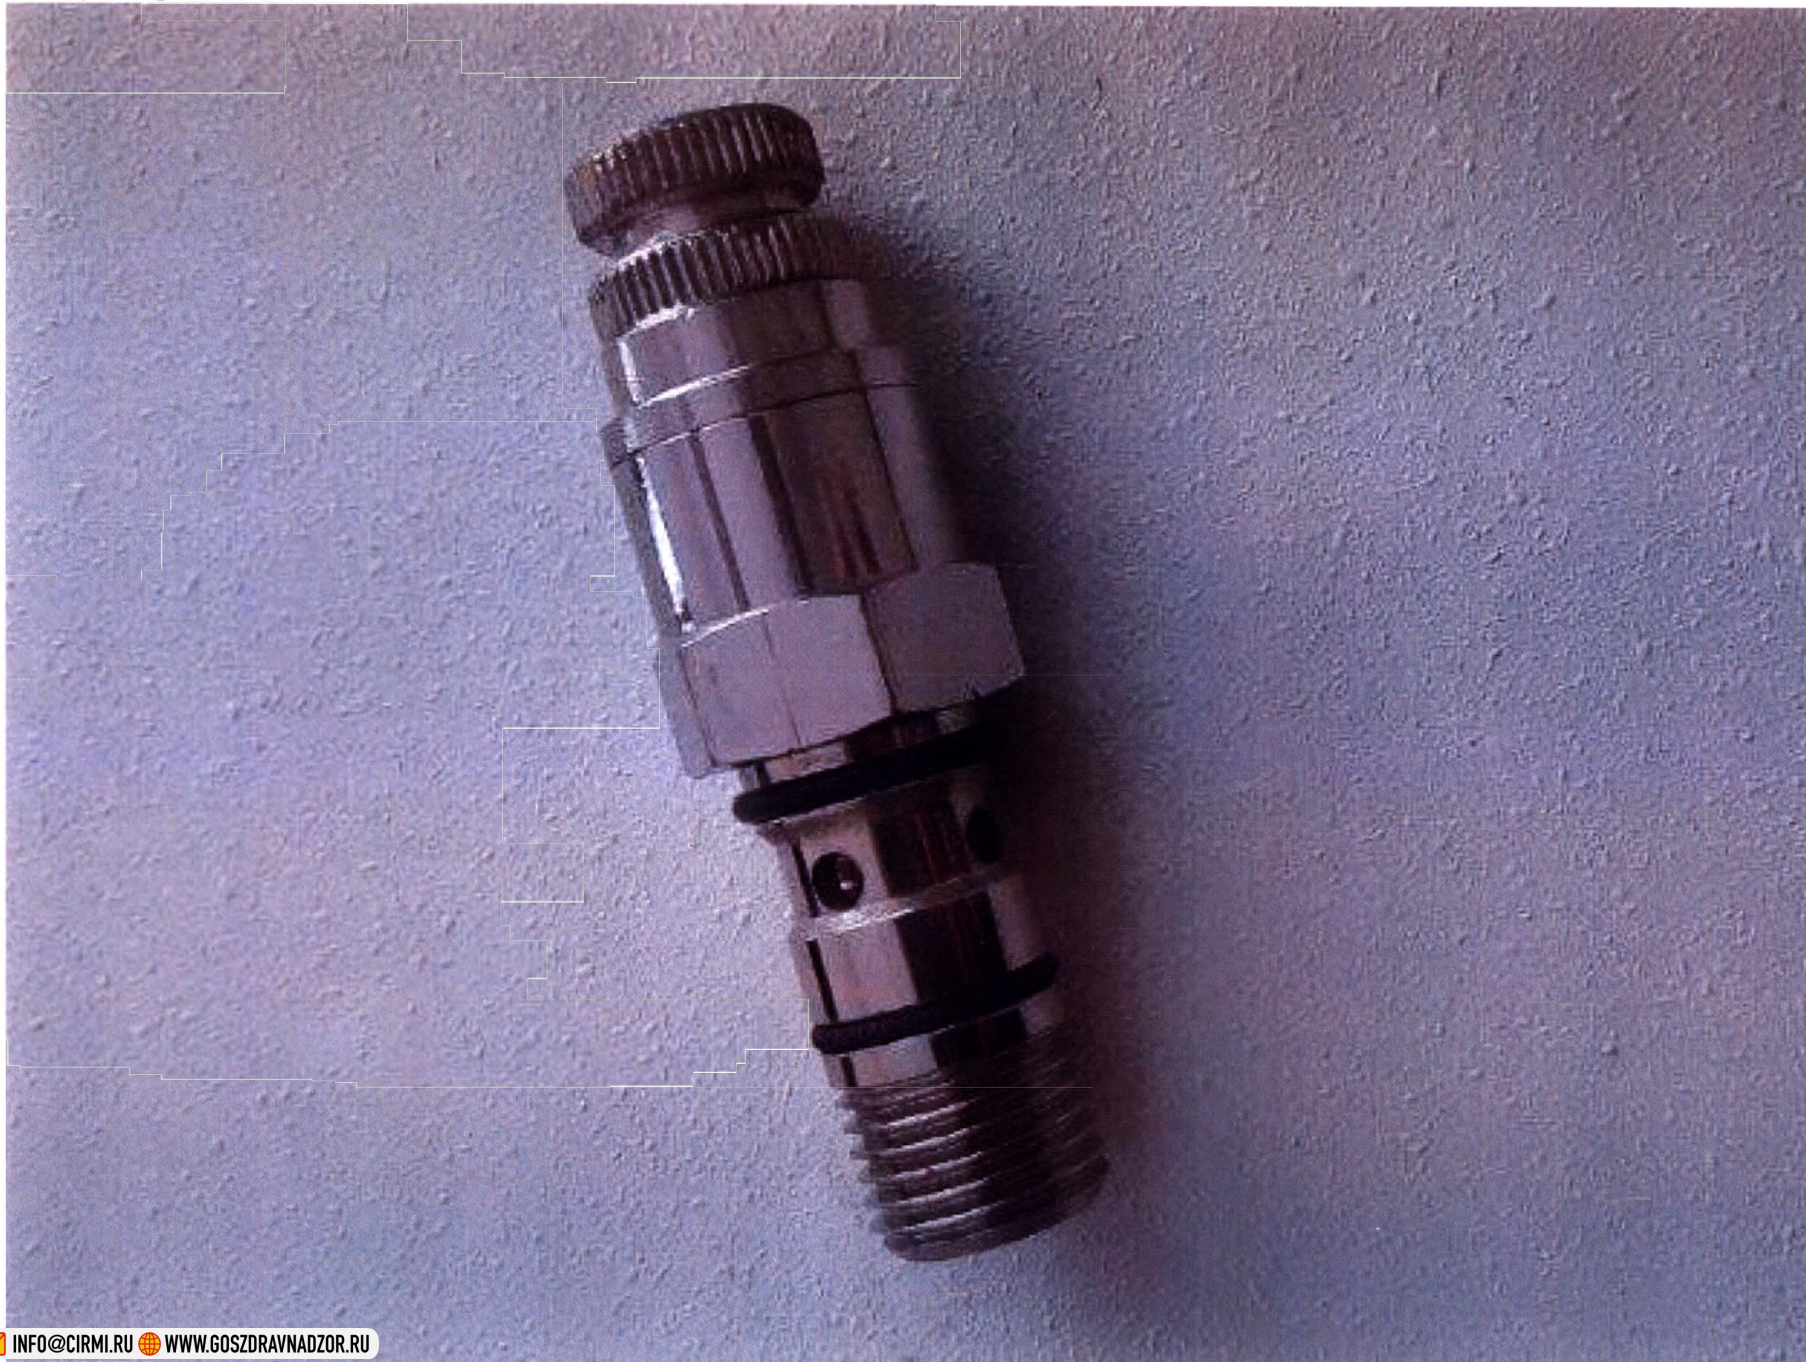

1.2.18. Клапан управления

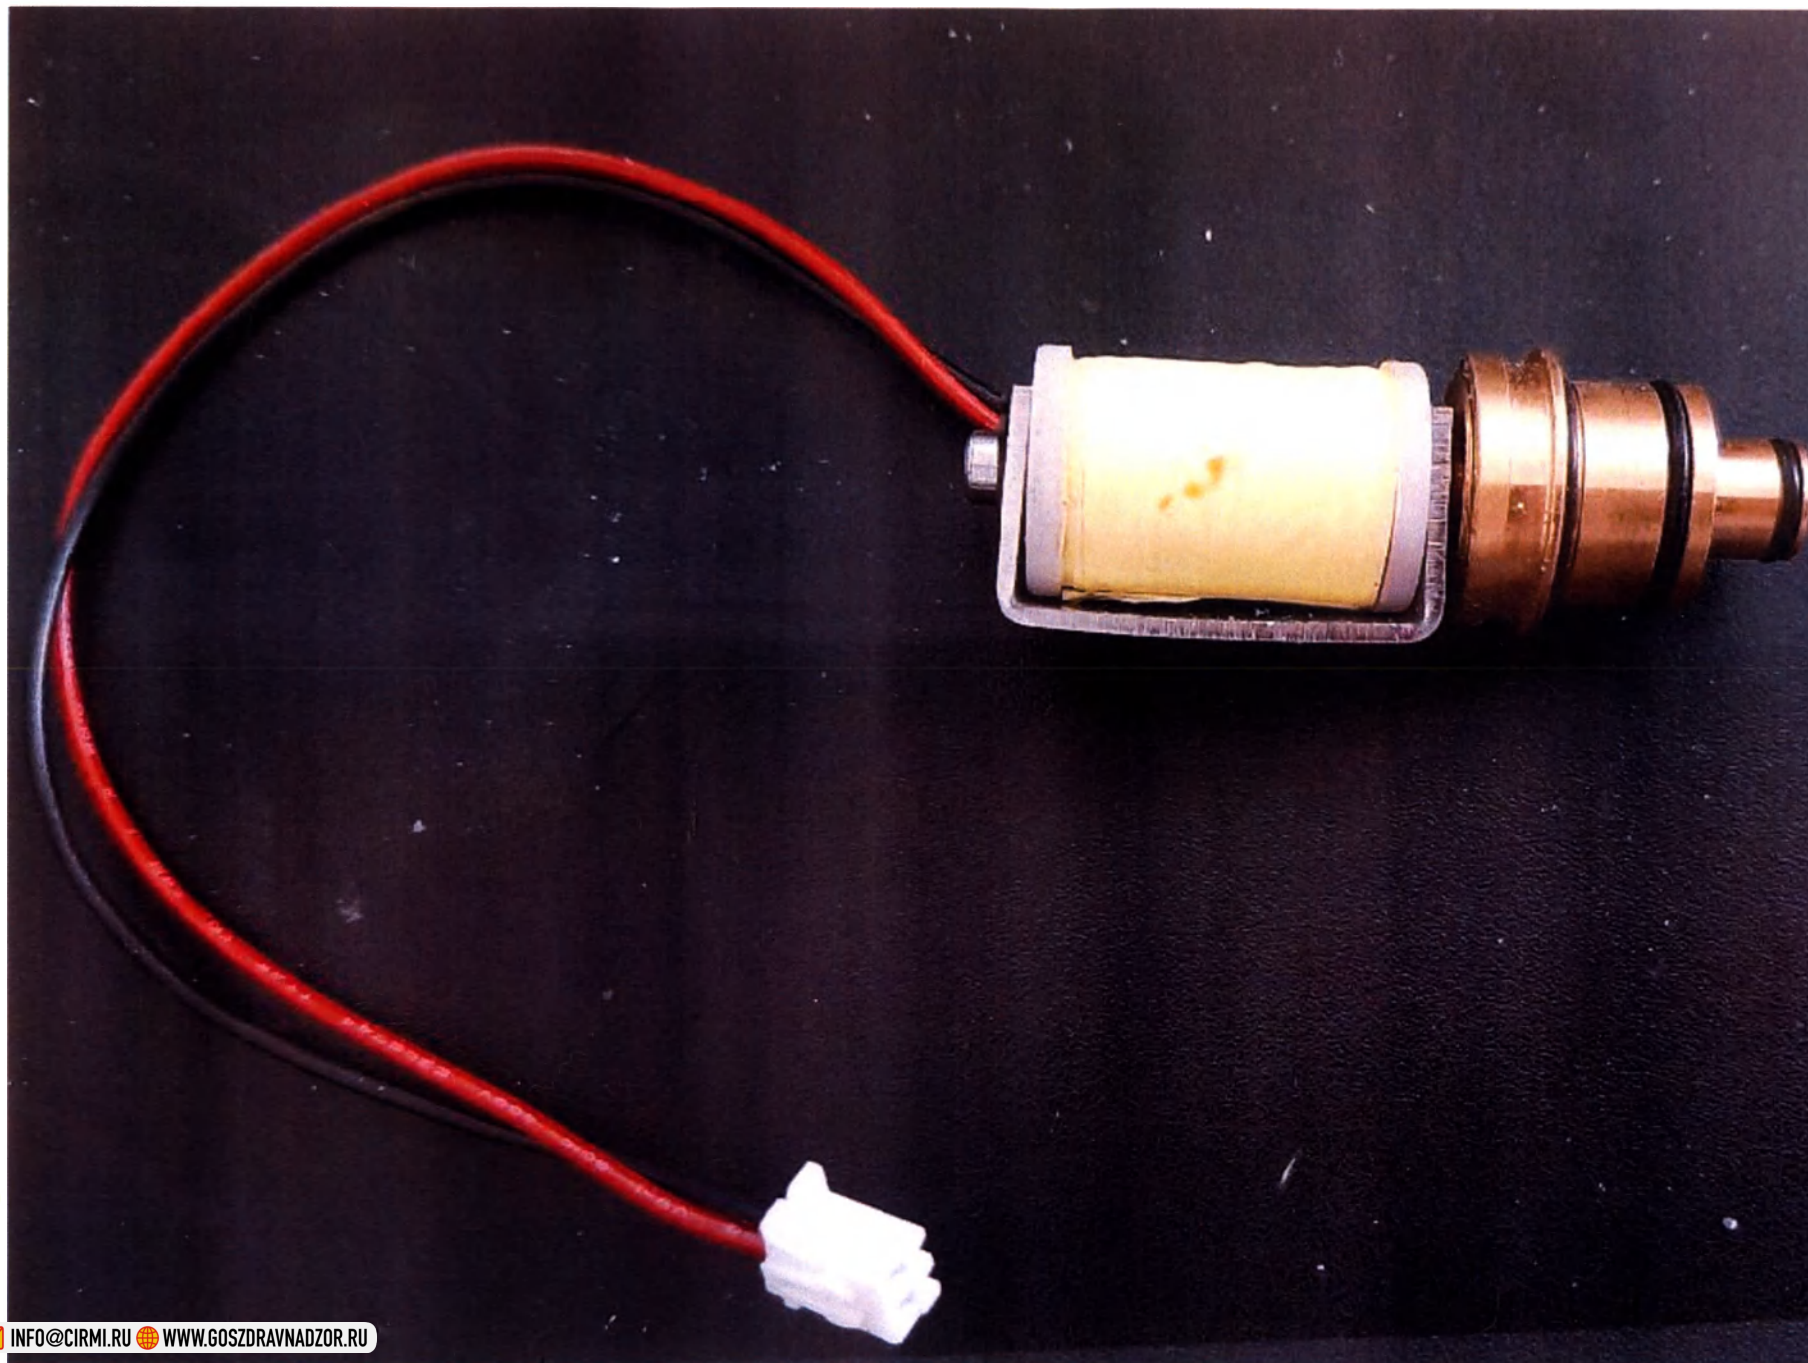


2. Фотографические изображения медицинского изделия в транспортной упаковке
2.1. Аппарат искусственной вентиляции легких портативный Oxivent

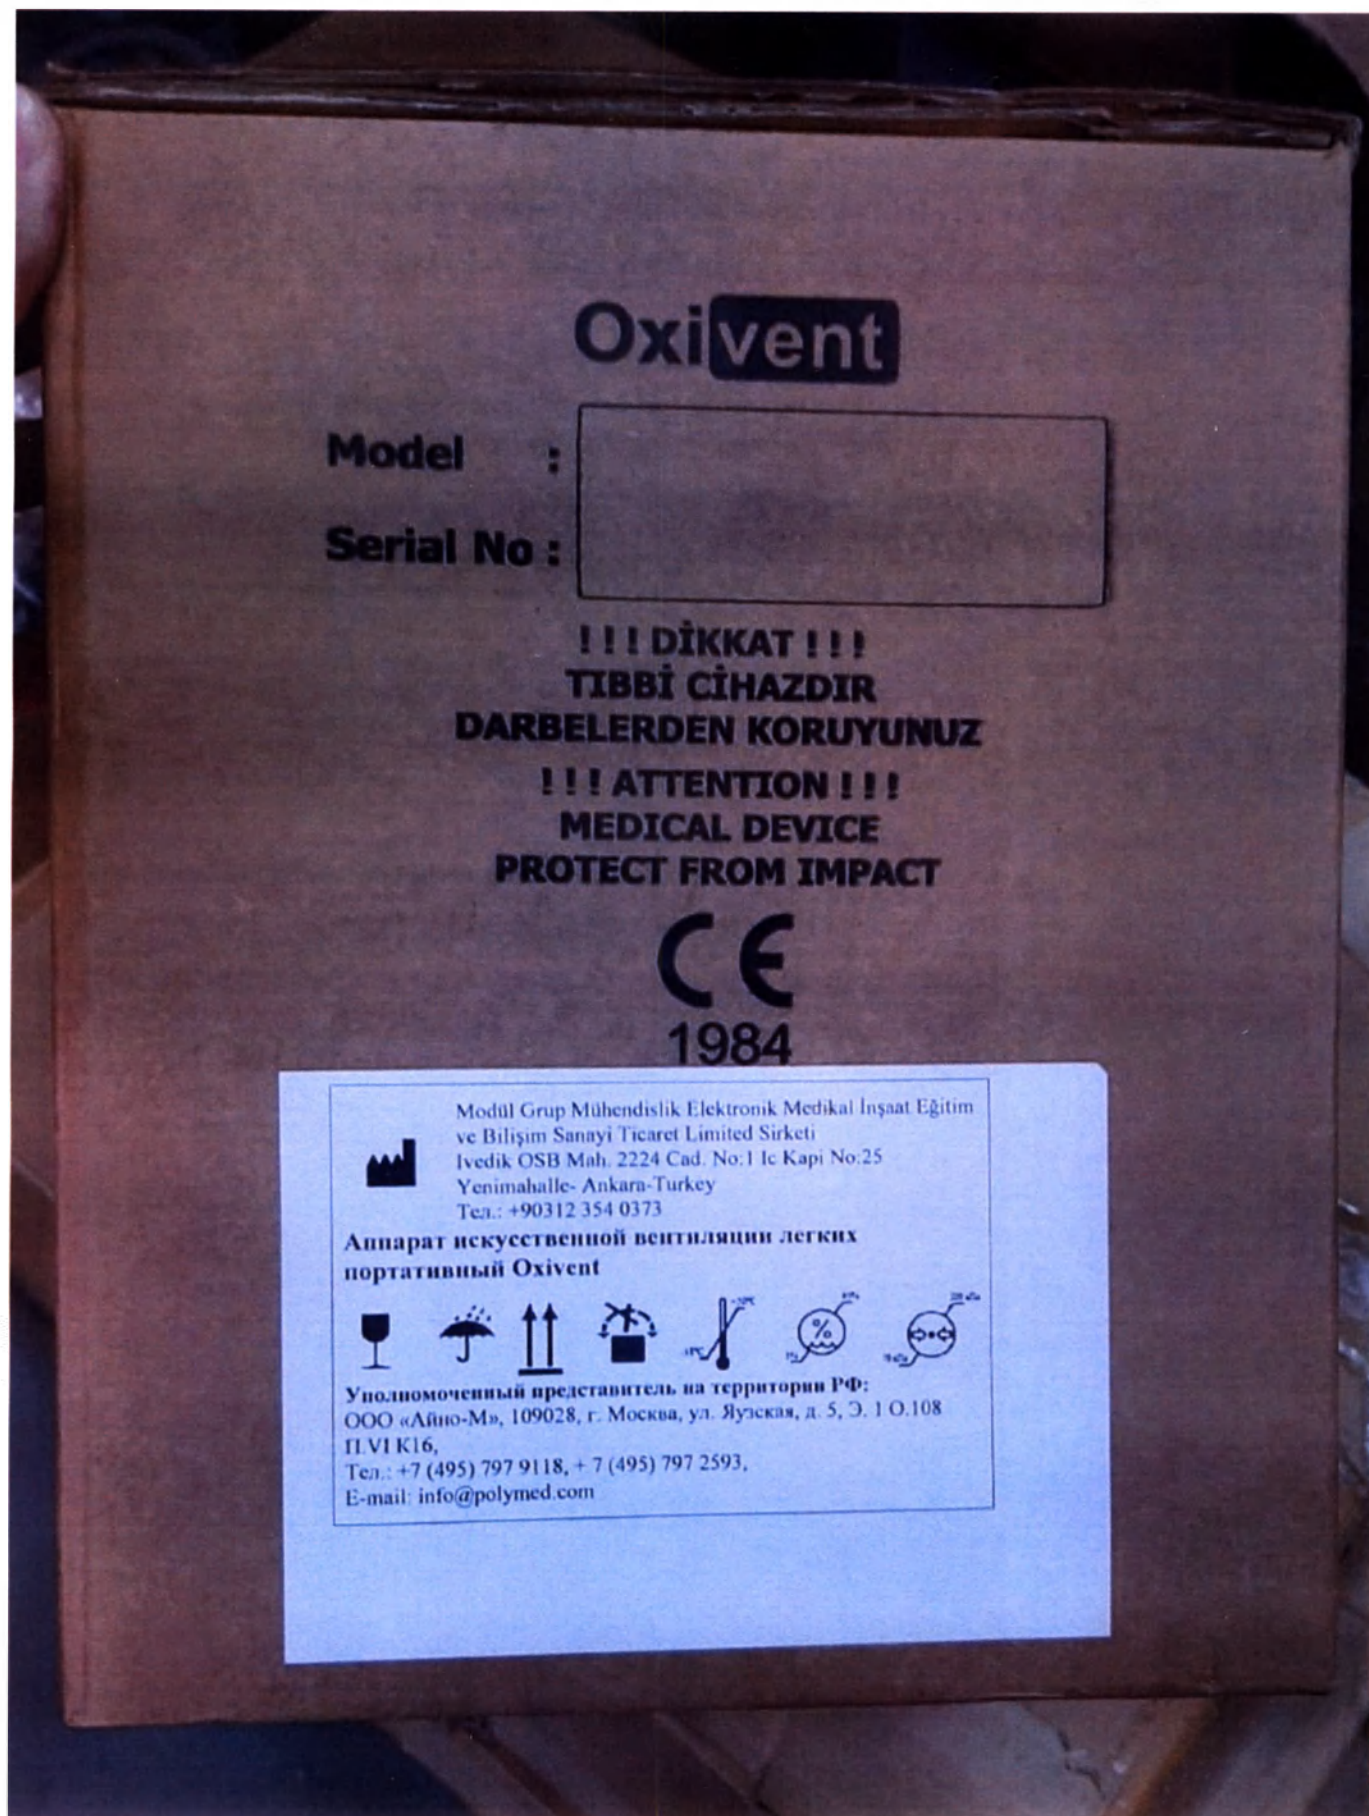

2.2. Тележка




3. Маркировка транспортной упаковки
- 3.1. Аппарат искусственной вентиляции легких портативный Oxivent

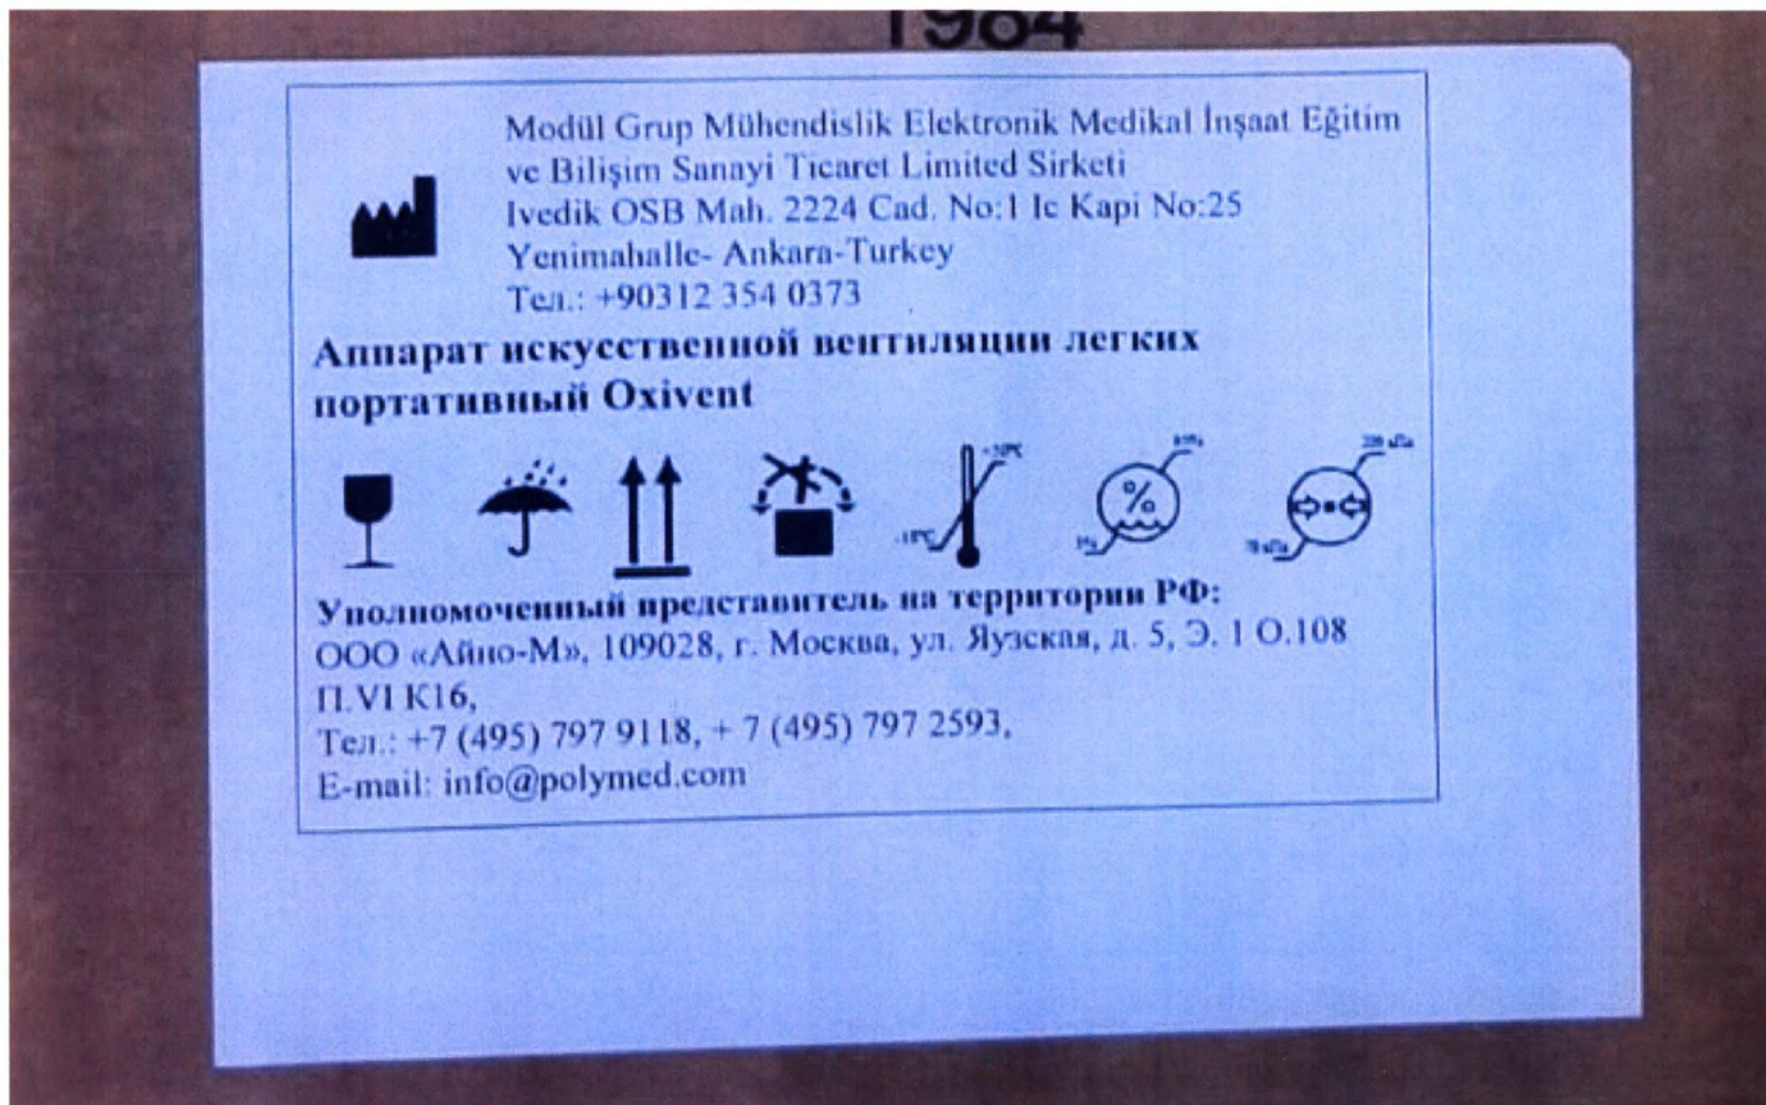



Modül Grup Mühendislik Elektronik Medikal İnşaat Eğitim
ve Bilişim Sanayi Ticaret Limited Sirketi
Ivedik OSB Mah. 2224 Cad. No:1 İç Kapi No:25
Yenimahalle- Ankara-Turkey
Тел.: +90312 354 0373

**Аппарат искусственной вентиляции легких
портативный Oxivent**



Тележка



Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «Айно-М», 109028, г. Москва, ул. Яузская, д. 5, Э. 1 О.108
П. VI K16,
Тел.: +7 (495) 797 9118, + 7 (495) 797 2593,
E-mail: info@polymed.com

В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью



50 (пятидесять) листов листа(ов)
Генеральный директор ООО «Айно-М»

Габриэлов И. Б.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Айно-М»

Габриэлов И. Б.

«21» августа 2023г



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат искусственной вентиляции легких портативный Oxivent

1. Индивидуальная маркировка

1.1. Аппарат искусственной вентиляции легких портативный Oxivent



Modül Grup Mühendislik Elektronik Medikal İnşaat Eğitim ve Bilişim
Sanayi Ticaret Limited Sirketi
Ivedik OSB Mah. 2224 Cad. No:1 İç Kapi No:25 Yenimahalle- Ankara-
Turkey
Тел.: +90312 354 0373

Аппарат искусственной вентиляции легких портативный Oxivent

РУ № _____ от _____



XX.XX.XXXX



Oxi4Plus






XXXXXX/XXXX-XXXXXX

V ~ 100-240 В

f 50-60 Гц

Преобразователь 12 В



8 680829 050336

Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Айно-М», 109028, г. Москва, ул. Яузская,
д. 5, Э. 1 О.108 П. VI К16, тел.: +7 (495) 797 9118,
+ 7 (495) 797 2593, E-mail: info@polymed.com



2. Маркировка транспортной упаковки

2.1. Аппарат искусственной вентиляции легких портативный Oxivent



Modül Grup Mühendislik Elektronik Medikal İnşaat Eğitim ve Bilişim Sanayi Ticaret Limited Sirketi
Ivedik OSB Mah. 2224 Cad. No:1 İç Kapi No:25 Yenimahalle- Ankara-Turkey
Тел.: +90312 354 0373

Аппарат искусственной вентиляции легких портативный Oxivent



Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Айно-М», 109028, г. Москва, ул. Яузская, д. 5, Э. 1 О.108 П. VI К16,
Тел.: +7 (495) 797 9118, +7 (495) 797 2593,
E-mail: info@polymed.com



2.2. Тележка



Modül Grup Mühendislik Elektronik Medikal İnşaat Eğitim ve Bilişim Sanayi Ticaret Limited Sirketi
Ivedik OSB Mah. 2224 Cad. No:1 İç Kapi No:25 Yenimahalle- Ankara-Turkey
Тел.: +90312 354 0373

Аппарат искусственной вентиляции легких портативный Oxivent

Тележка



Уполномоченный представитель на территории РФ:

ООО «Айно-М», 109028, г. Москва, ул. Яузская, д. 5, Э. 1 О.108 П. VI К16,
Тел.: +7 (495) 797 9118, +7 (495) 797 2593,
E-mail: info@polymed.com



В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

3 (три) листа(ов)
Генеральный директор ООО «Айно-М»

Габриэлов И. Б.
Габриэлов И. Б.