


Фотографические изображения

Реагенты в кассете для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в образцах плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HIV-1)


Реагенты в кассете для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в образцах плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HIV-1)



Реагенты в кассете для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в образцах плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HIV-1)

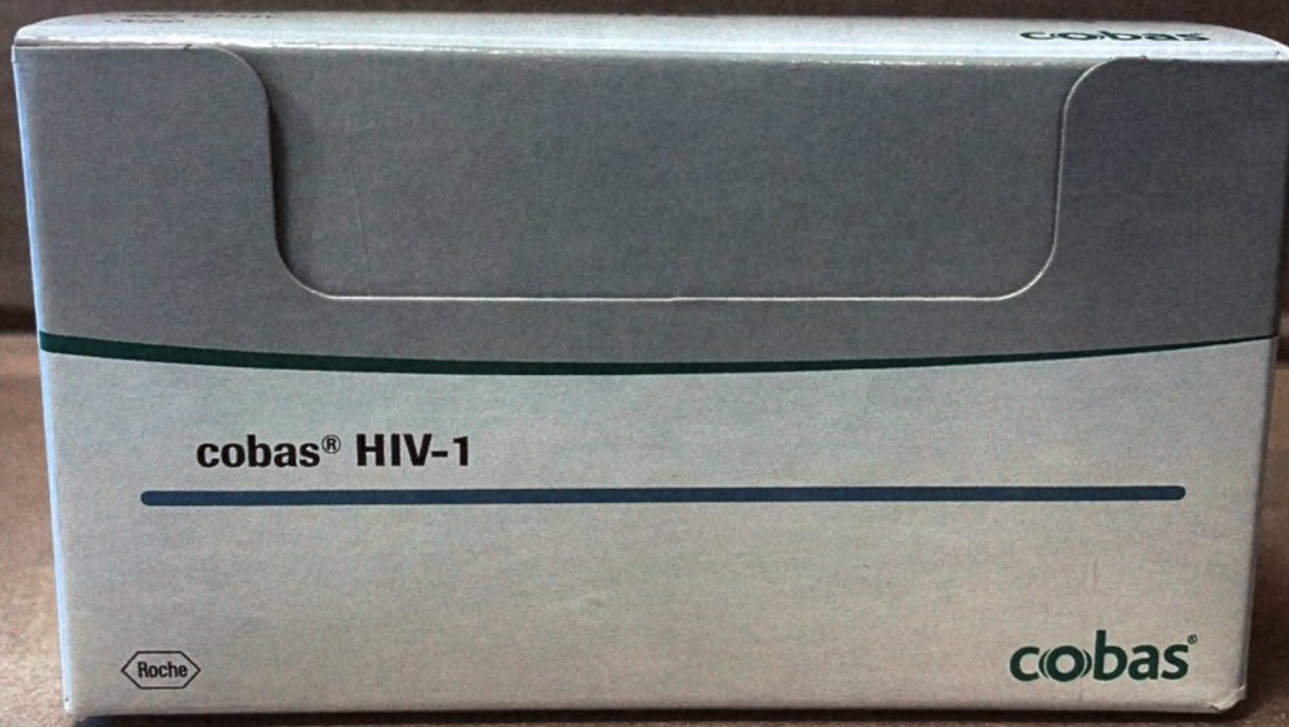

Реагенты в кассете для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в образцах плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HIV-1)

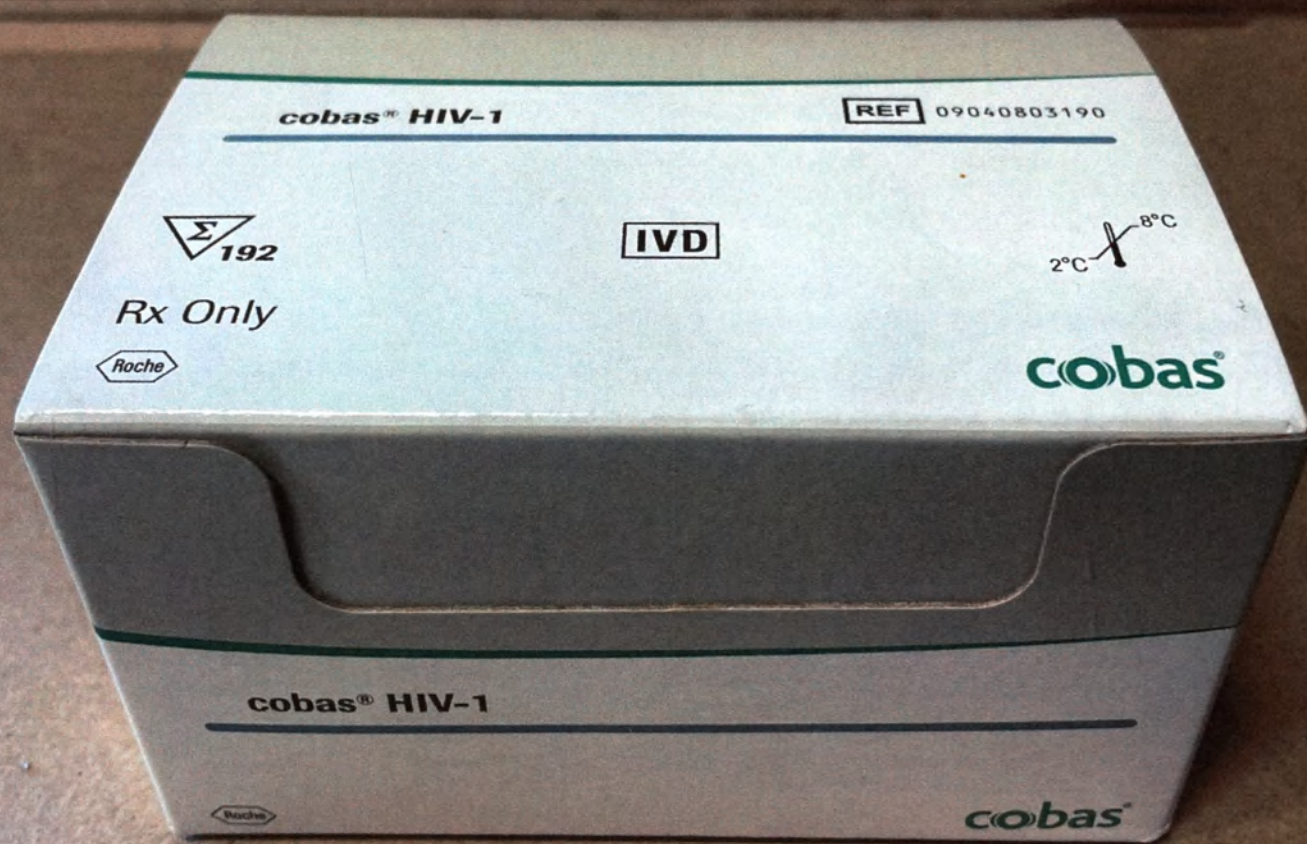

Реагенты в кассете для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в образцах плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HIV-1)



Реагенты в кассете для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в образцах плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HIV-1)

CONTENT

HIV-1 Cassette	x 1
PASE	22.3 mL
RNA-QS	21.2 mL
EB	21.2 mL
MMX-R1	7.5 mL
HIV-1 MMX-R2	9.7 mL

For USA*

HIV-1 Cassette x 1

PASE 22.3 mL

(Proteinase Solution)

Tris buffer, < 0.05% EDTA, Calcium chloride, Calcium acetate,
8% (w/v) Proteinase

RNA-QS 21.2 mL

(RNA Quantitation Standard)

Tris buffer, < 0.05% EDTA, < 0.001% Non-HIV related armored RNA
construct containing primer and probe specific sequence regions
(non-infectious RNA in MS2 bacteriophage), < 0.1% Sodium azide

EB 21.2 mL

(Elution Buffer)

Tris buffer, 0.2% Methyl-4 hydroxybenzoate

MMX-R1 7.5 mL

(Master Mix Reagent 1)

Manganese acetate, Potassium hydroxide, < 0.1% Sodium azide

HIV-1 MMX-R2 9.7 mL

(HIV-1 Master Mix Reagent 2)

Tricine buffer, potassium acetate, 18% Dimethyl sulfoxide, Glycerol,
< 0.1% Tween 20, EDTA, < 0.12% dATP, dCTP, dGTP, dUTPs,
< 0.01% Upstream and downstream HIV primers, < 0.01%
Quantitation Standard forward and reverse primers, < 0.01%
Fluorescent-labeled oligonucleotide probes specific for HIV and the
HIV Quantitation Standard, < 0.01% Oligonucleotide aptamer,
< 0.1% Z05D DNA polymerase, < 0.10% AmpErase
(uracil-N-glycosylase) enzyme (microbial), < 0.1% Sodium azide


*Composition information required for US only.

For USA:

cobas® HIV-1 for use on the **cobas® 6800/8800** Systems is an *in vitro* nucleic acid amplification test for the quantitation of HIV-1 in EDTA plasma of HIV-1-infected individuals. **cobas® HIV-1** is not intended for use as a screening test for the presence of HIV-1 in donated blood or plasma or as a diagnostic test to confirm the presence of HIV-1 infection.

Refer to the product specific Instructions For Use for detailed information regarding hazards.

Реагенты в кассете для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в образцах плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HIV-1)

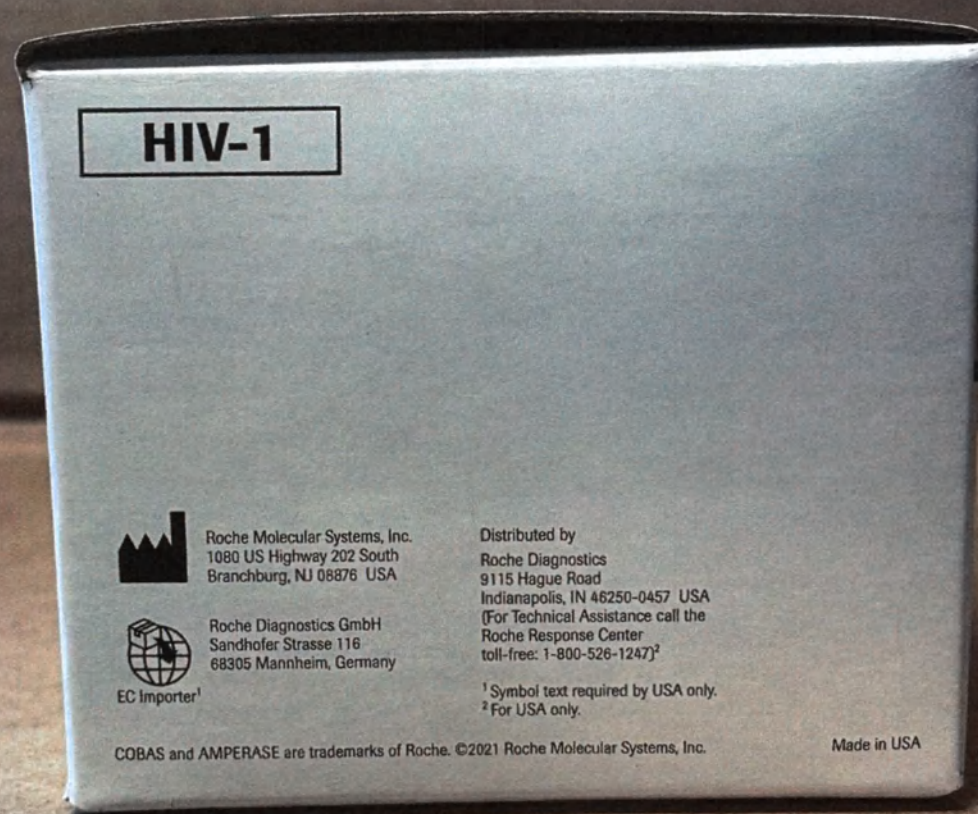

Реагенты в кассете для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в образцах плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HIV-1)



H334, H360, H402

Реагенты в кассете для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в образцах плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HIV-1)

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/16560 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Molecular Systems, Inc», 1080 US Highway 202 South, Branchburg, NJ, 08876, United States

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше).


Кат. номер 09040803190

Ссылка для получения «Инструкции по использованию» _____


реагенты в кассете для количественного определения РНК вируса
иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в образцах плазмы на системе




Реагенты в кассете для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в образцах плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HIV-1)

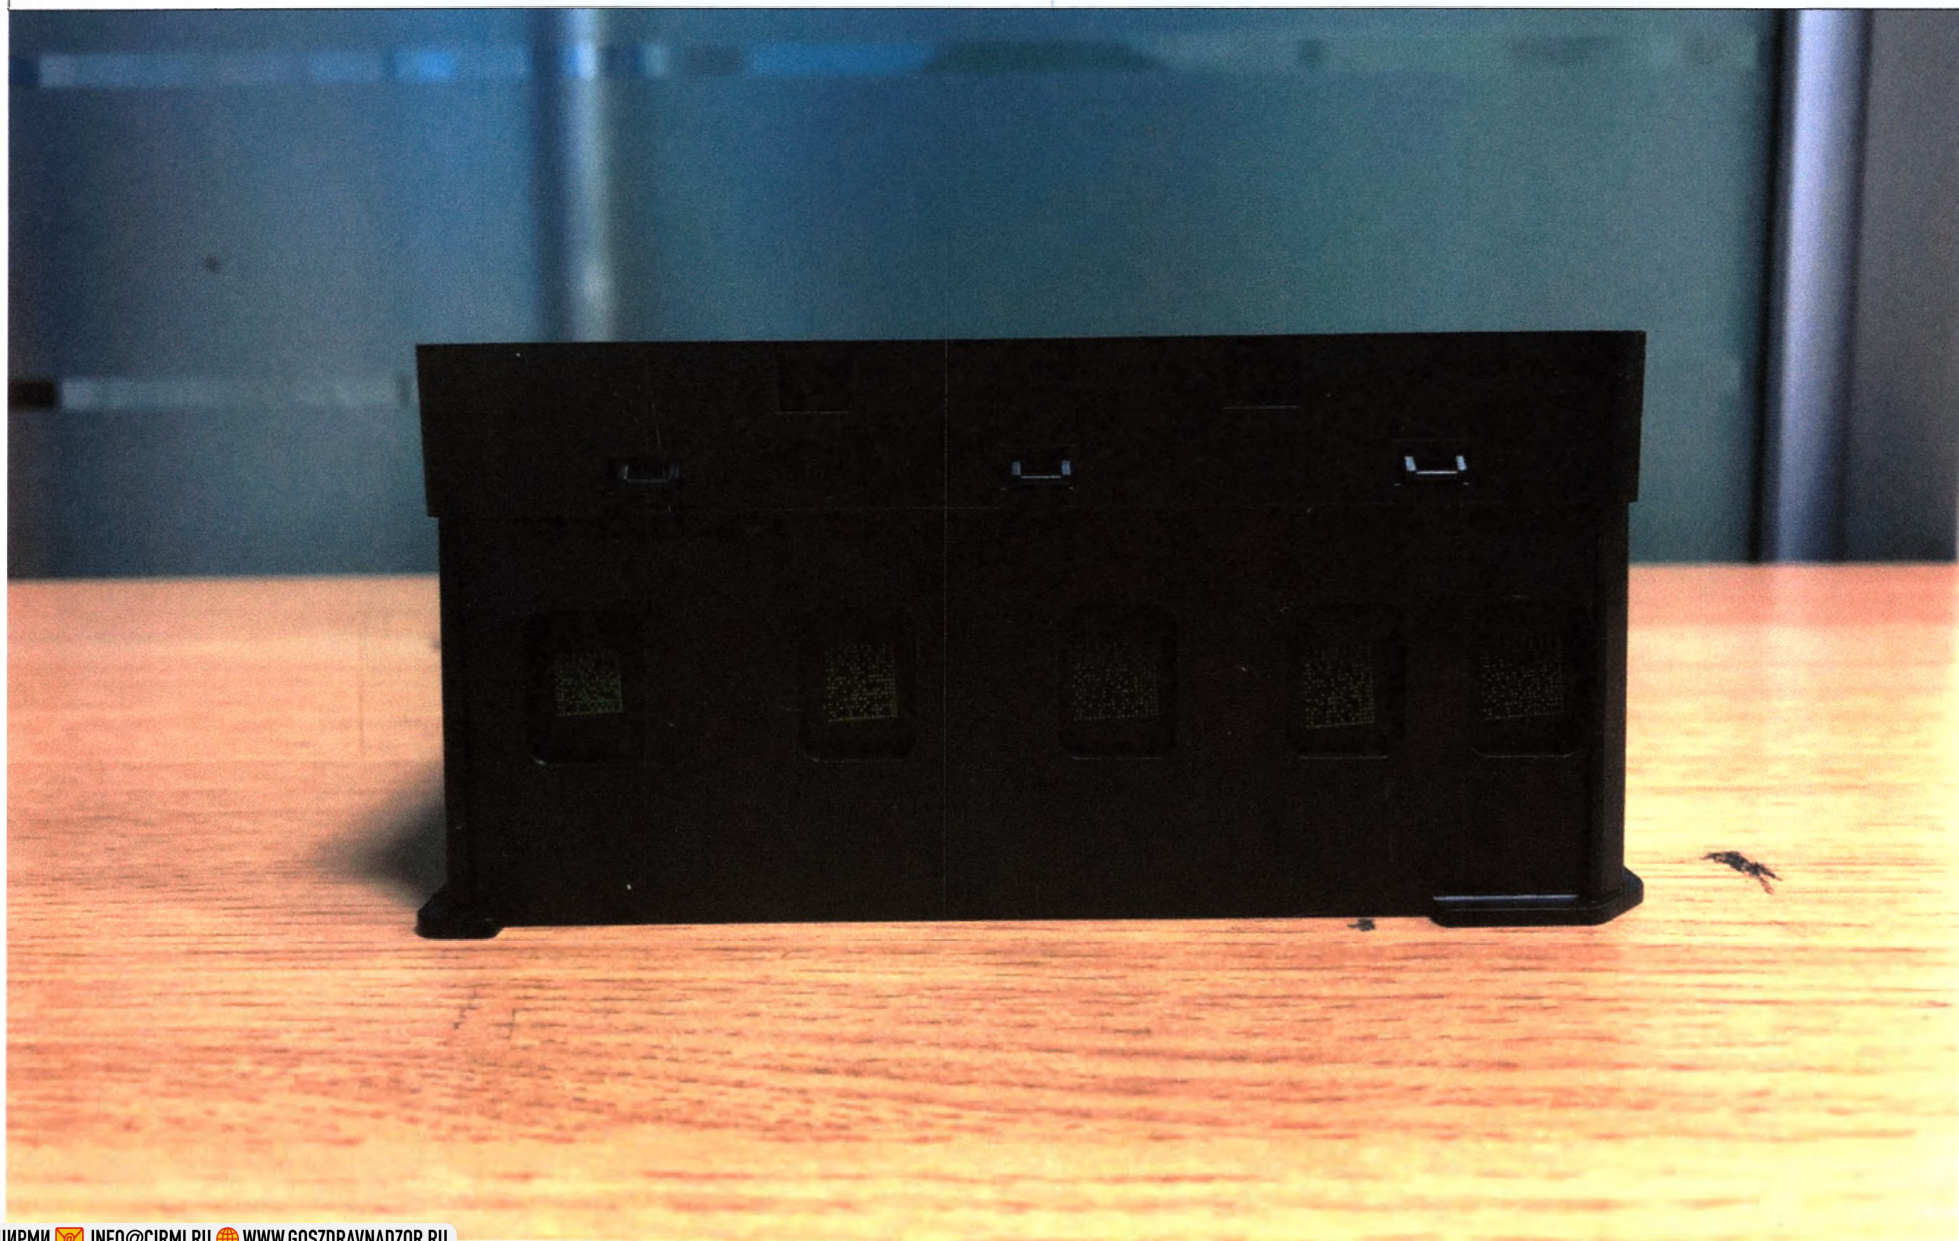

Реагенты в кассете для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в образцах плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HIV-1)

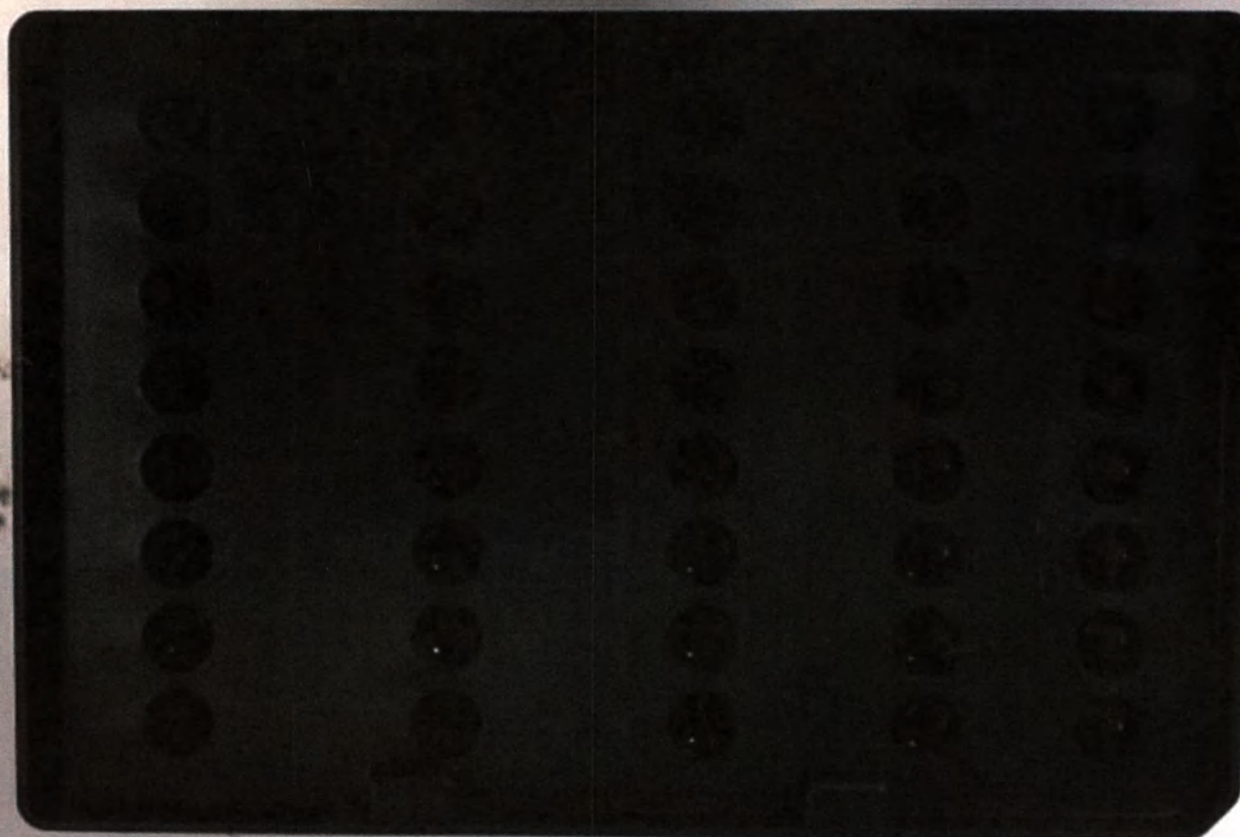

Реагенты в кассете для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) в образцах плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HIV-1)

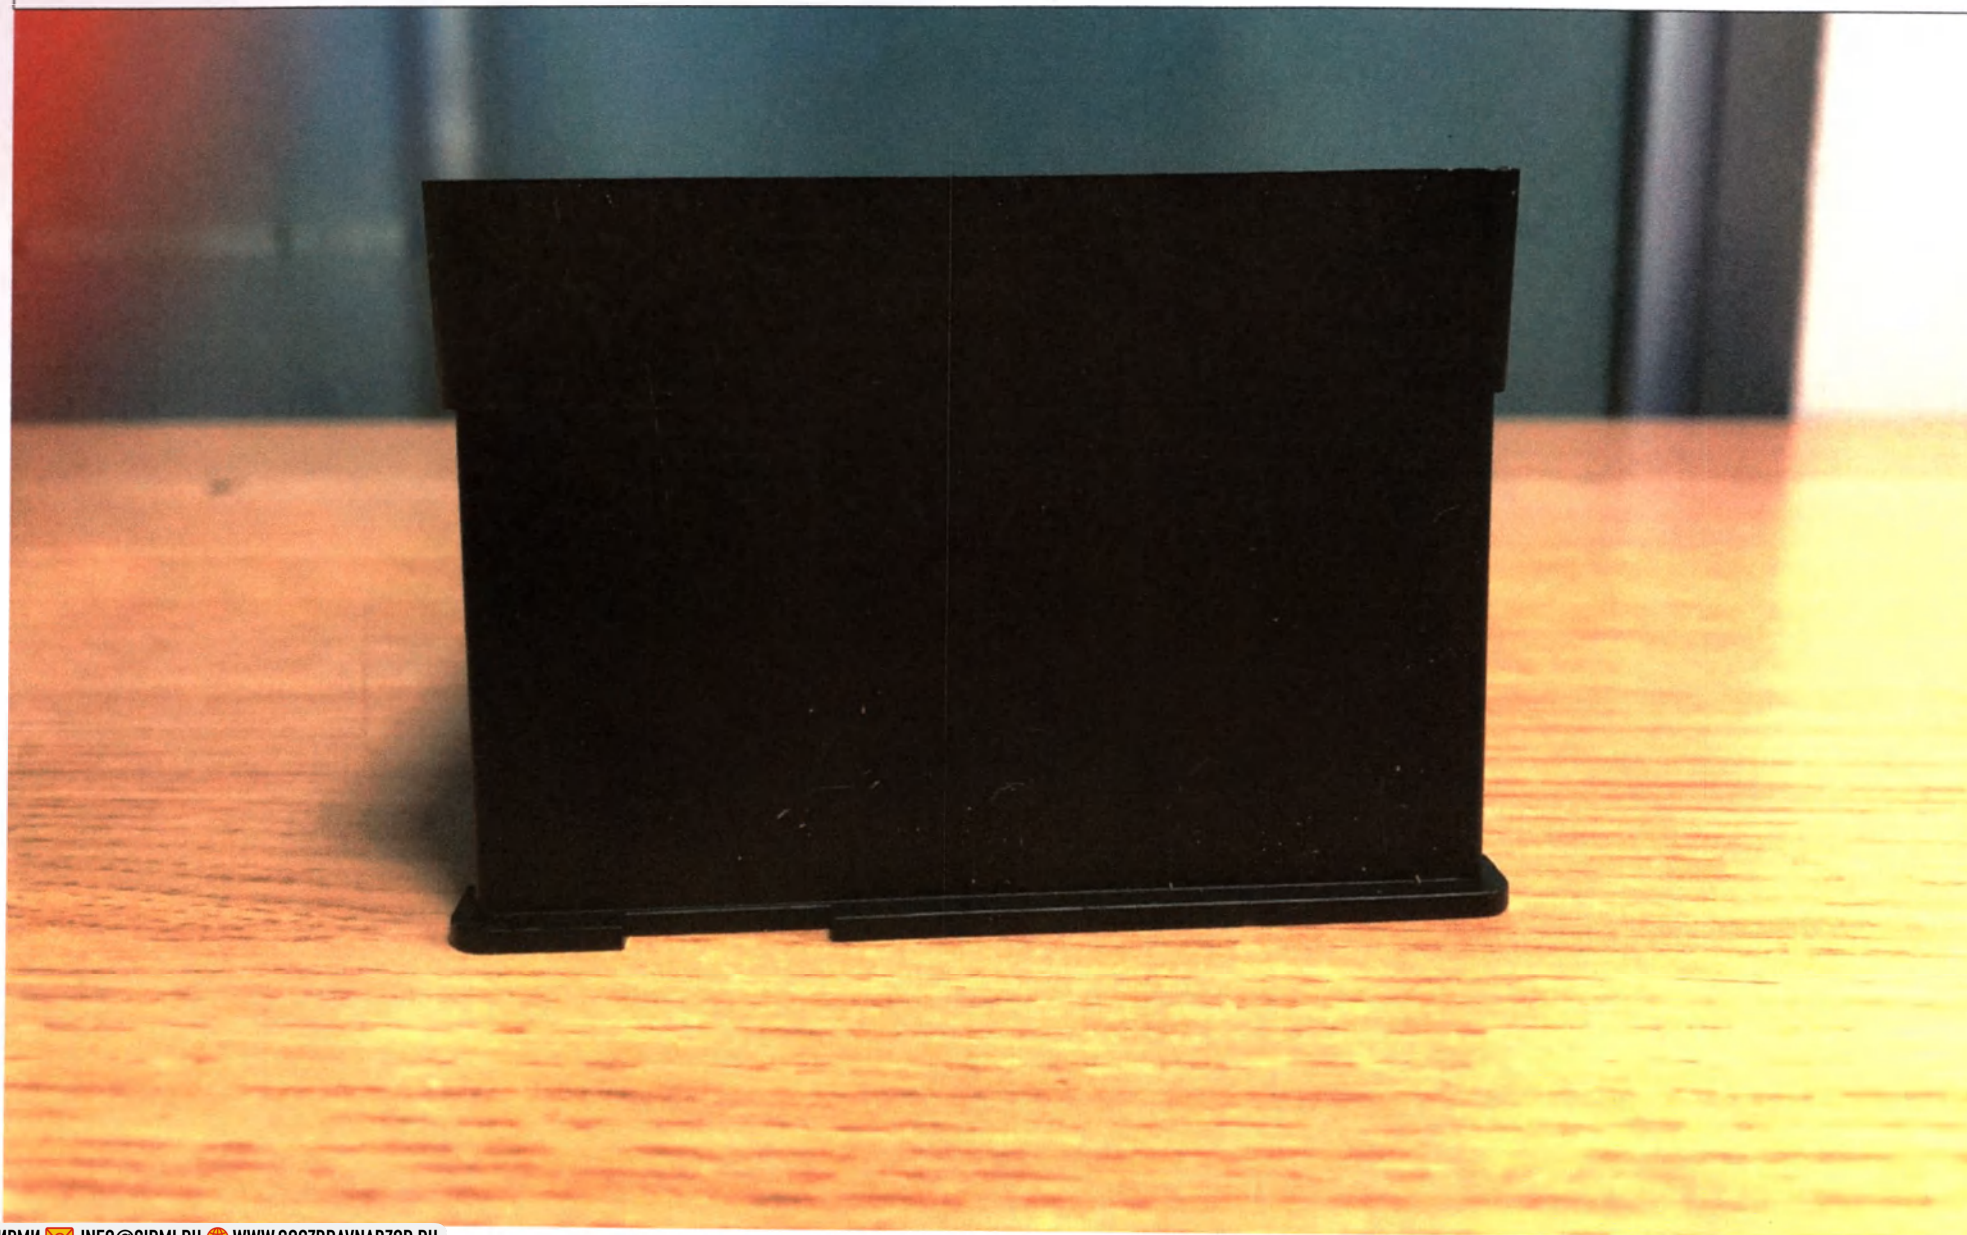

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
12 листа (ов)



Михайлов Е.А.

по доверенности
от 30.01.2023 г.