


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Федерального бюджетного учреждения науки «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека



В.Г. Акимкин




«10» апреля 2012 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами, *TBEV*, *Borrelia burgdorferi sl*, *Anaplasma phagocytophilum*, *Ehrlichia chaffeensis* / *Ehrlichia muris*, в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс® *TBEV*, *B.burgdorferi sl*, *A.phagocytophilum*, *E.chaffeensis* / *E.muris*-FL»

2022 г.

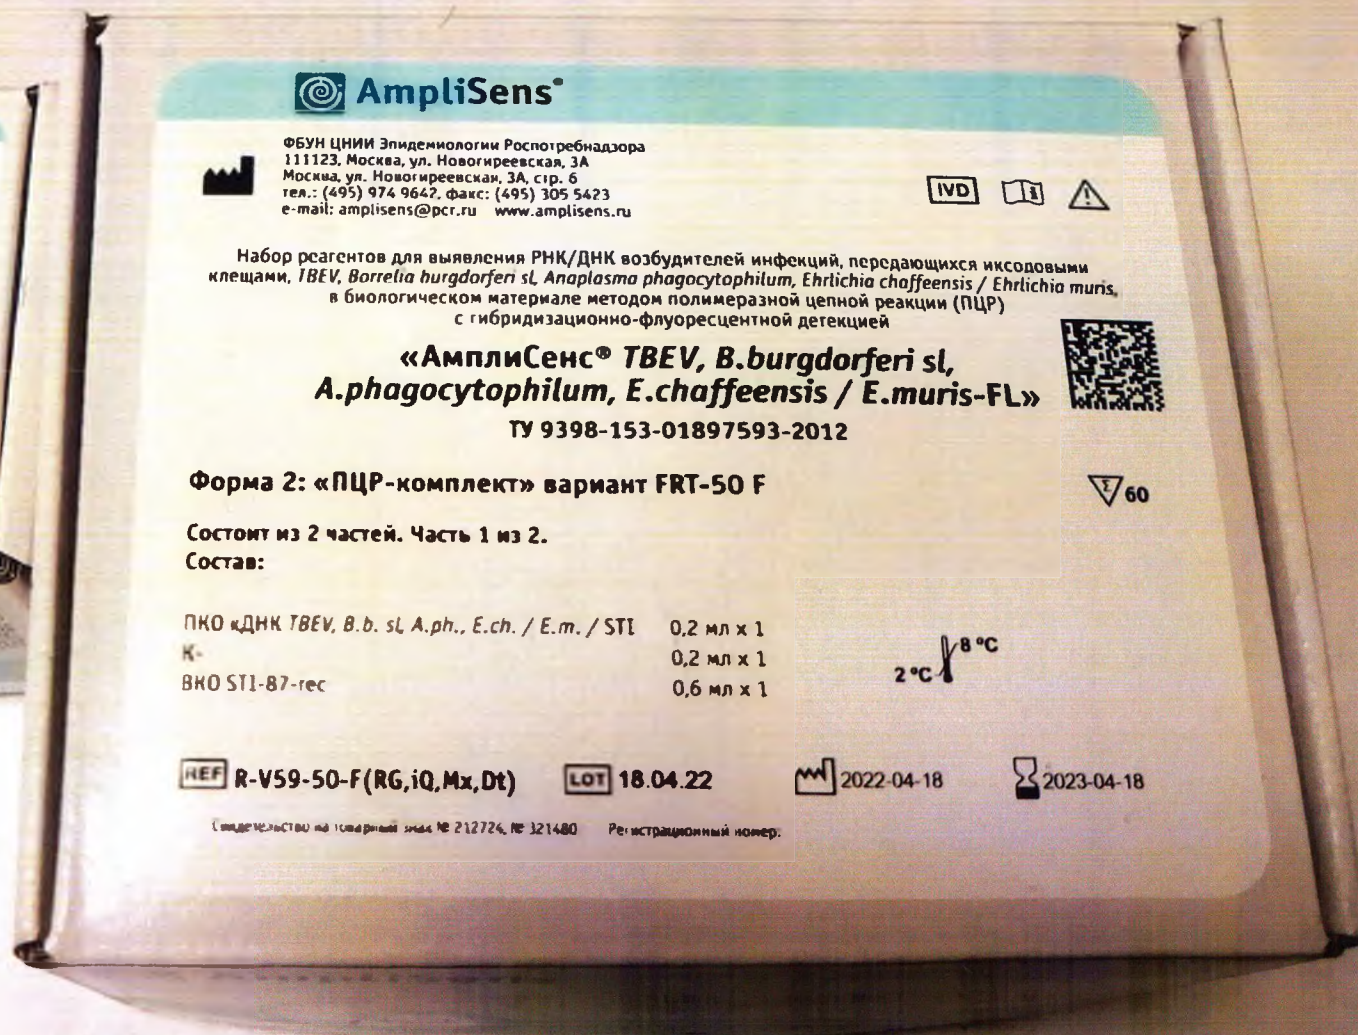

фотография набора реагентов «АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis/E.muris-FL» формы 2 после вскрытия внешней упаковки (в коробке).



AmpliSens®

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Информационные Технологии»
111125, Москва, ул. Вавилова, д. 34
Многоканальный телефон: 8 (495) 317-60-00
E-mail: info@amplisens.ru, www.amplisens.ru

Набор реагентов для выявления РНК ДНК возбудителей инфекций: паразитарных заболеваний (TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL) в биологических материалах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентно-флуоресцентной детекцией

«АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»

ТУ 9398-153-01897 593-2012

Формы 2: ПЦР-комплект вариант FRT-50 F

Состав: 2 части. Часть 1 из 2.

Состав:

Таблица TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL	0,2 мл x 1
Таблица TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL	0,2 мл x 1
Таблица TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL	0,6 мл x 1

2°C 3°C

REF R-V59-50-F (B6, Mx, D1) LOT 18.04.22 2022-04-18 2023-04-18

AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

ВКЛАДЫШ
к набору реагентов
«АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»

Формы 2 REF R-V59-50-F (RG, Q, Mx, D1) REF H-1532-1

LOT 18.04.22

Настройка для приборов роторного типа
Rotor-Gene 6000, Rotor-Gene Q

Канал	Сайт/канал Сигнал/канал От уровня сигнала	Threshold Порог	Dynamic Динамический Фон	Signal Сигнал Корректировка	More settings Other Настройка Дополнительно
FAM/Green	от 5F1 до 10F1	0,03	Включен	Включен	5 %
JOE/Yellow	от 5F1 до 10F1	0,03	Включен	Включен	5 %
ROX/Orange	от 5F1 до 10F1	0,03	Включен	Включен	5 %

Примечание: в случае, если прибор настроен на канал FAM/Green, JOE/Yellow и ROX/Orange не использовать каналы для определения результатов.

Настройка для приборов планетарного типа
CFX96

Примечание: Для каждого шага стала цифровым каналом. Это можно задать в настройках прибора.

Канал: Threshold

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

набора реагентов для выявления РНК ДНК возбудителей инфекций: паразитарных заболеваний (TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL) в биологических материалах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентно-флуоресцентной детекцией

«АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»

AmpliSens®

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Информационные Технологии»
111125, Москва, ул. Вавилова, д. 34
Многоканальный телефон: 8 (495) 317-60-00
E-mail: info@amplisens.ru, www.amplisens.ru

AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Набор реагентов для выявления РНК ДНК возбудителей инфекций: паразитарных заболеваний (TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL) в биологических материалах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентно-флуоресцентной детекцией

«АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»

Формы 2 LOT 18.04.22 2022-04-18 2023-04-18

ТУ 9398-153-01897 593-2012

1. Технические характеристики

Наименование	Единица измерения	Значение
Полноразмерный набор реагентов для выявления РНК ДНК возбудителей инфекций: паразитарных заболеваний (TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL) в биологических материалах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентно-флуоресцентной детекцией	мл	0,2
Полноразмерный набор реагентов для выявления РНК ДНК возбудителей инфекций: паразитарных заболеваний (TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL) в биологических материалах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентно-флуоресцентной детекцией	мл	0,2
Полноразмерный набор реагентов для выявления РНК ДНК возбудителей инфекций: паразитарных заболеваний (TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL) в биологических материалах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентно-флуоресцентной детекцией	мл	0,6

2. Состав, комплектация

Наименование	Значение	Единица измерения
Полноразмерный набор реагентов для выявления РНК ДНК возбудителей инфекций: паразитарных заболеваний (TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL) в биологических материалах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентно-флуоресцентной детекцией	0,2	мл
Полноразмерный набор реагентов для выявления РНК ДНК возбудителей инфекций: паразитарных заболеваний (TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL) в биологических материалах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентно-флуоресцентной детекцией	0,2	мл
Полноразмерный набор реагентов для выявления РНК ДНК возбудителей инфекций: паразитарных заболеваний (TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL) в биологических материалах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентно-флуоресцентной детекцией	0,6	мл

3. Условия хранения и транспортировки

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С не более 1 года.

Транспортировать в сухом, защищенном от света месте при температуре от 2 до 8 °С не более 1 сут.

4. Дата выпуска

2022-04-18

5. Номер партии

18.04.22

6. Номер документа

2023-04-18

AmpliSens®

Краткое руководство

набор реагентов
«АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»

REF R-V59-50-F (RG, Q, Mx, D1) REF H-1532-1

Формы 2

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Информационные Технологии»
111125, Москва, ул. Вавилова, д. 34
Многоканальный телефон: 8 (495) 317-60-00
E-mail: info@amplisens.ru, www.amplisens.ru

AmpliSens®

ИЗДАТЕЛЬСТВО «Информационные Технологии»
111125, Москва, ул. Вавилова, д. 34
Многоканальный телефон: 8 (495) 317-60-00
E-mail: info@amplisens.ru, www.amplisens.ru

Набор реагентов для выявления РНК ДНК возбудителей инфекций: паразитарных заболеваний (TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL) в биологических материалах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентно-флуоресцентной детекцией

«АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»

ТУ 9398-153-01897 593-2012

Формы 2: ПЦР-комплект вариант FRT-50 F

Состав: 2 части. Часть 1 из 2.

Состав:

Таблица TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL	0,2 мл x 1
Таблица TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL	0,2 мл x 1
Таблица TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL	0,6 мл x 1

2°C 3°C


REF R-V59-50-F (B6, Mx, D1) LOT 18.04.22 2022-04-18 2023-04-18

Фотография набора реагентов «АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis/E.muris-FL» формы 2 до вскрытия внешней упаковки (в пакете с замком Zip-Lock).






Фотография набора реагентов «АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis/E.muris-FL» формы 2 до вскрытия внешней упаковки (в металлизированном пакете с замком Zip-Lock).

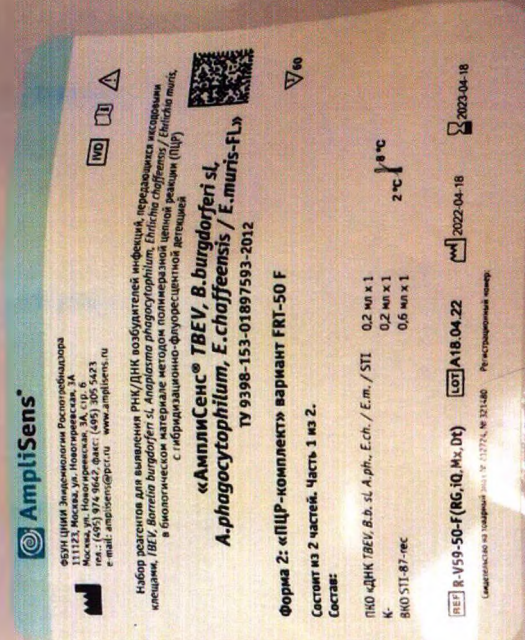


Фотография набора реагентов «АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis/E.muris-FL» формы 2 после вскрытия внешней упаковки (в металлизированном пакете с замком Zip-Lock).



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
набора реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей
инфекции, передающихся иксодовыми клещами,
TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum,
E.chaffeensis / E.muris-FL, в биопон-ассом
материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
с гибридно-флуоресцентной детекцией
«АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl,
A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора



ВКЛАДЫШ
к набору реагентов
«АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum,
E.chaffeensis / E.muris-FL»

Форма 2 REF R-V69-50-F(RG-IQ-Mx-DI); REF H-1532-1
LOT A18.04.22
Набор для прибора Rotor-Gene 6000, Rotor-Gene Q

Канал	Calibration	Threshold	Dynamic threshold	Slope Correct	More settings/Outer
FAM/Grn	от 5FI до 10FI	0.03	включена	коррект, усредн	Нормализация
JOE/Yel	от 5FI до 10FI	0.03	включена	включена	5%
ROX/Orange	от 5FI до 10FI	0.03	включена	включена	5%

Примечание: В случае если при флуоресценции по каналу FAM/Grn, JOE/Yel или ROX/Orange не со-
блюдается экспоненциальный рост (не имеет S-образный вид), установить значение порога срабатывания
на 10% (10% от порога флуоресценции по каналу FAM/Grn, JOE/Yel или ROX/Orange).

НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПРИБОРА ПЛАЗМЕННОГО ТИПА
CFX96
Примечание: Для каждого шага этапа амплификации, назов канал Step. Оптика, задать скорость
нагрева/охлаждения Ramp Rate 2.5 °C/s

Канал	Threshold
FAM/Grn	включена

Установить пороговое значение на уровне 5 %, от максимального уровня флуоресценции



«АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl,
A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»
Формы 2, «ПЦР-инициаторы» набор R-V69-50-F
Состав: 2 части. Част. 1 из 2.
Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22

Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22

Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22

Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22

Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22

Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22

Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22

Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22

Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22

Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22

Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22

Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22

Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22

Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22

Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22

Срок годности: 12 месяцев. Дата: 18.04.22



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами, *TBEV*, *Borrelia burgdorferi* sL, *Anaplasma phagocytophilum*, *Ehrlichia chaffeensis* / *Ehrlichia muris*, в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией

**«АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sL,
A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»**

ТУ 9398-153-01897593-2012




Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F



Состоит из 2 частей. Часть 1 из 2.

Состав:

ПКО кДНК TBEV, B.b. sL, A.ph., E.ch. / E.m. / STI	0,2 мл x 1
К-	0,2 мл x 1
ВКО STI-87-rec	0,6 мл x 1



REF R-V59-50-F(RG,iQ,Mx,Dt)

LOT 18.04.22

2022-04-18

2023-04-18

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480 Регистрационный номер:



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора
111223, Москва, ул. Новодорожская, 3А, стр. 6
т.: (495) 874-10-00, ф.: (495) 395-5473
e-mail: amplisens@ros.ru, www.amplisens.ru

Набор реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся искожными
«Amplisens® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»
с биологическим материалом методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
с гибридным флуоресцентным детектированием

«Amplisens® TBEV, B.burgdorferi sl,
A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»

ТУ 9398-153-01897593-2012

Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F
Состоит из 2 частей. Часть 1 из 2.
Состав:

ПНО-4ДНК TBEV, B.b. sl, A.ph., E.ch., / E.m. / SIT 0,2 мл x 1
K- 0,2 мл x 1
BHO-SIT-87-nc 0,6 мл x 1

REF R-V59-50-F(RG, IQ, Mx, Dn) LOT 18.04.22 2023.04.18

(информация о товаре: лот № 71375, № 171486) Роспотребнадзор



2 °C


2023.04.18

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

набора реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей
инфекций, передающихся искожными
TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum,
E.chaffeensis / E.muris-FL, в биологическом
материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
с гибридным флуоресцентным детектированием
«Amplisens® TBEV, B.burgdorferi sl,
A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора
111223, Москва, ул. Новодорожская, 3А, стр. 6
т.: (495) 874-10-00, ф.: (495) 395-5473
e-mail: amplisens@ros.ru, www.amplisens.ru



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора

ВКЛАДЫШ

к набору реагентов
«Amplisens® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum,
E.chaffeensis / E.muris-FL»

Форма 2 REF R-V59-50-F(RG, IQ, Mx, Dn) REF H-1532-1

LOT 18.04.22

Настройкой для прибора второго типа

Канал	Сайт/канал	Threshold/ Порог	Dynamic/ Динамич. фон	Store Correct/ Коррект. углона	More settings/ Остаток параметров
FAM/Green	OT 5FI до 10FI	0.03	ВКЛЮЧЕНА	ВКЛЮЧЕНА	5 %
JOE/Yellow	OT 5FI до 10FI	0.03	ВКЛЮЧЕНА	ВКЛЮЧЕНА	5 %
ROX/Orange	OT 5FI до 10FI	0.03	ВКЛЮЧЕНА	ВКЛЮЧЕНА	5 %

Примечание – В случае, если крайняя флуоресценция по каналам FAM/Green, JOE/Yellow и ROX/Orange не соответствует экспозиционному росту (не имеют S-образный вид), установить значение порога отрицательных проб (NTC Negative Control) равное 10 %.


Настройкой для прибора планшетного типа

SFX06

Примечание – Для каждого шага цикла центрирование, нажав кнопку Step Options, задать скорость нагревания/охлаждения (Panel Heat 2,5 °C/sec).

Канал FAM/Green

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Набор реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся искожными
TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL, в биологическом
материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридным флуоресцентным
детектированием «Amplisens® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»

Форма 2

LOT 18.04.22 2023.04.18

Настройка для прибора второго типа

Наименование параметра	Значение	Единица измерения
1. Температура инкубации	45 °C	°C
2. Скорость нагрева/охлаждения	2,5 °C/sec	°C/sec
3. Порог флуоресценции	0.03	
4. Динамич. фон	ВКЛЮЧЕНА	
5. Store Correct	ВКЛЮЧЕНА	
6. More settings	5 %	%

Наименование параметра	Значение	Единица измерения
1. Температура инкубации	45 °C	°C
2. Скорость нагрева/охлаждения	2,5 °C/sec	°C/sec
3. Порог флуоресценции	0.03	
4. Динамич. фон	ВКЛЮЧЕНА	
5. Store Correct	ВКЛЮЧЕНА	
6. More settings	5 %	%

Примечание – В случае, если крайняя флуоресценция по каналам FAM/Green, JOE/Yellow и ROX/Orange не соответствует экспозиционному росту (не имеют S-образный вид), установить значение порога отрицательных проб (NTC Negative Control) равное 10 %.

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора

111223, Москва, ул. Новодорожская, 3А, стр. 6

т.: (495) 874-10-00, ф.: (495) 395-5473

e-mail: amplisens@ros.ru, www.amplisens.ru



ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
Роспотребнадзора

111223, Москва, ул. Новодорожская, 3А, стр. 6

т.: (495) 874-10-00, ф.: (495) 395-5473

e-mail: amplisens@ros.ru, www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru

www.amplisens.ru


www.amplisens.ru

www.amplisens.ru



AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pcr.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами, *TBEV*, *Borrelia burgdorferi* sL, *Anaplasma phagocytophilum*, *Ehrlichia chaffeensis* / *Ehrlichia muris*, в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией



«АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sL, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»

ТУ 9398-153-01897593-2012

Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состоит из 2 частей. Часть 1 из 2.
Состав:

ПКО кДНК TBEV, B.b. sL, A.ph., E.ch. / E.m. / STI	0,2 мл x 1
К-	0,2 мл x 1
ВКО STI-87-rec	0,6 мл x 1

2°C 8°C

REF R-V59-50-F(RG,iQ,Mx,Dt)

LOT 18.04.22

2022-04-18

2023-04-18

Свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480 Регистрационный номер.

фотография набора реагентов «АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis/E.muris-FL» формы 2, части 1 после вскрытия упаковки (в пакете с замком Zip-Lock).

АмплиСенс®

Формы 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состояние из 2 частей. Часть 1 из 2.

Состав:

ТКО-ДНК (TBEV, B.b., A.ph., E.ch., /E.m./, ST) 0,2 мл x 1

К. 0,2 мл x 1

ВМД-511 81-мг 0,6 мл x 1

Формы 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состояние из 2 частей. Часть 1 из 2.

Состав:

ТКО-ДНК (TBEV, B.b., A.ph., E.ch., /E.m./, ST) 0,2 мл x 1

К. 0,2 мл x 1

ВМД-511 81-мг 0,6 мл x 1

Формы 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состояние из 2 частей. Часть 1 из 2.

Состав:

ТКО-ДНК (TBEV, B.b., A.ph., E.ch., /E.m./, ST) 0,2 мл x 1

К. 0,2 мл x 1

ВМД-511 81-мг 0,6 мл x 1

АмплиСенс®

Формы 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состояние из 2 частей. Часть 1 из 2.

Состав:

ТКО-ДНК (TBEV, B.b., A.ph., E.ch., /E.m./, ST) 0,2 мл x 1

К. 0,2 мл x 1

ВМД-511 81-мг 0,6 мл x 1

Формы 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состояние из 2 частей. Часть 1 из 2.

Состав:

ТКО-ДНК (TBEV, B.b., A.ph., E.ch., /E.m./, ST) 0,2 мл x 1

К. 0,2 мл x 1

ВМД-511 81-мг 0,6 мл x 1

АмплиСенс®

Формы 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состояние из 2 частей. Часть 1 из 2.

Состав:

ТКО-ДНК (TBEV, B.b., A.ph., E.ch., /E.m./, ST) 0,2 мл x 1

К. 0,2 мл x 1

ВМД-511 81-мг 0,6 мл x 1

Формы 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состояние из 2 частей. Часть 1 из 2.

Состав:


ТКО-ДНК (TBEV, B.b., A.ph., E.ch., /E.m./, ST) 0,2 мл x 1

К. 0,2 мл x 1

ВМД-511 81-мг 0,6 мл x 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

набор реагентов для выявления РНК-ДНК содержащих инфекций, передаваемых клещами: TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL, в биологических материалах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентно-ферментативной детекцией «АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»




фотография набора реагентов «АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sL, A.phagocytophilum, E.chaffeensis/E.muris-FL» формы 2, части 1 до вскрытия упаковки (в металлизированном пакете с замком Zip-Lock).



AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111123, Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 8
Москва, ул. Новогиревская, 3А, стр. 8
тел.: (495) 974 9642, факс: (495) 305 5423
e-mail: amplisens@pct.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами: TBEV, Borrelia burgdorferi sL, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis / Ehrlichia muris с гибридационно-флуоресцентной детекцией (ПЦР)

«АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sL, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»

ТУ 9398-153-01897593-2012



Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F



Состоит из 2 частей. Часть 1 из 2.
Состав:

ПКО «ДНК TBEV, B. b. sL A. ph., E. ch. / E. m. / STI	0,2 мл x 1
К-	0,2 мл x 1
ВКО STI 87-rec	0,6 мл x 1

2 °C / 8 °C

REF R-V59-50-F(RG,iQ,Mx,Dt)

LOT A18.04.22

2022-04-18


2023-04-18

(свидетельство на товарный знак № 212726, № 321460) Регистрационный номер:


фотография набора реагентов «АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis/E.muris-FL» формы 2, части 1 после вскрытия упаковки
(в металлизированном пакете с замком Zip-Lock).





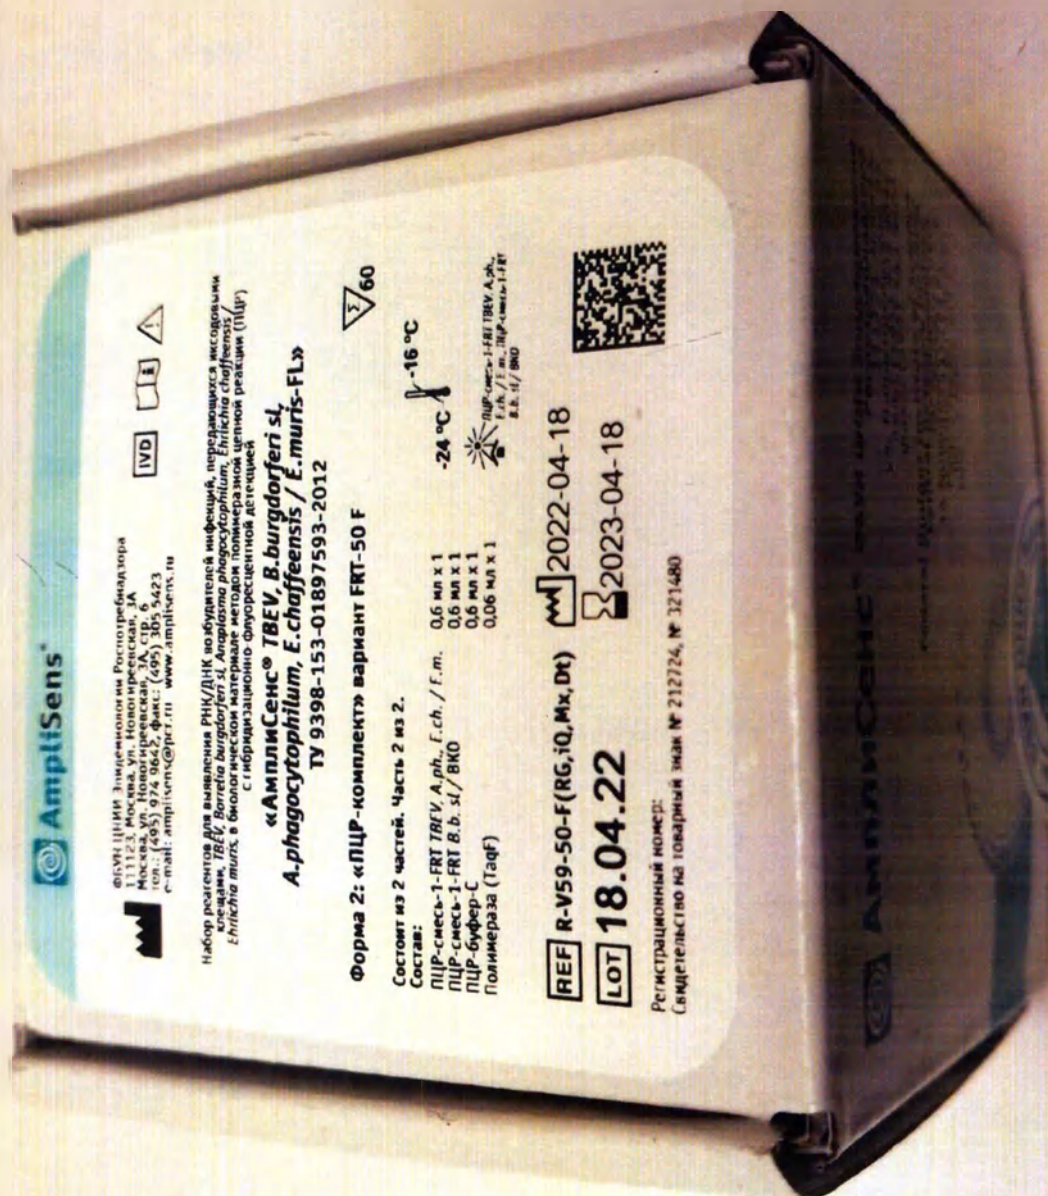

фотография набора реагентов «АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis/E.muris-FL» формы 2, части 2 после вскрытия упаковки (в коробке).

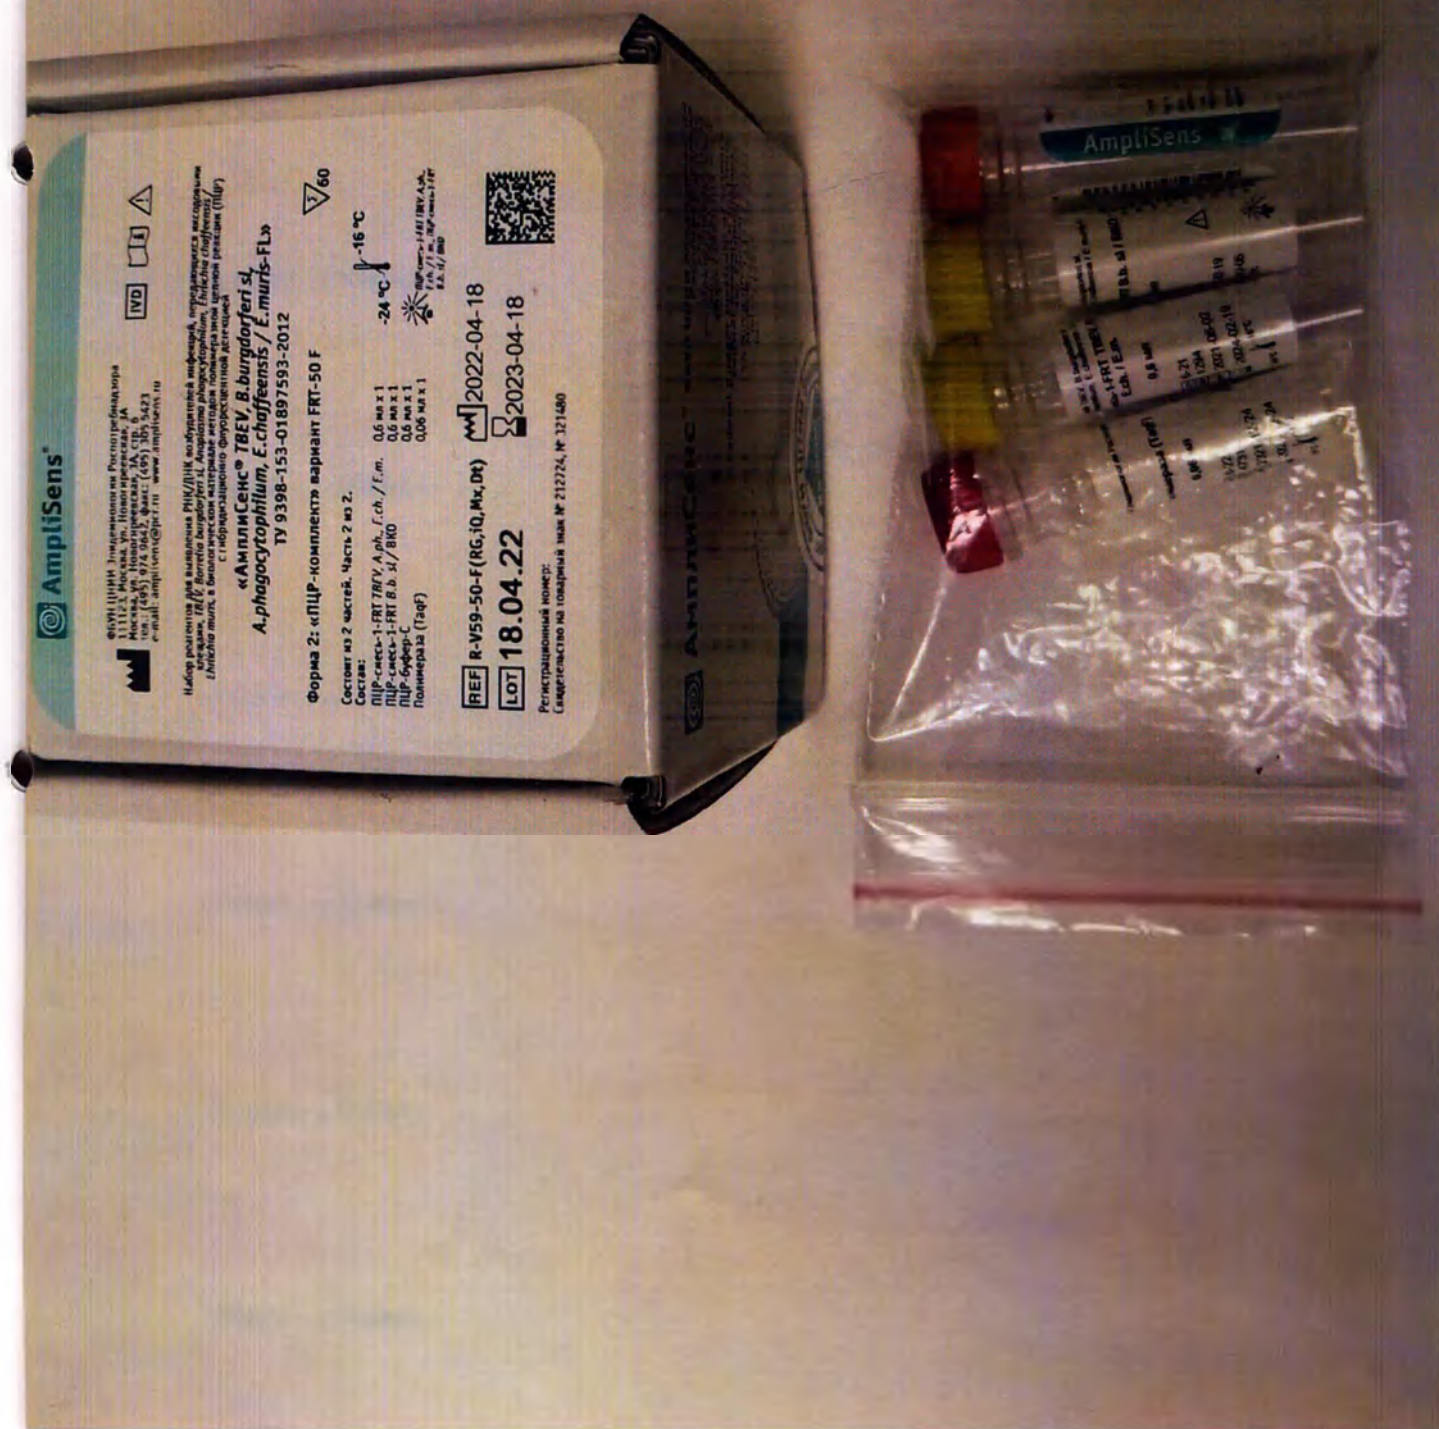






фотография набора реагентов «АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis/E.muris-FL» формы 2, части 2 до вскрытия упаковки (в металлизированном пакете с замком Zip-Lock).



AmpliSens®

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
111121 Москва, ул. Новогиреевская, 3А
Москва, ул. Новогиреевская, 3А, стр. 6
тел.: (495) 874-3642, факс: (495) 303-3423
e-mail: amplisens@yandex.ru www.amplisens.ru



Набор реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся половым путем: TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL
Или использовать в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
с информативностью диагностической агентами

**«АмплиСенс® TBEV, B.burgdorferi sl,
A.phagocytophilum, E.chaffeensis / E.muris-FL»
ТУ 9398-153-01897593-2012**


Форма 2: «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F

Состоит из 2 частей. Часть 2 из 2.

Состав:

ПЦР-смесь-1-FRT TBEV, A.ph., f.ch. / f.m.	0,6 мл х 1
ПЦР-смесь-1-FRT B.b. sl / BKO	0,6 мл х 1
ПЦР-буфер-С	0,6 мл х 1
Полимераза (TaqF)	0,06 мл х 1

-24 °C / -16 °C



REF R-V59-50-F(RG, IQ, Mx, Dt)

2022-04-18

LOT A18.04.22

2023-04-18

Регистрационный номер:
свидетельство на товарный знак № 212724, № 321480







КОПИЯ ВЕРНА
Прошито, пронумеровано и скреплено печатью: 21
(двадцать один) лист —

Руководитель службы регистрации медицинских изделий
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
(Доверенность № 169/22 от 16.11.2022 г.)



09 2023 г.

А.О.Лисицына

М.П.

(Handwritten signature)