



Фотографические изображения

Реагенты в кассете для количественного анализа РНК вируса гепатита С (ВГС) в образцах сыворотки и плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HCV)


Реагенты в кассете для количественного анализа РНК вируса гепатита С (ВГС) в образцах сыворотки и плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HCV)

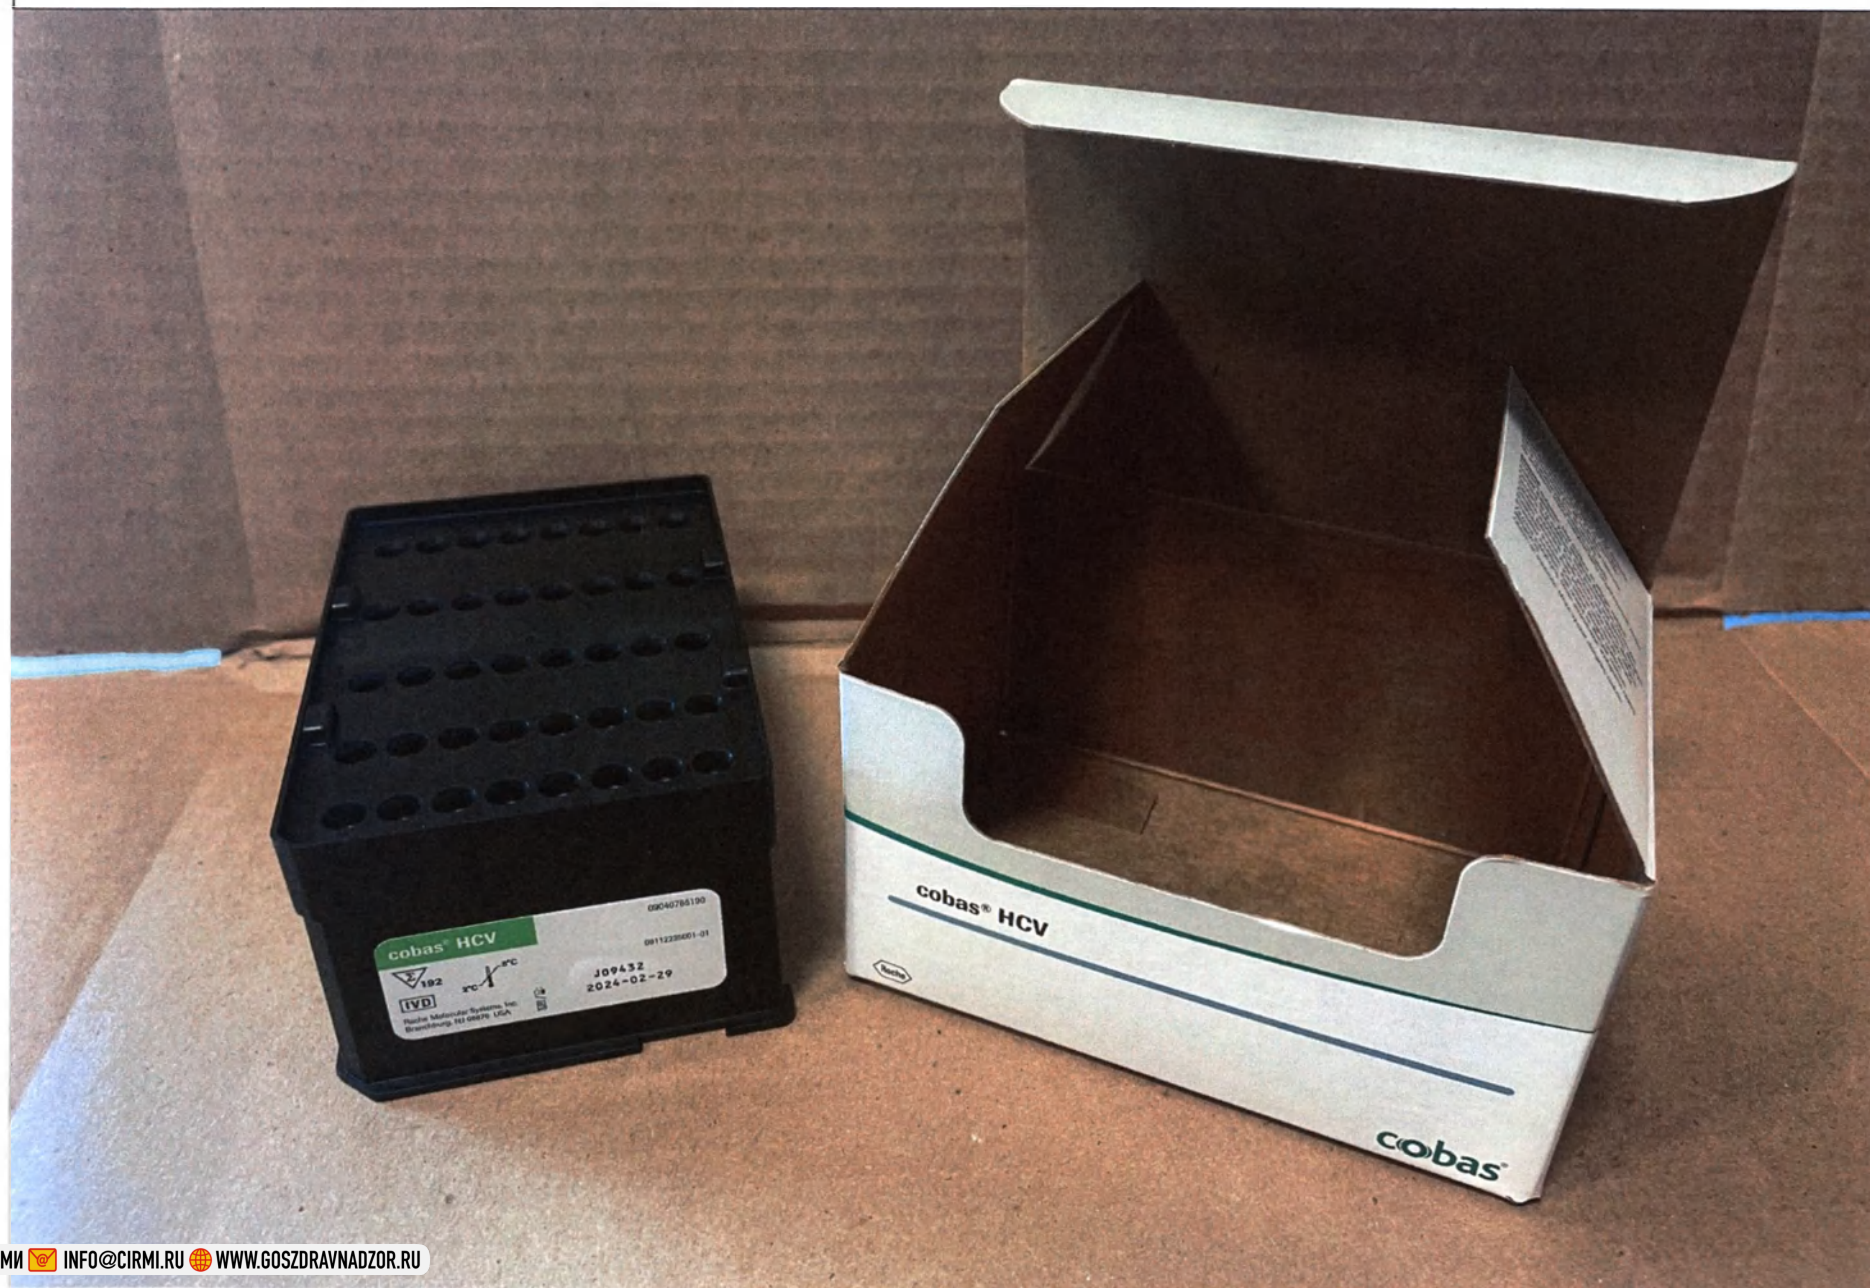

Реагенты в кассете для количественного анализа РНК вируса гепатита С (ВГС) в образцах сыворотки и плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HCV)

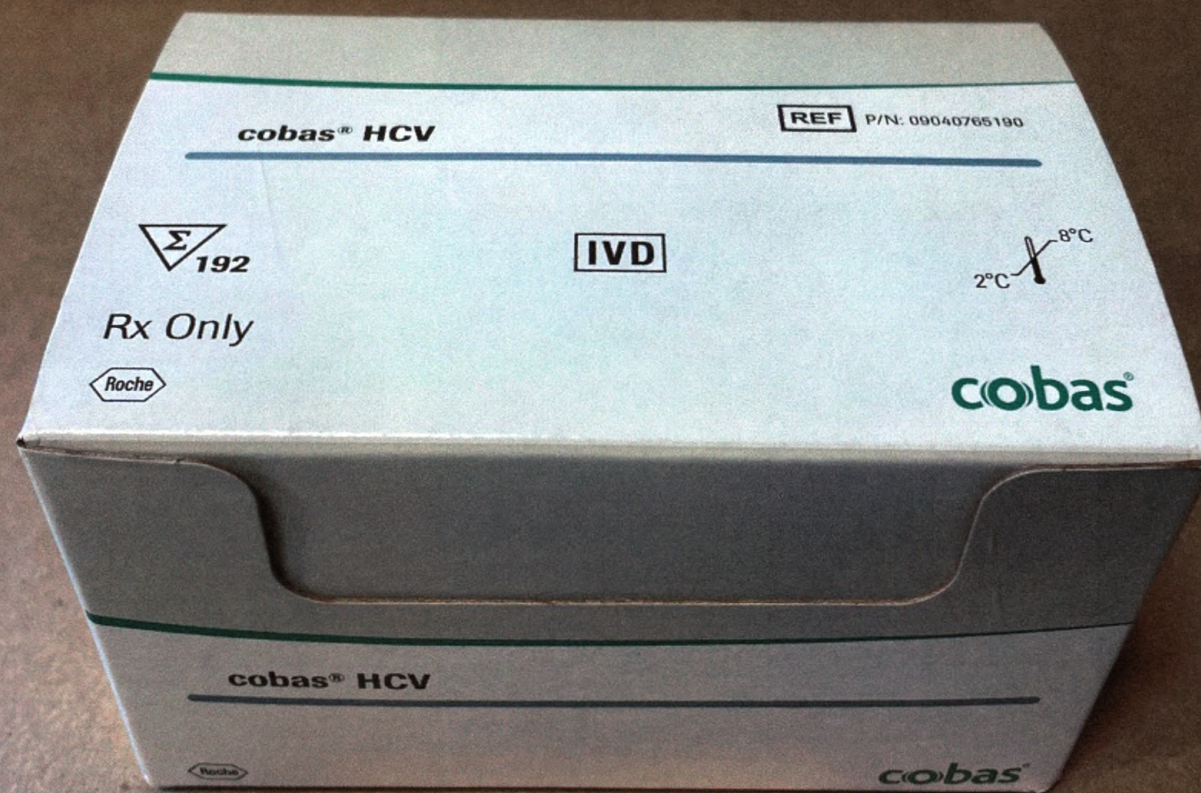

Реагенты в кассете для количественного анализа РНК вируса гепатита С (ВГС) в образцах сыворотки и плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HCV)

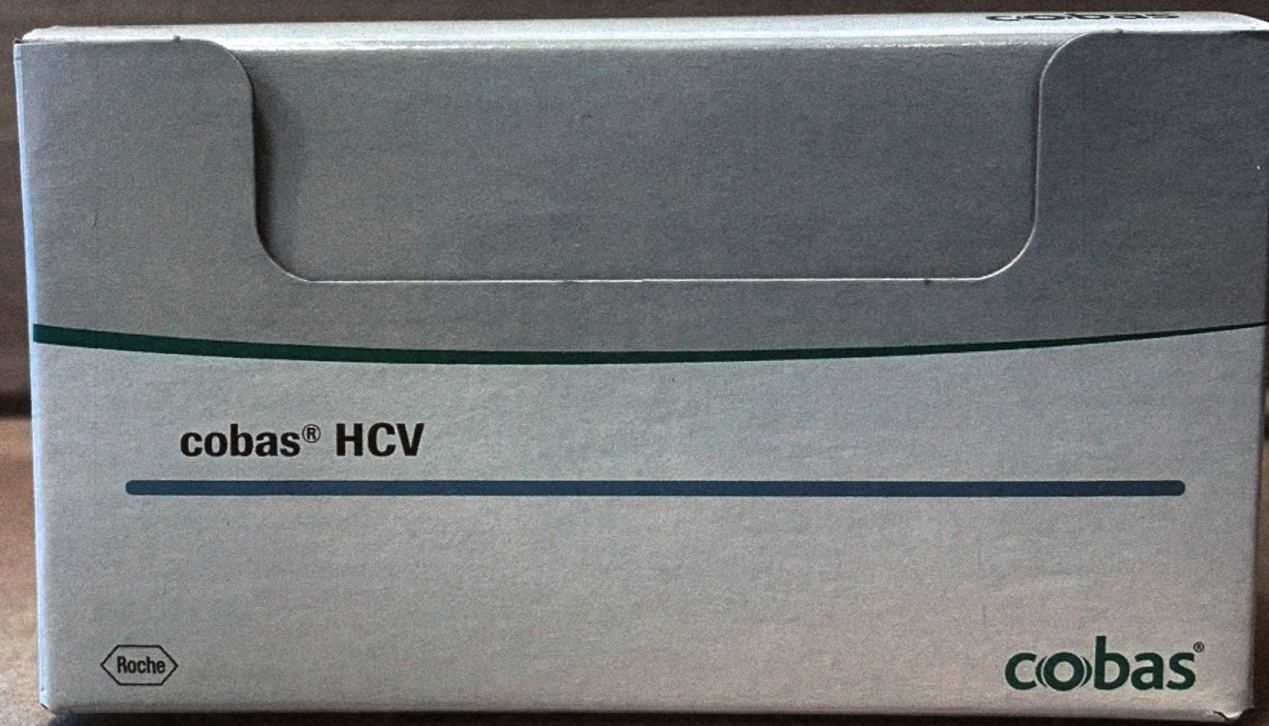

Реагенты в кассете для количественного анализа РНК вируса гепатита С (ВГС) в образцах сыворотки и плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HCV)



Реагенты в кассете для количественного анализа РНК вируса гепатита С (ВГС) в образцах сыворотки и плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HCV)

CONTENT

HCV Cassette	x 1
PASE	22.3 mL
RNA-QS	21.2 mL
EB	21.2 mL
MMX-R1	7.5 mL
HCV MMX-R2	9.7 mL

For USA*

HCV Cassette	x 1
PASE (Proteinase Solution)	22.3 mL
Tris buffer, < 0.05% EDTA, Calcium chloride, Calcium acetate, 8% (w/v) Proteinase	
RNA-QS (RNA Quantitation Standard)	21.2 mL
Tris buffer, < 0.05% EDTA, < 0.001% Non-HCV related armored RNA construct containing primer and probe specific primer sequence regions (non-infectious RNA in MS2 bacteriophage), < 0.1% Sodium azide	

EB 21.2 mL
(Elution Buffer)
Tris buffer, 0.2% Methyl-4 hydroxybenzoate

MMX-R1 7.5 mL
(Master Mix Reagent 1)
Manganese acetate, Potassium hydroxide, < 0.1% Sodium azide

HCV MMX-R2 9.7 mL
(HCV Master Mix Reagent 2)
Tricine buffer, potassium acetate, 18% Dimethyl sulfoxide, Glycerol, < 0.1% Tween 20, EDTA, < 0.12% dATP, dCTP, dGTP, and dUTP, < 0.01% Upstream and downstream HCV primers, < 0.01% Quantitation Standard forward and reverse primers, < 0.01% Fluorescent-labeled oligonucleotide probes specific for HCV and the HCV Quantitation Standard, < 0.01% Oligonucleotide aptamer, < 0.01% Z05D DNA polymerase (microbial), < 0.1% AmpErase (uracil-N-glycosylase) enzyme (microbial), < 0.1% Sodium azide

*Composition information required for US only.

For USA:

cobas® HCV for use on the **cobas® 6800/8800** Systems is an in vitro nucleic acid amplification test for both the detection and quantitation of hepatitis C virus (HCV) RNA, in human EDTA plasma or serum, of HCV antibody positive or HCV-infected individuals. **cobas® HCV** has not been approved for use as a screening test for the presence of HCV in blood or blood products.

Refer to the product specific Instructions For Use for detailed information regarding hazards.

Реагенты в кассете для количественного анализа РНК вируса гепатита С (ВГС) в образцах сыворотки и плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HCV)

HCV



Roche Molecular Systems, Inc.
1080 US Highway 202 South
Branchburg, NJ 08876 USA



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany

EC Importer¹

Distributed by
Roche Diagnostics
9115 Hague Road
Indianapolis, IN 46250-0457 USA
(For Technical Assistance call the
Roche Response Center
toll-free: 1-800-526-1247)²

¹ Symbol text required by USA only.

² For USA only.

COBAS and AMPERASE are trademarks of Roche. ©2021 Roche Molecular Systems, Inc.


Made in USA

Реагенты в кассете для количественного анализа РНК вируса гепатита С (ВГС) в образцах сыворотки и плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HCV)

Реагенты в кассете для количественного анализа РНК вируса гепатита С (ВГС) в образцах сыворотки и плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HCV)




Реагенты в кассете для количественного анализа РНК вируса гепатита С (ВГС) в образцах сыворотки и плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HCV)

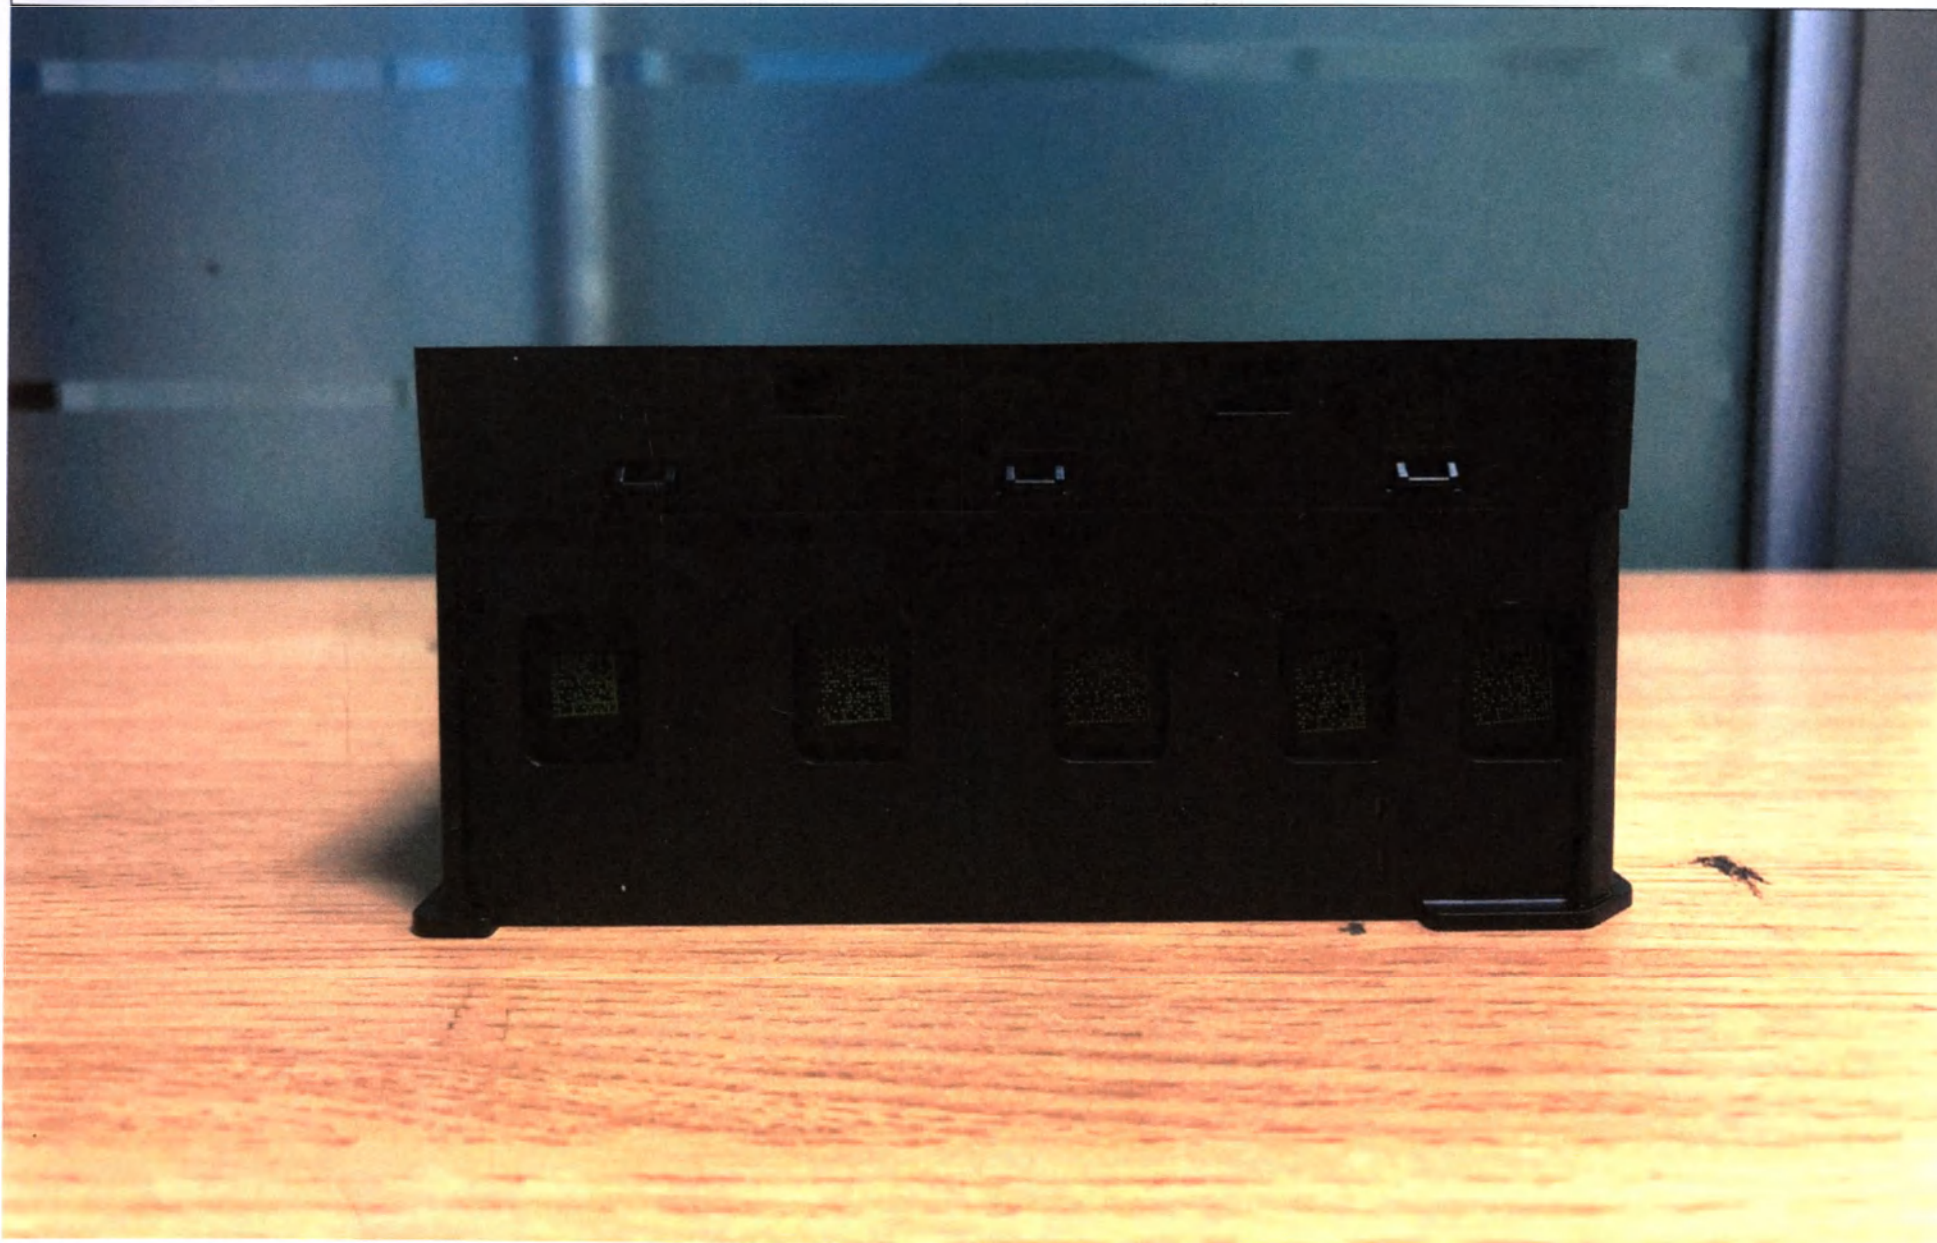

Реагенты в кассете для количественного анализа РНК вируса гепатита С (ВГС) в образцах сыворотки и плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HCV)



Реагенты в кассете для количественного анализа РНК вируса гепатита С (ВГС) в образцах сыворотки и плазмы на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas® HCV)

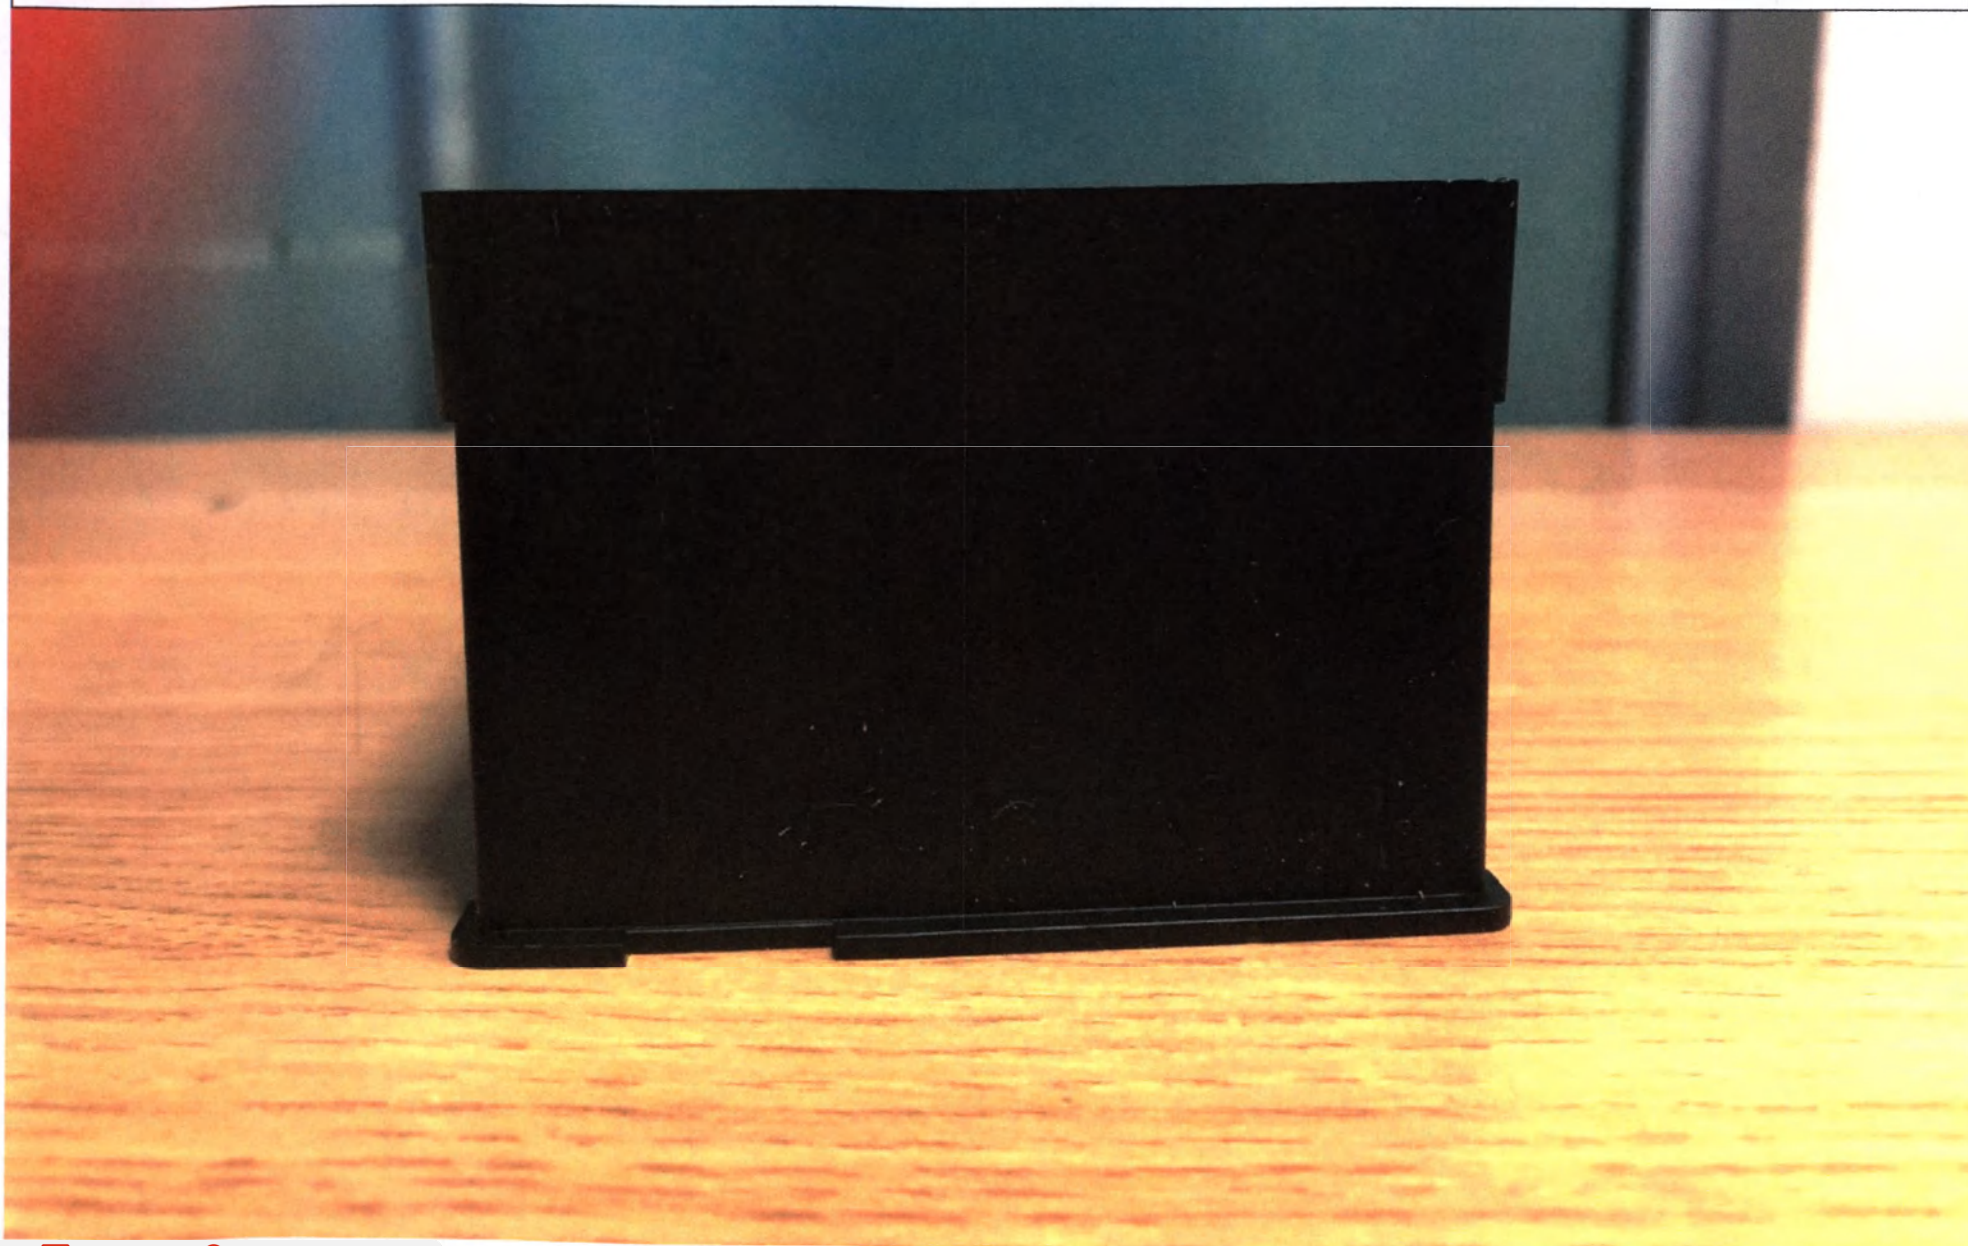

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

12 листа (ов)



по доверенности
от 30.01.2023 г.