


Фотографические изображения

Материал контрольный отрицательный для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, в вариантах исполнения, производства «Exact Diagnostics» («Экзект Диагностикс»), США

Версия 1


Материал контрольный отрицательный для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, вариант исполнения

Материал контрольный отрицательный (EDX Bulk Negative), флакон, объем 50 мл – 1 шт. (общий вид, спереди)

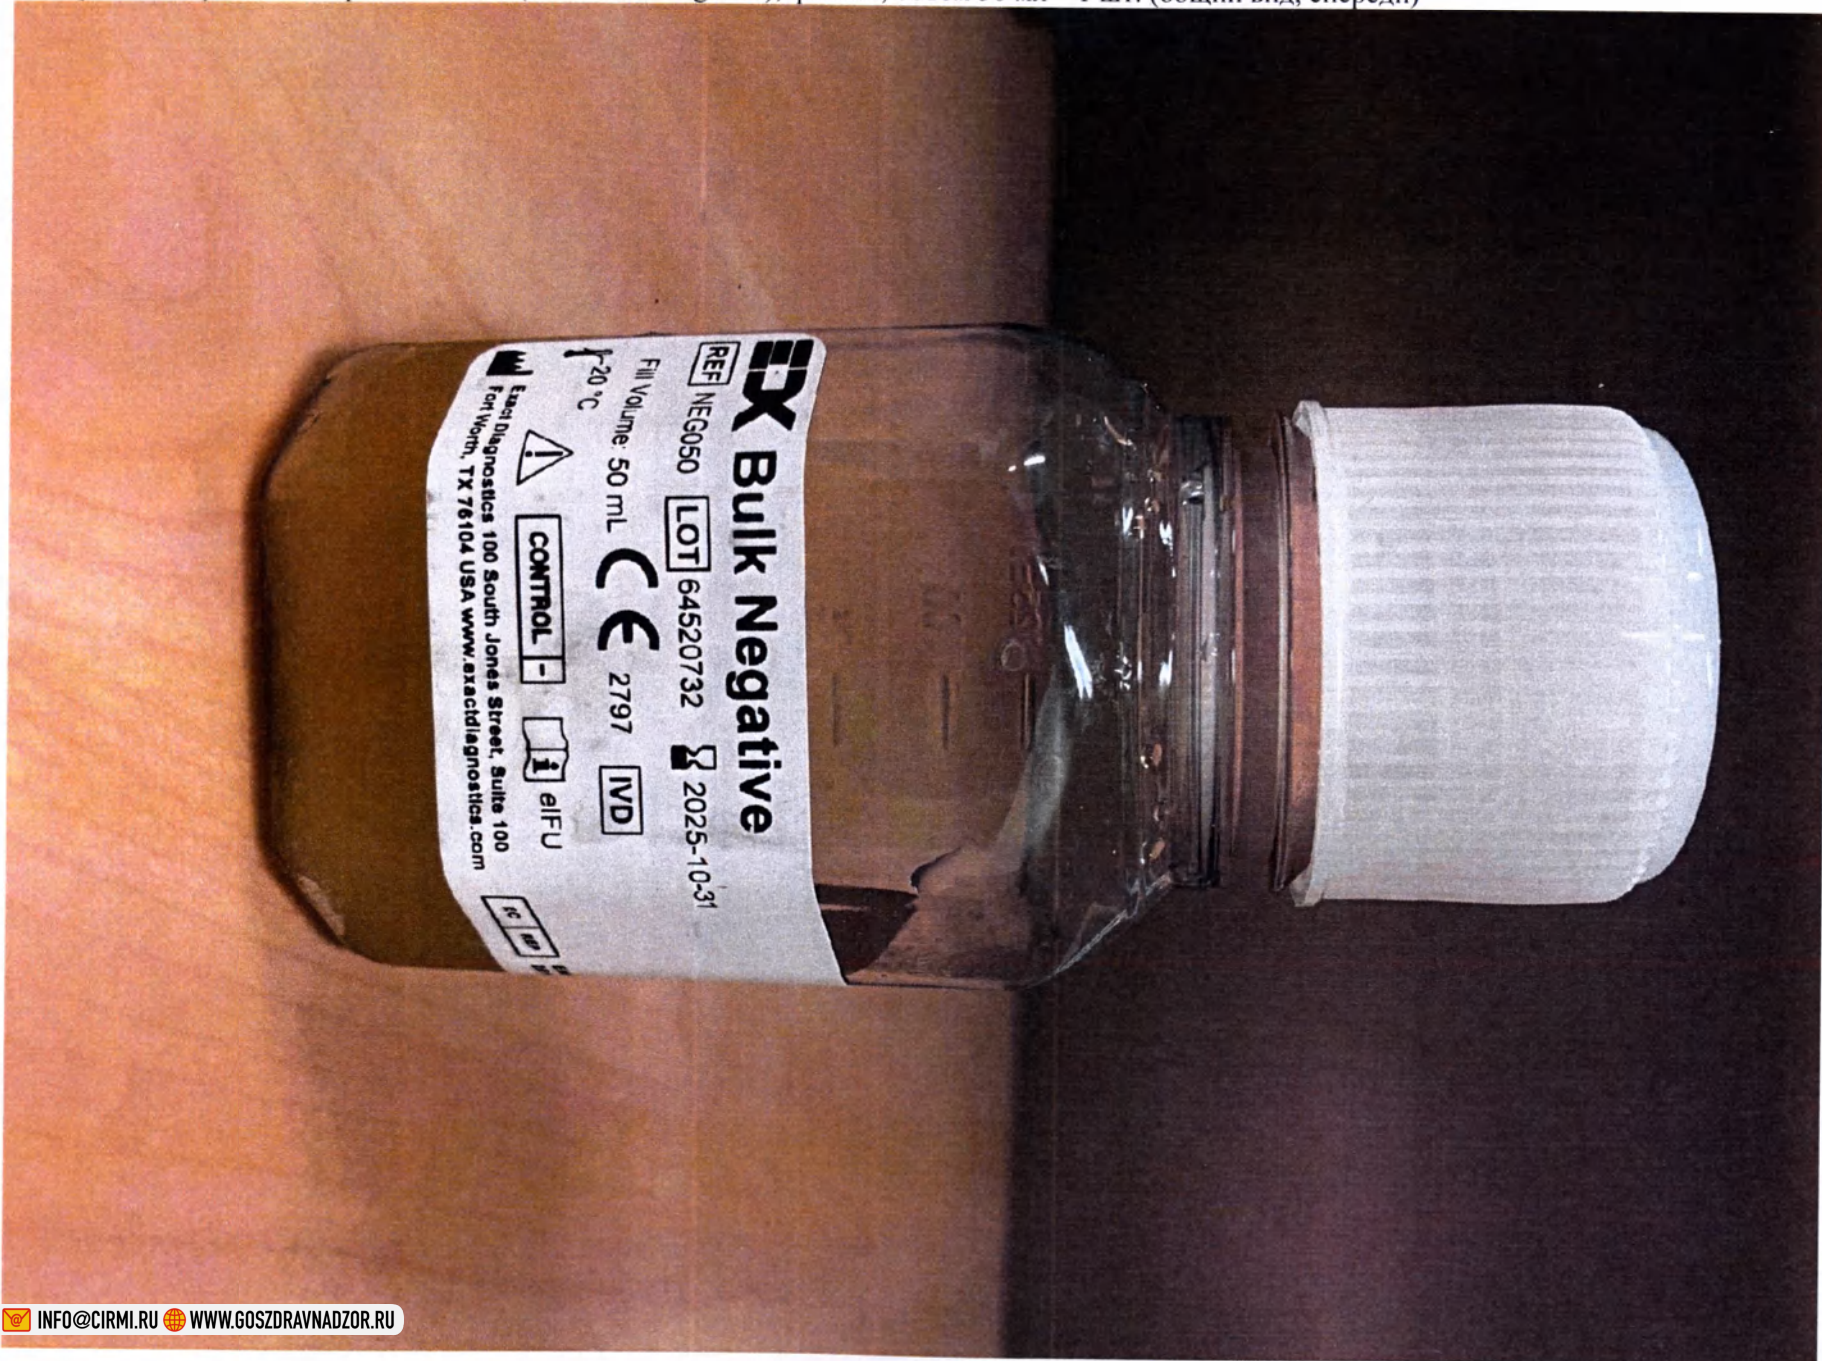


материал контрольный отрицательный для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, вариант исполнения

материал контрольный отрицательный (EDX Bulk Negative), флакон, объем 50 мл – 1 шт. (общий вид, справа)

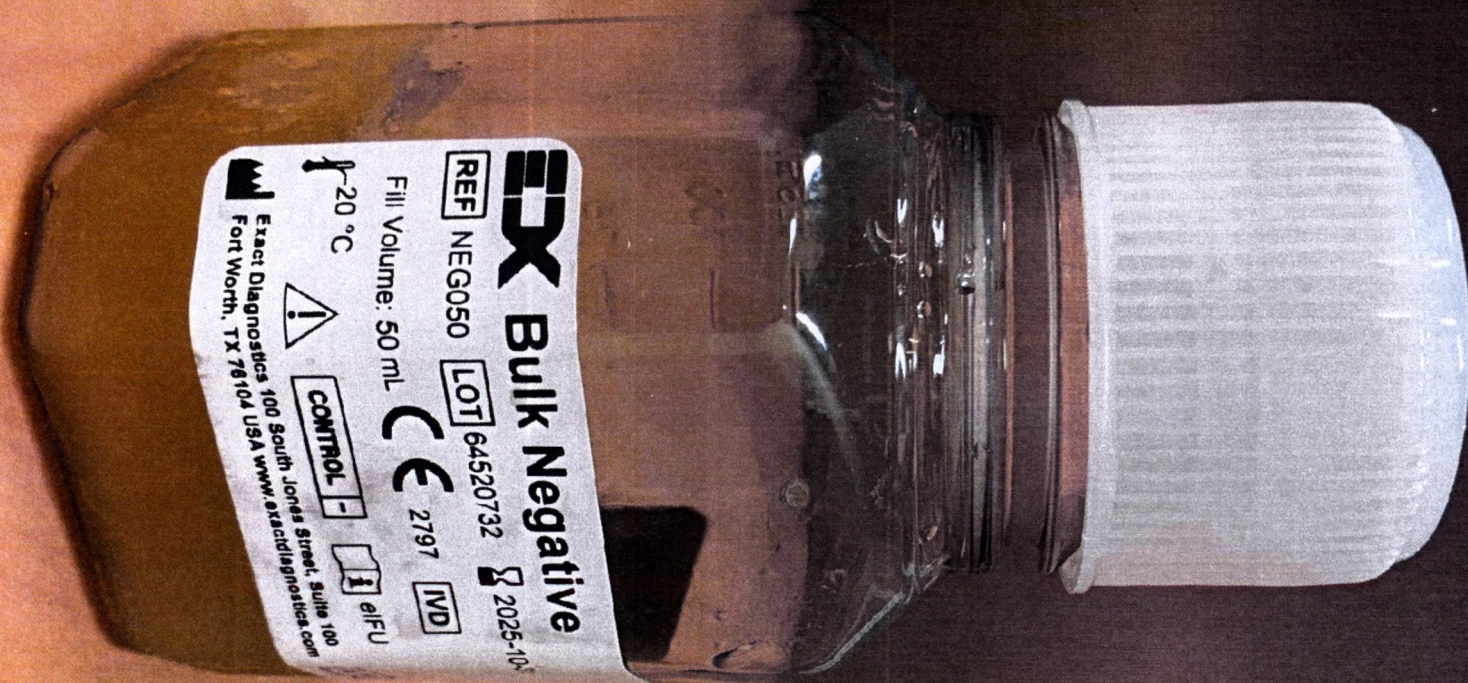

иал контрольный отрицательный для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов,
т исполнения

иал контрольный отрицательный (EDX Bulk Negative), флакон, объем 50 мл – 1 шт. (общий вид, слева)

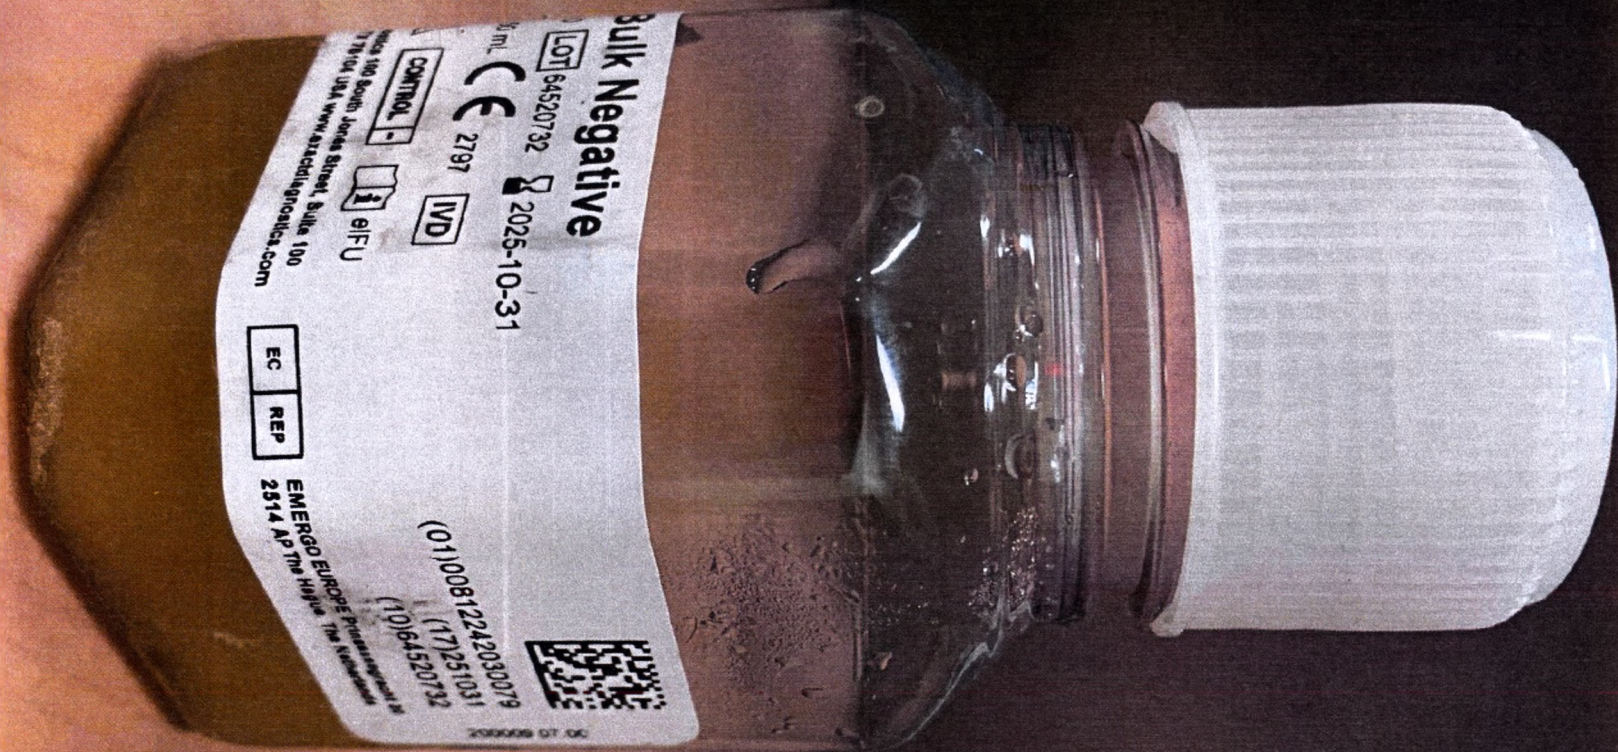

материал контрольный отрицательный для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, вариант исполнения

материал контрольный отрицательный (EDX Negative Run Control), пробирка, объем 1 мл – 5 шт. (общий вид)




Материал контрольный отрицательный для диагностики in vitro для внутрिलाбораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, вариант исполнения

Материал контрольный отрицательный (EDX Negative Run Control), пробирка, объем 1 мл – 5 шт. (пробирки)



Макет транспортной маркировки.

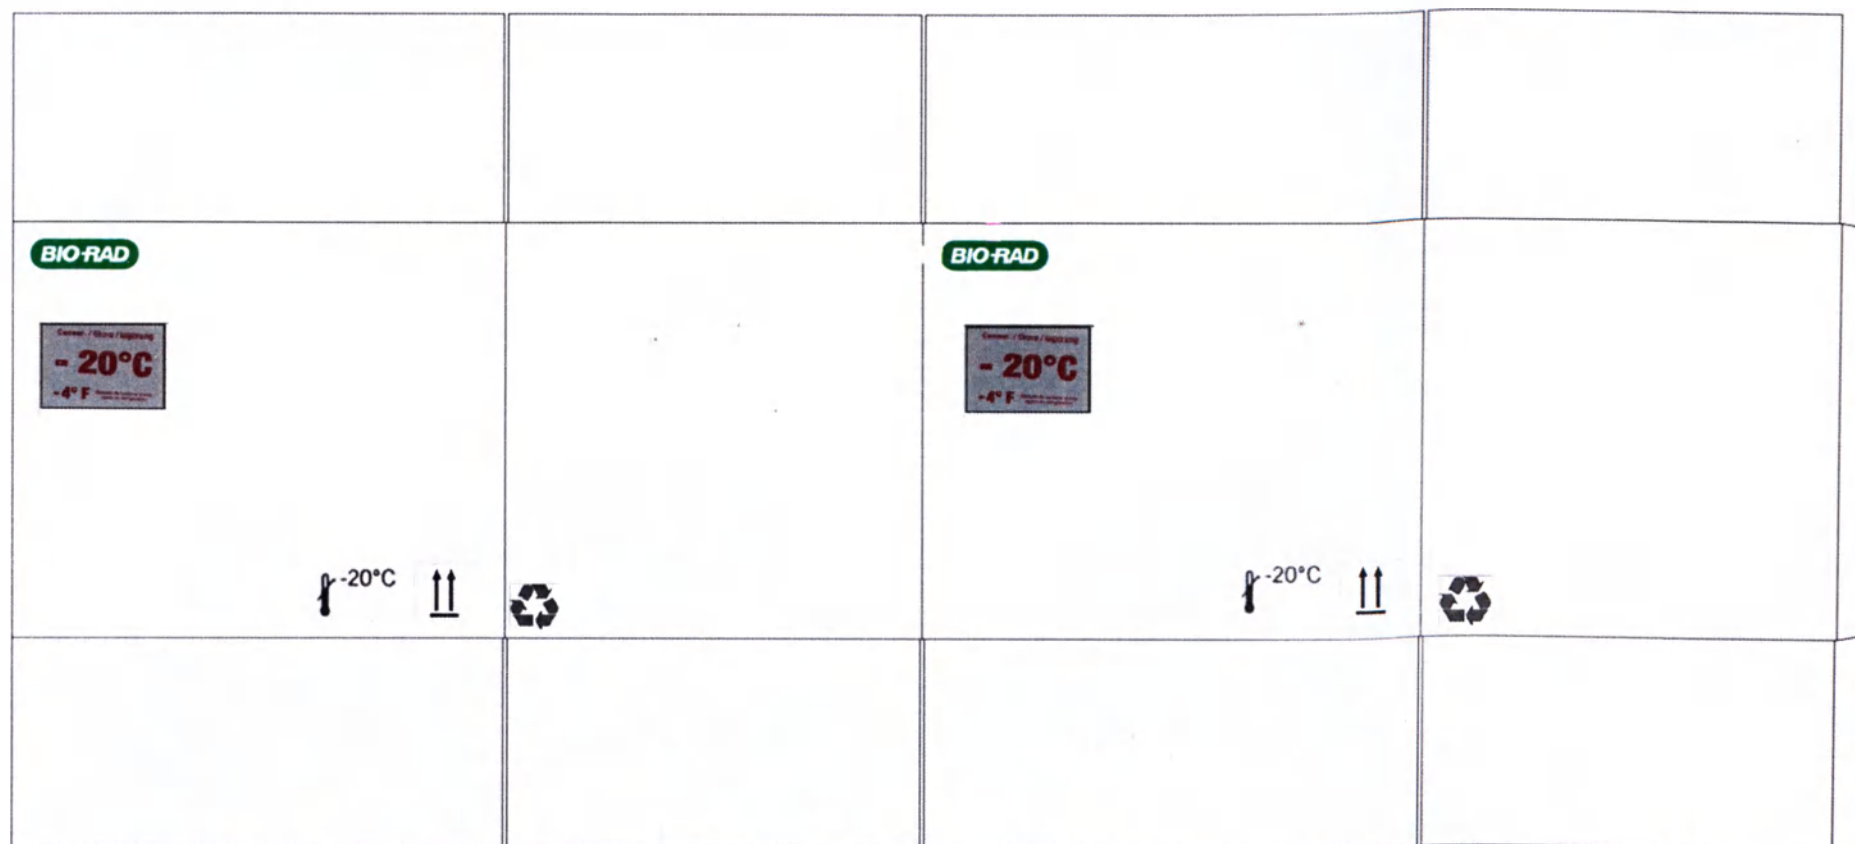

Всего пронумеровано,
прошито и скреплено
печатью 6 листа «об»

По доверенности № 15/2023
от 19.12.2022

