

"УТВЕРЖДАЮ"

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
Чэнь Син _____
2018 г.





Фотографические изображения медицинского изделия
*Анализаторы гематологические автоматические ВС-5300,
ВС-5380 с принадлежностями*



Анализатор BC-5380 основной блок

Основная этикетка для анализатора BC 5380.

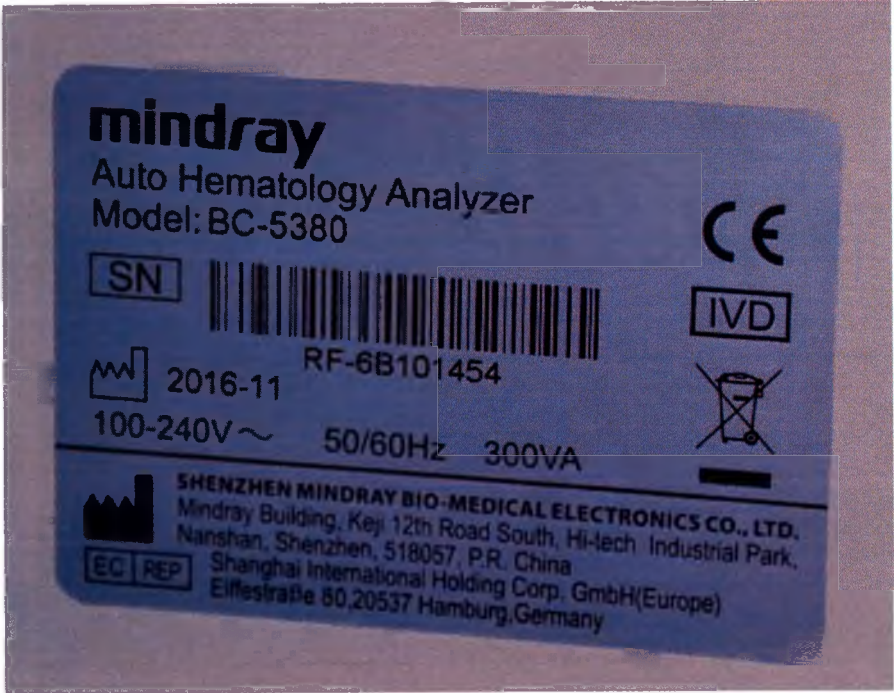

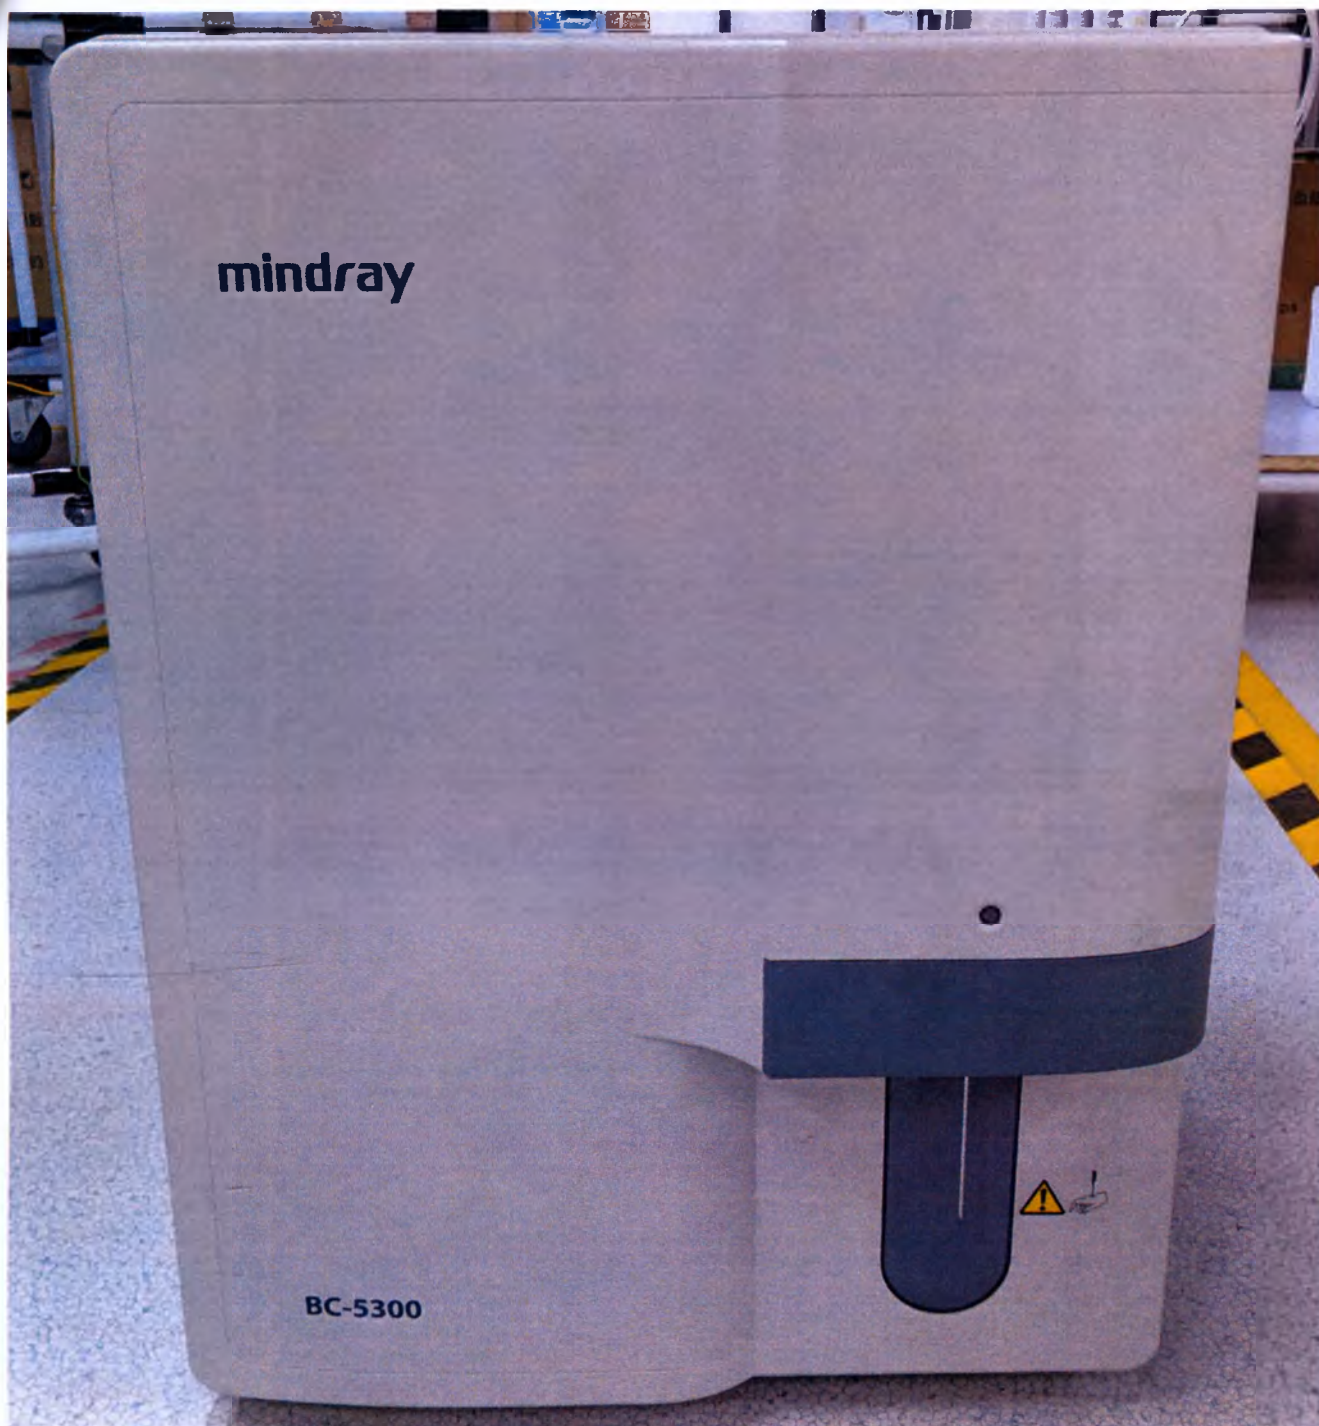

Анализатор BC-5300 основной блок

Основная этикетка для анализатора BC 5300

mindray

Auto Hematology Analyzer

Model: BC-5300



SN



IVD

RD-86101829



2018-06



100-240V ~ 50/60Hz 300VA



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany



Кабель питания

**Анализатор
гематологический автоматический
BC-5380**

Руководство оператора

Телефон технической поддержки пользователей
(звонок по России бесплатный)

8-800-333-5323

(Пн.-Пт., 9:00-18:00)

E-mail: ruservice@mindray.com

mindray

Руководство оператора для Анализатора BC-5380

BC-5300

**Анализатор
гематологический автоматический**


Руководство по эксплуатации

mindray


Руководство по эксплуатации BC-5300 (BC-5300 Operation Manual).



Дилуент М-53D Diluent- канистра, объёмом 20 л.

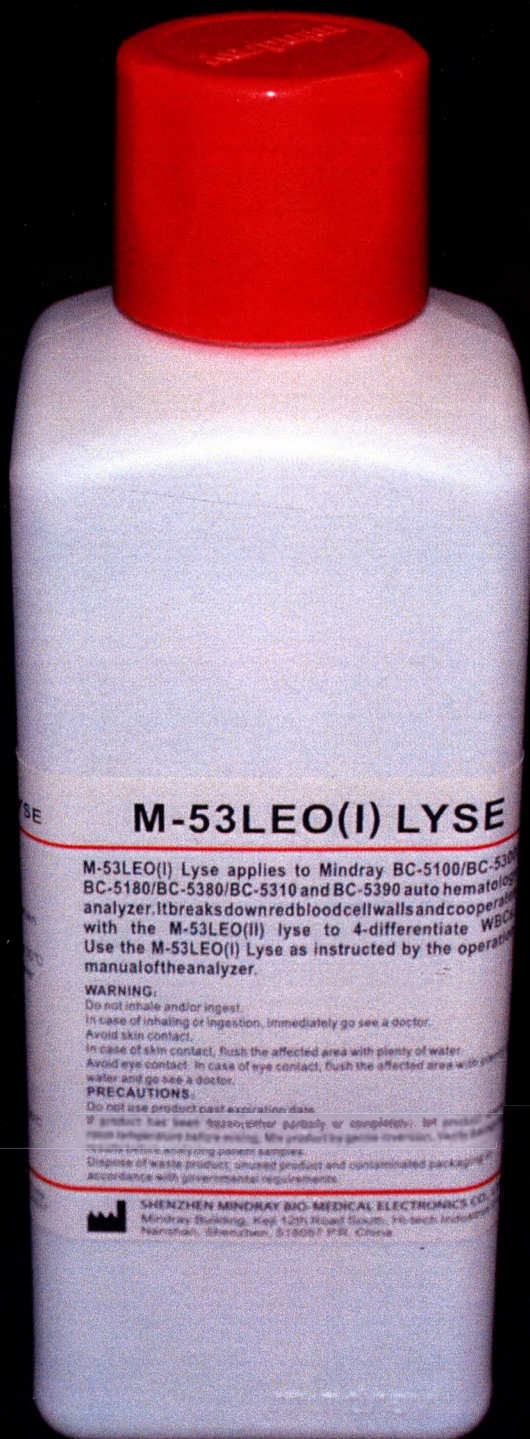

Реагент лизирующий М-53 LEO (I) Lyse - флакон, объемом 500 мл.

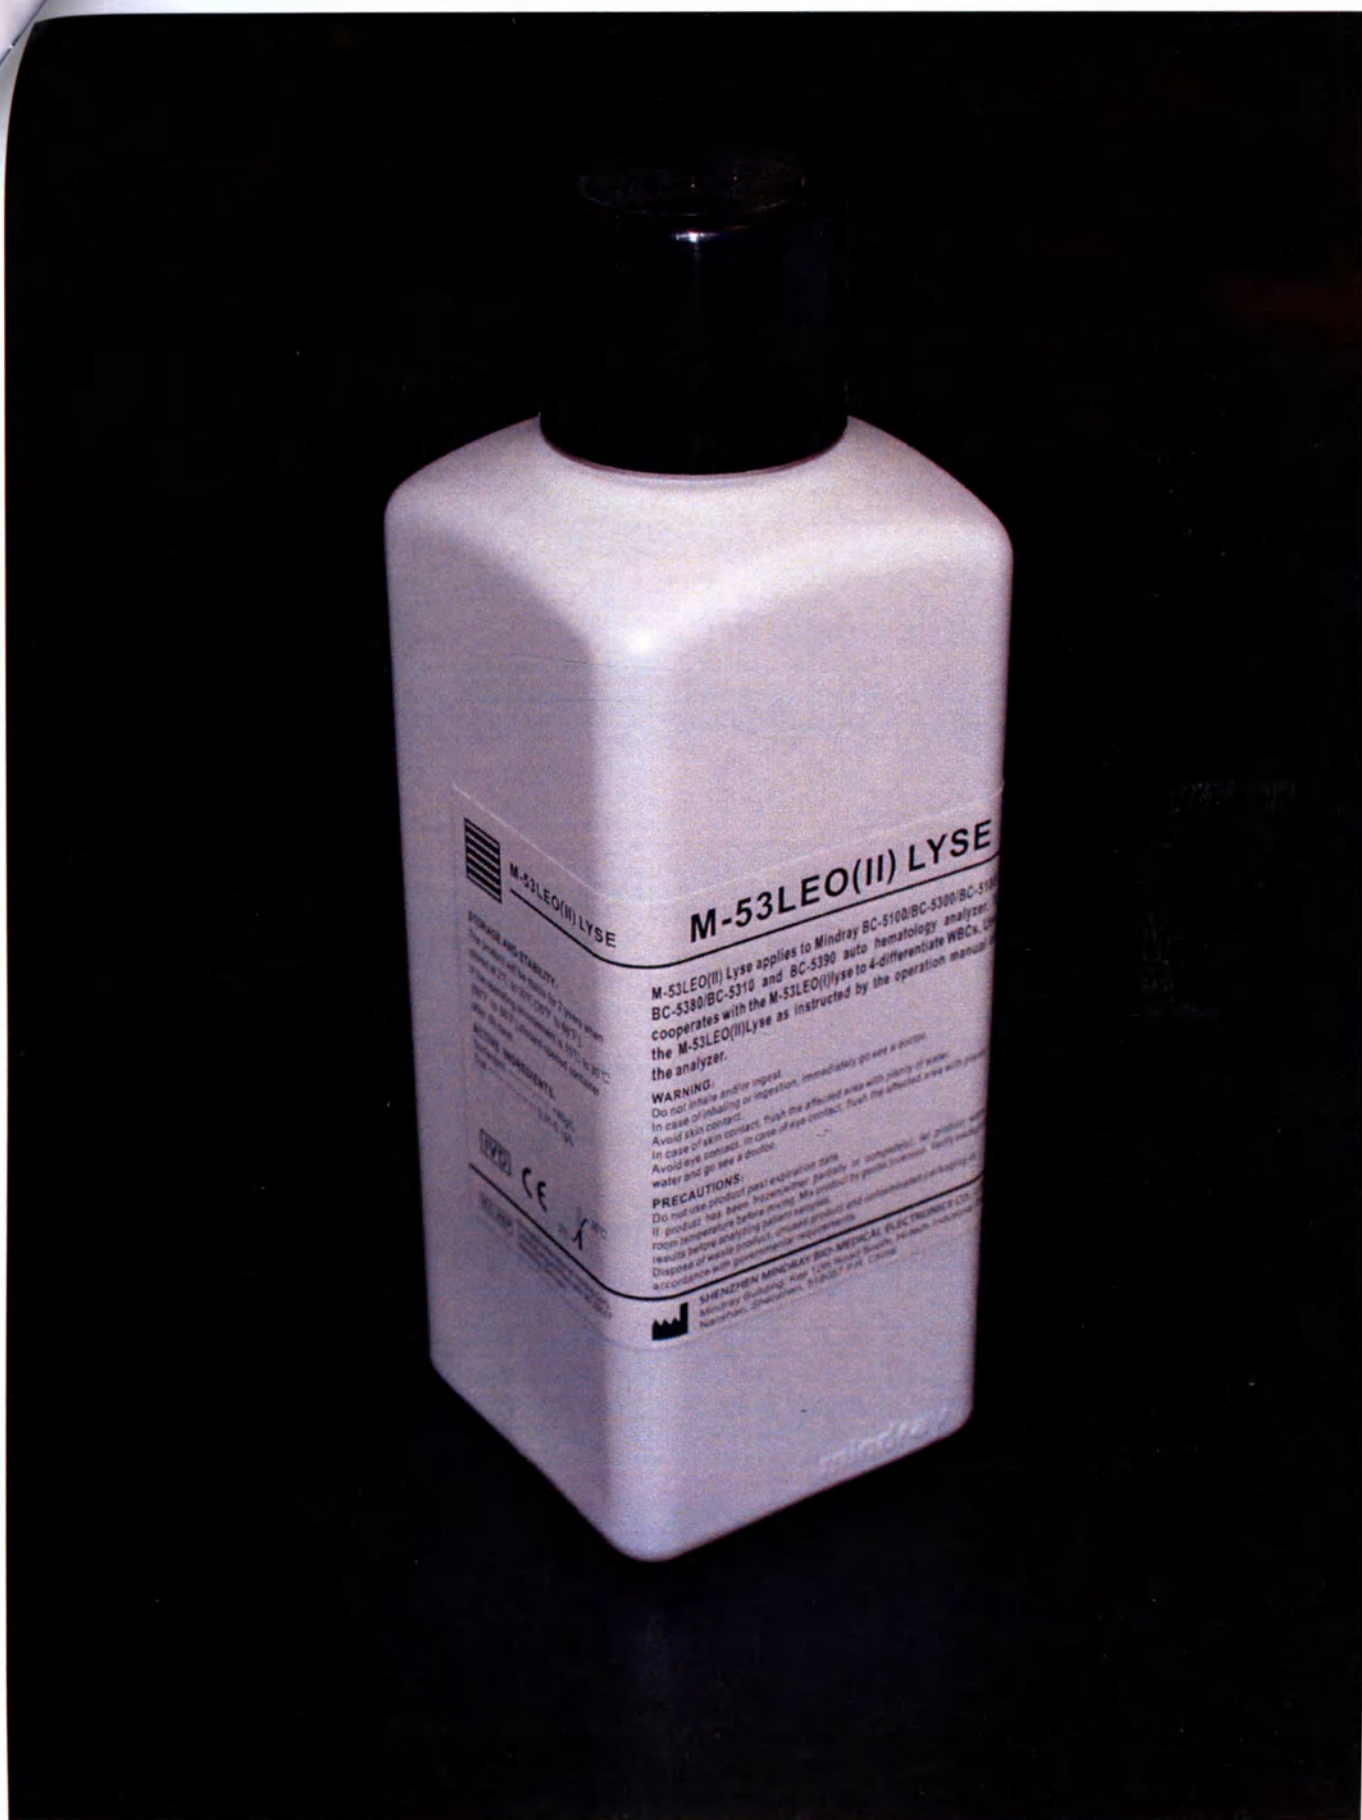

Реагент лизирующий M-53 LEO (II) Lyse - флакон, объемом 200 мл.




Реагент лизирующий М-53 LH Lyse - флакон, объемом 200 мл.




Диск с программным обеспечением




Кабель сетевой для соединения с компьютером

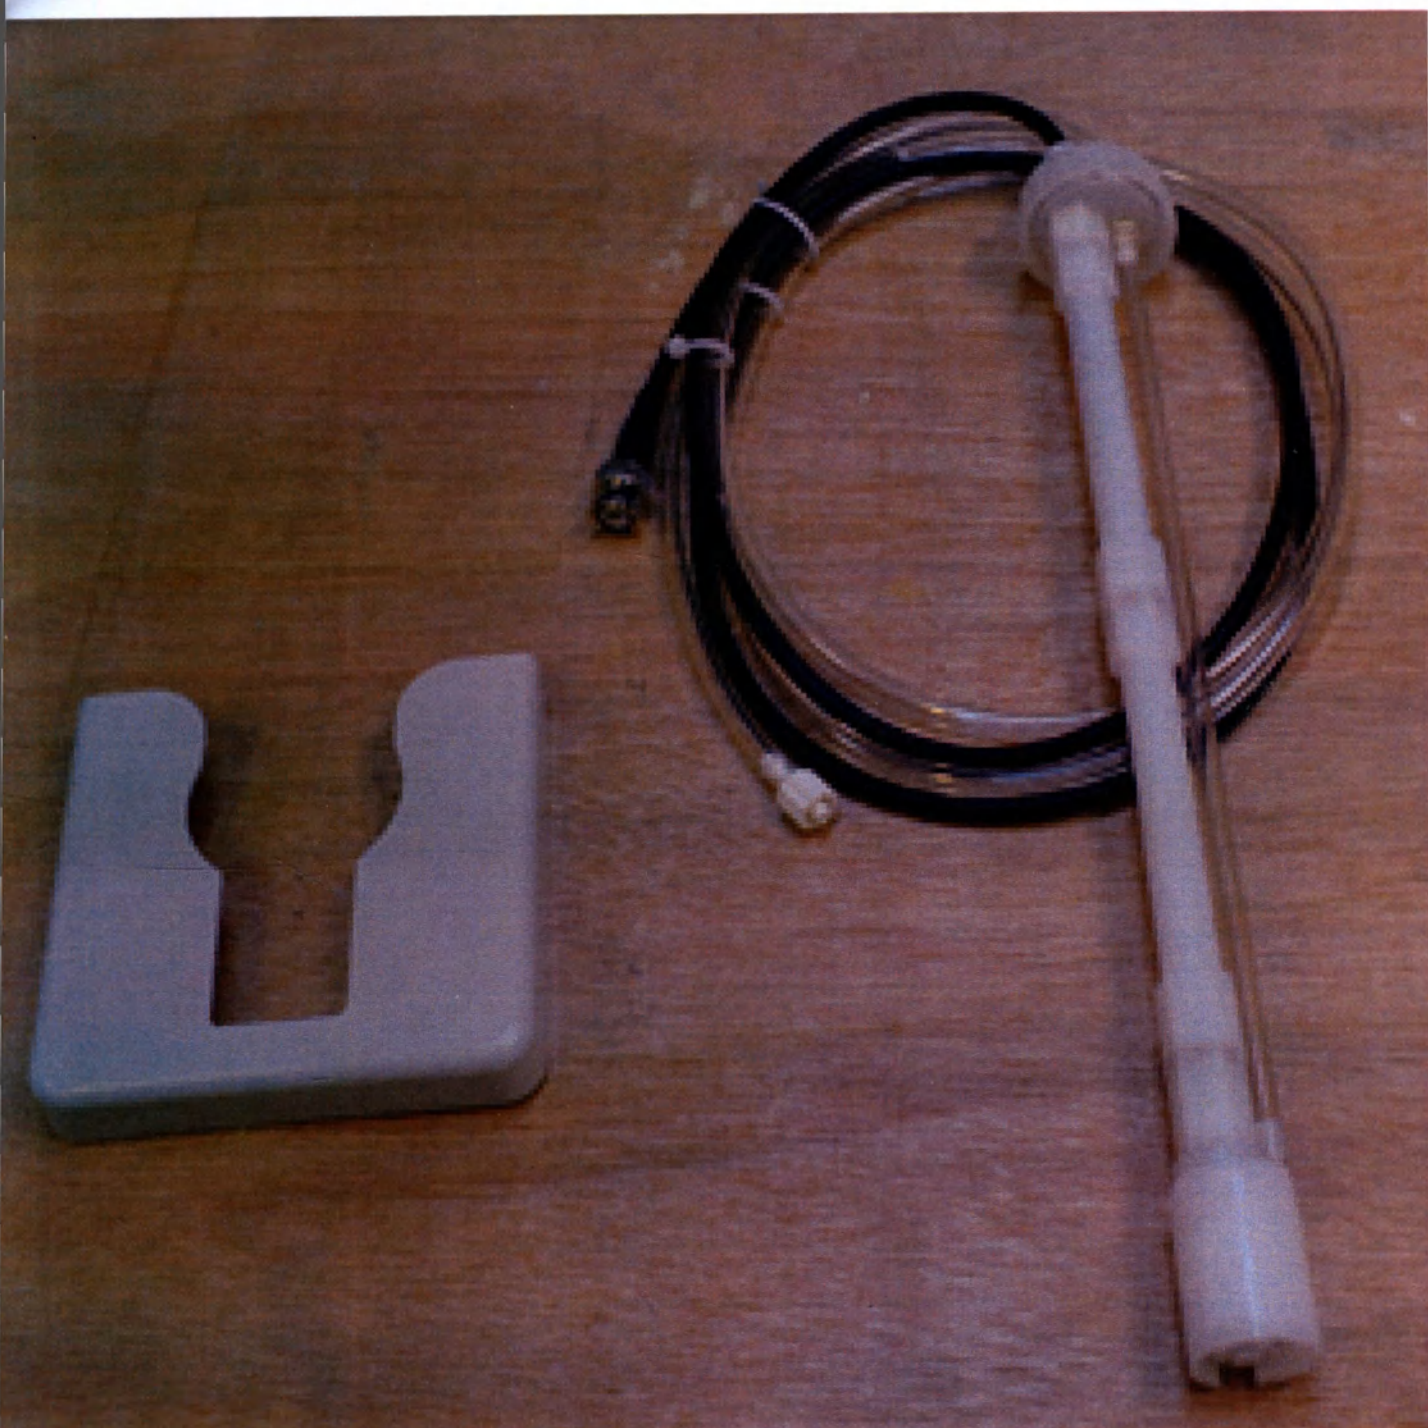

Сборка крышки флакона для дилюента

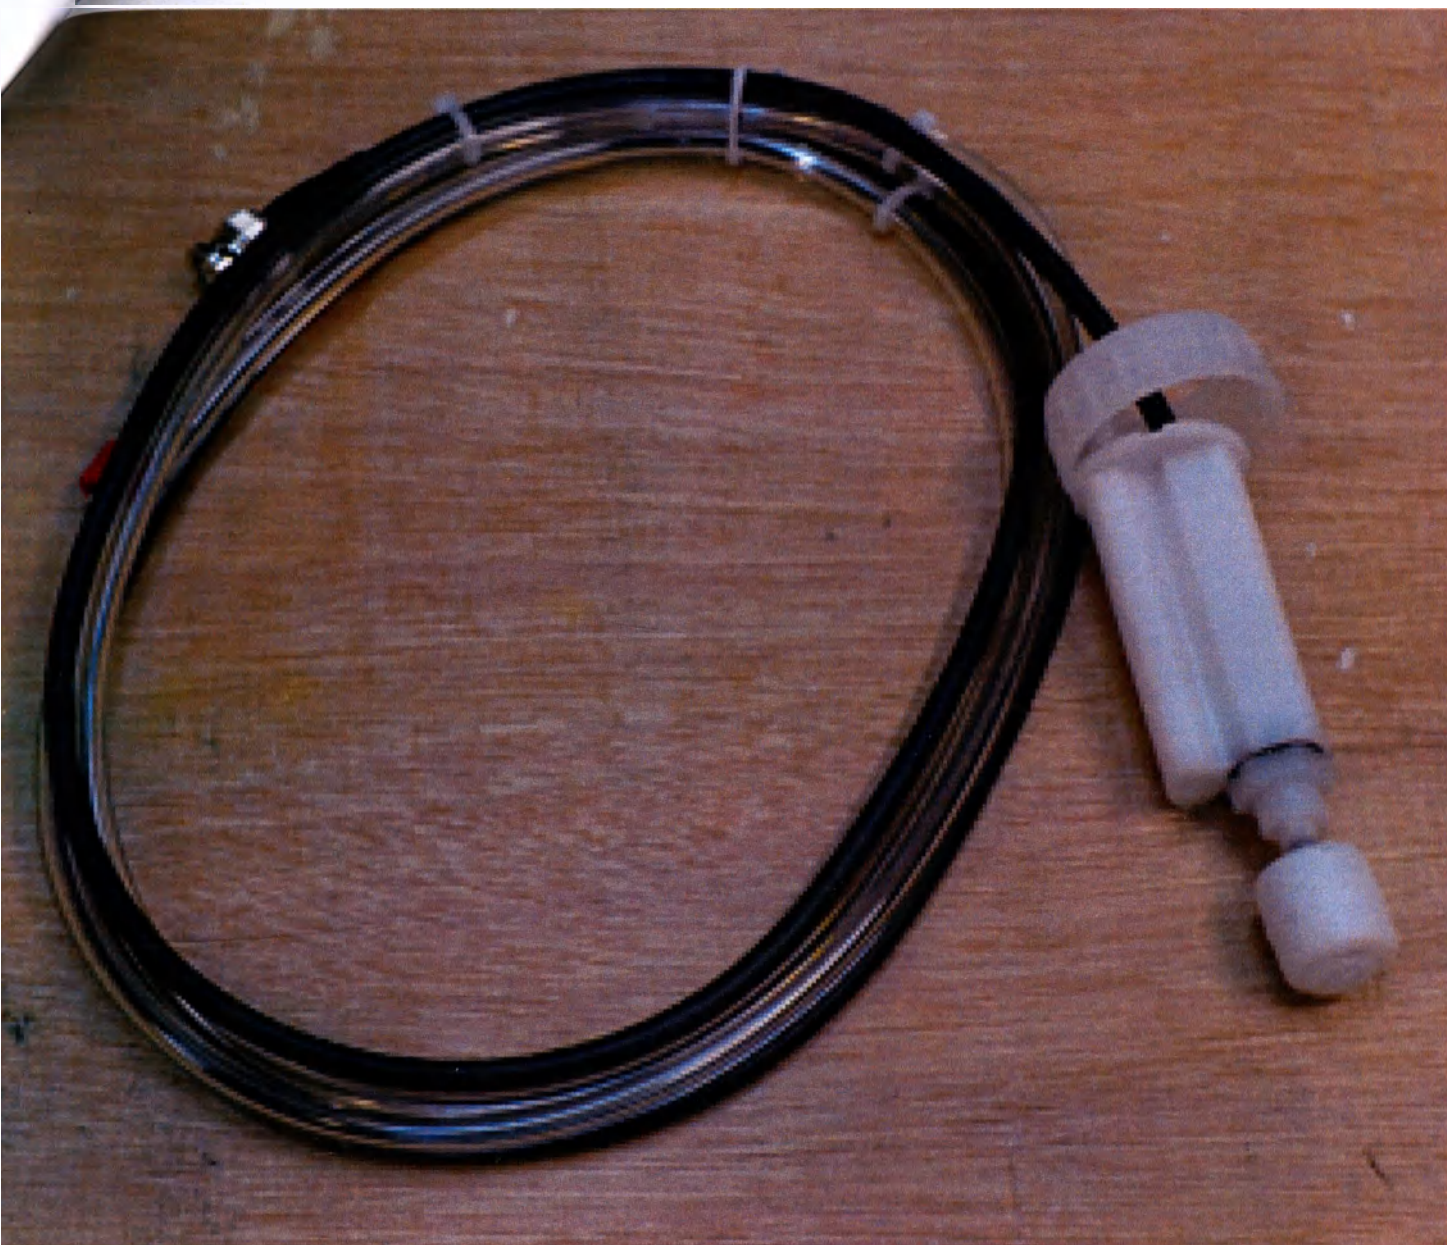

Сборка крышки флакона для отходов

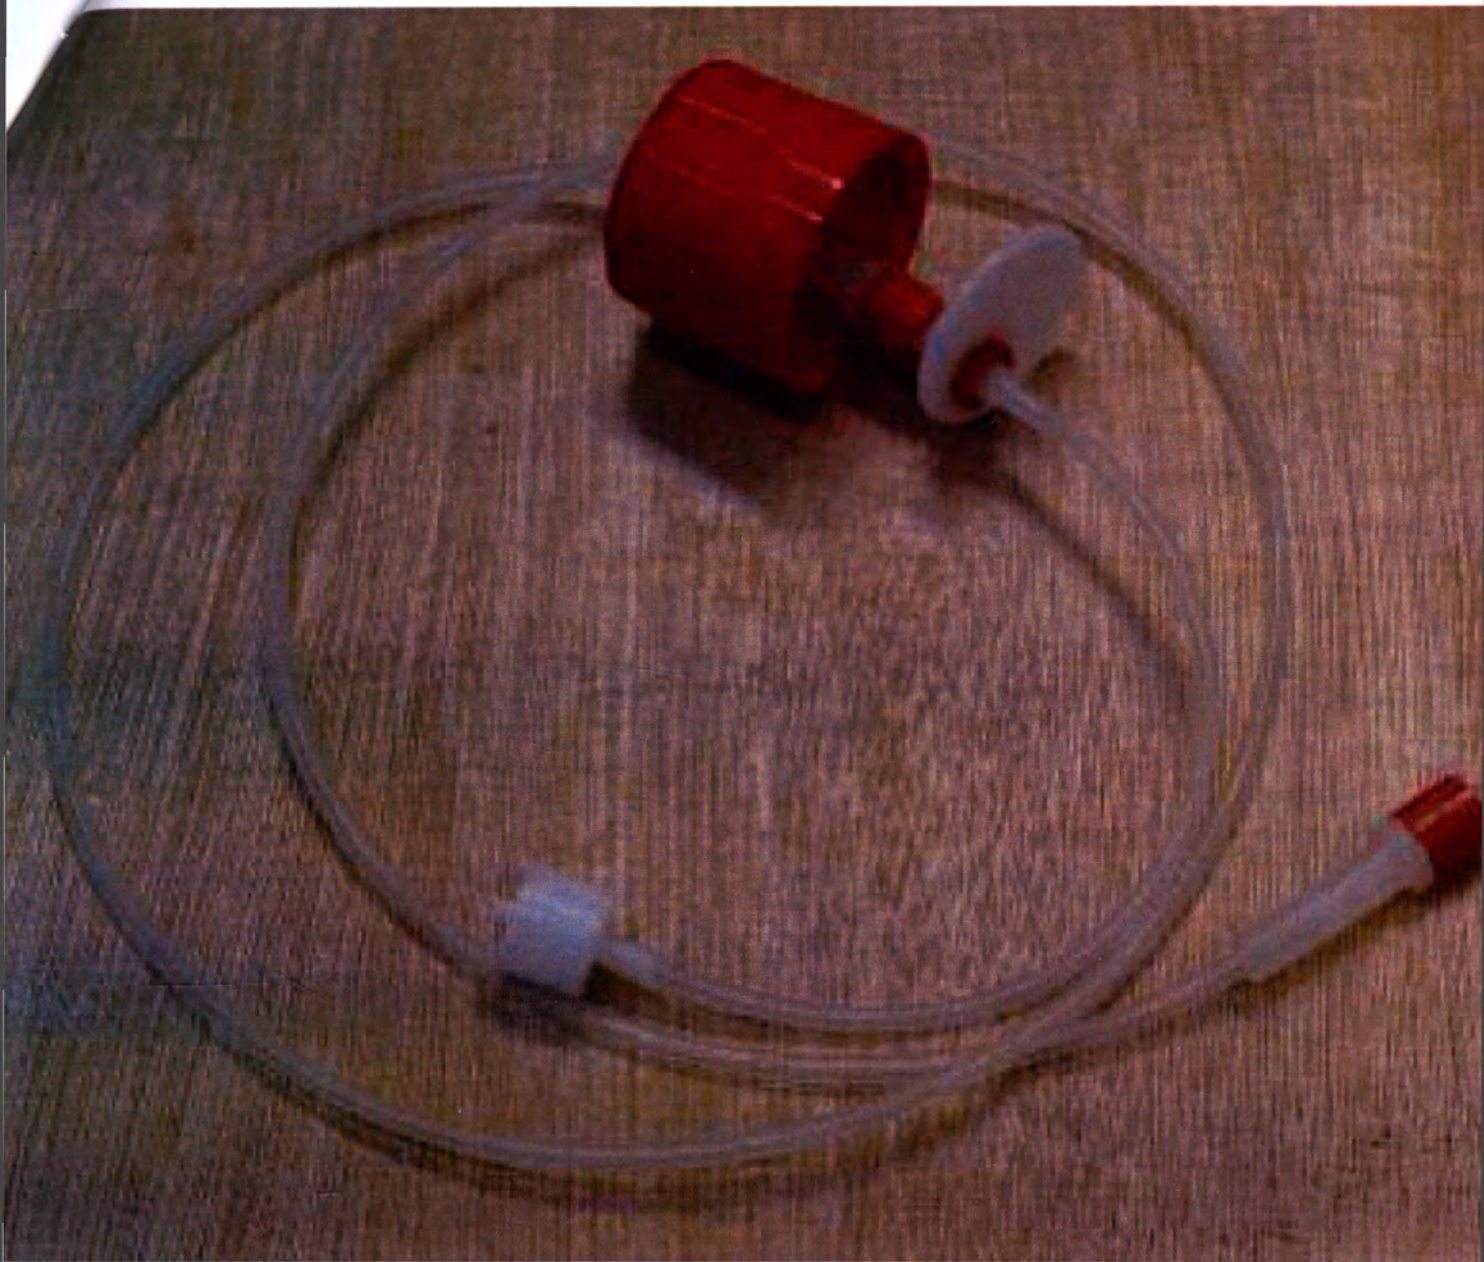

Сборка крышки флакона для лизирующего реагента LEO(I) Lyse




борка крышки флакона для лизирующего реагента LEO(II) Lyse



Сборка флакона для лизирующего реагента LH Lyse


Принадлежности:

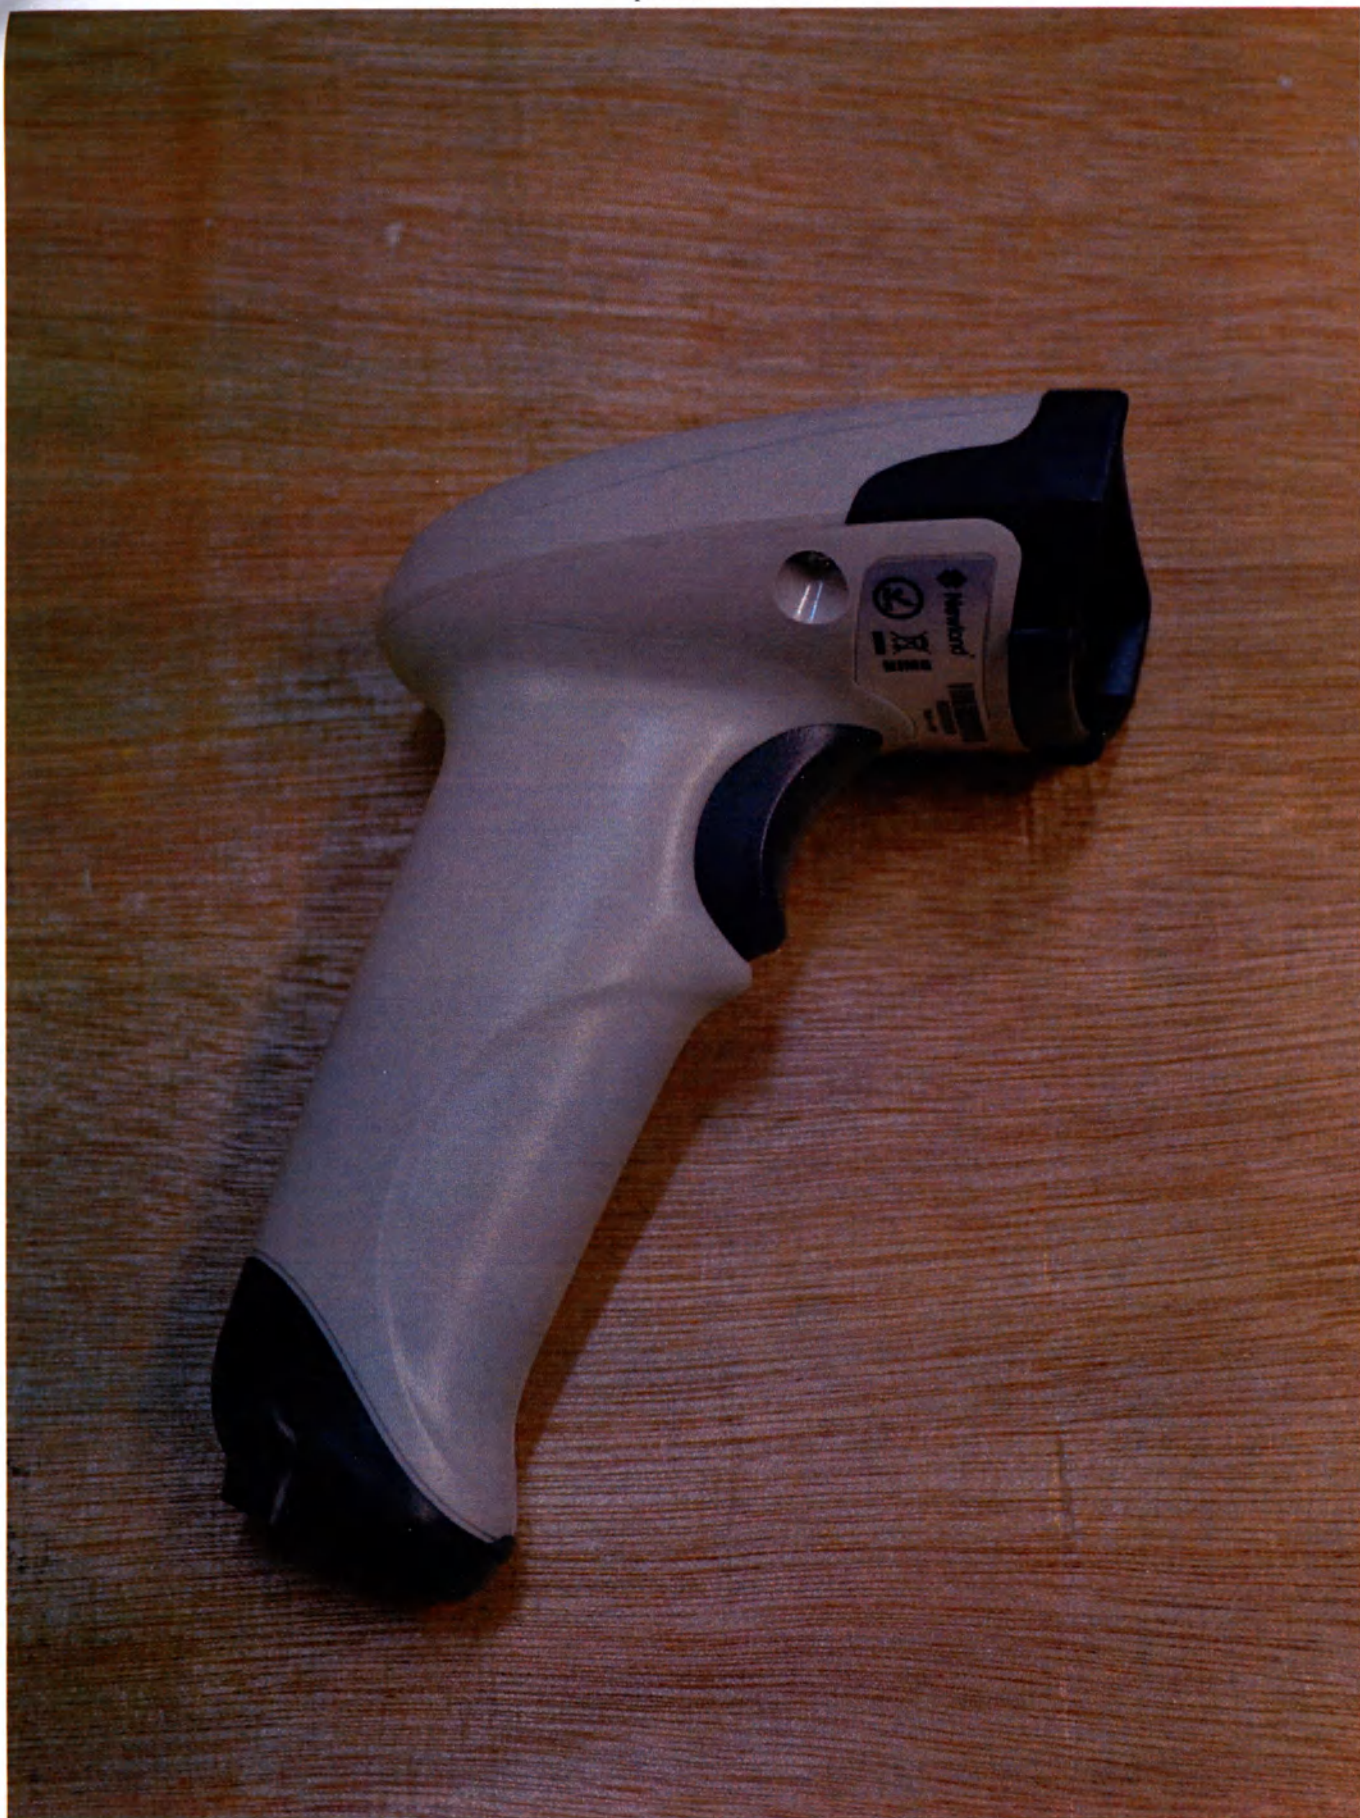

Сканер штрих-кодов



Адаптер пробирок

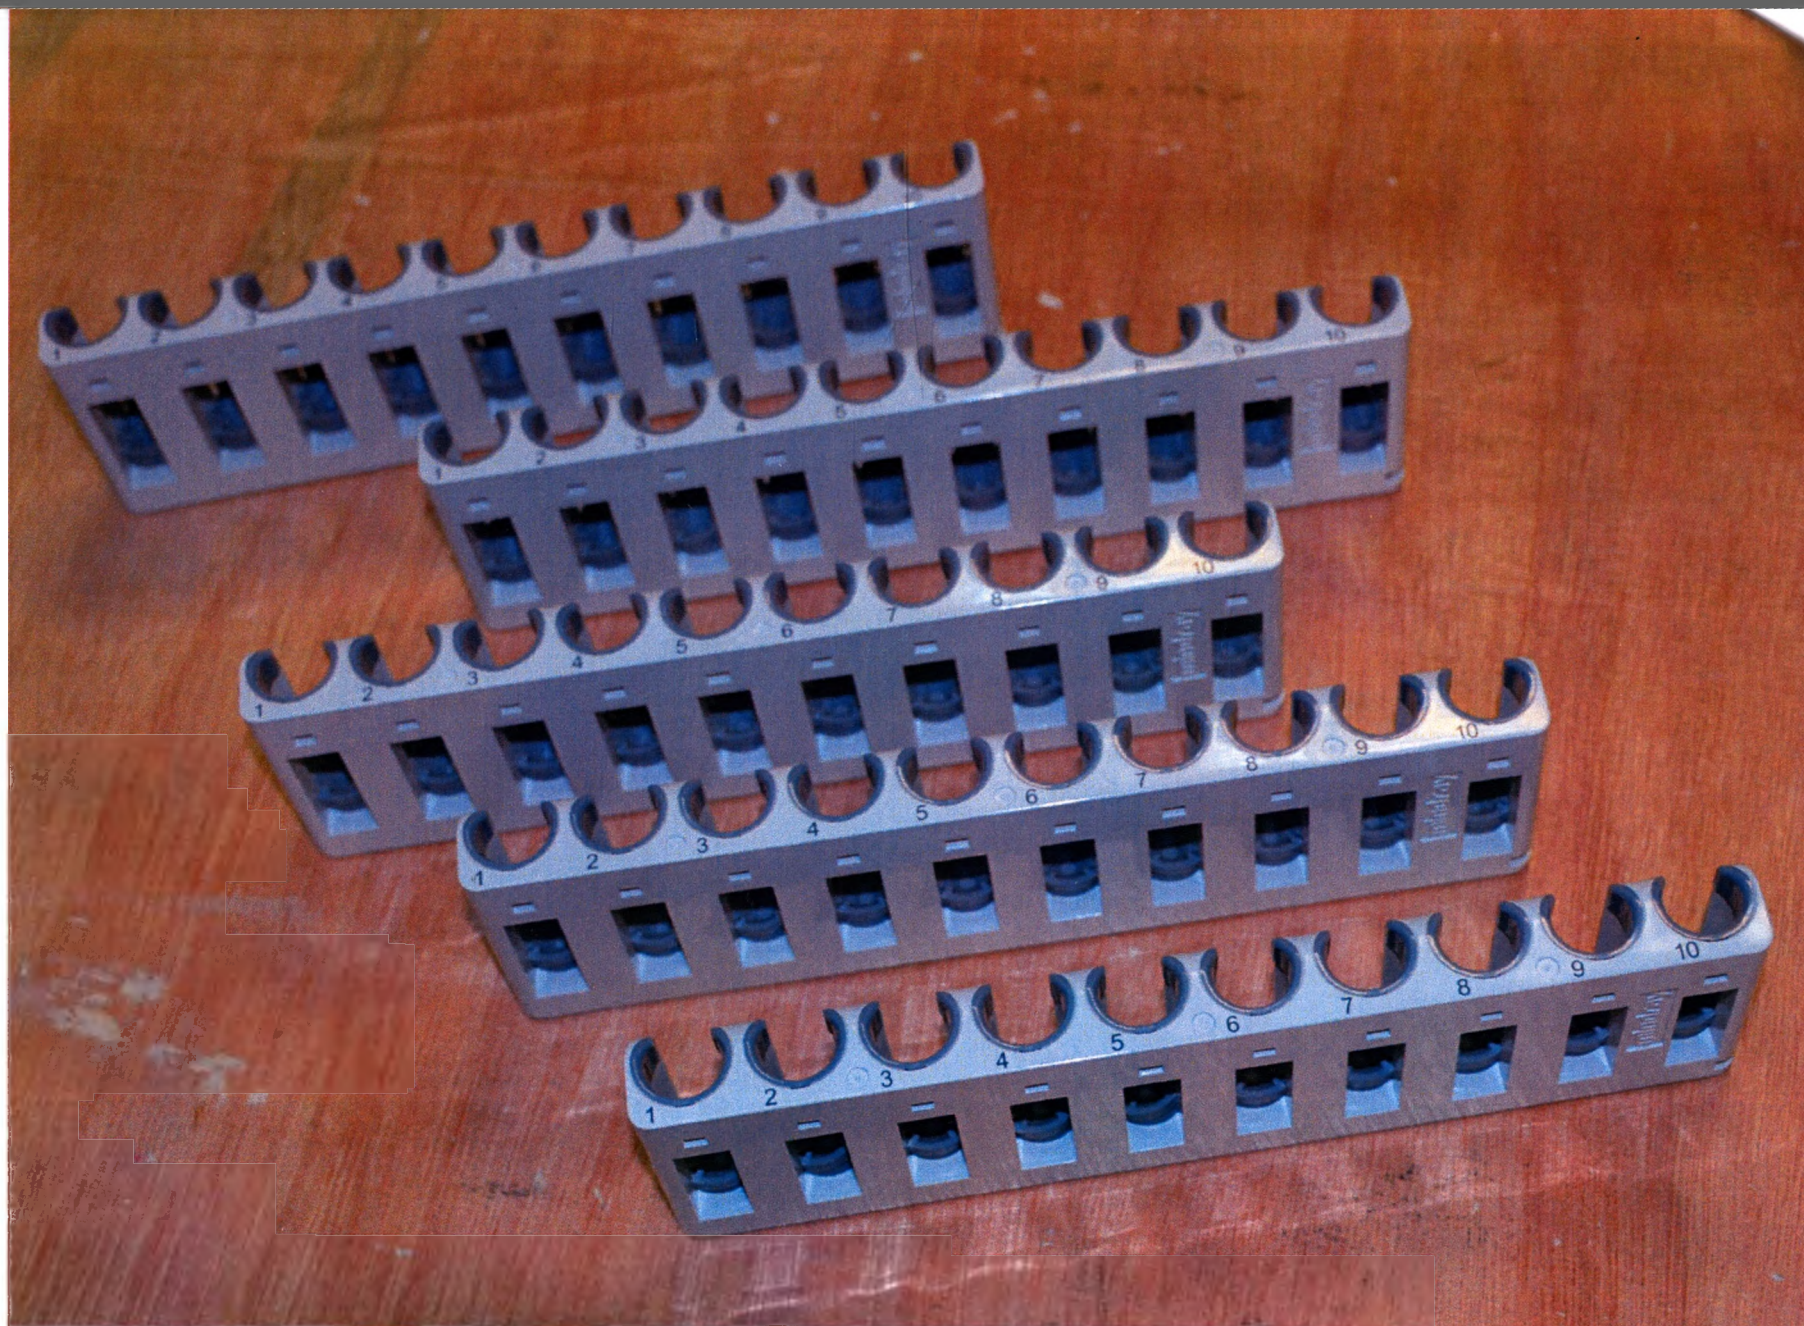

Штатив для пробирок, 5 штук

Handwritten signature

