


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Носова Т.А.

24.04.2020 г.



Фотографические изображения изделия:

Набор калибраторов для количественного определения общего простатспецифического антигена (total prostate specific antigen (t-PSA CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд.»), Китай

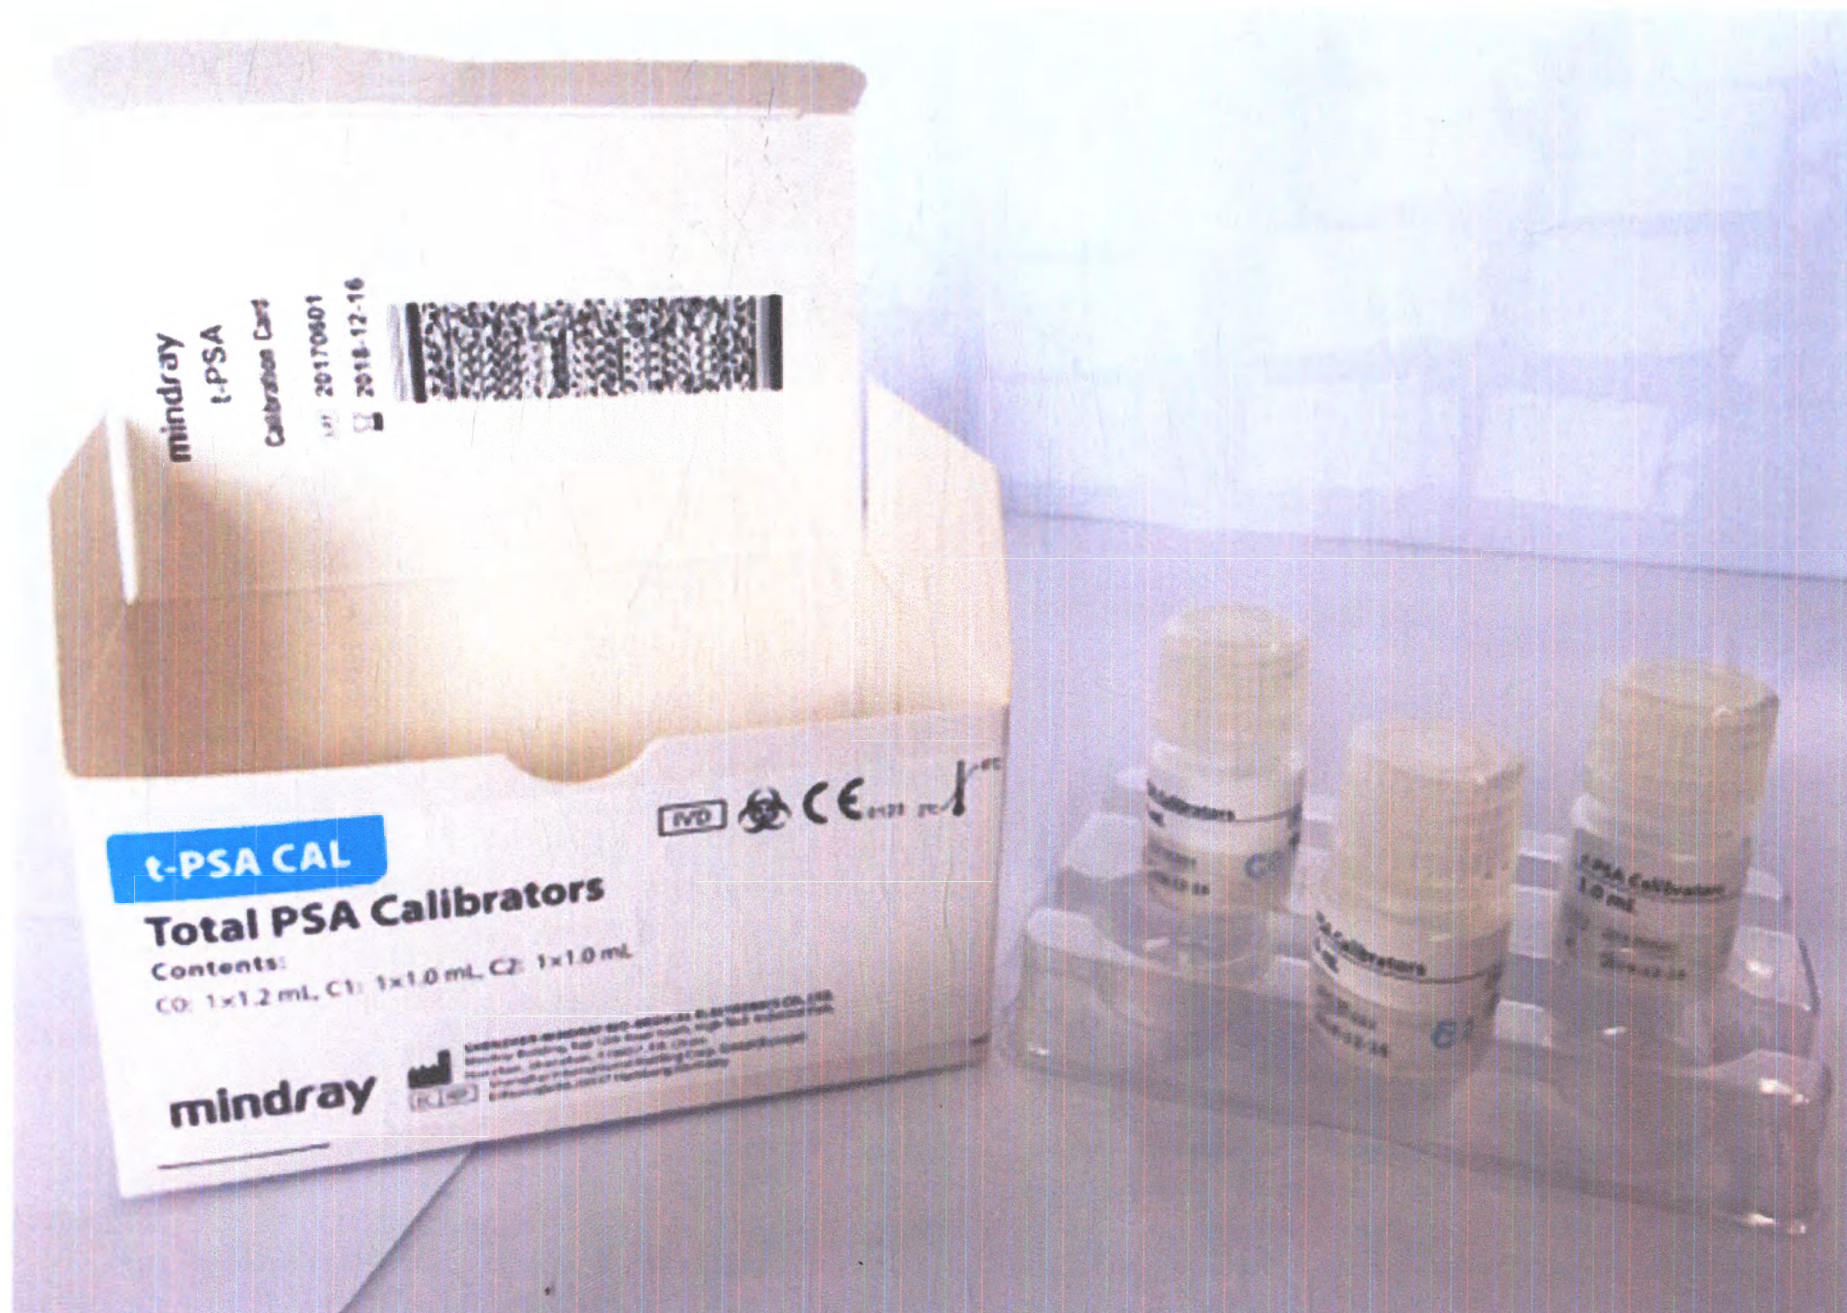



Общий вид медицинского изделия (Набор калибраторов для количественного определения общего простат- специфического антигена (total prostate specific antigen (t-PSA CAL)) иммунохемилюминесцентным методом в клиническом образце на анализаторах серии CL для диагностики in vitro, в варианте исполнения t-PSA211)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 3 листа (-ов)

Генеральный Директор Носова Т.А.
М.П.

