

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»



Носова Т.А.

30.04.2020

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

*Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный для диагностики in vitro
серии CL с принадлежностями*

Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. («Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал
Электроникс Ко., Лтд.»), Китай

2020

-Блок анализатора CL-1000i




Дозатор в сборе



Кабель сетевой




Штатив для проб

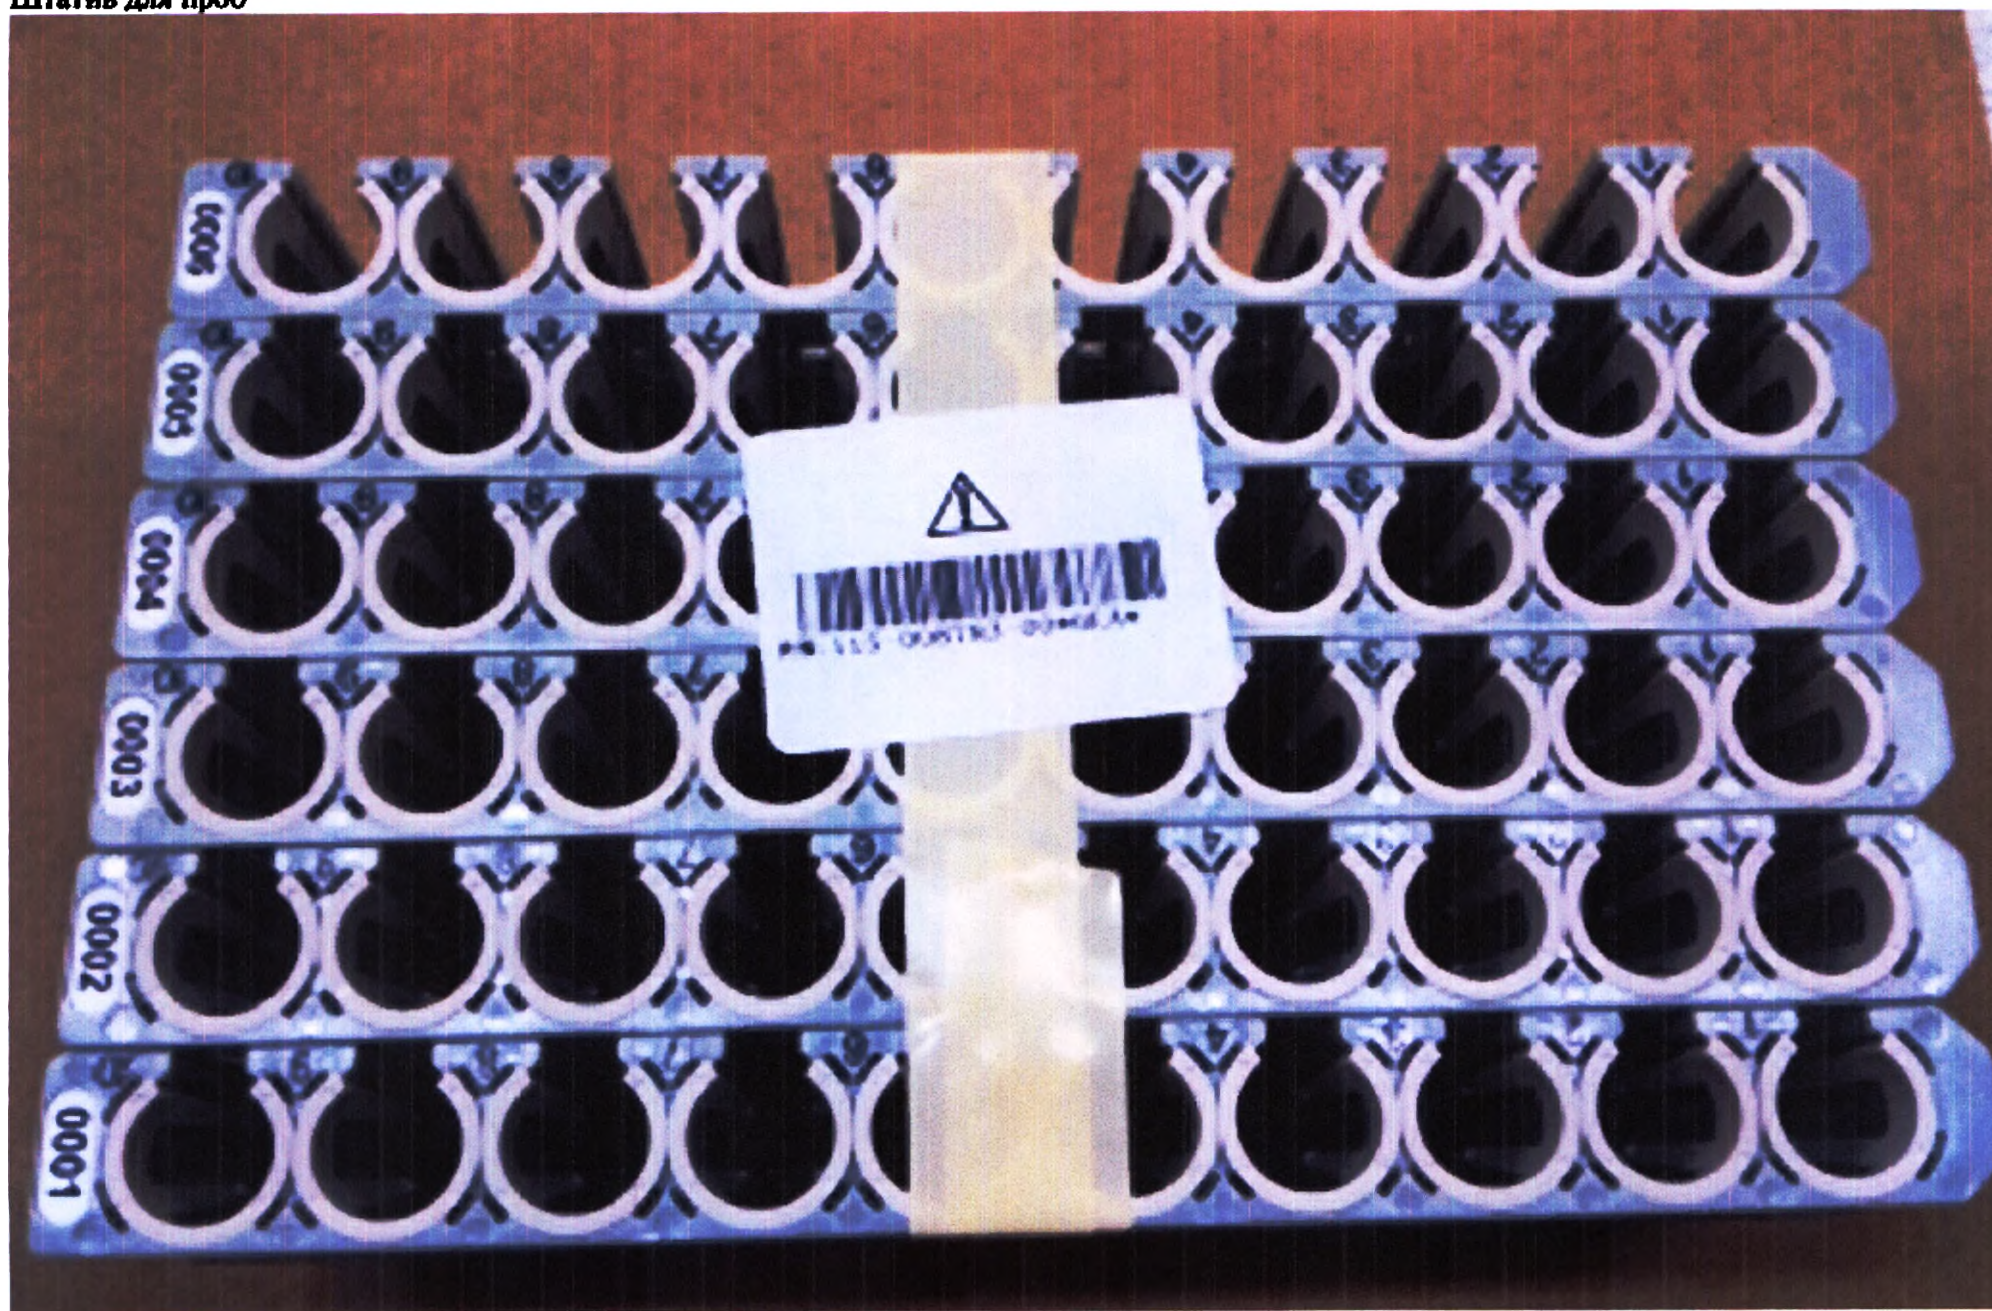

Винт М4х12



Микропробирка 2.0 мл

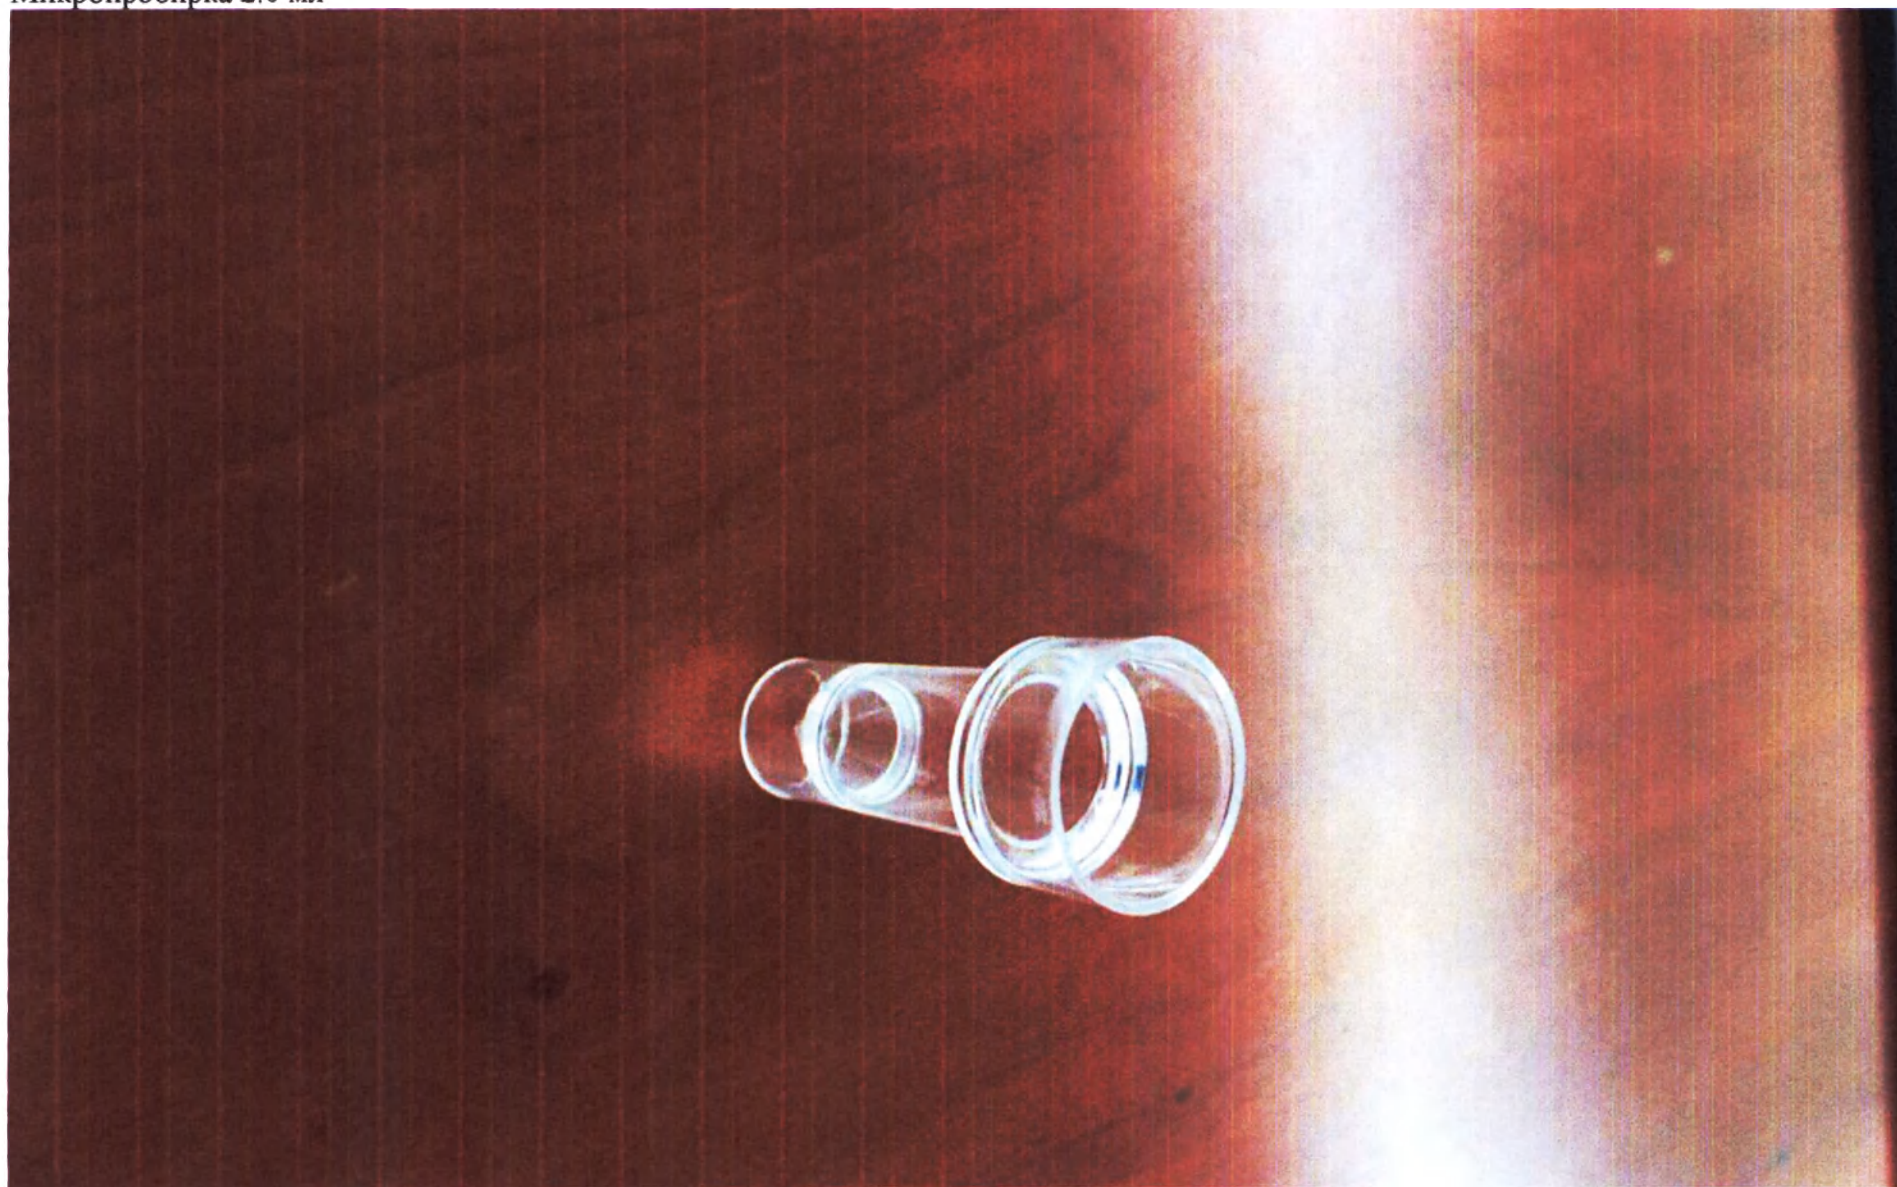


Стяжка кабельная



-Крышка резиновая



-Инструмент для очистки диспергаторов (устройство для прочистки и шприц)

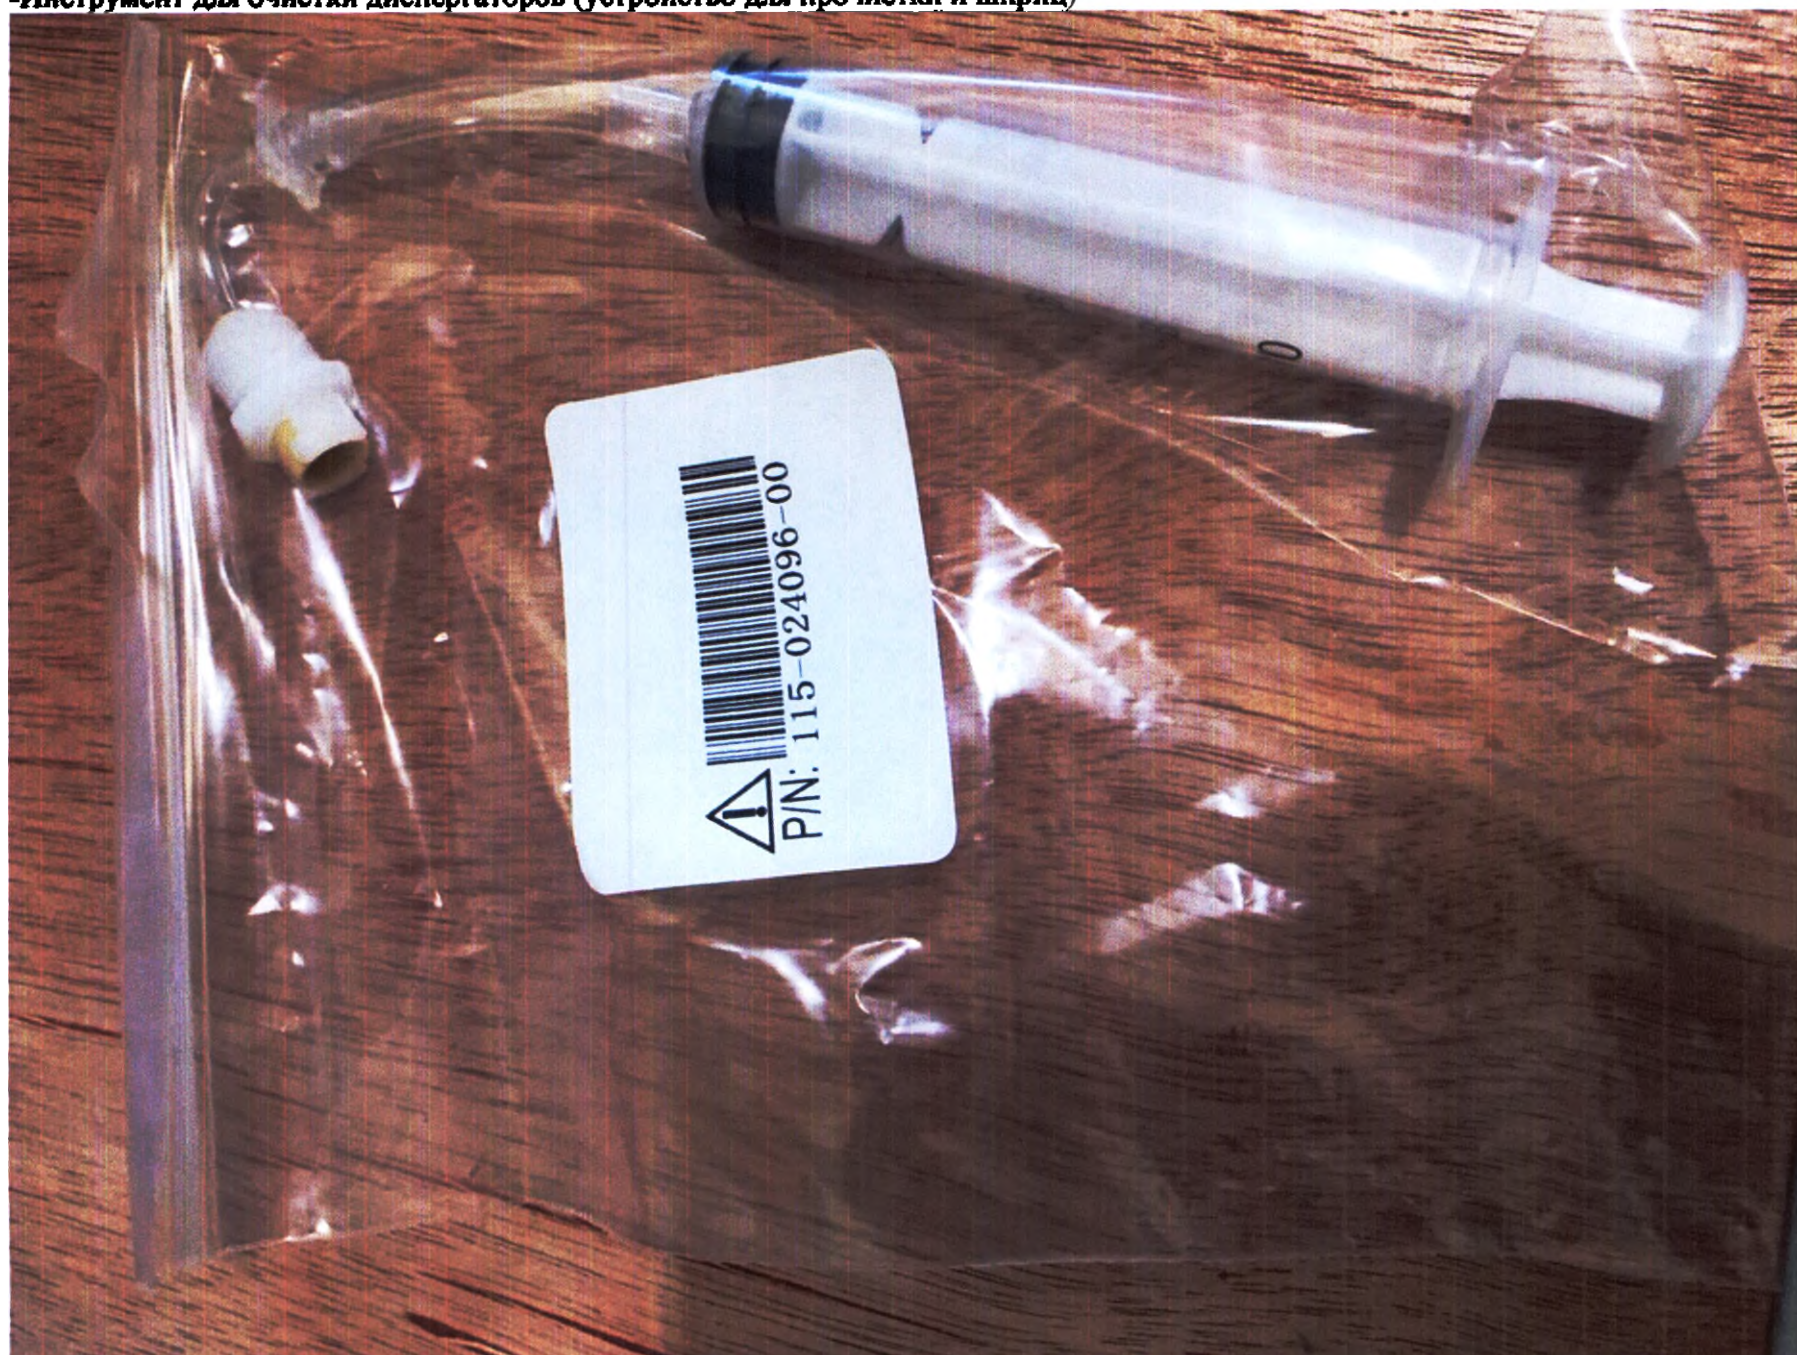

Контейнер твердых отходов-



-Кабель питания



-Сканер штрихкодов ручной (фотографическое изображение №1)



Сканер штрихкодов ручной (фотографическое изображение №2)



-Микропробирка 0.5 мл



-Инструмент для очистки диспергаторов



-Шайба шприца




Держатель штатива для проб




-Винт М4 х 8



Наклейки со штрихкодом (50 штук)

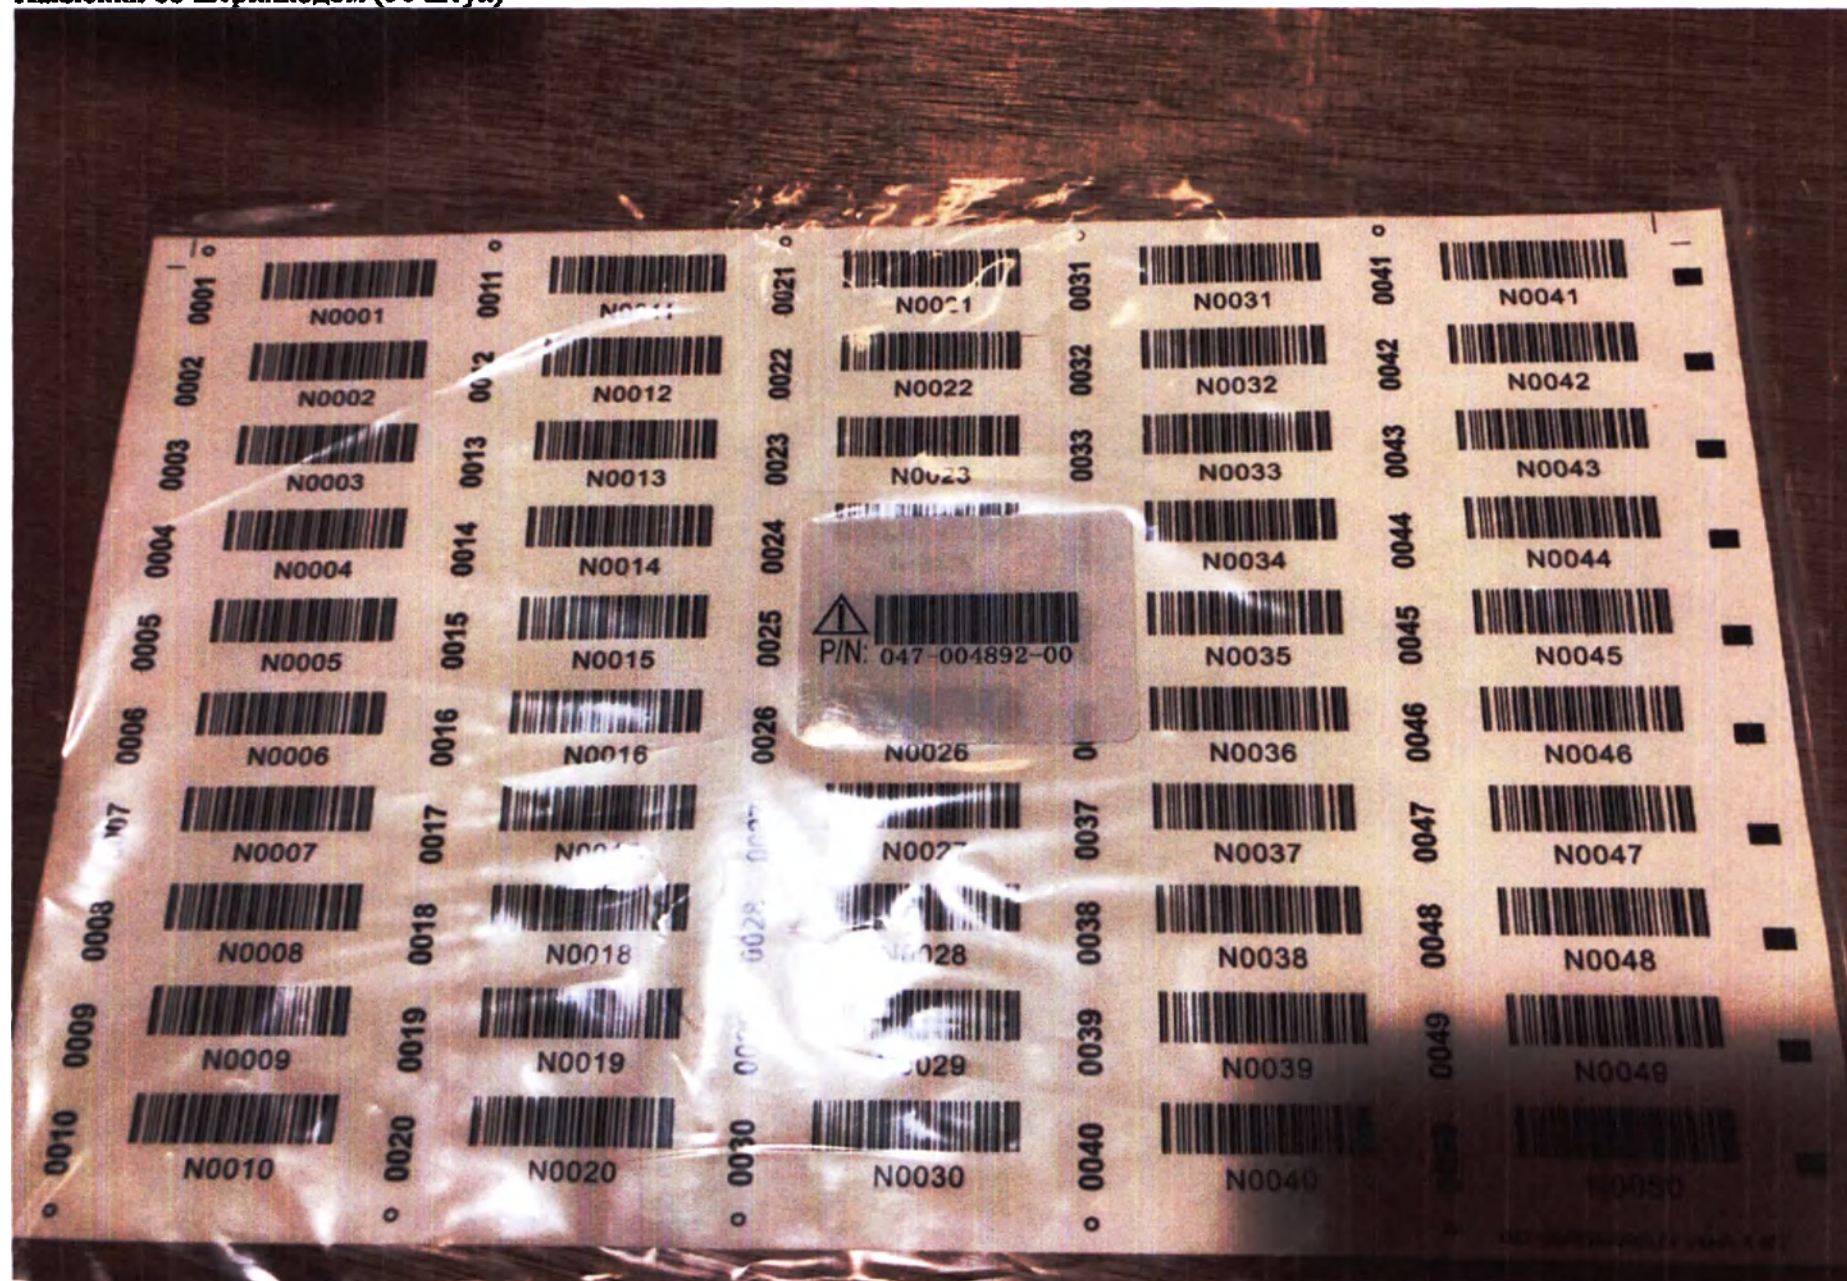

-Лоток с кюветами (88 кювет)

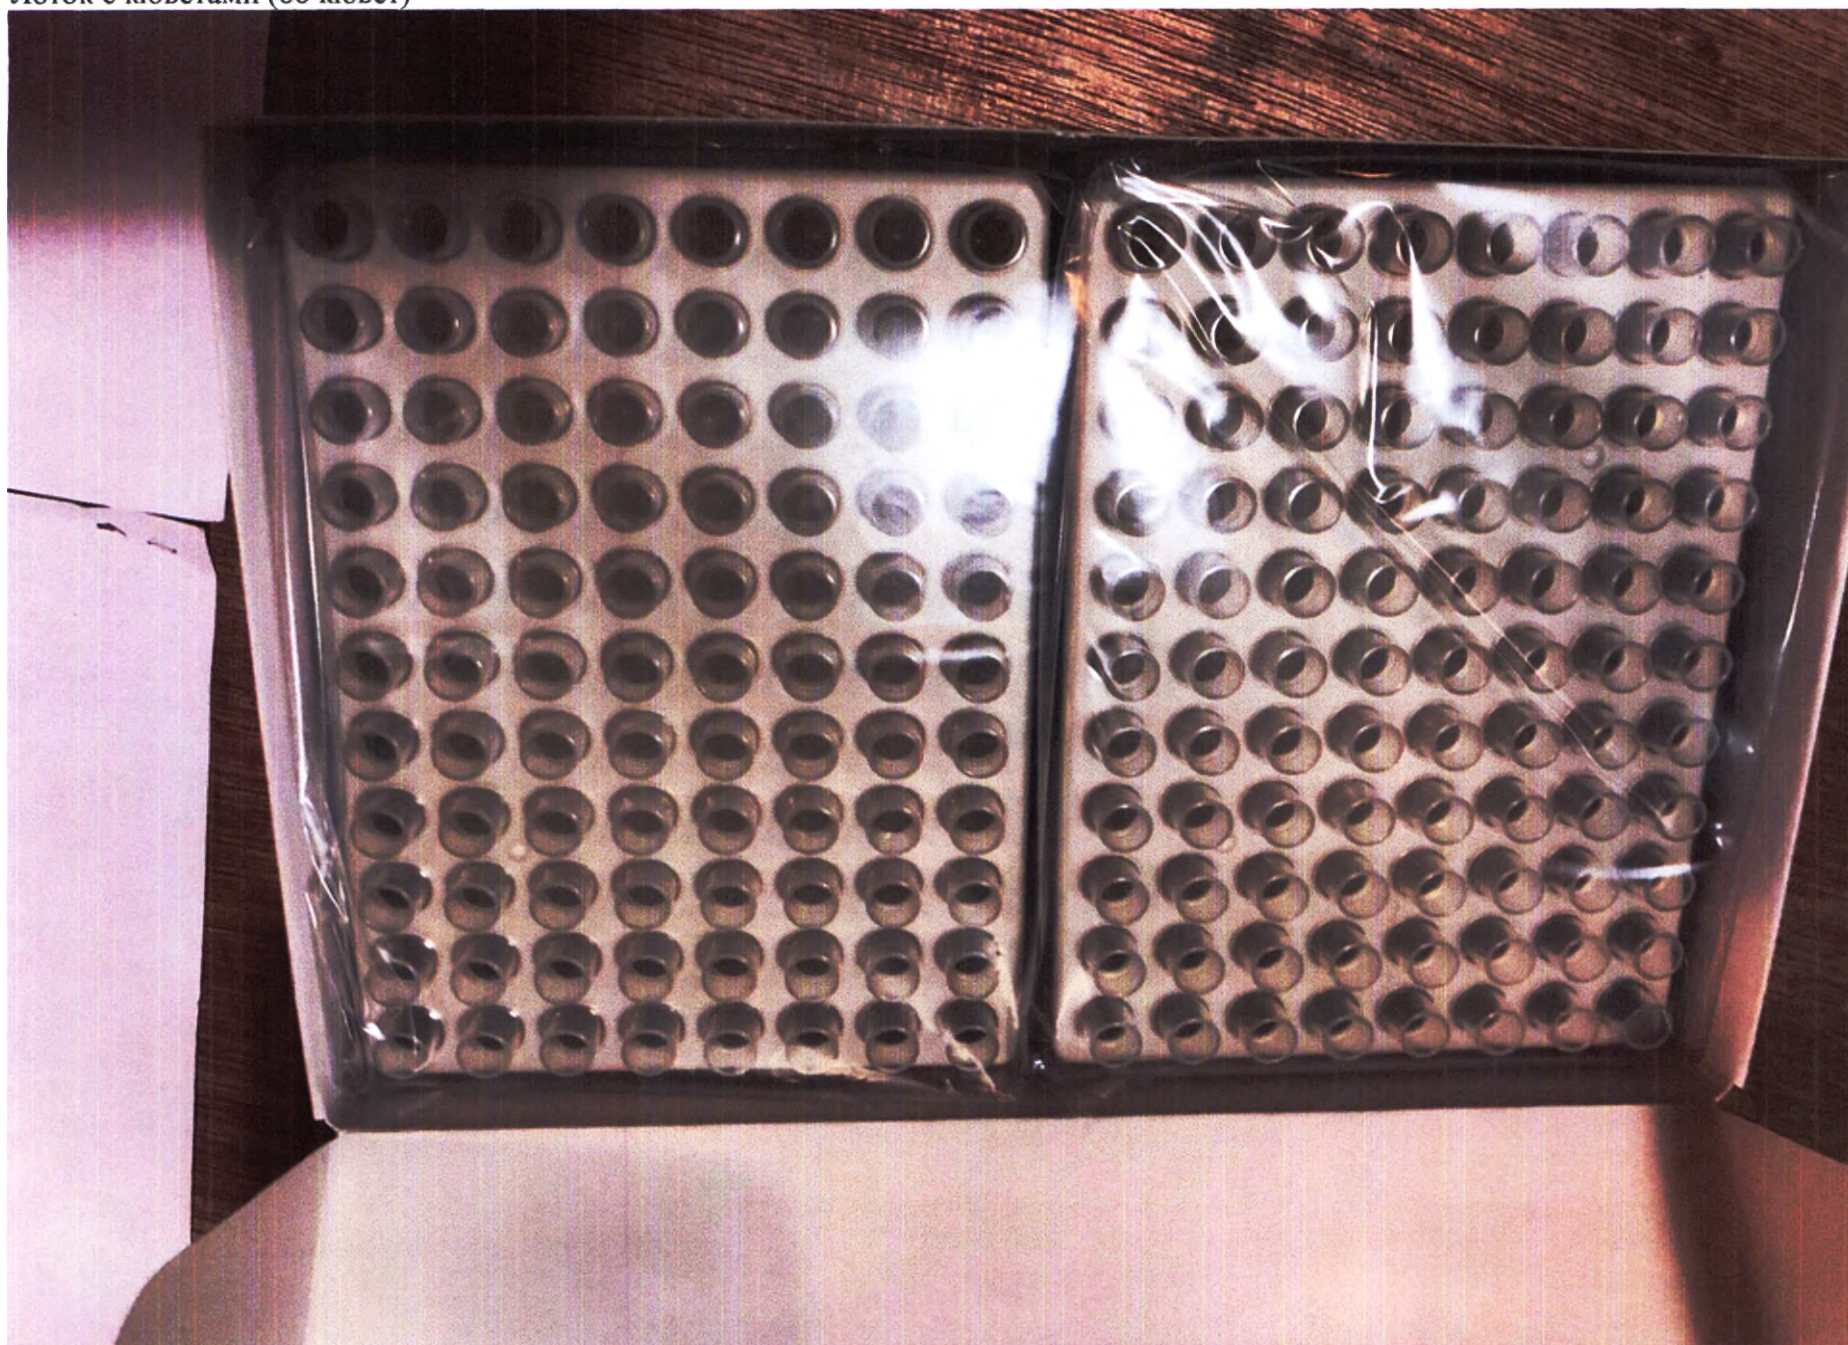

-Диск установочный с программным обеспечением CL-1000i



-Крышка для отверстий





-Пробка ПВХ (10 м)

- Шайба внешняя




- Пластина дисплея



- Крепление для пластины дисплея



- Подставка под клавиатуру в сборе

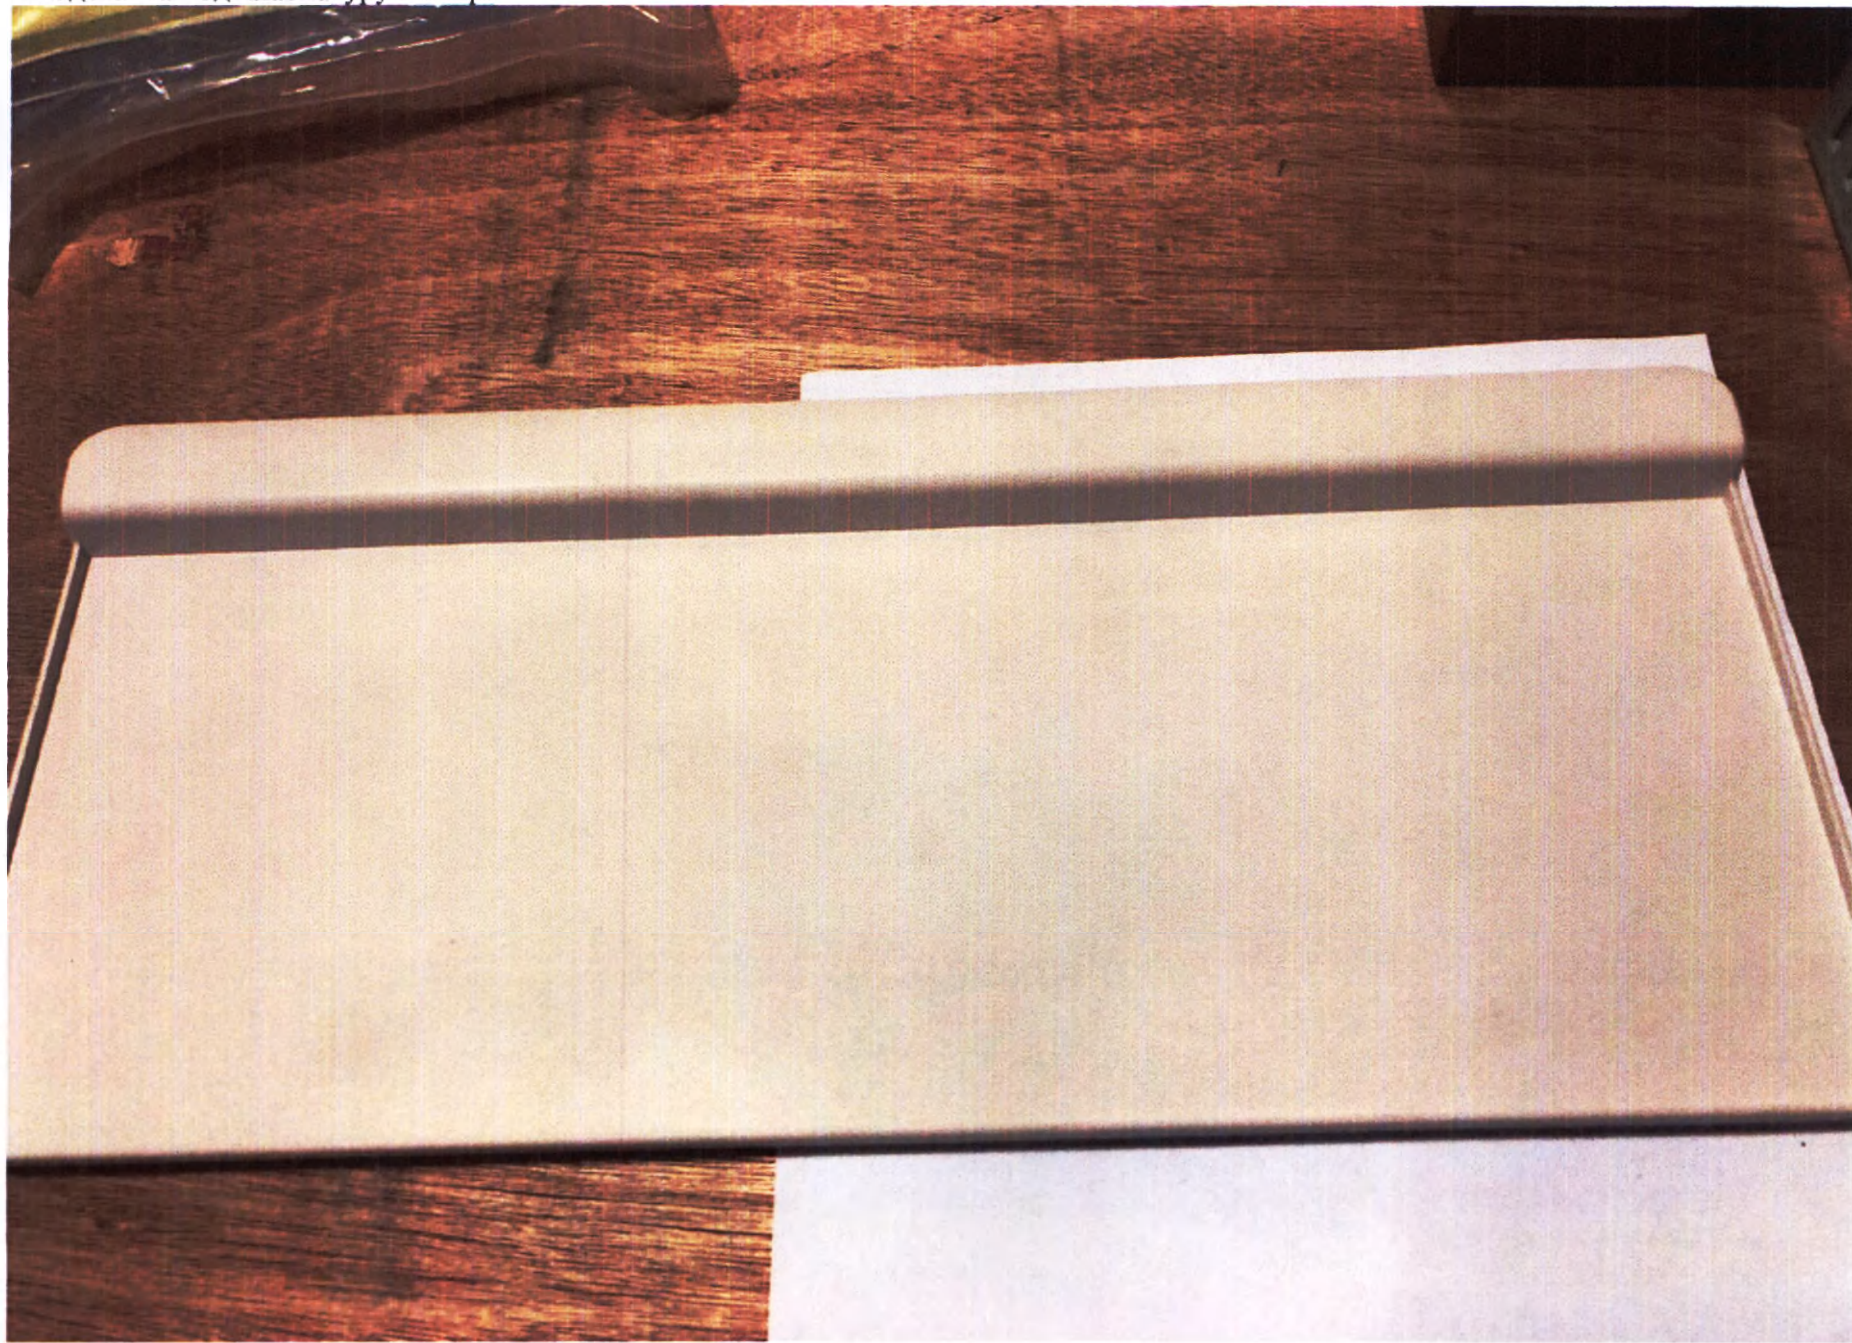

- Винт высокопрочный с потайной головкой и внутренним шестигранником под ключ, М5×12



-Винт крестообразный М4Х16




-Пружинная шайба стандартная



- Винт с шестигранной головкой М4Х16



-Канистра для жидких отходов в сборе

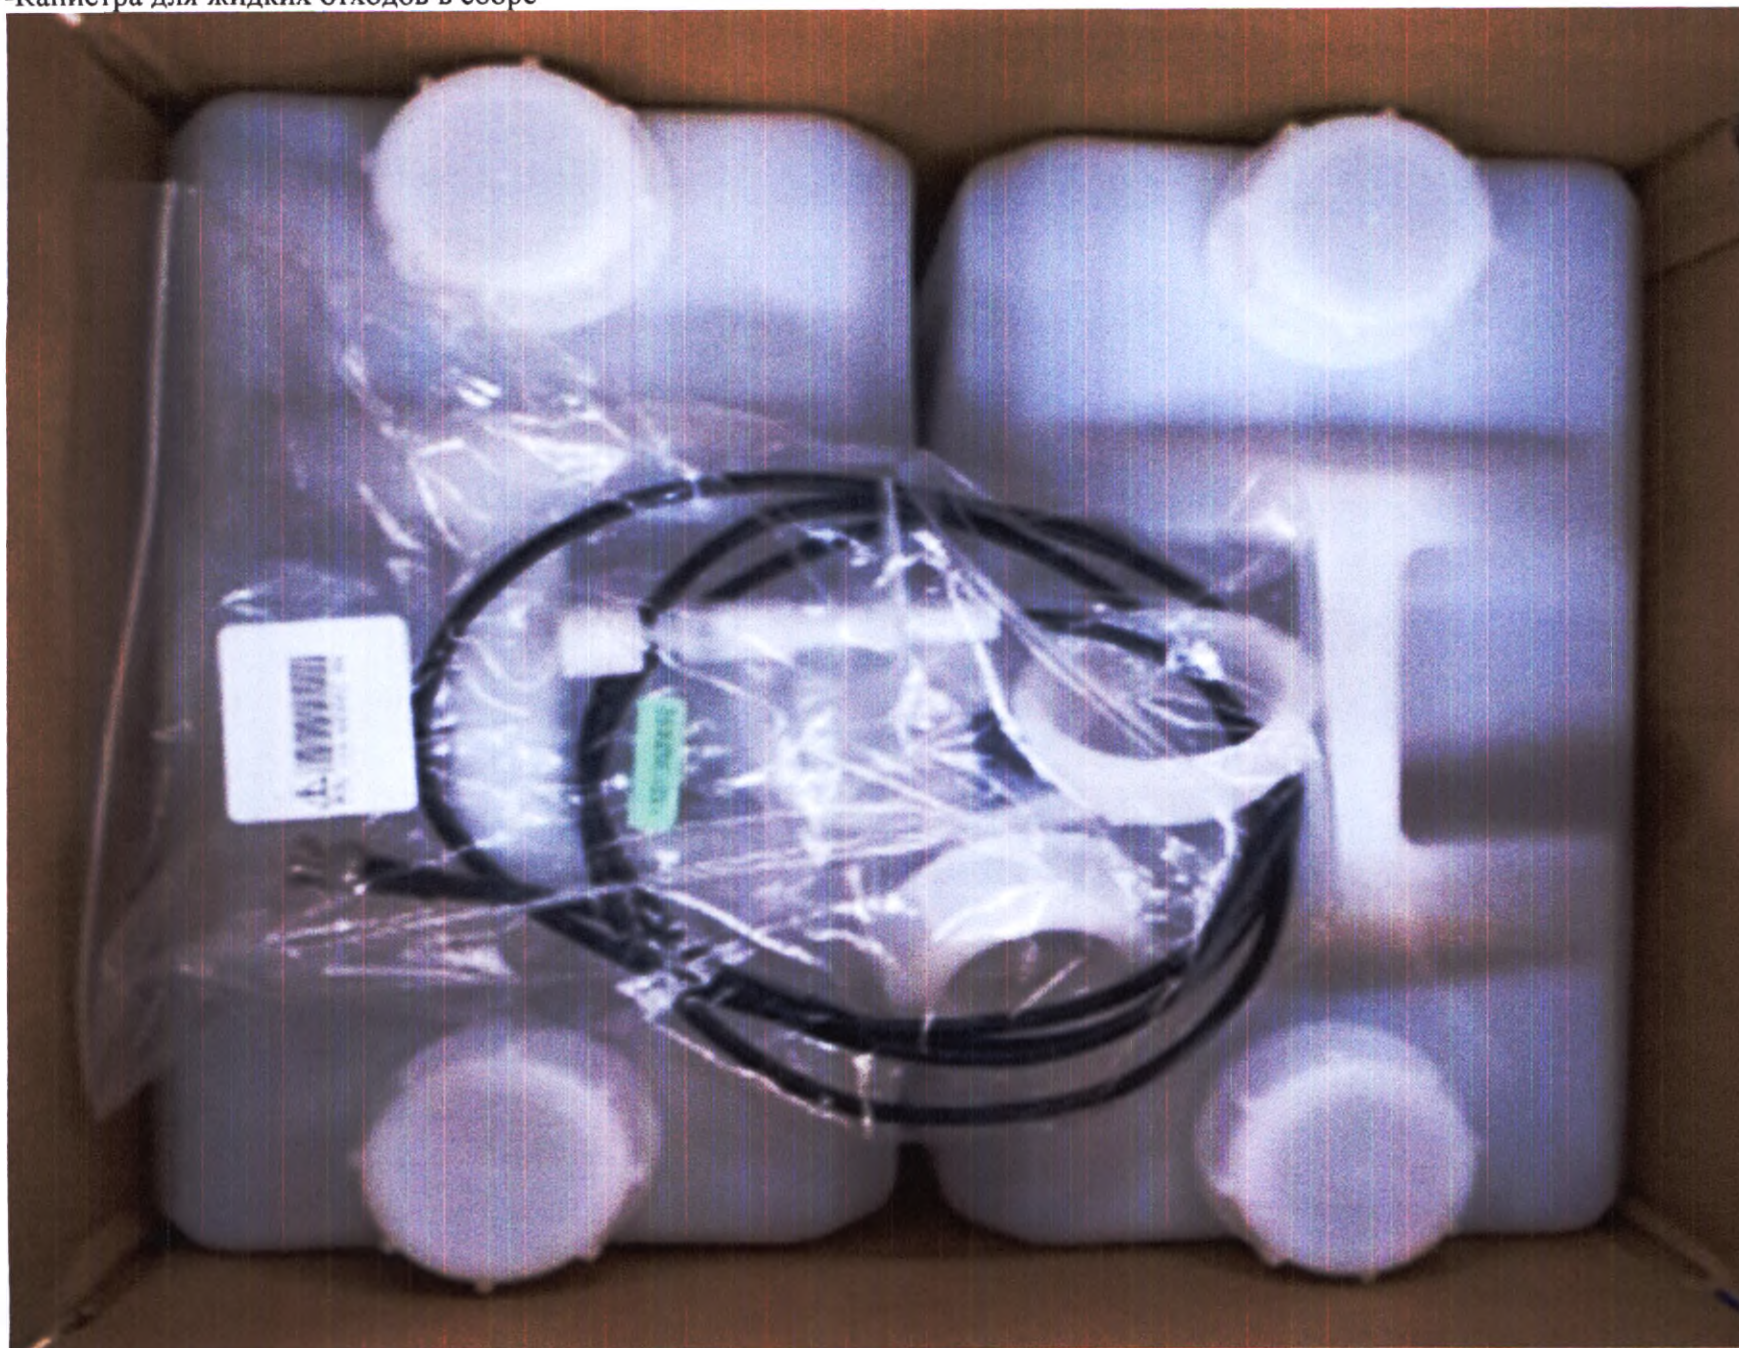

-Канистра пластиковая 15 литров



- Колпачок флакона промывочного буфера в сборе



-Монитор сенсорный с ЖК дисплеем 17"




-Разбавитель для проб (auto)






-Раствор промывочный

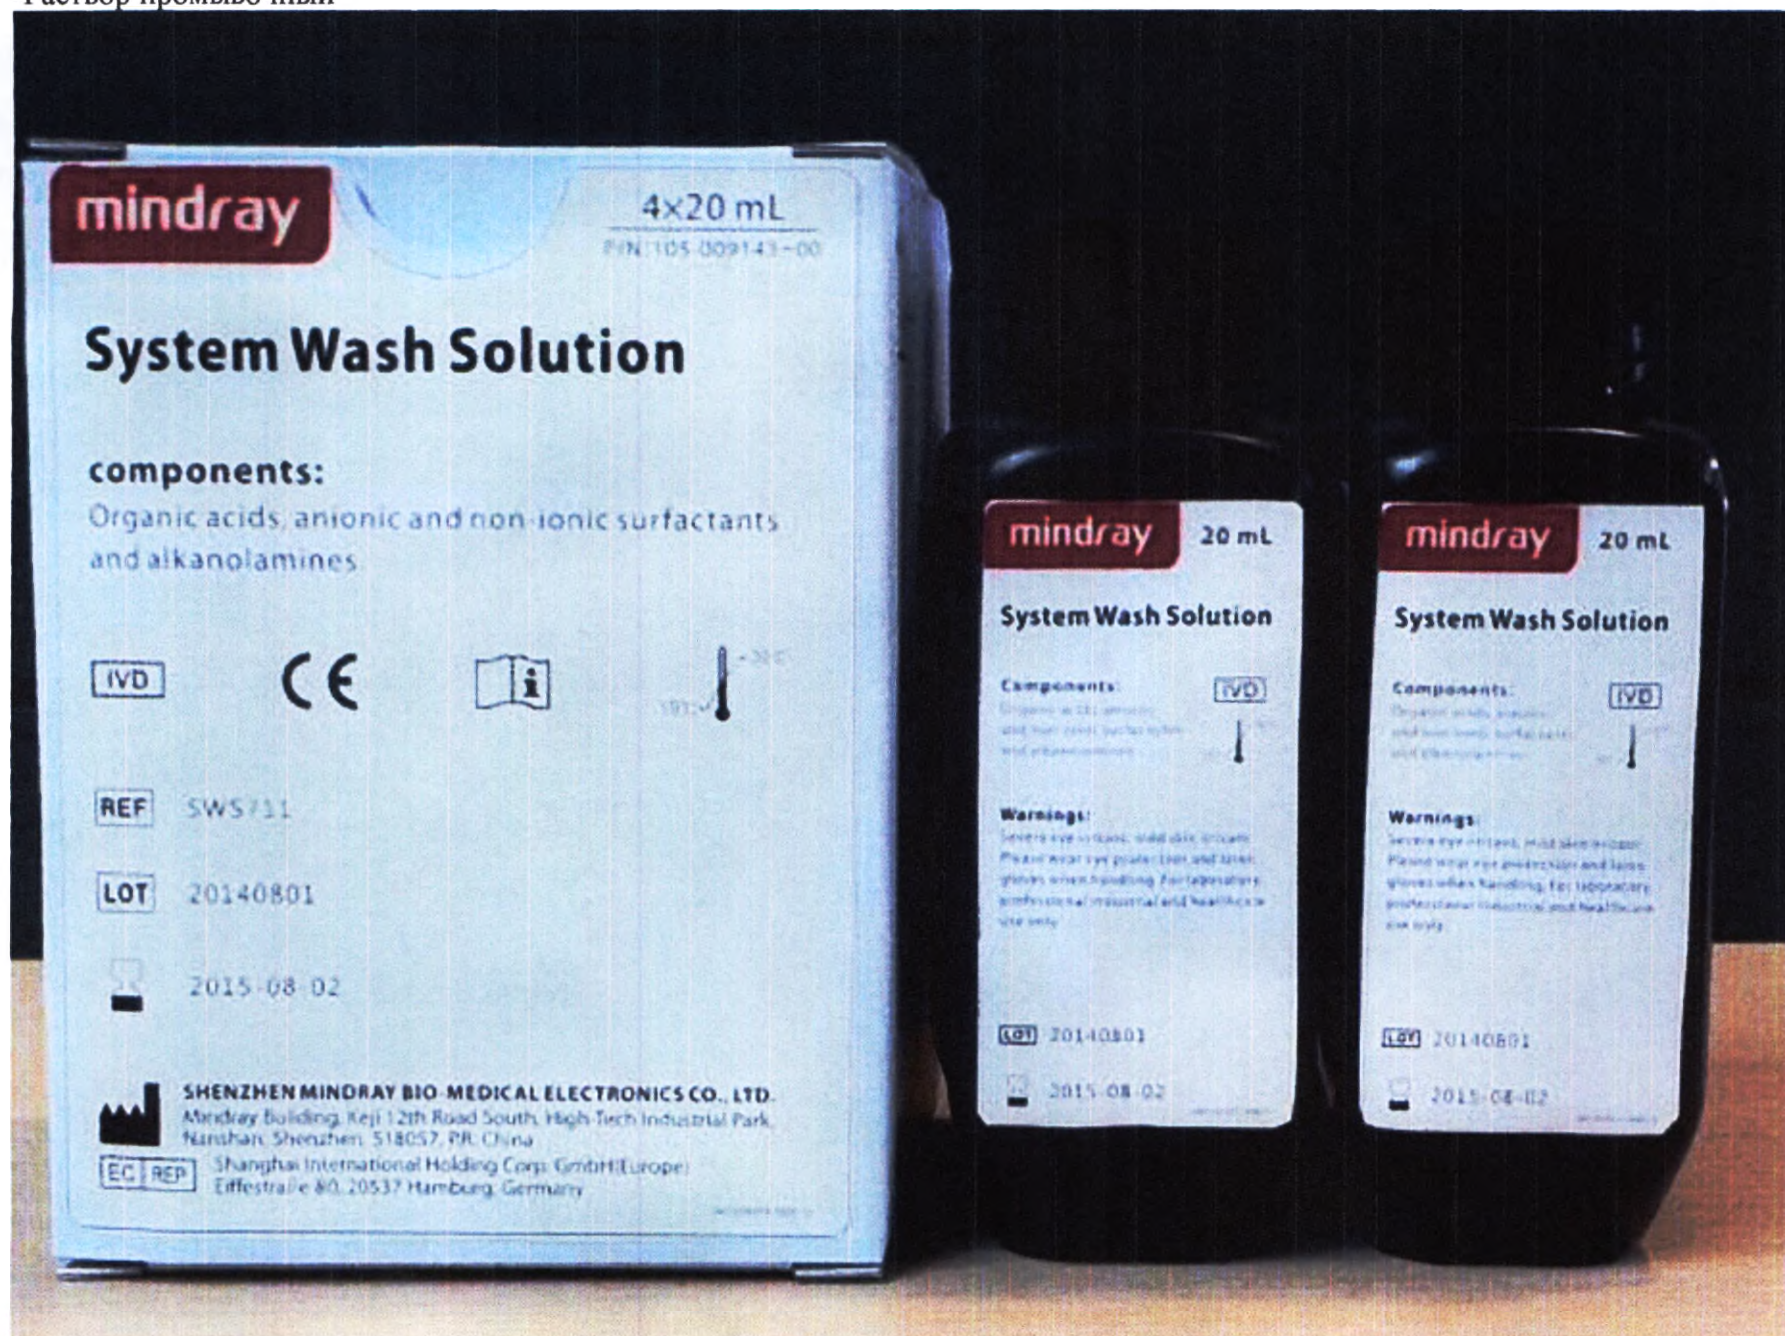

-Раствор для обнаружения



-Штатив для проб дополнительный

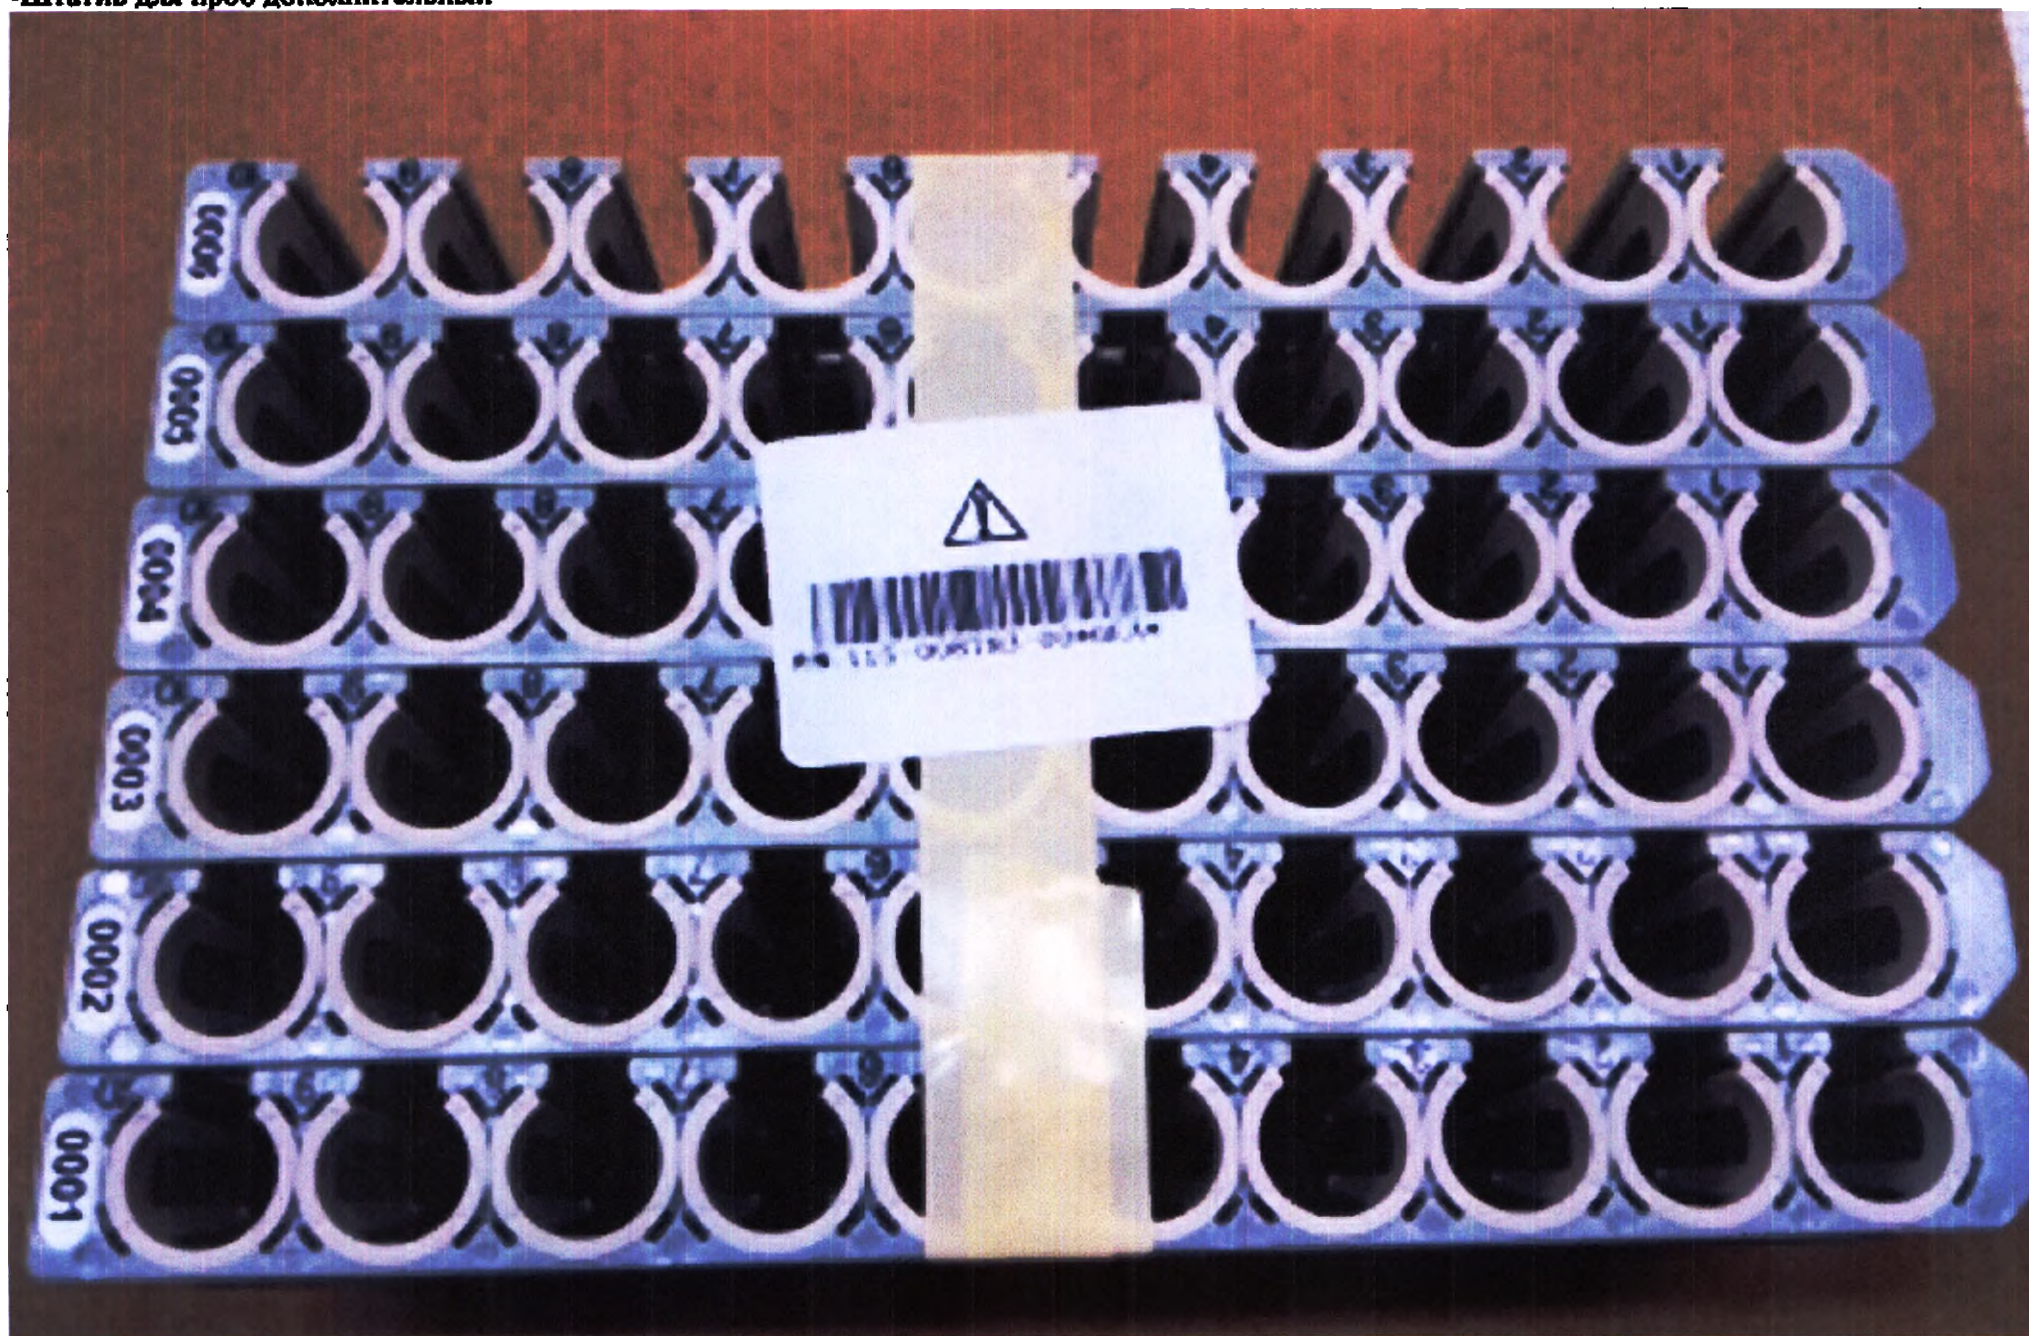

-Флакон субстрата пустой



-Дисперсионный шприц с трубкой




-Блок анализатора CL-1200i




-Блок анализа CL-2000i



- Штатив для калибраторов

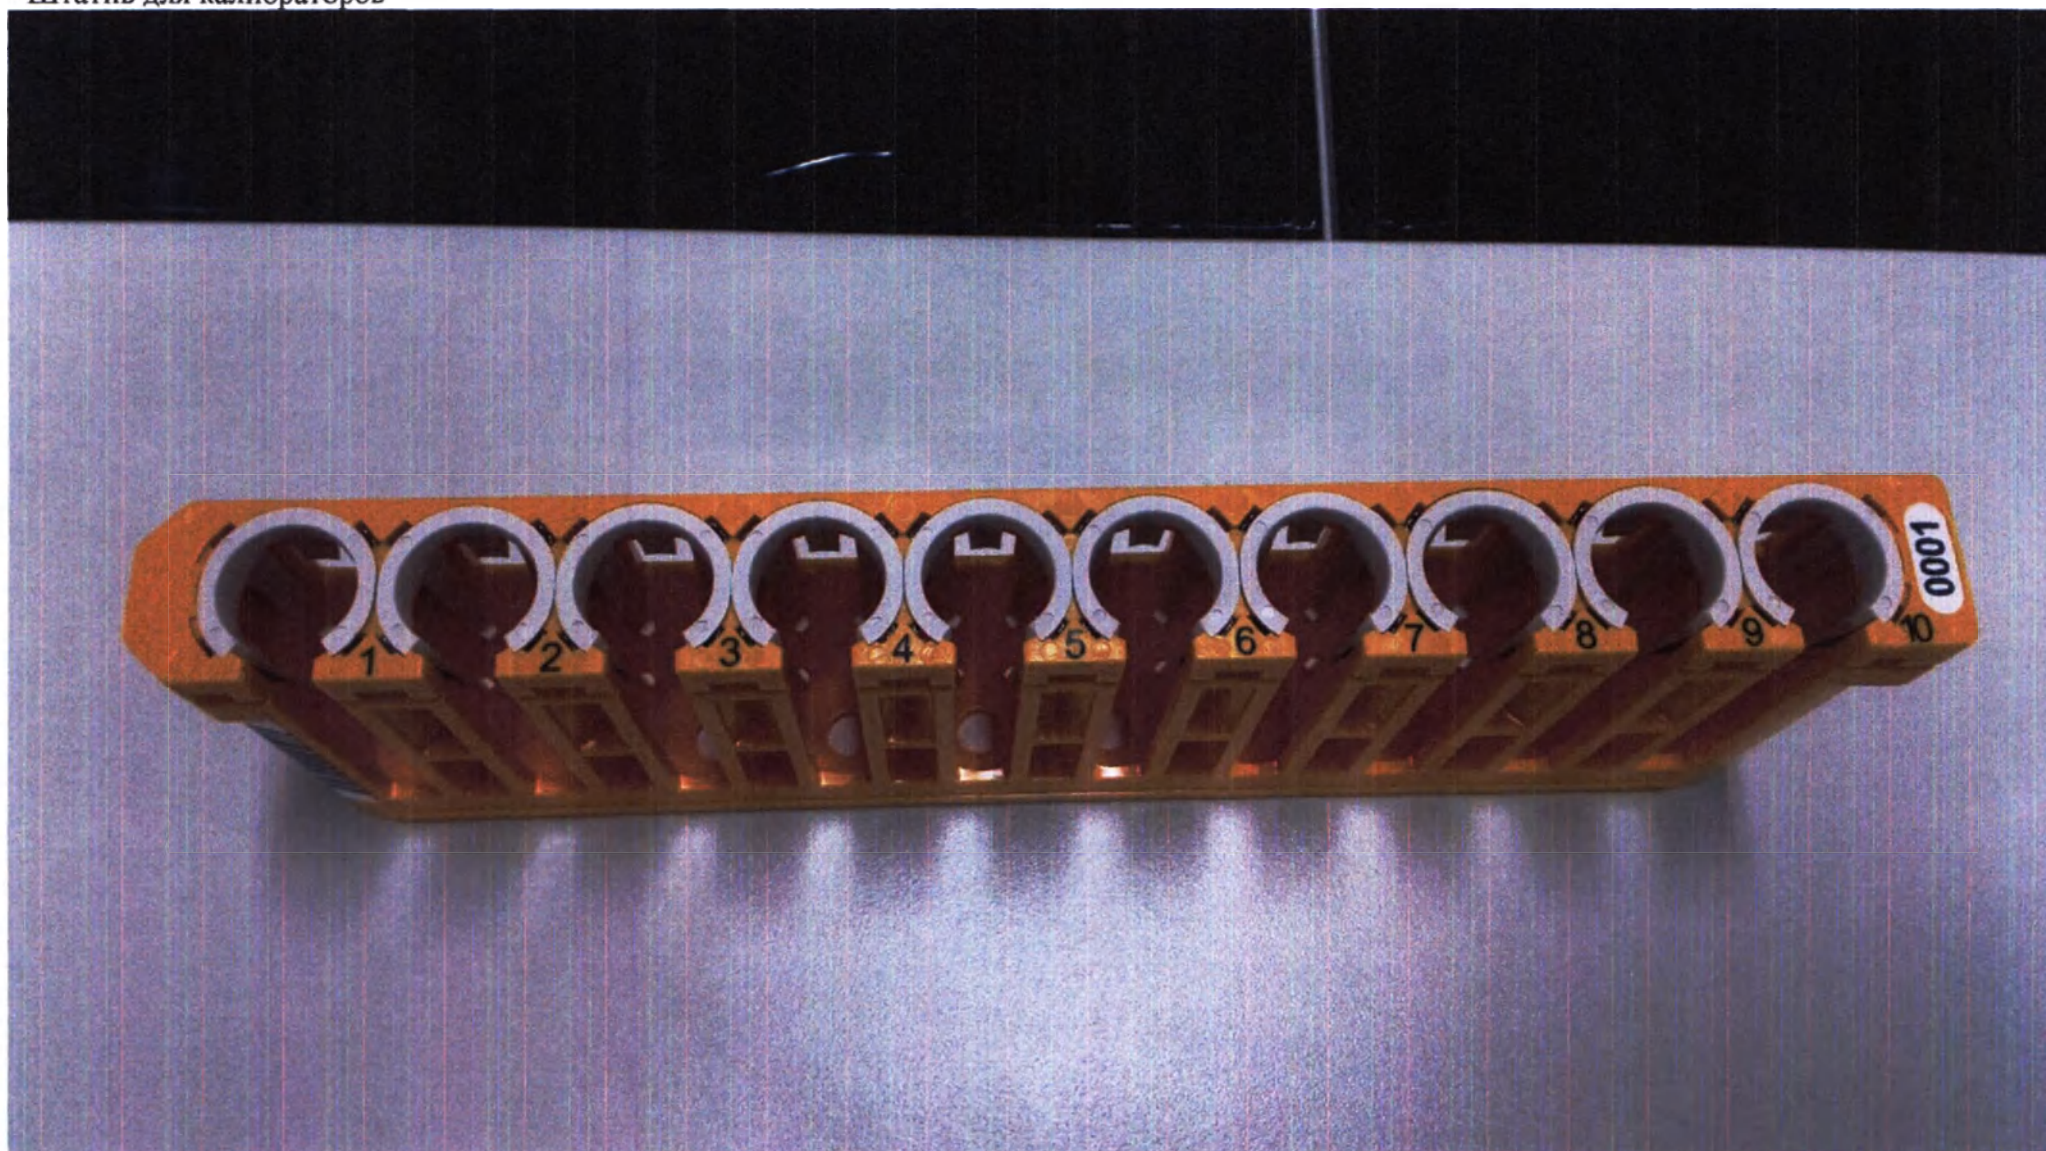


- Штатив для STAT проб

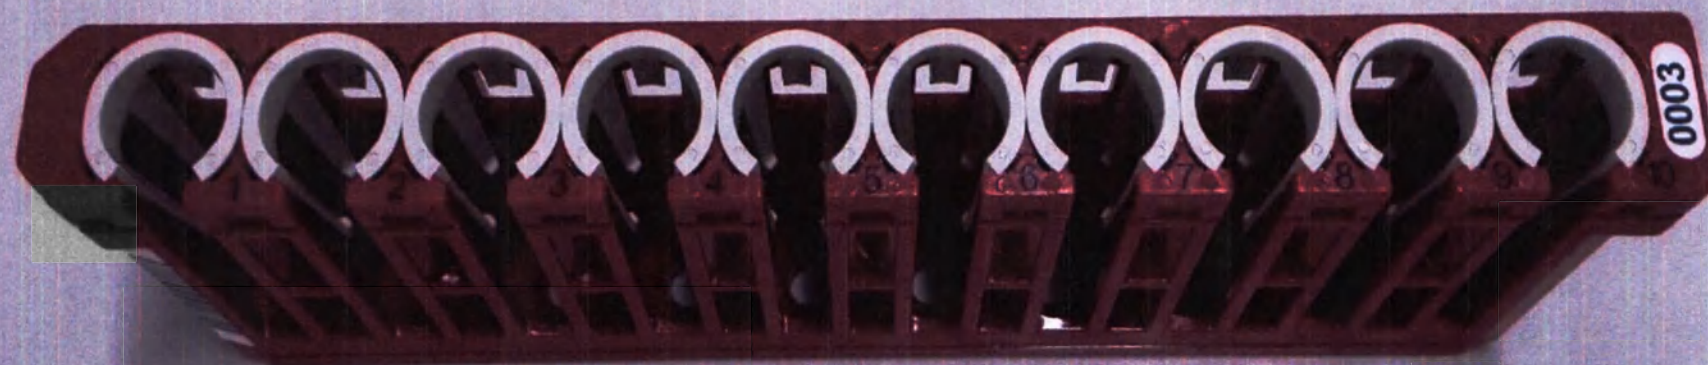


- Штатив для повторных проб



- Штатив для проб

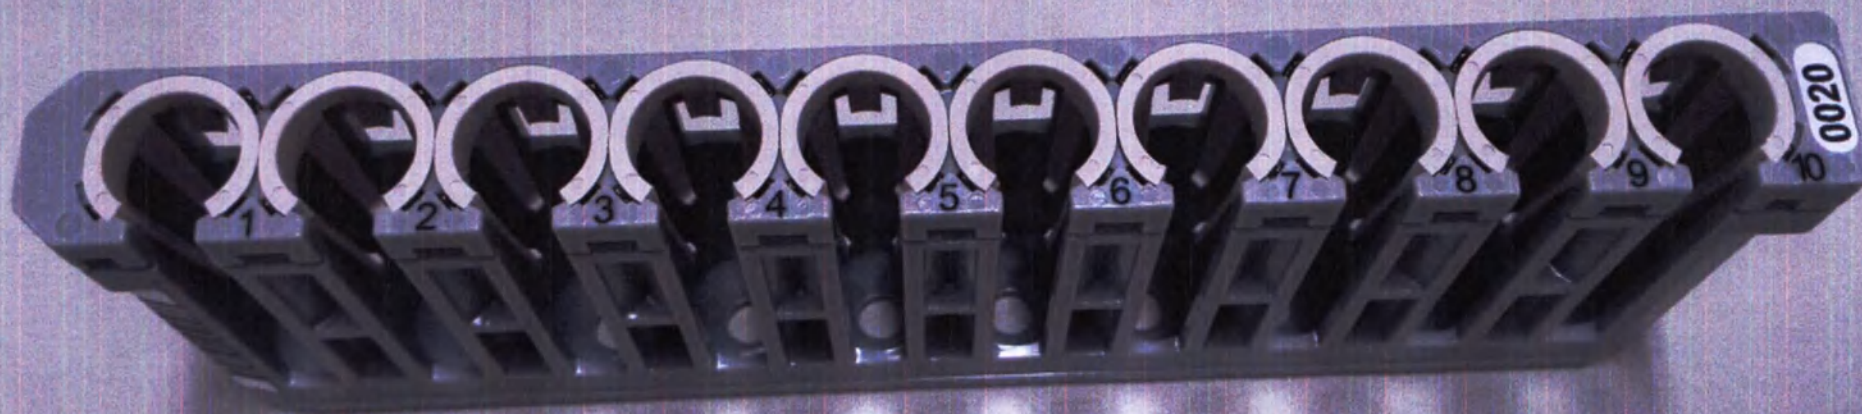

- Штатив для контролей качества

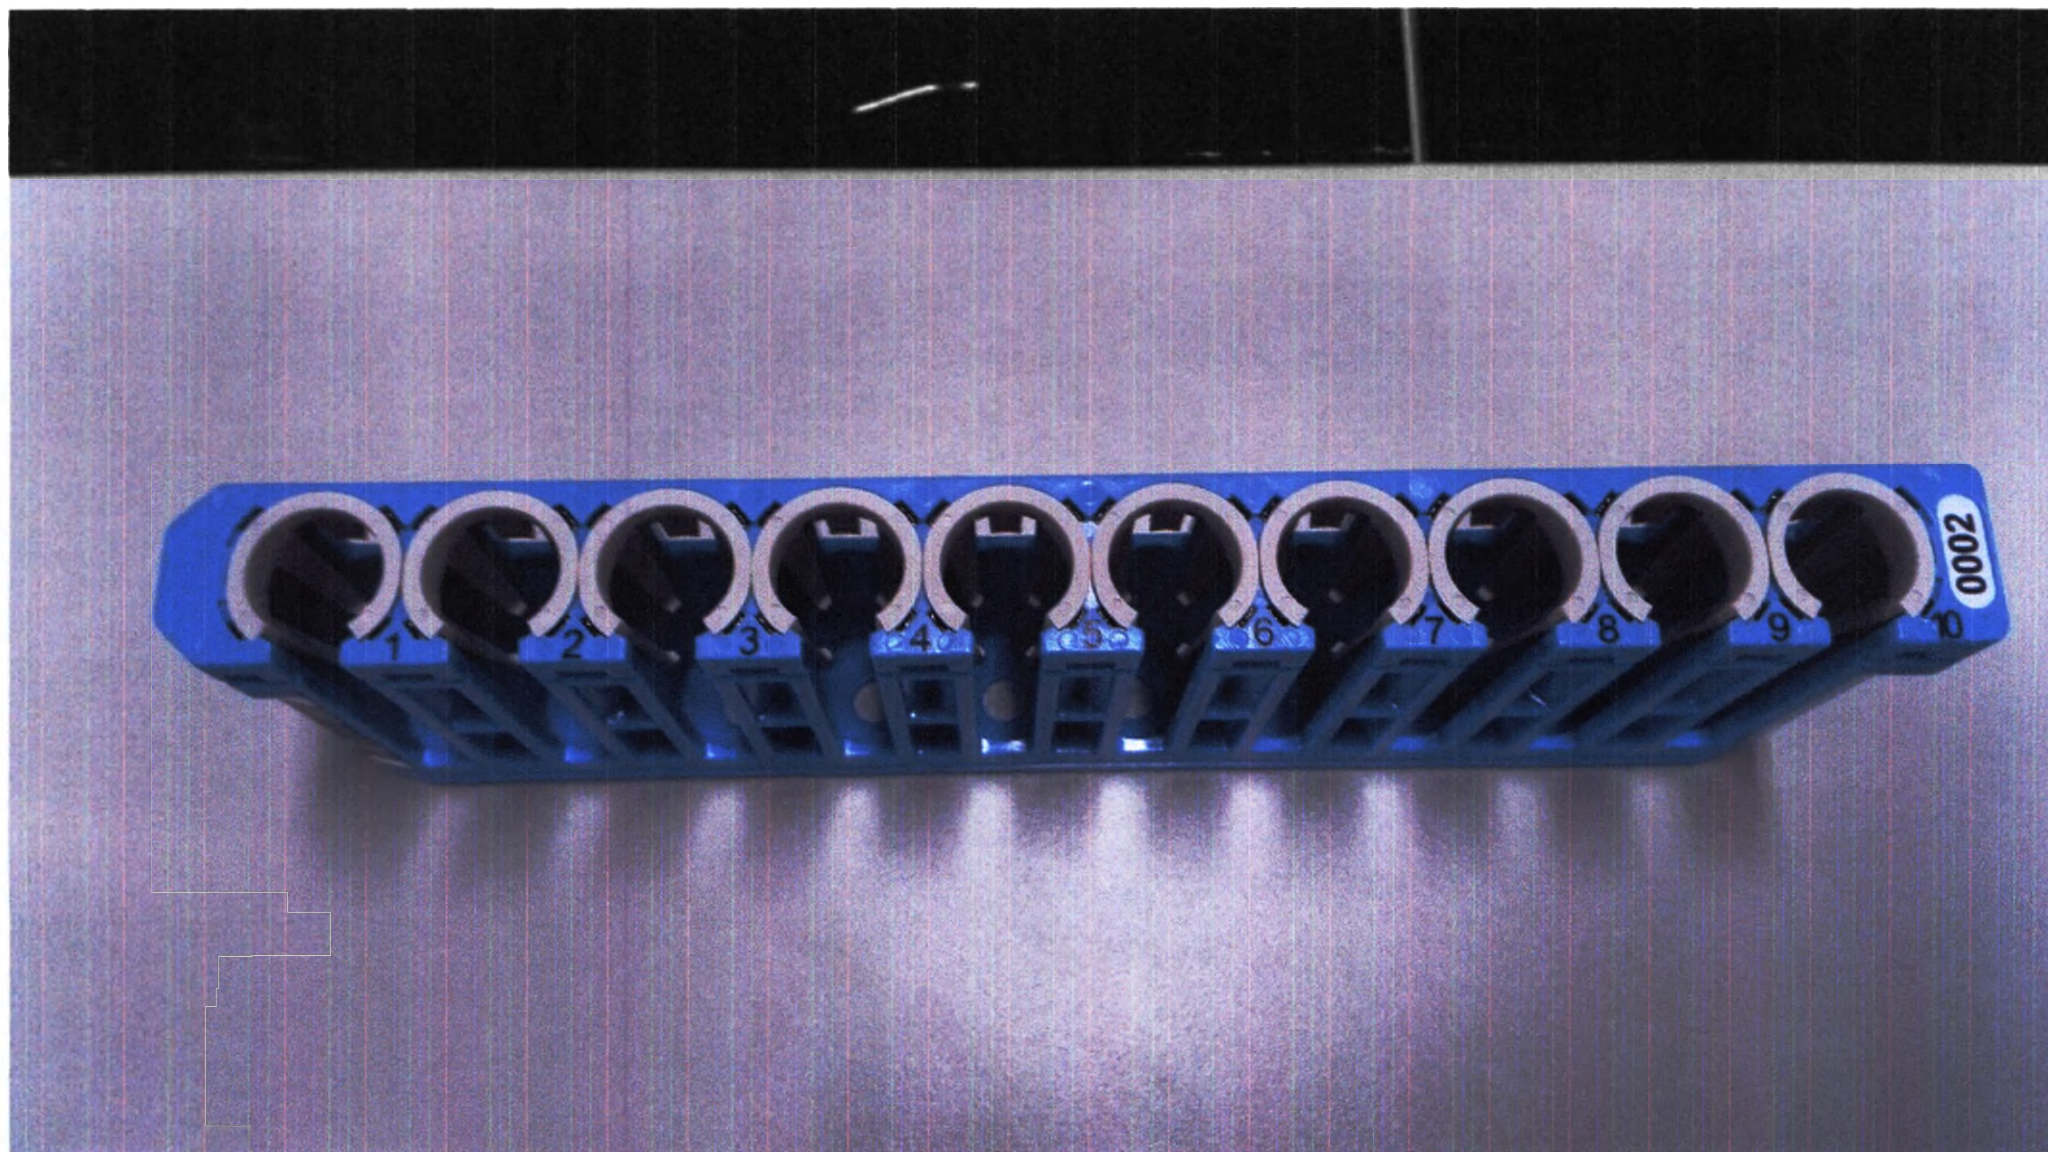

- Модуль подачи проб



- Шайба пружинная



-Пробка пластмассовая



- Лоток с кюветами (126 кюветы)



- Кабель последовательного порта




-Трубка 12х18 мм (5 м)



-Трубка насоса



- Прокладка резиновая уплотнительная

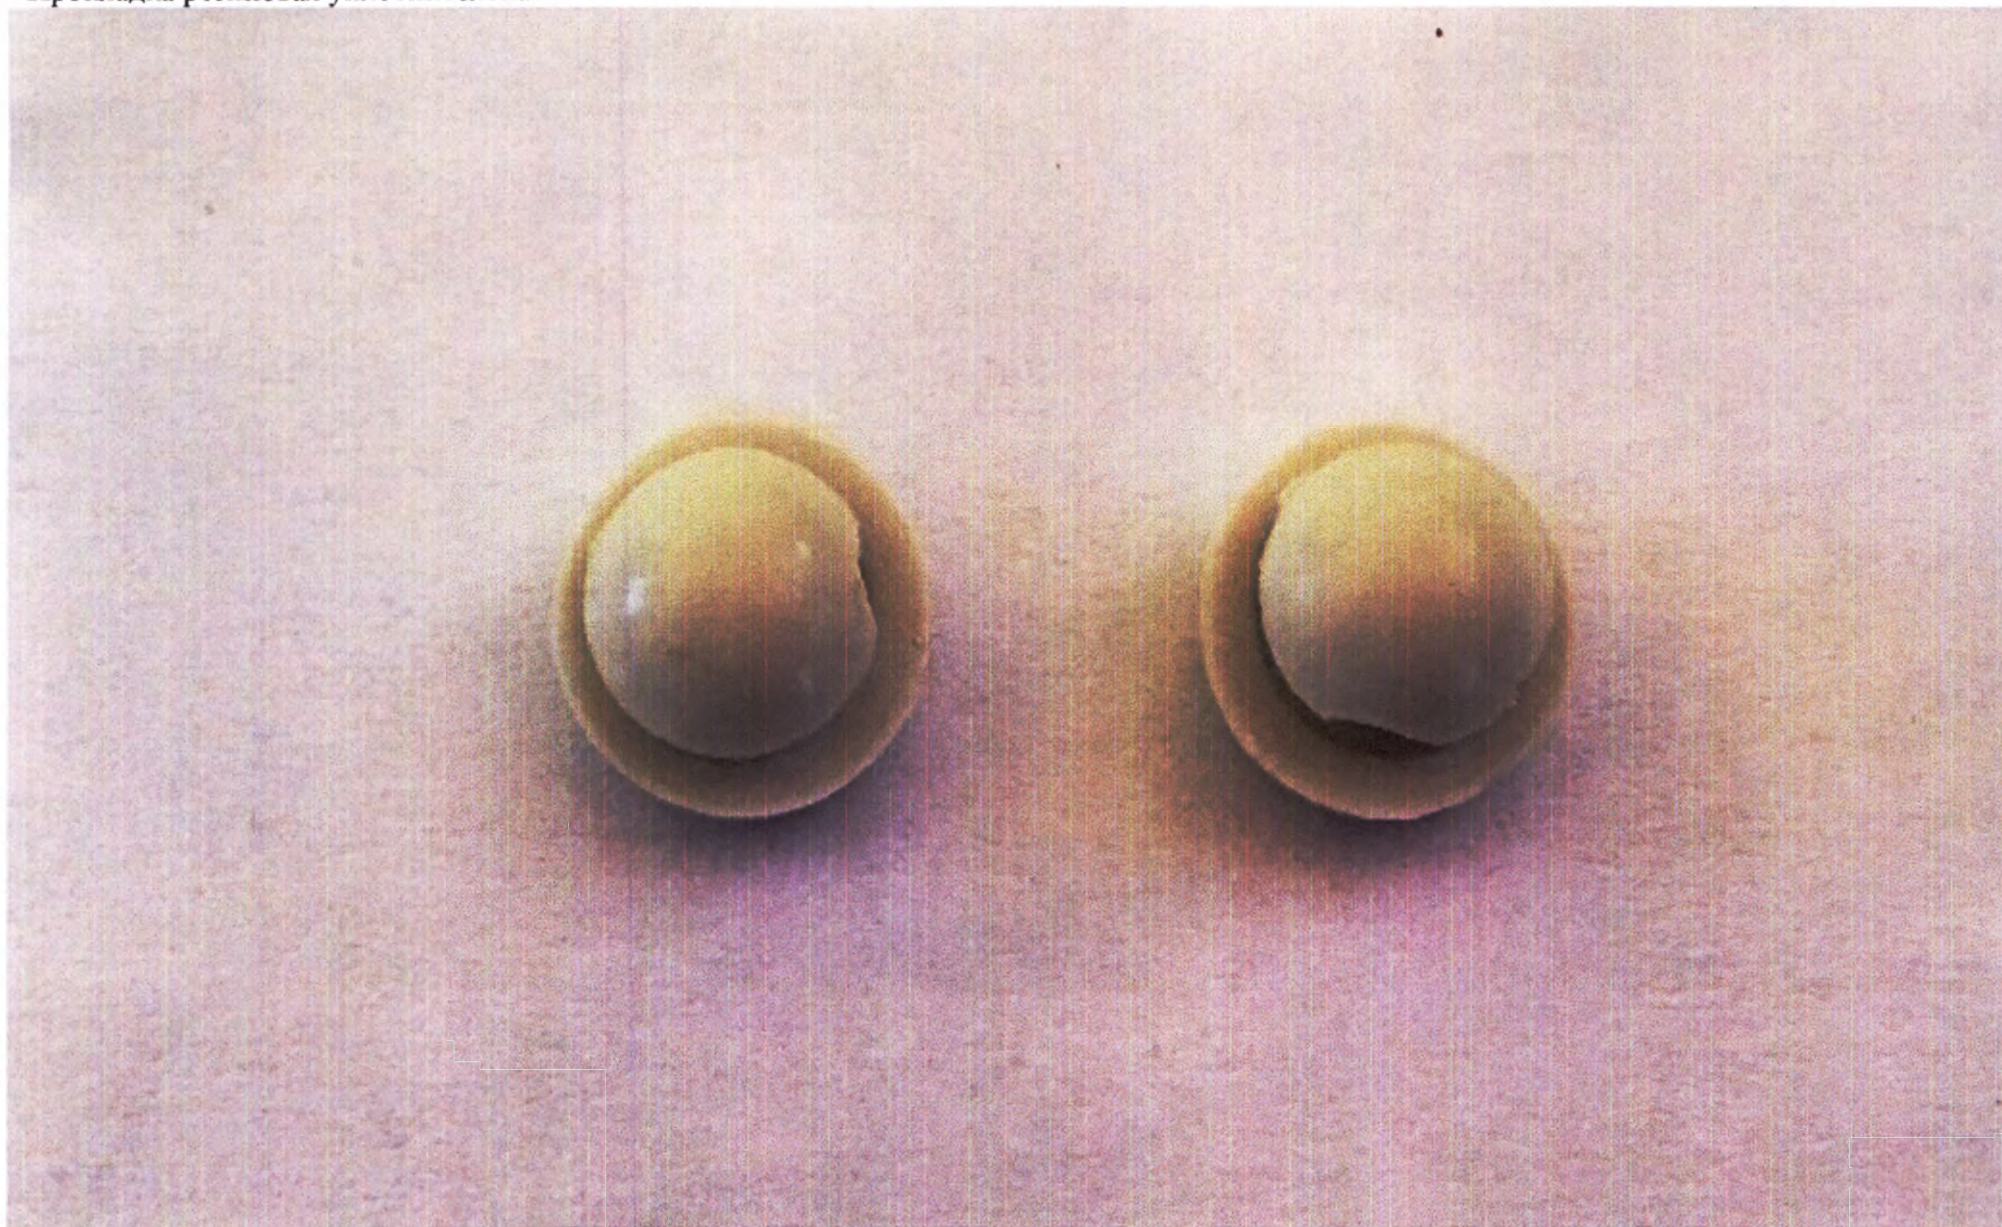


- Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением



-Отвертка (38 мм)



-Модуль транспортной пластины

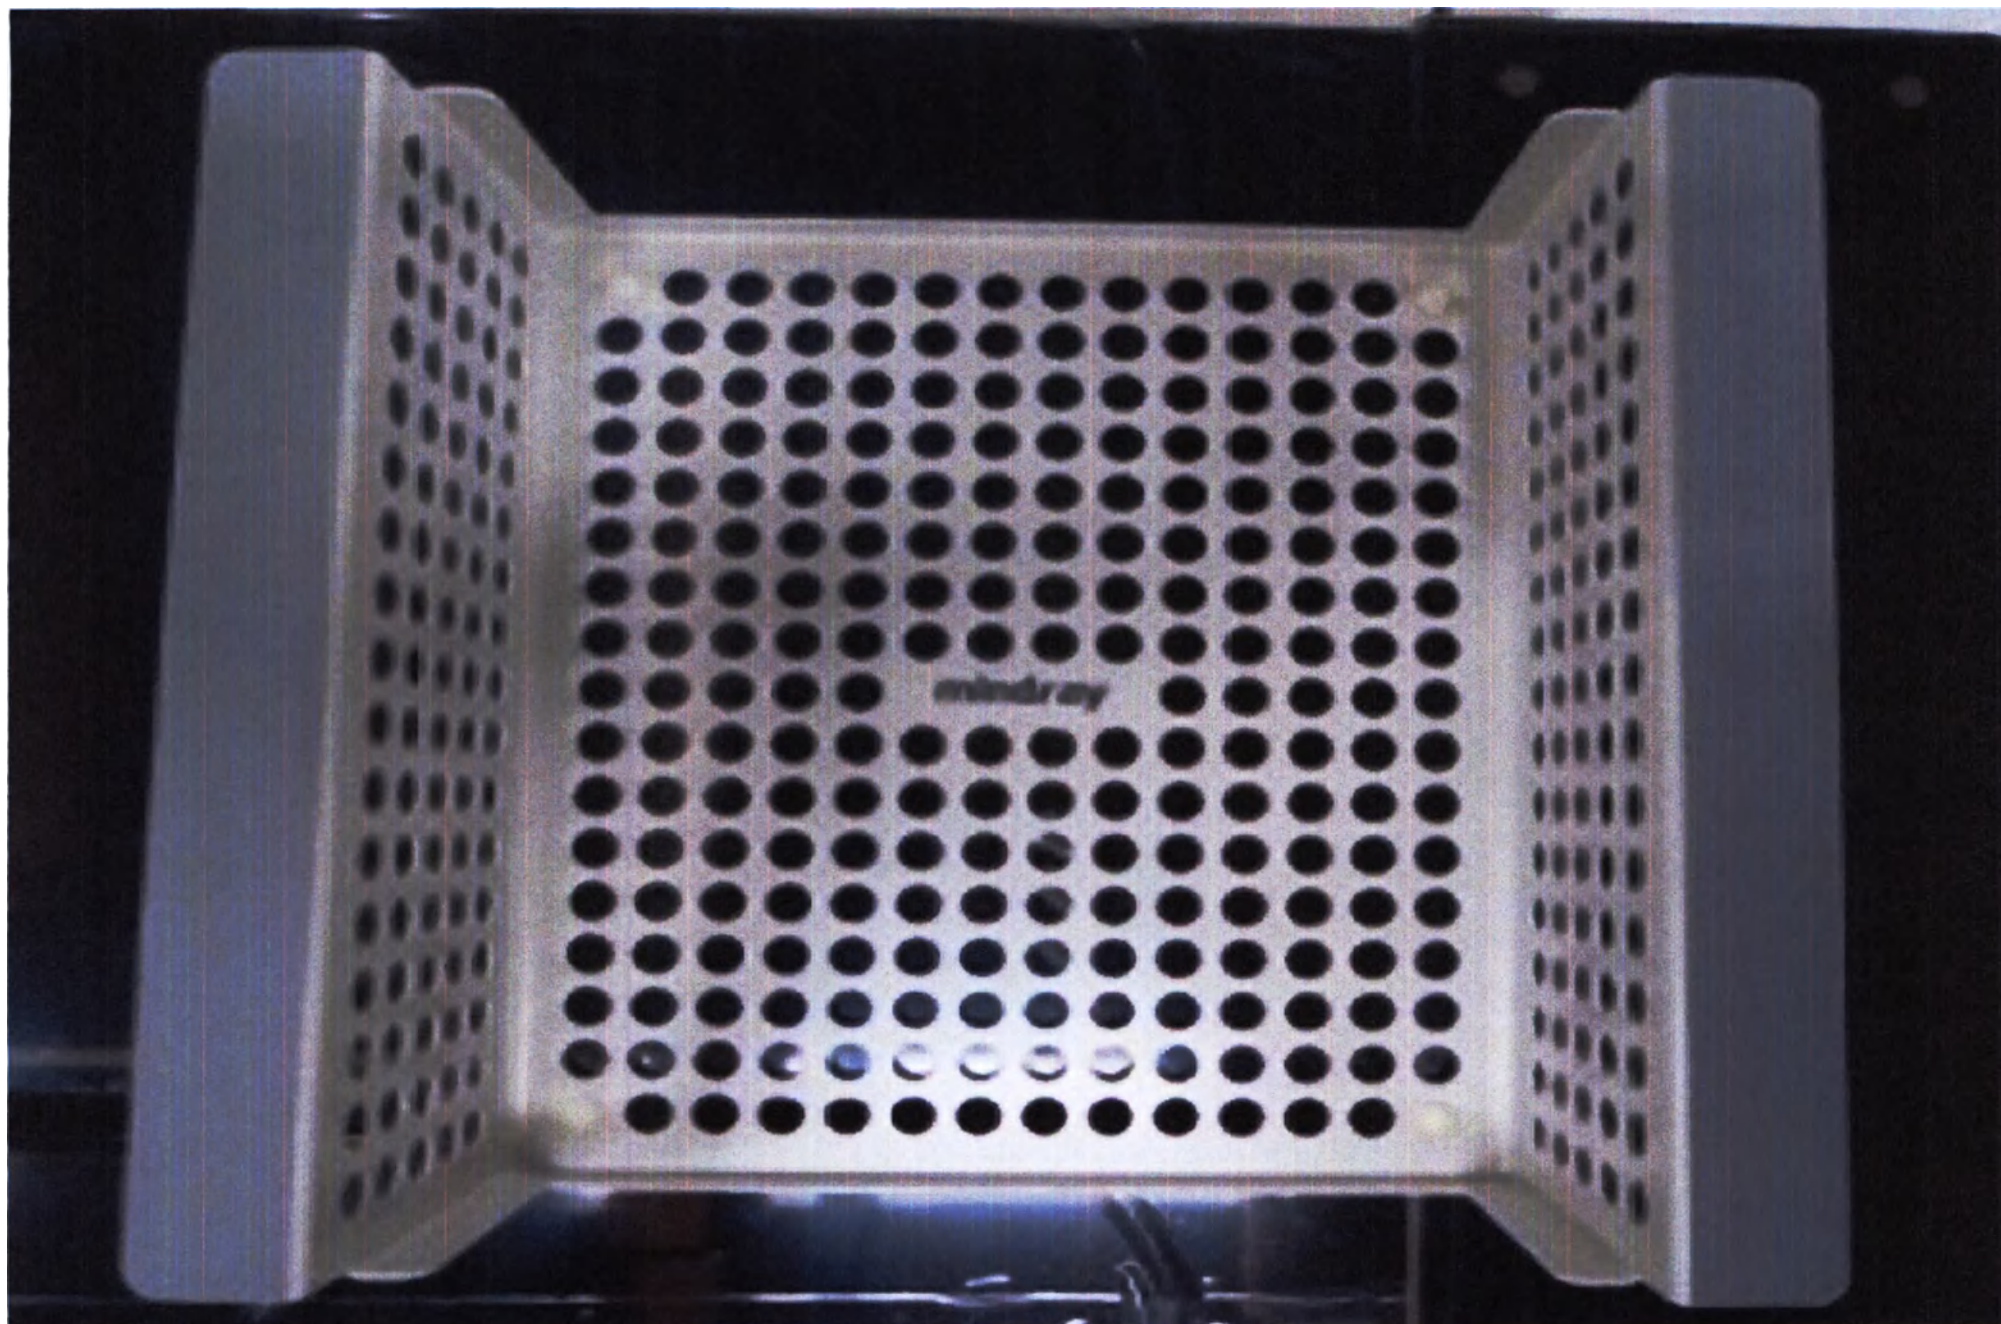


- Зажим для шланга 11-20 мм



- Винт с плоско-выпуклой головкой М4х8



-Игла-трубка для аспирации (диспергатор)

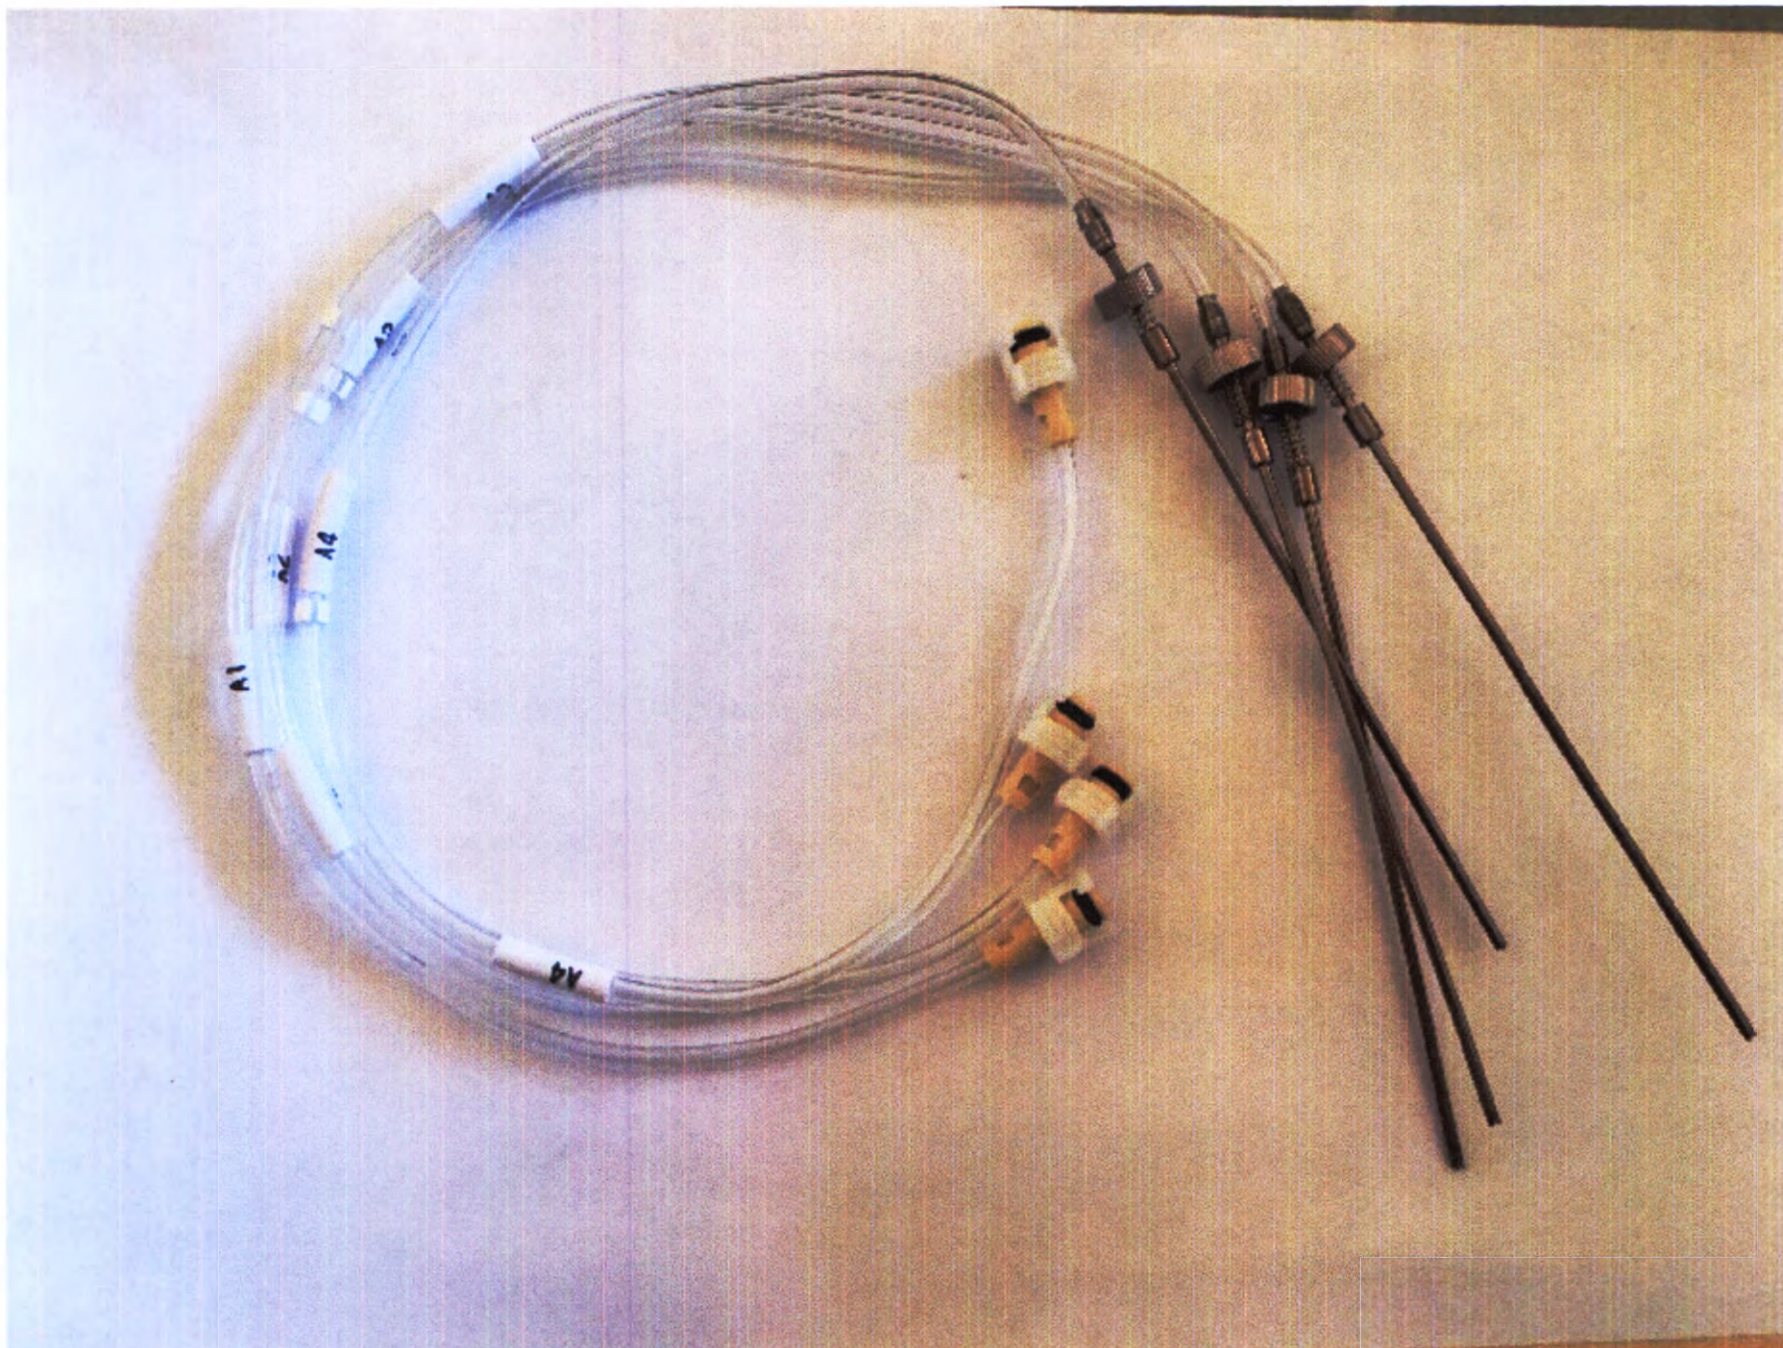

- Канистра для жидких отходов



-Канистра для жидких отходов 25 л



-Соединительный провод



-Насос вакуумный внешний



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 68 листа (-ов)

Генеральный директор _____
М.П.

Носова Т.А.

