



Shaping the Future of Endoscopy with you

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб. 7, стр. 4

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

**Помпа ENDOMAT SELECT в составе, в вариантах исполнения с принадлежностями
производства**

*Karl Storz SE & Co.KG, Germany («Карл Шторц SE и Ко. КГ», Германия)
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532, Tuttlingen, Germany*

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО КШТЭ ВОСТОК

Колас Мартин Пьер




«07» ноября 2023 г.

Помпа ENDOMAT SELECT в составе, в вариантах исполнения с принадлежностями

Вариант исполнения 1: Помпа ENDOMAT SELECT UP210 в составе:

1. Помпа ENDOMAT SELECT, модель UP210

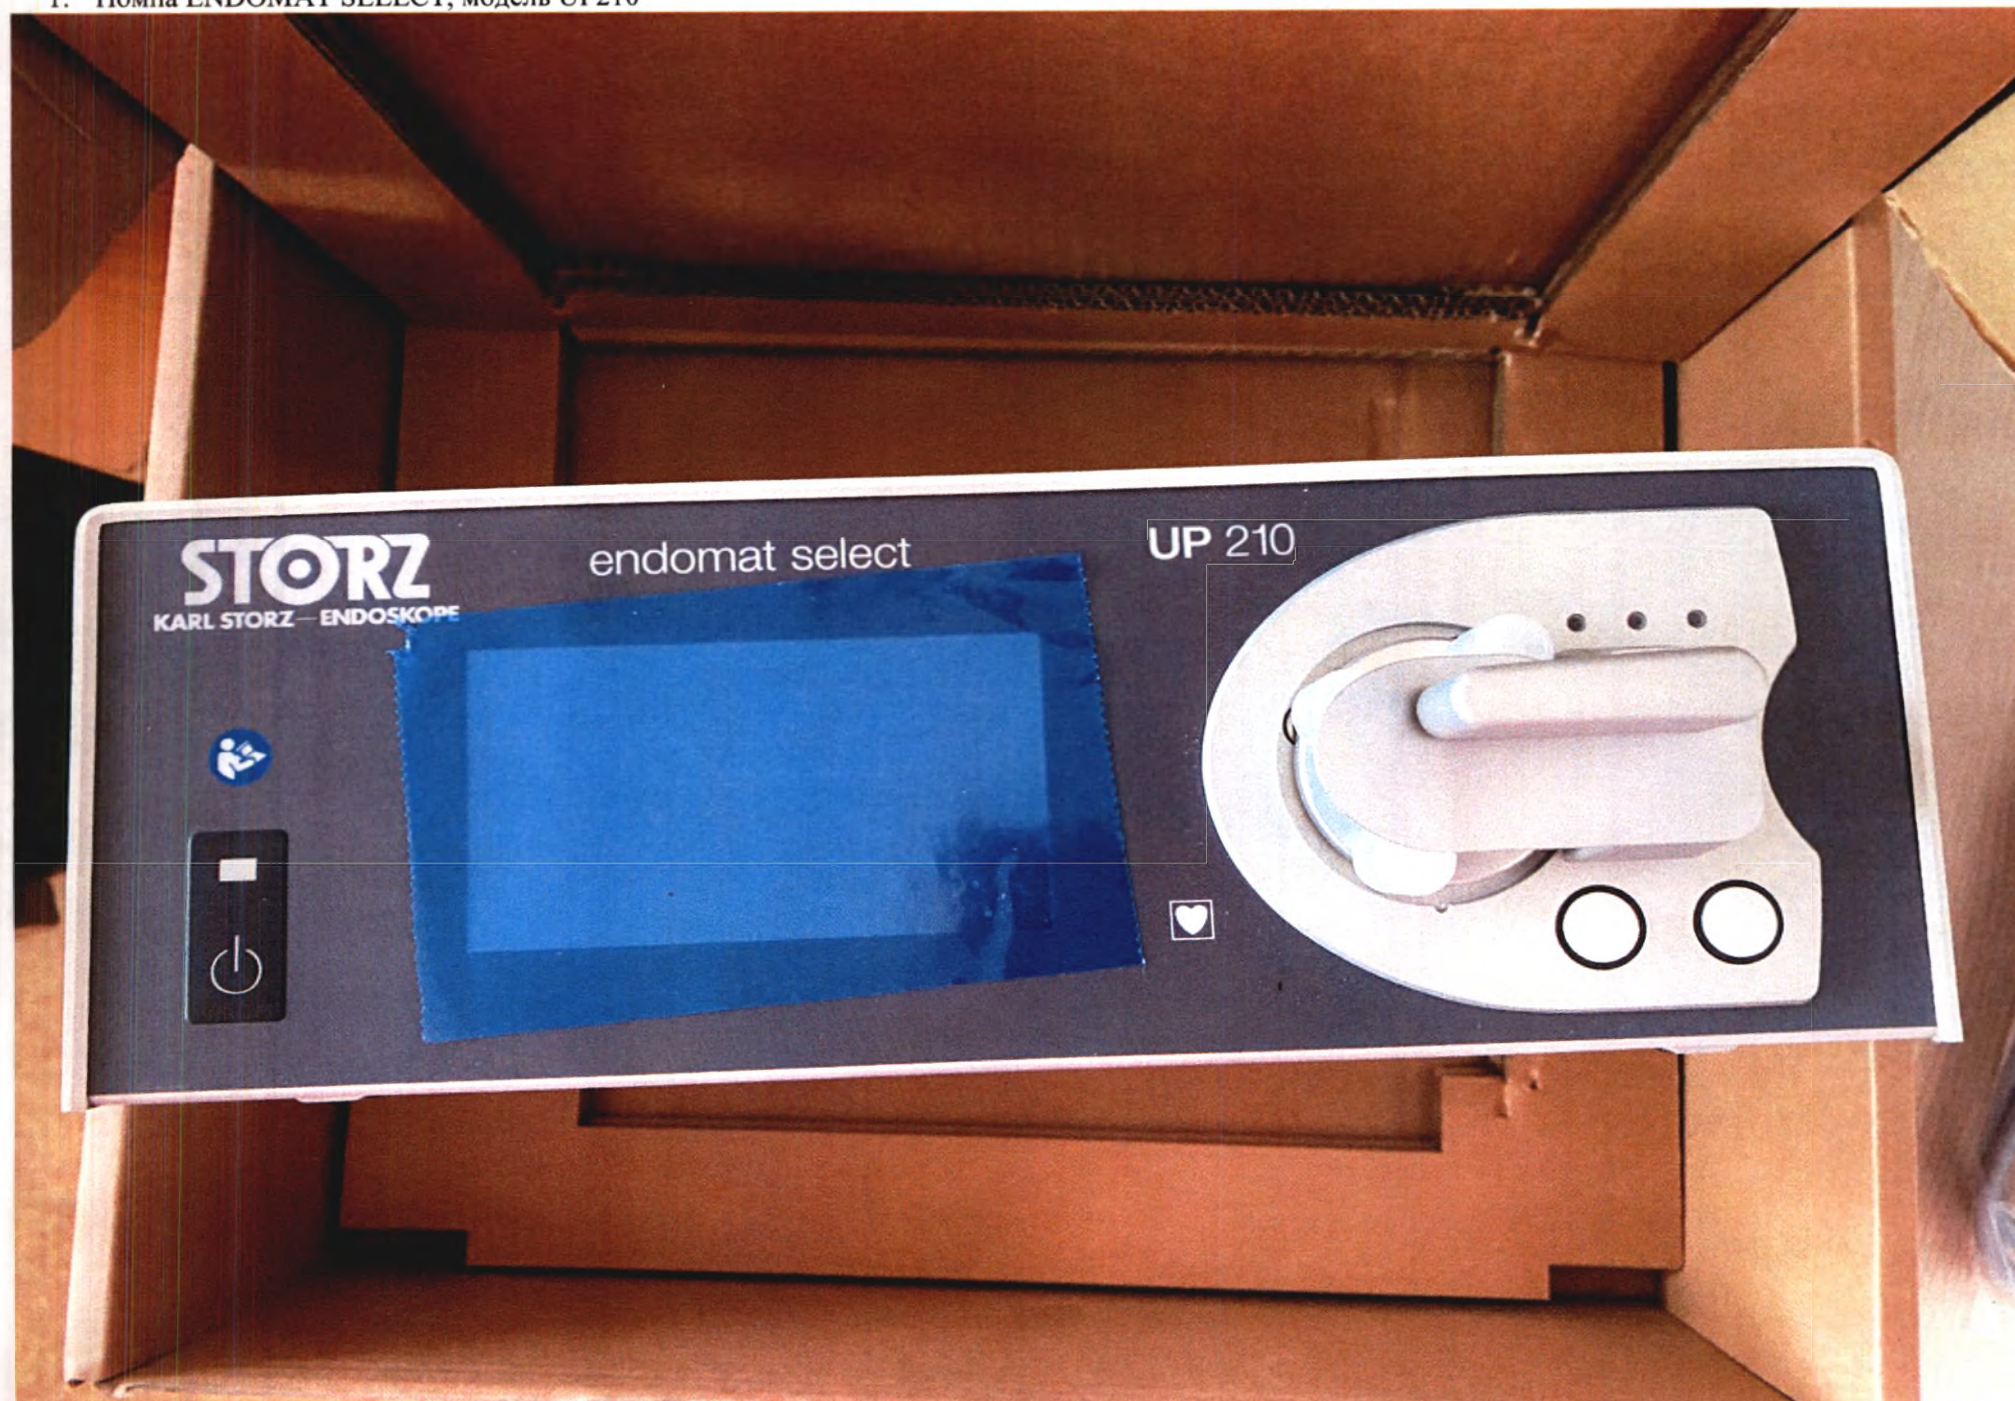

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ - ENDOSKOPE

Model :UP210
Voltage :100-240 VAC

Frequency :50/60 Hz
Power :72 VA
:2020-03

Classification IEC
Class I IP21D

CE 0123

(01) 04048551376041
(21) PP02552
AN: UP210





KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ

KARL STORZ—ENDOSKOPE

Model :UP210
Voltage :100-240 VAC

Classification IEC
Class I IP21D

Frequency :50/60 Hz
Power :72 VA
Power plug icon :2020-03



(01) 04048551376041
(21) PP02552
AN: UP210




C


US

SN: PP02552



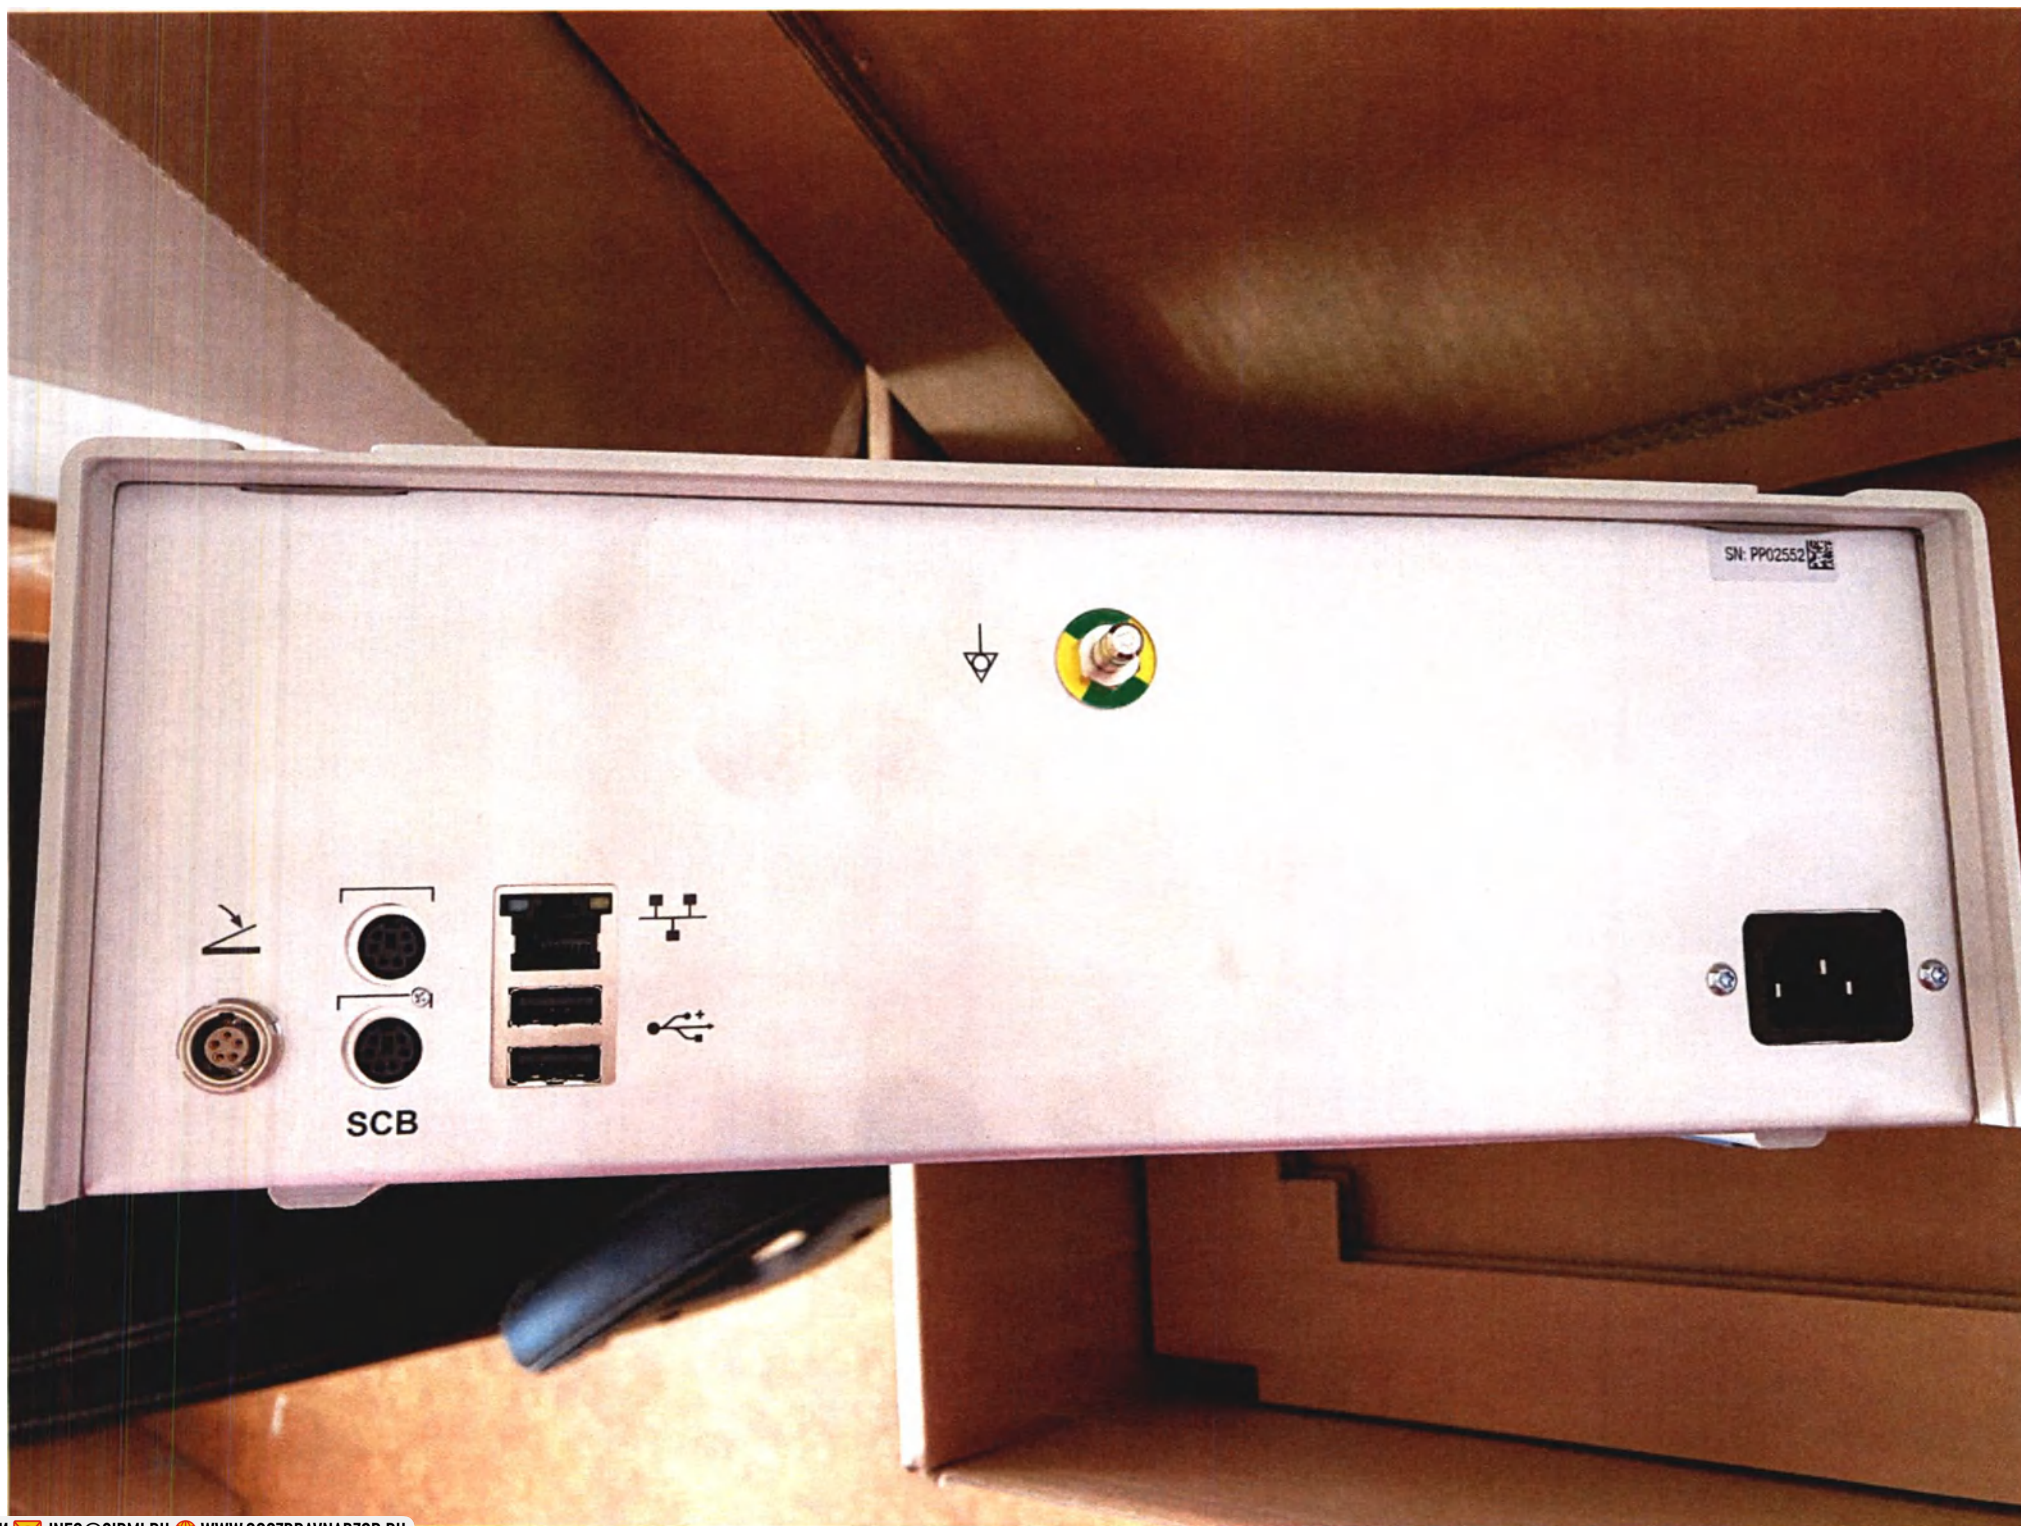

2. Кабель сетевой, длина 300 см

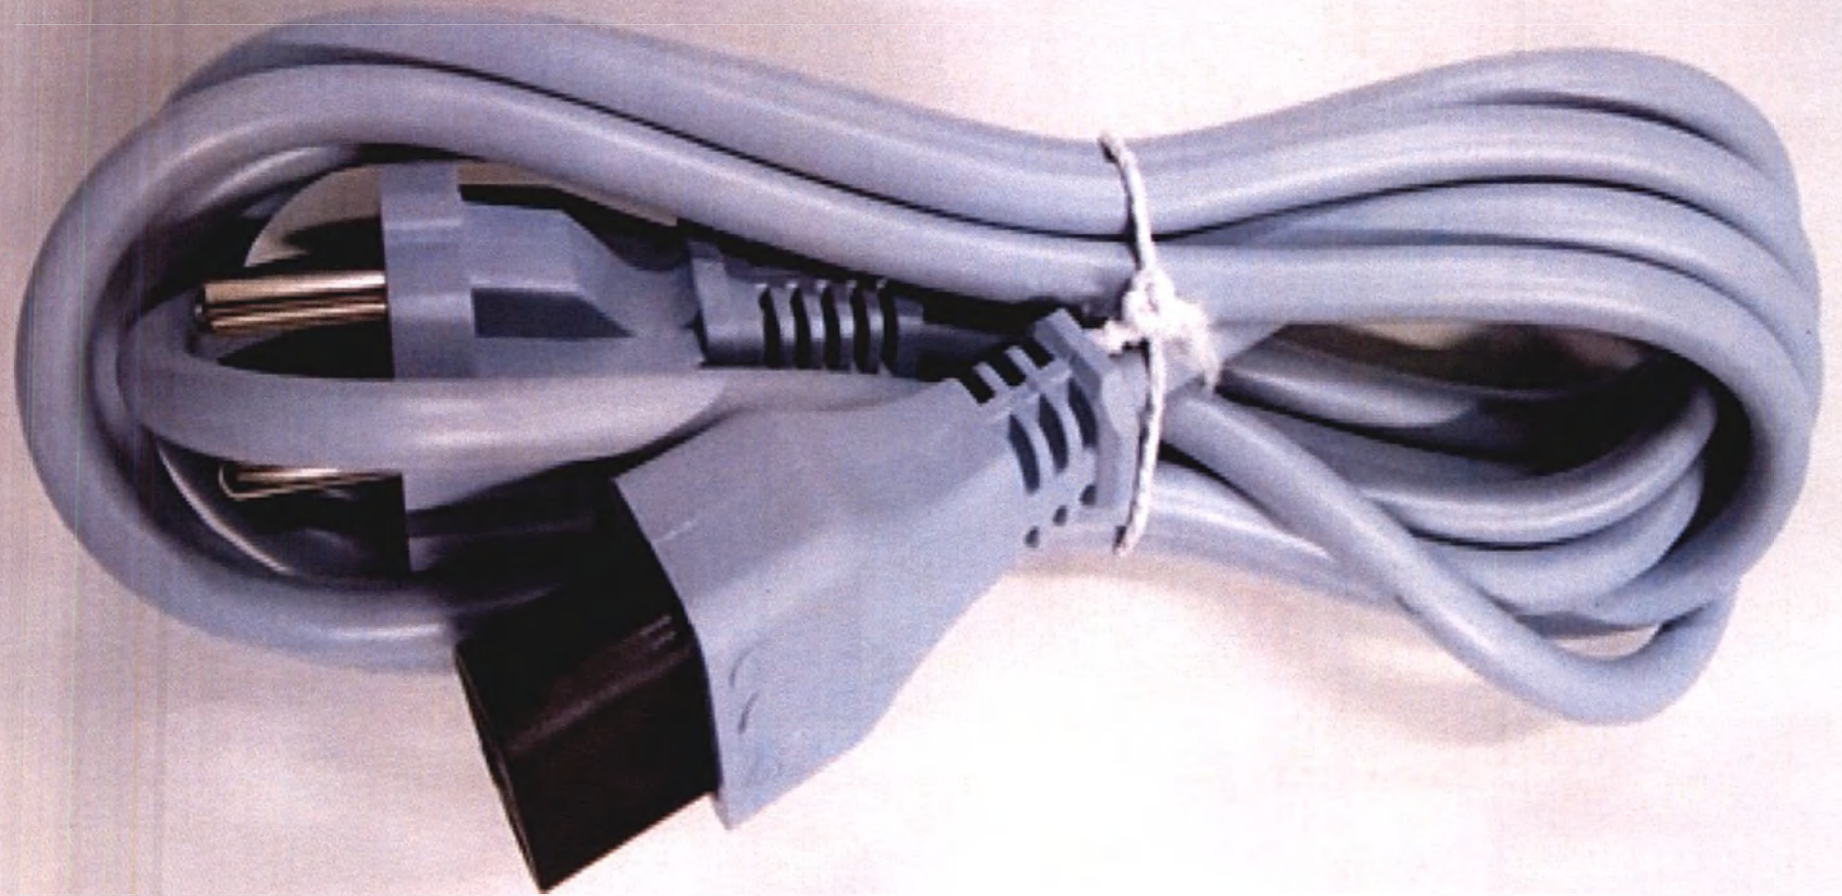

3. Инструкция по эксплуатации. Конечный вид может быть изменен, содержание будет приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.


STORZ

KARL STORZ — ENDOSKOPE

en Reprocessing instructions
ENDOMAT SELECT
UP210




4. Прибор проверки герметичности

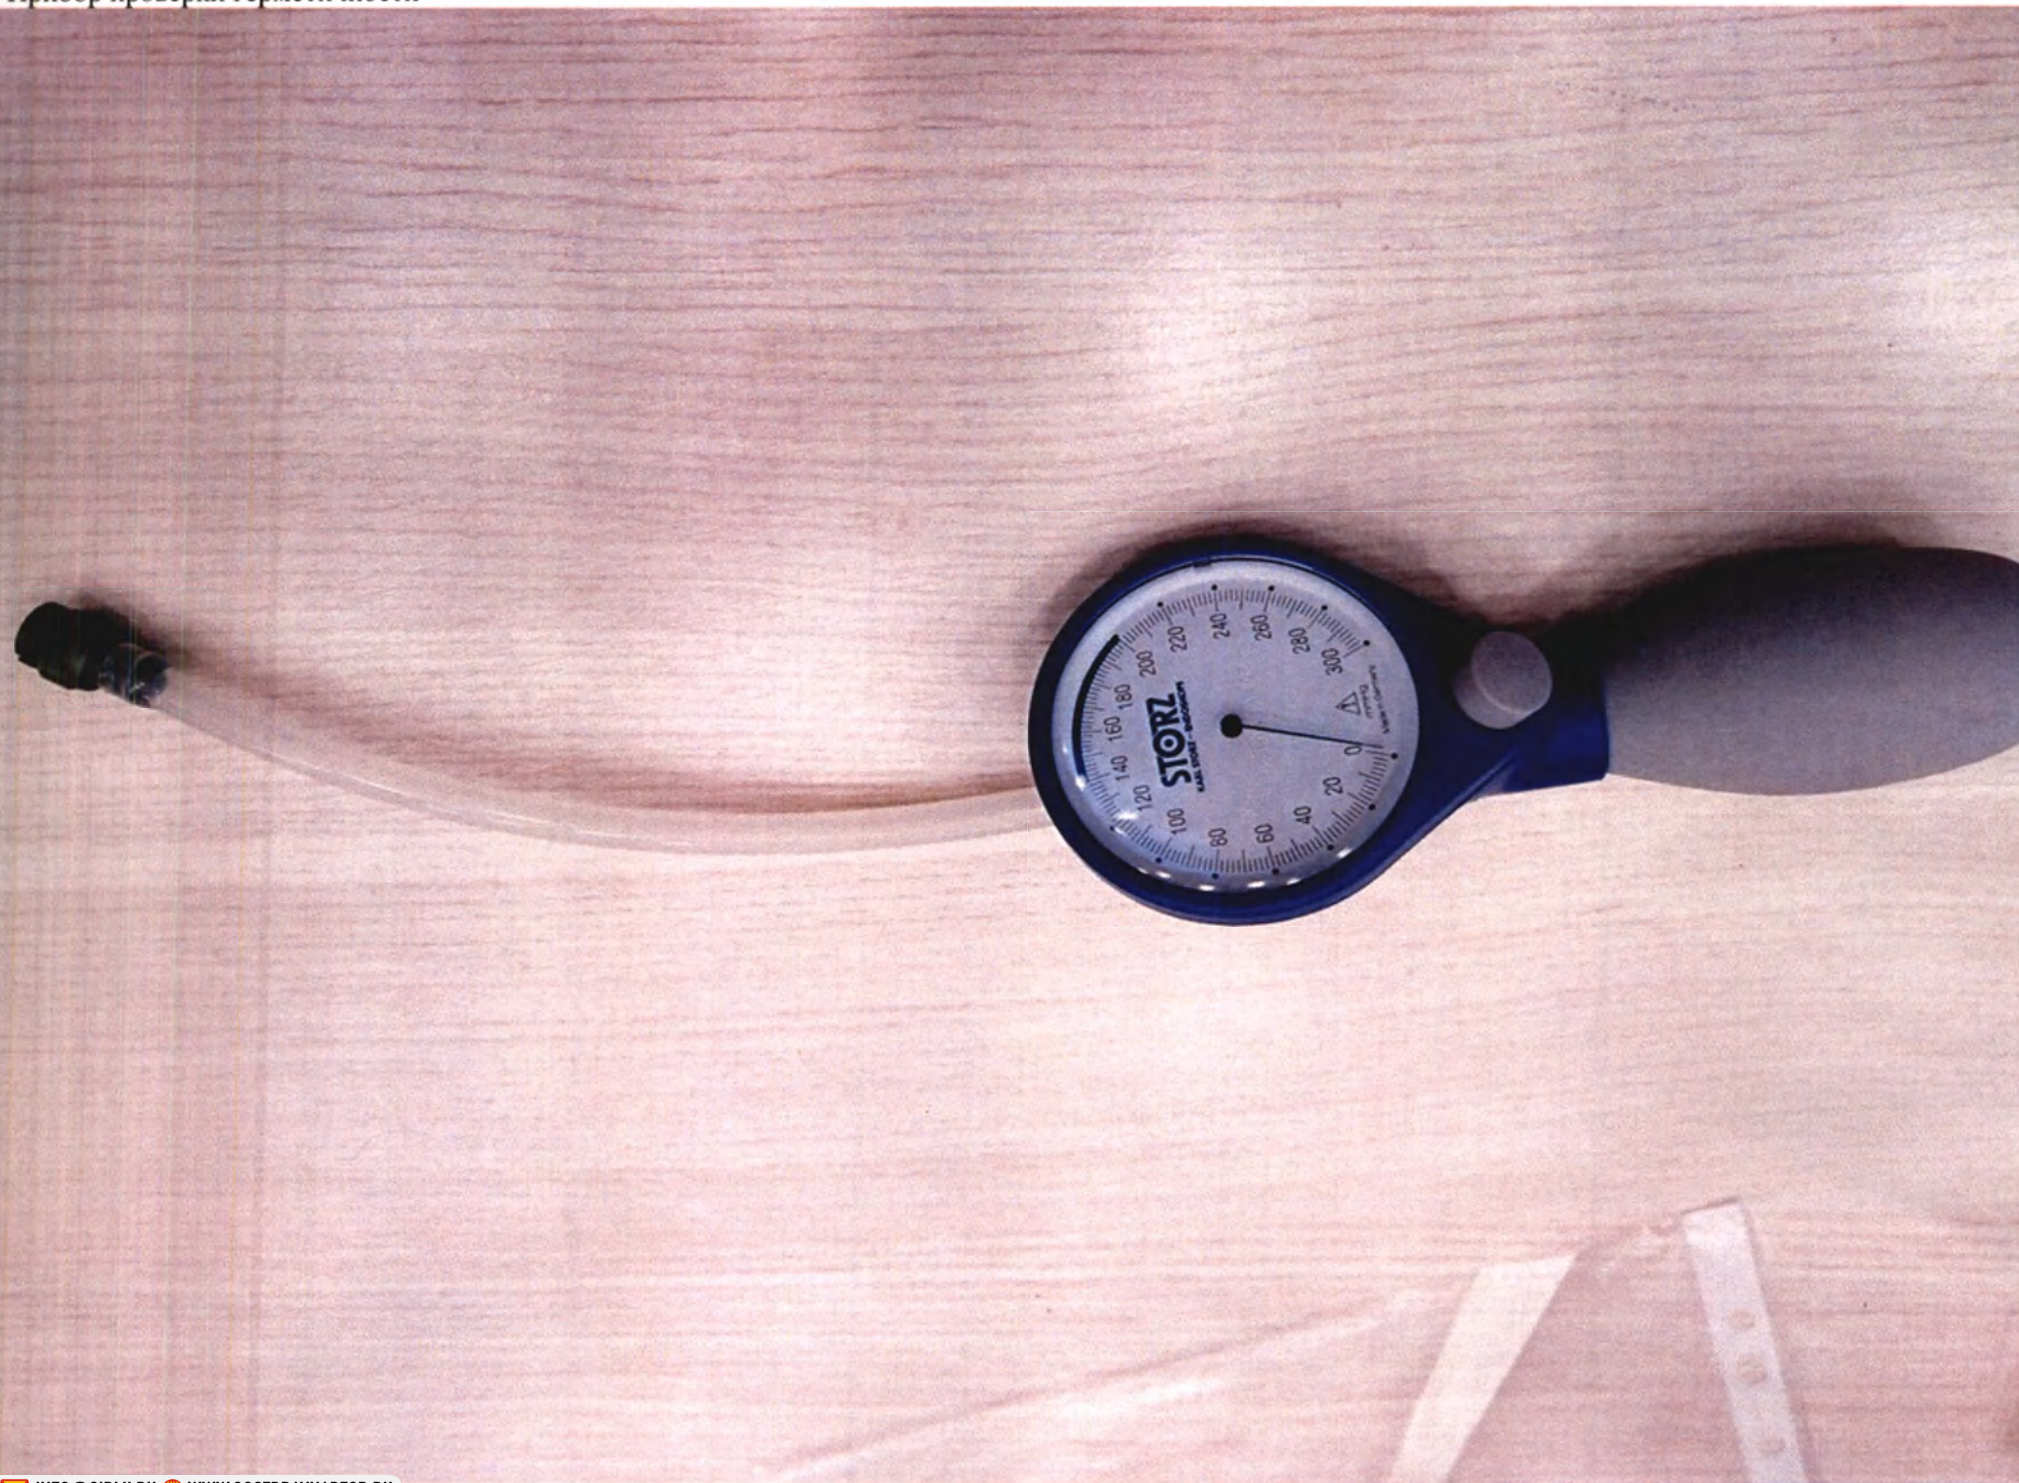

5. Банка аспирационная, 5 л, стерилизуемая




6. Крышка для применения с аспирационной банкой, 5 л, стерилизуемая

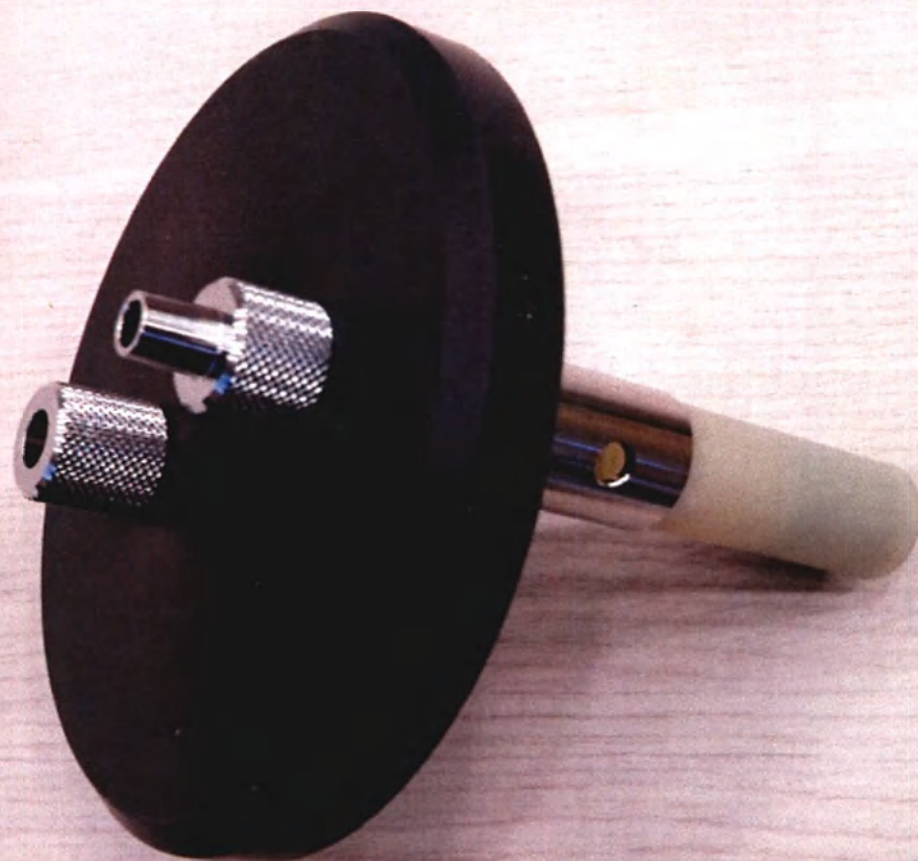


7. Фильтр металлический




8. Держатель для аспирационной банки, 5 л

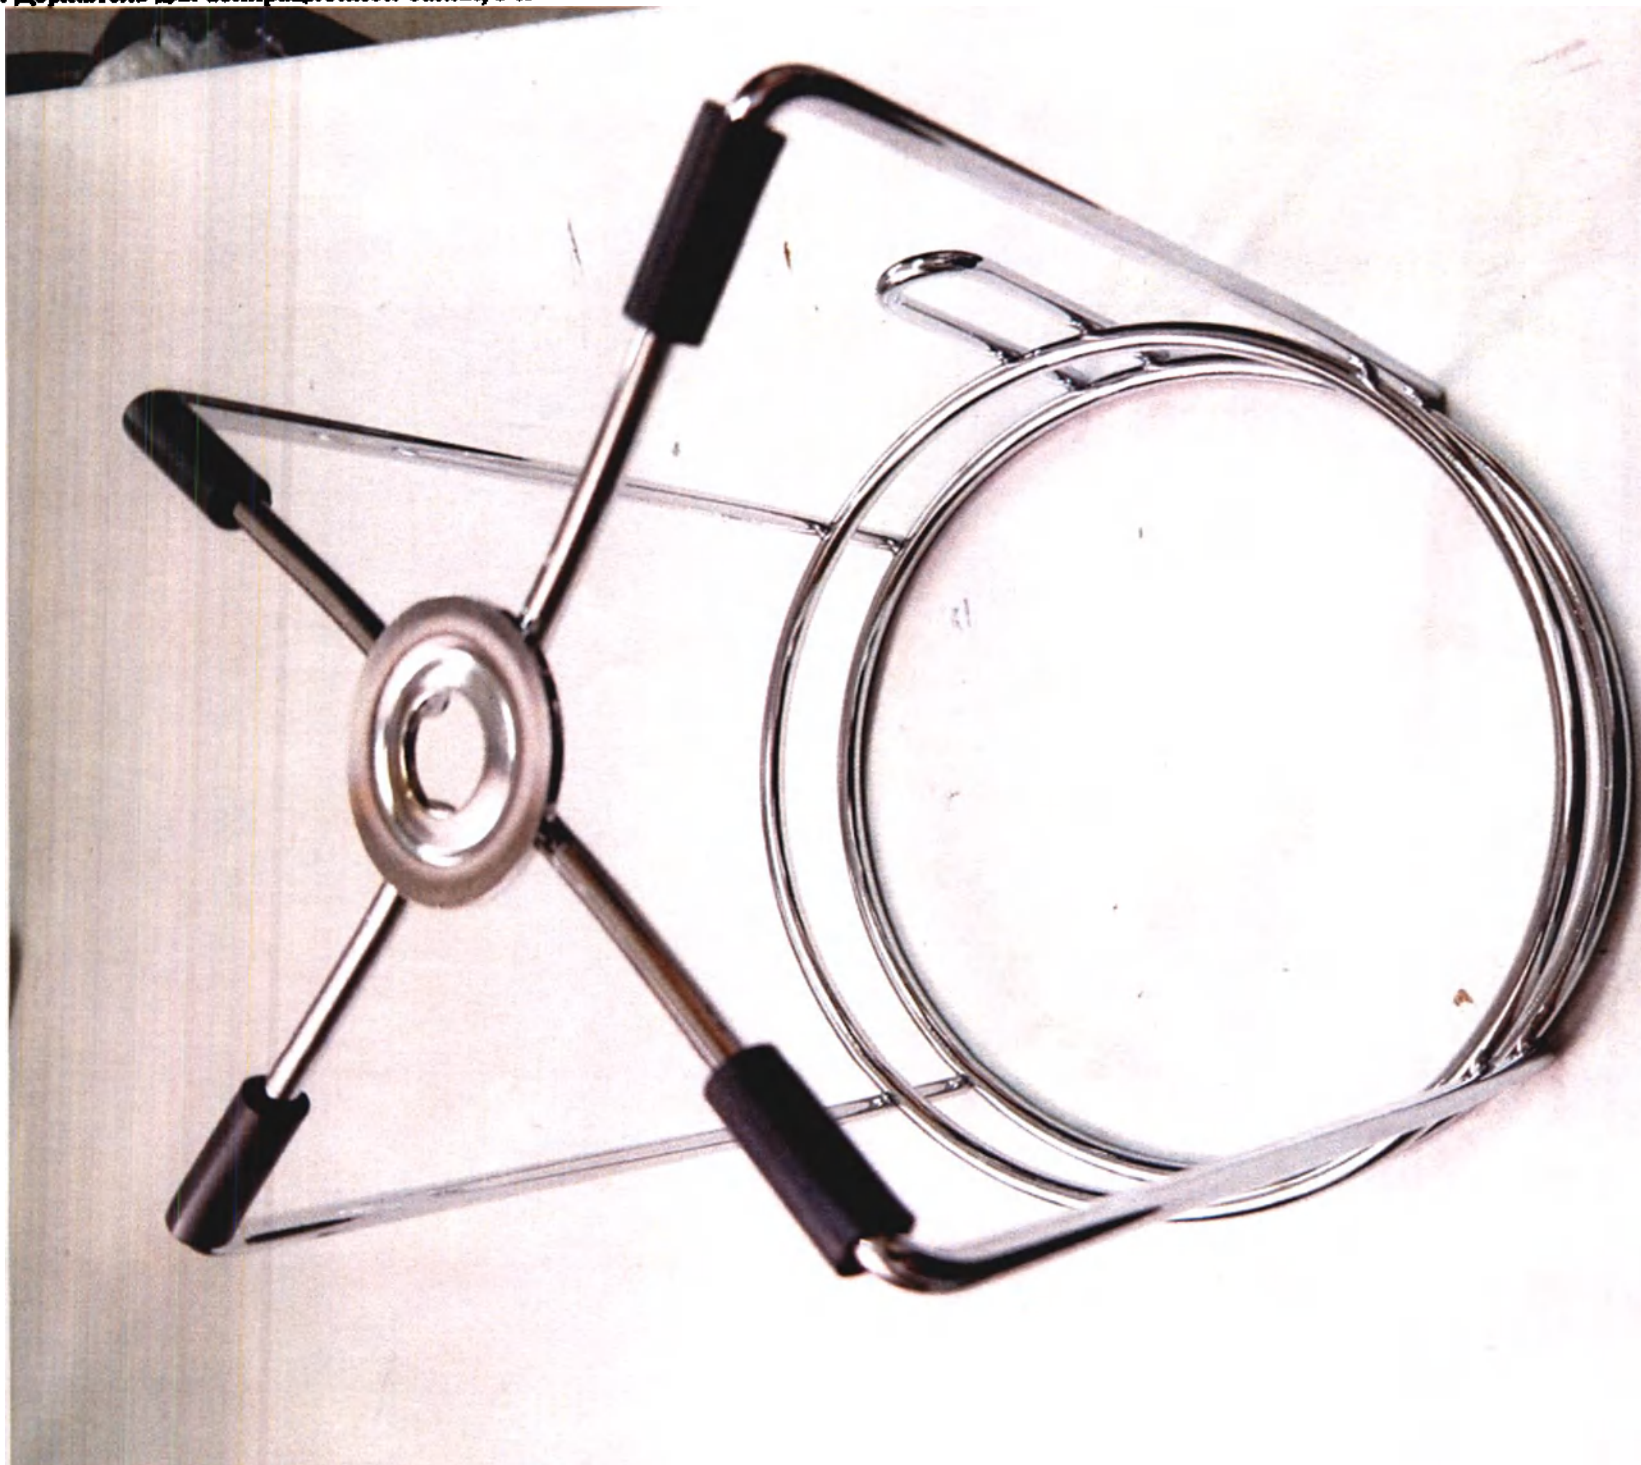

9. Элемент несущий для держателя банки

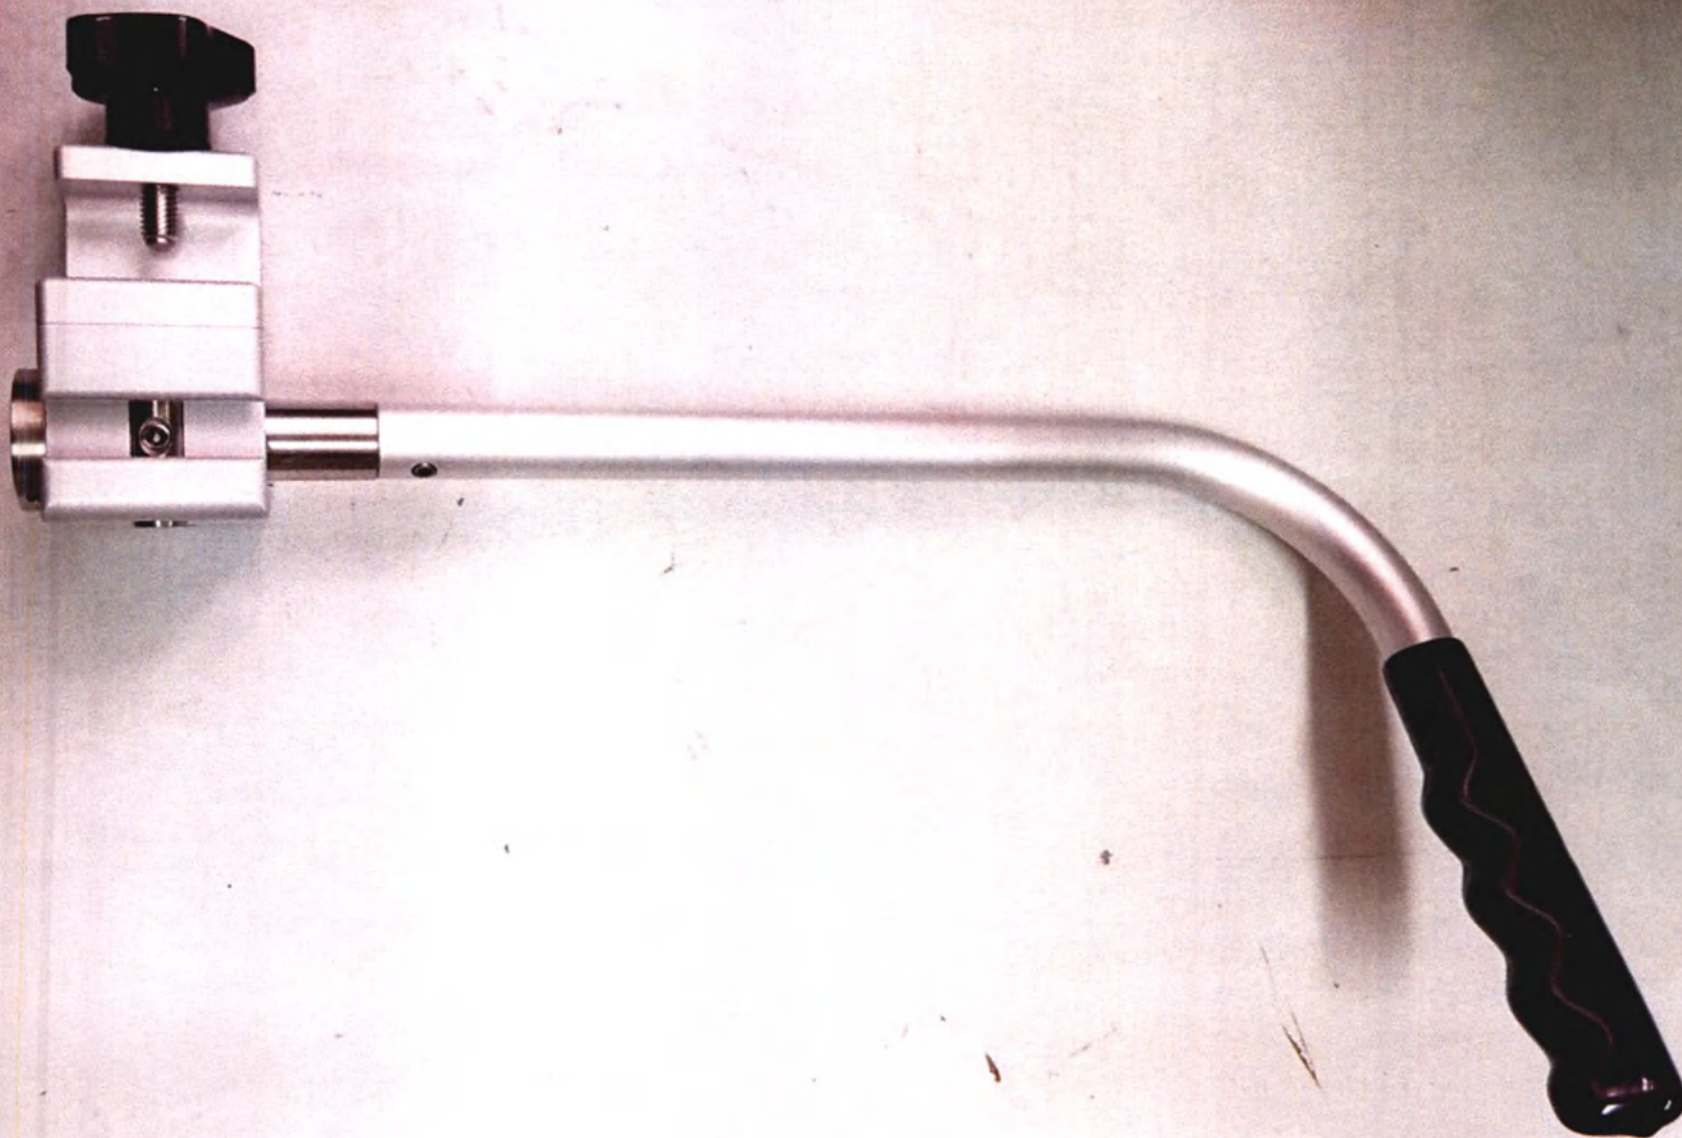


10. Банка аспирационная, 0,5 л, стерилизуемая

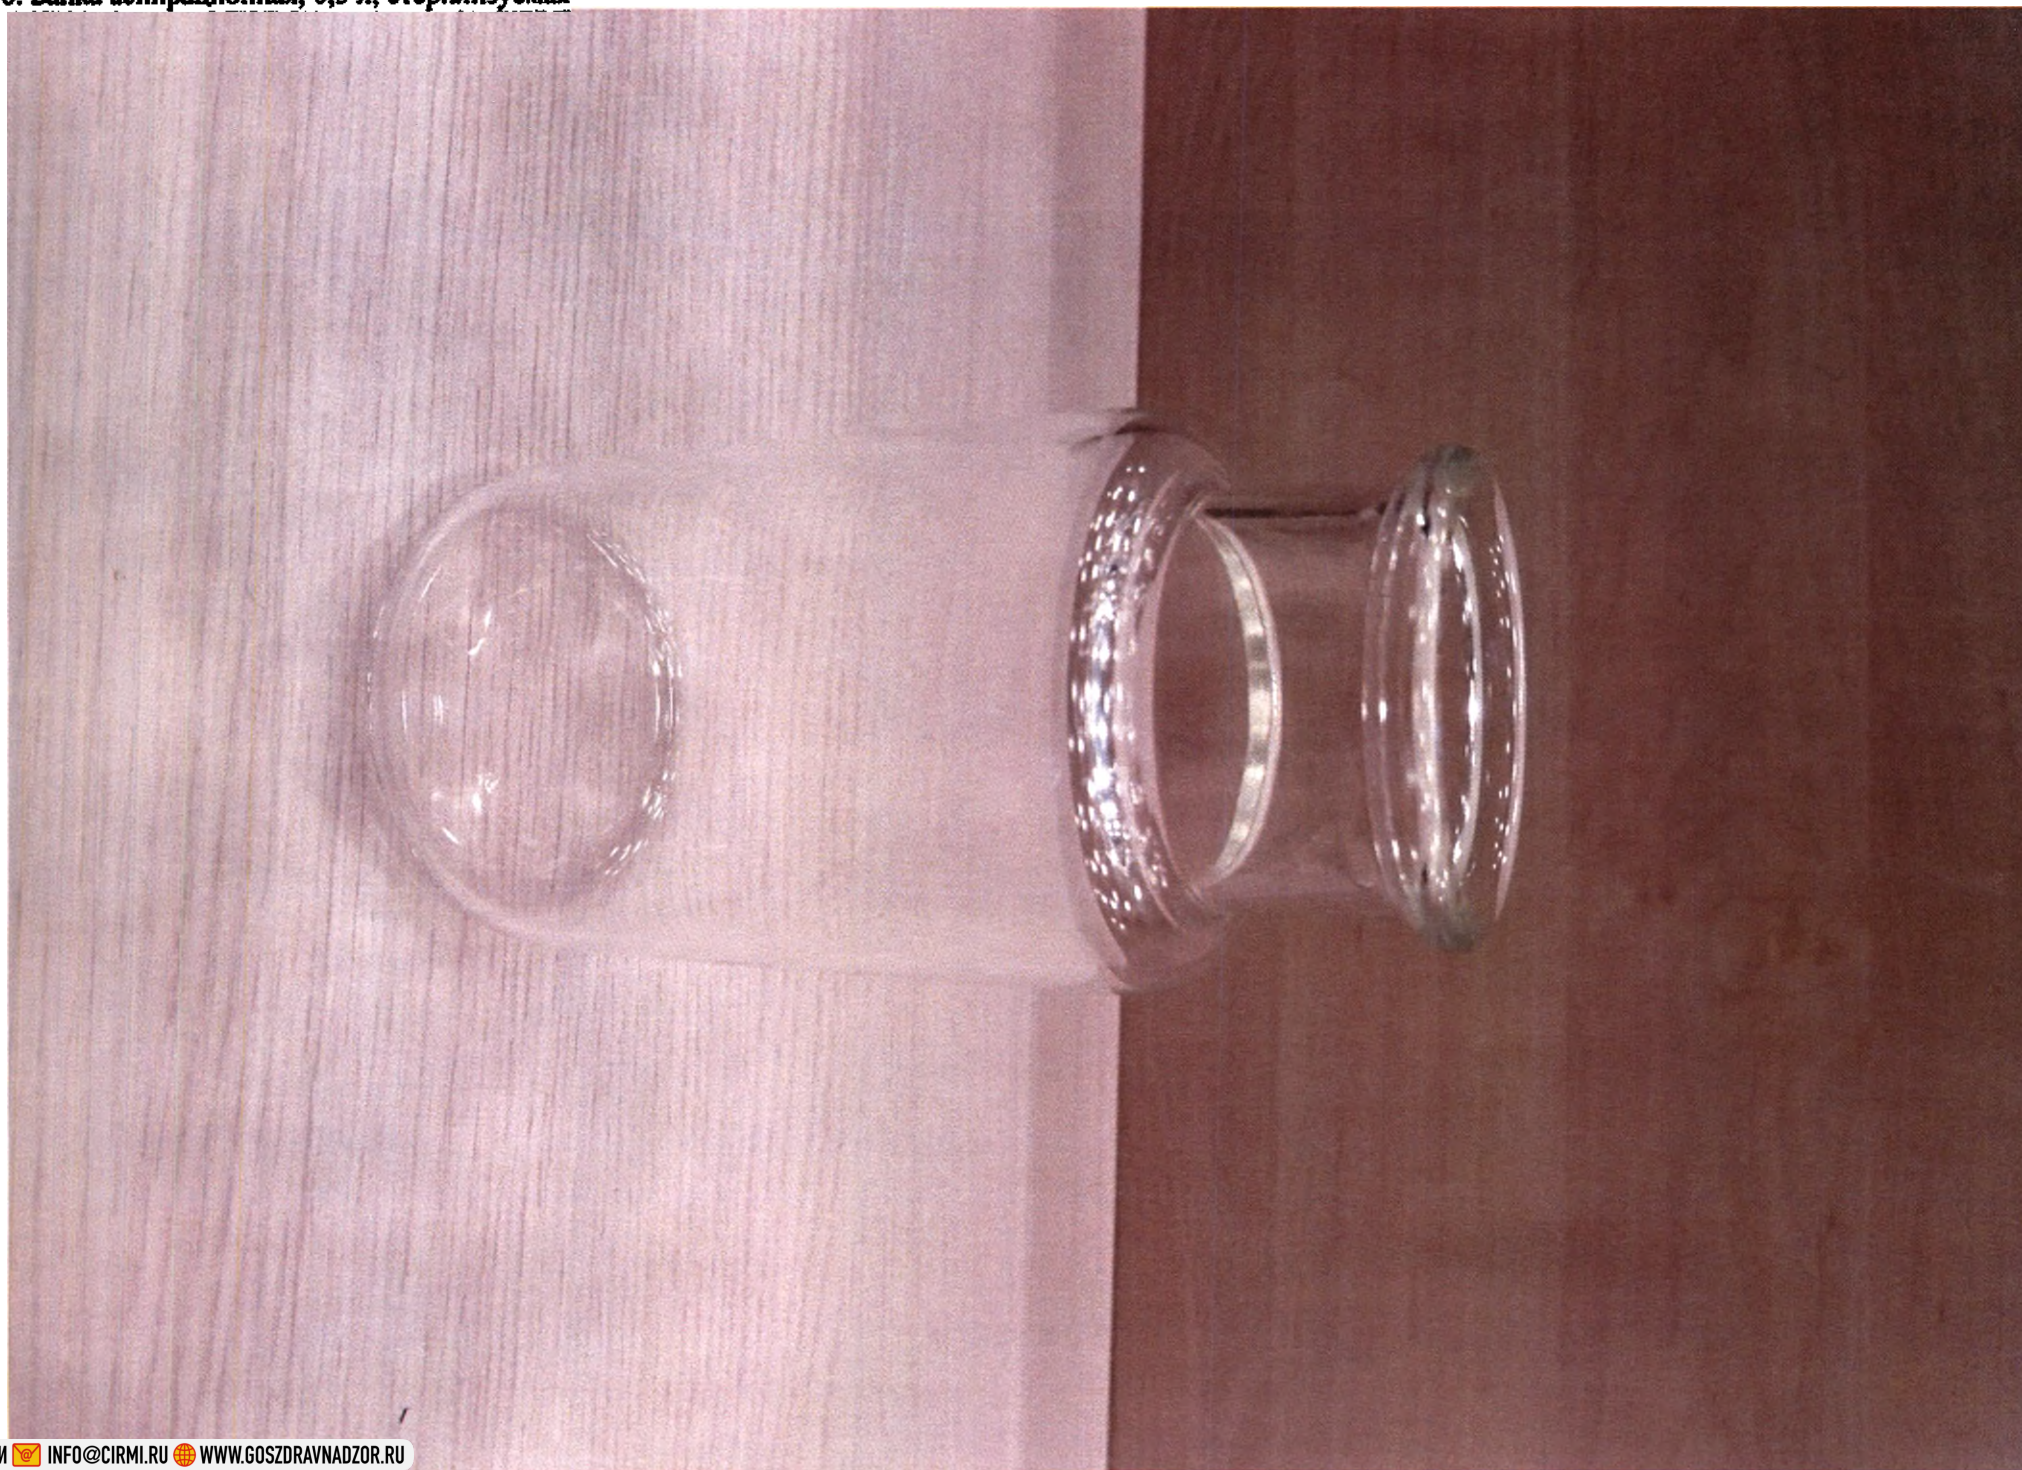


11. Крышка для применения с аспирационной банкой, 0,5 л




12. Держатель, для аспирационной банки 0,5 л

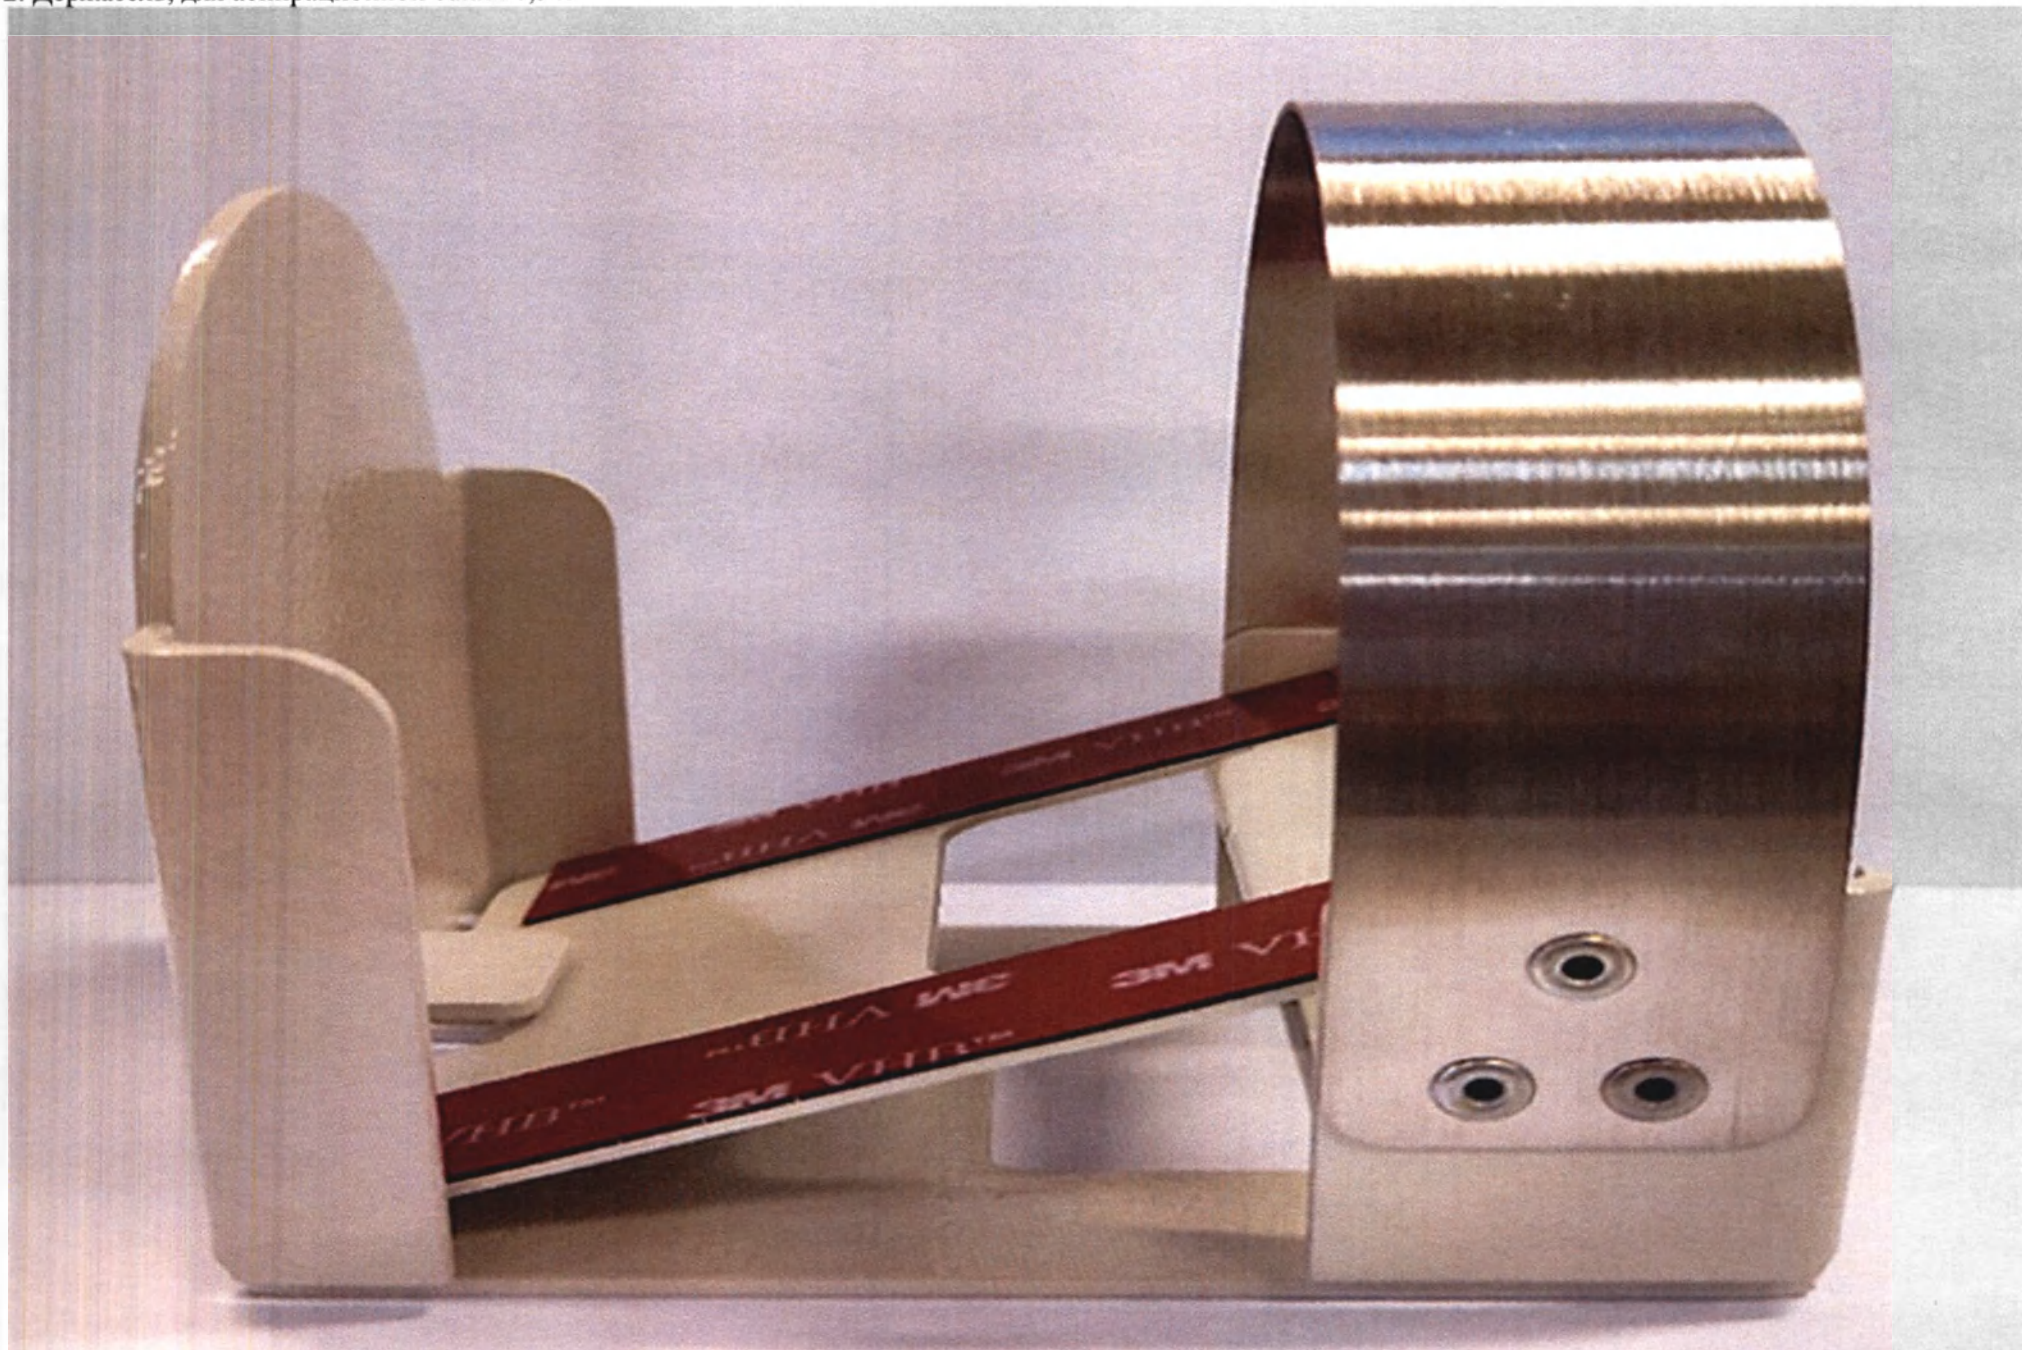


13. Кабель дистанционного управления для комбинации с UNIDRIVE S III ARTHRO

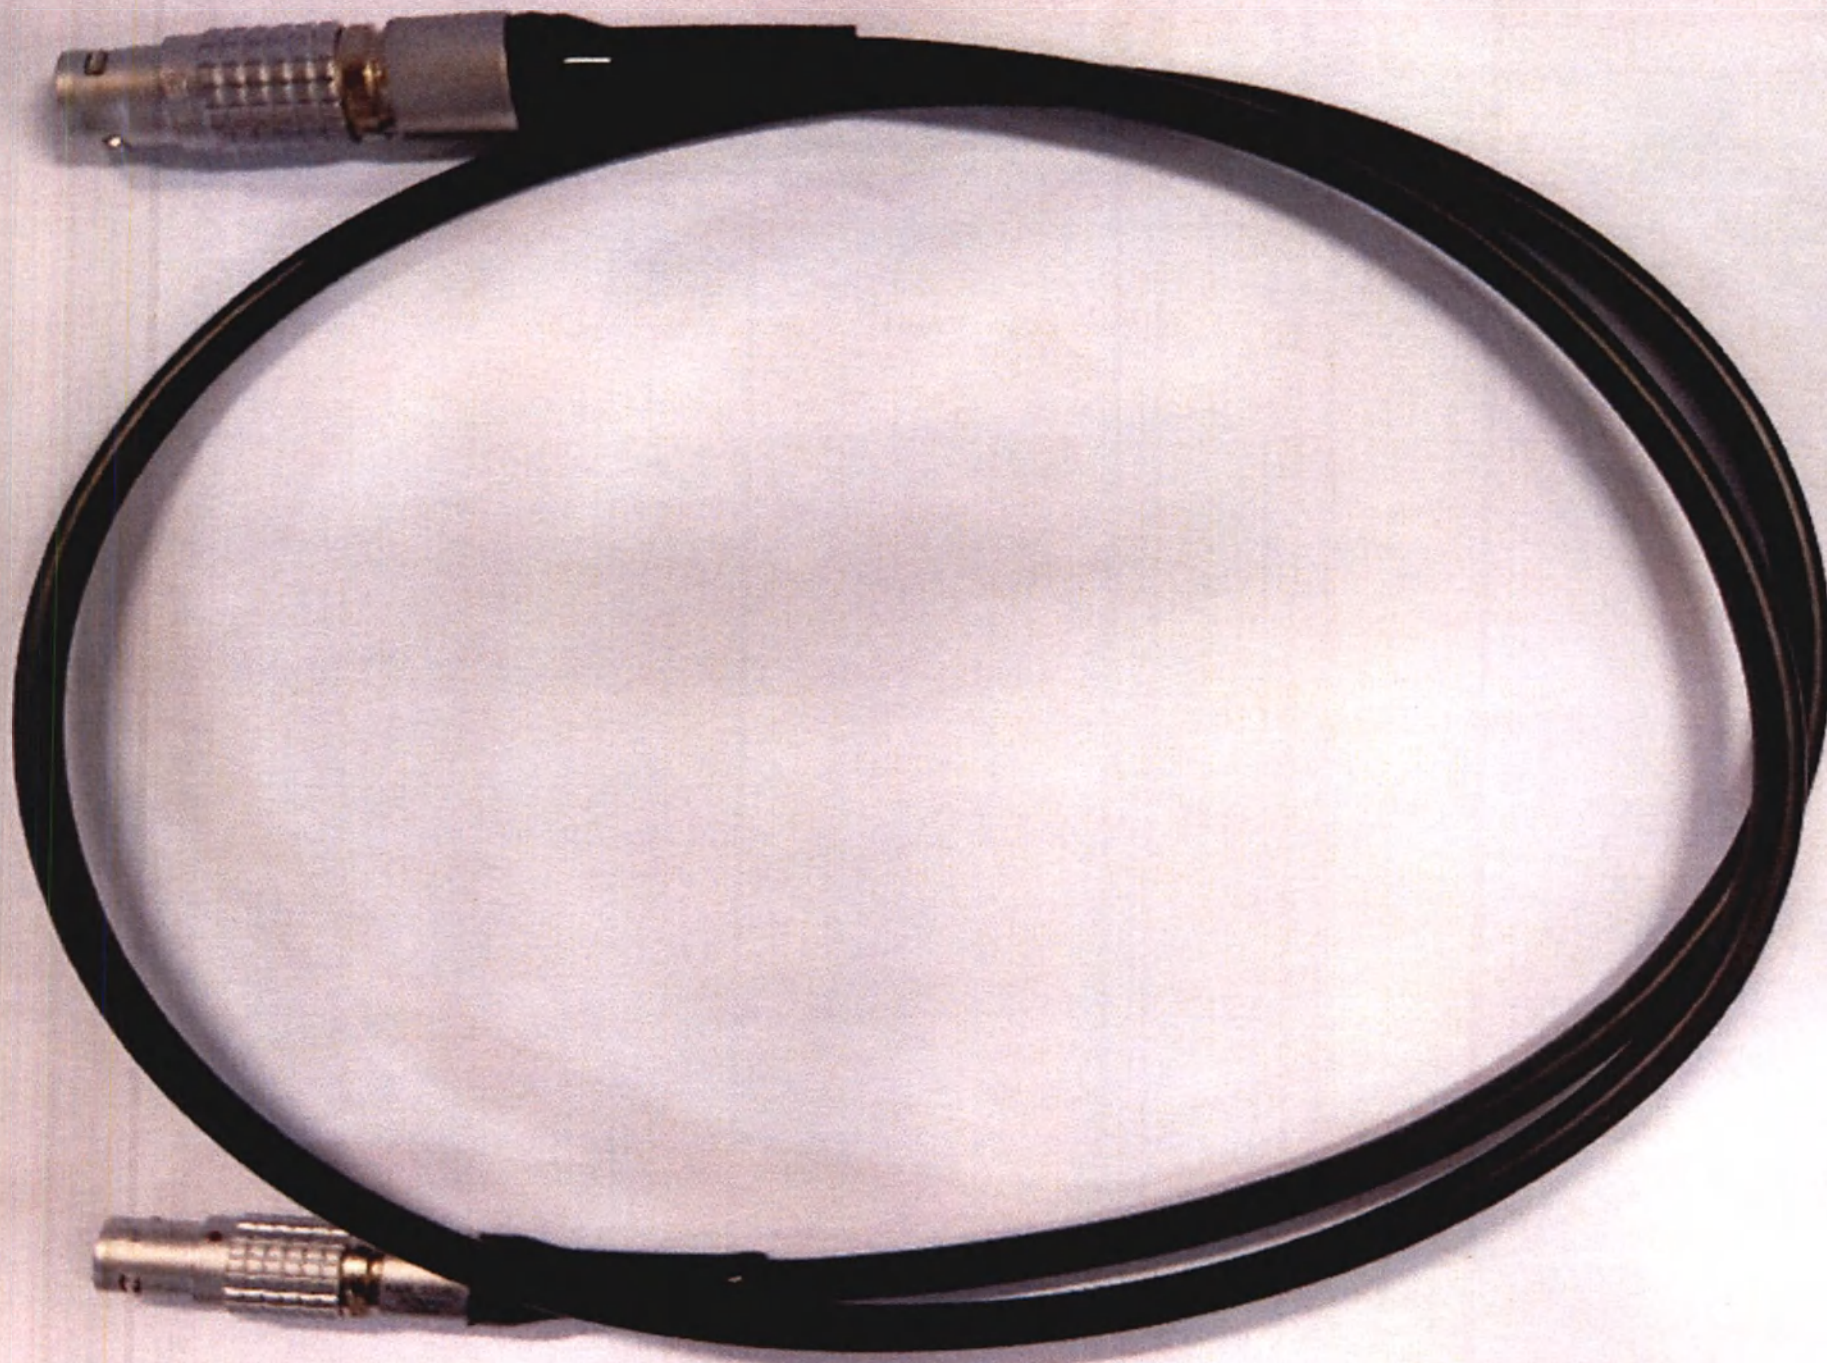

14. Кабель дистанционного управления для комбинации с UNIDRIVE S III или CALCUSON

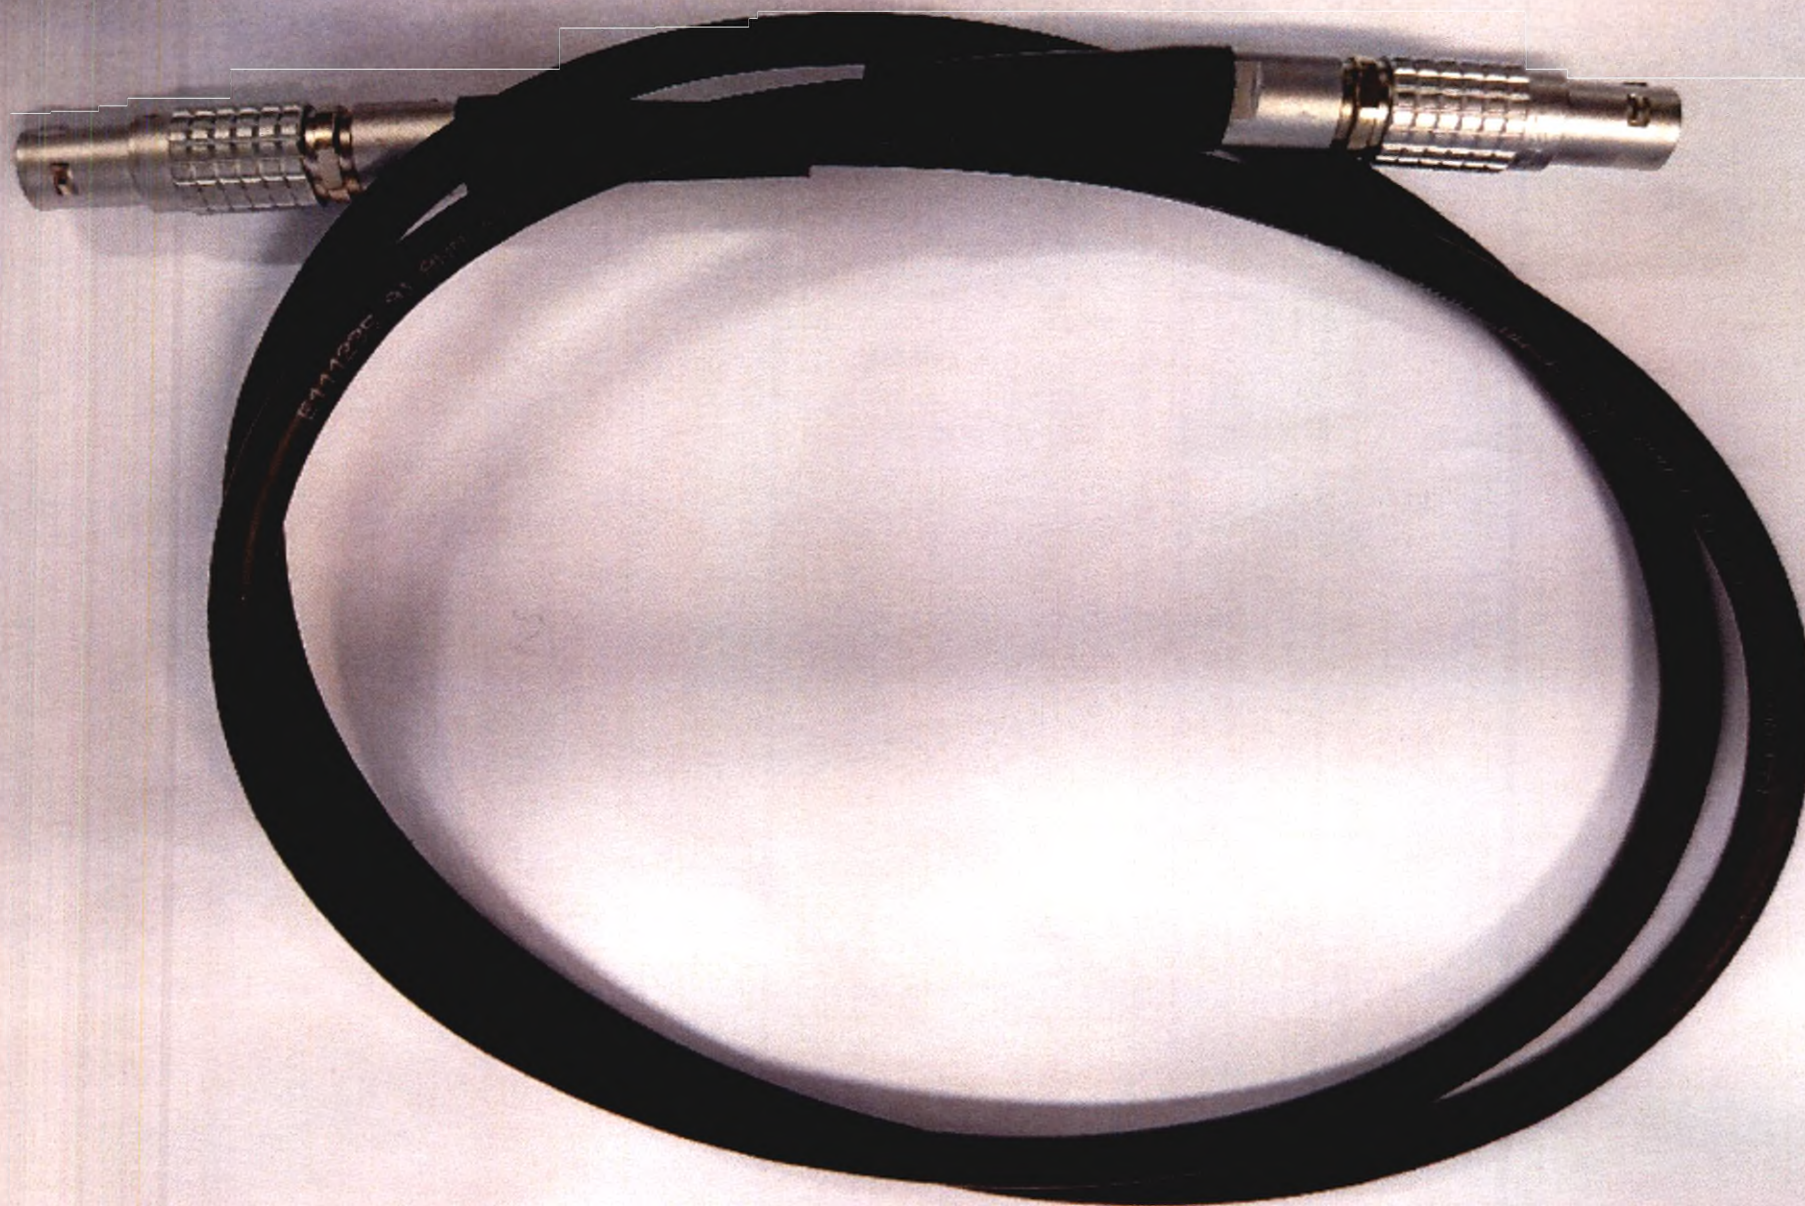

15. Переключатель однопедальный для ENT/NEURO

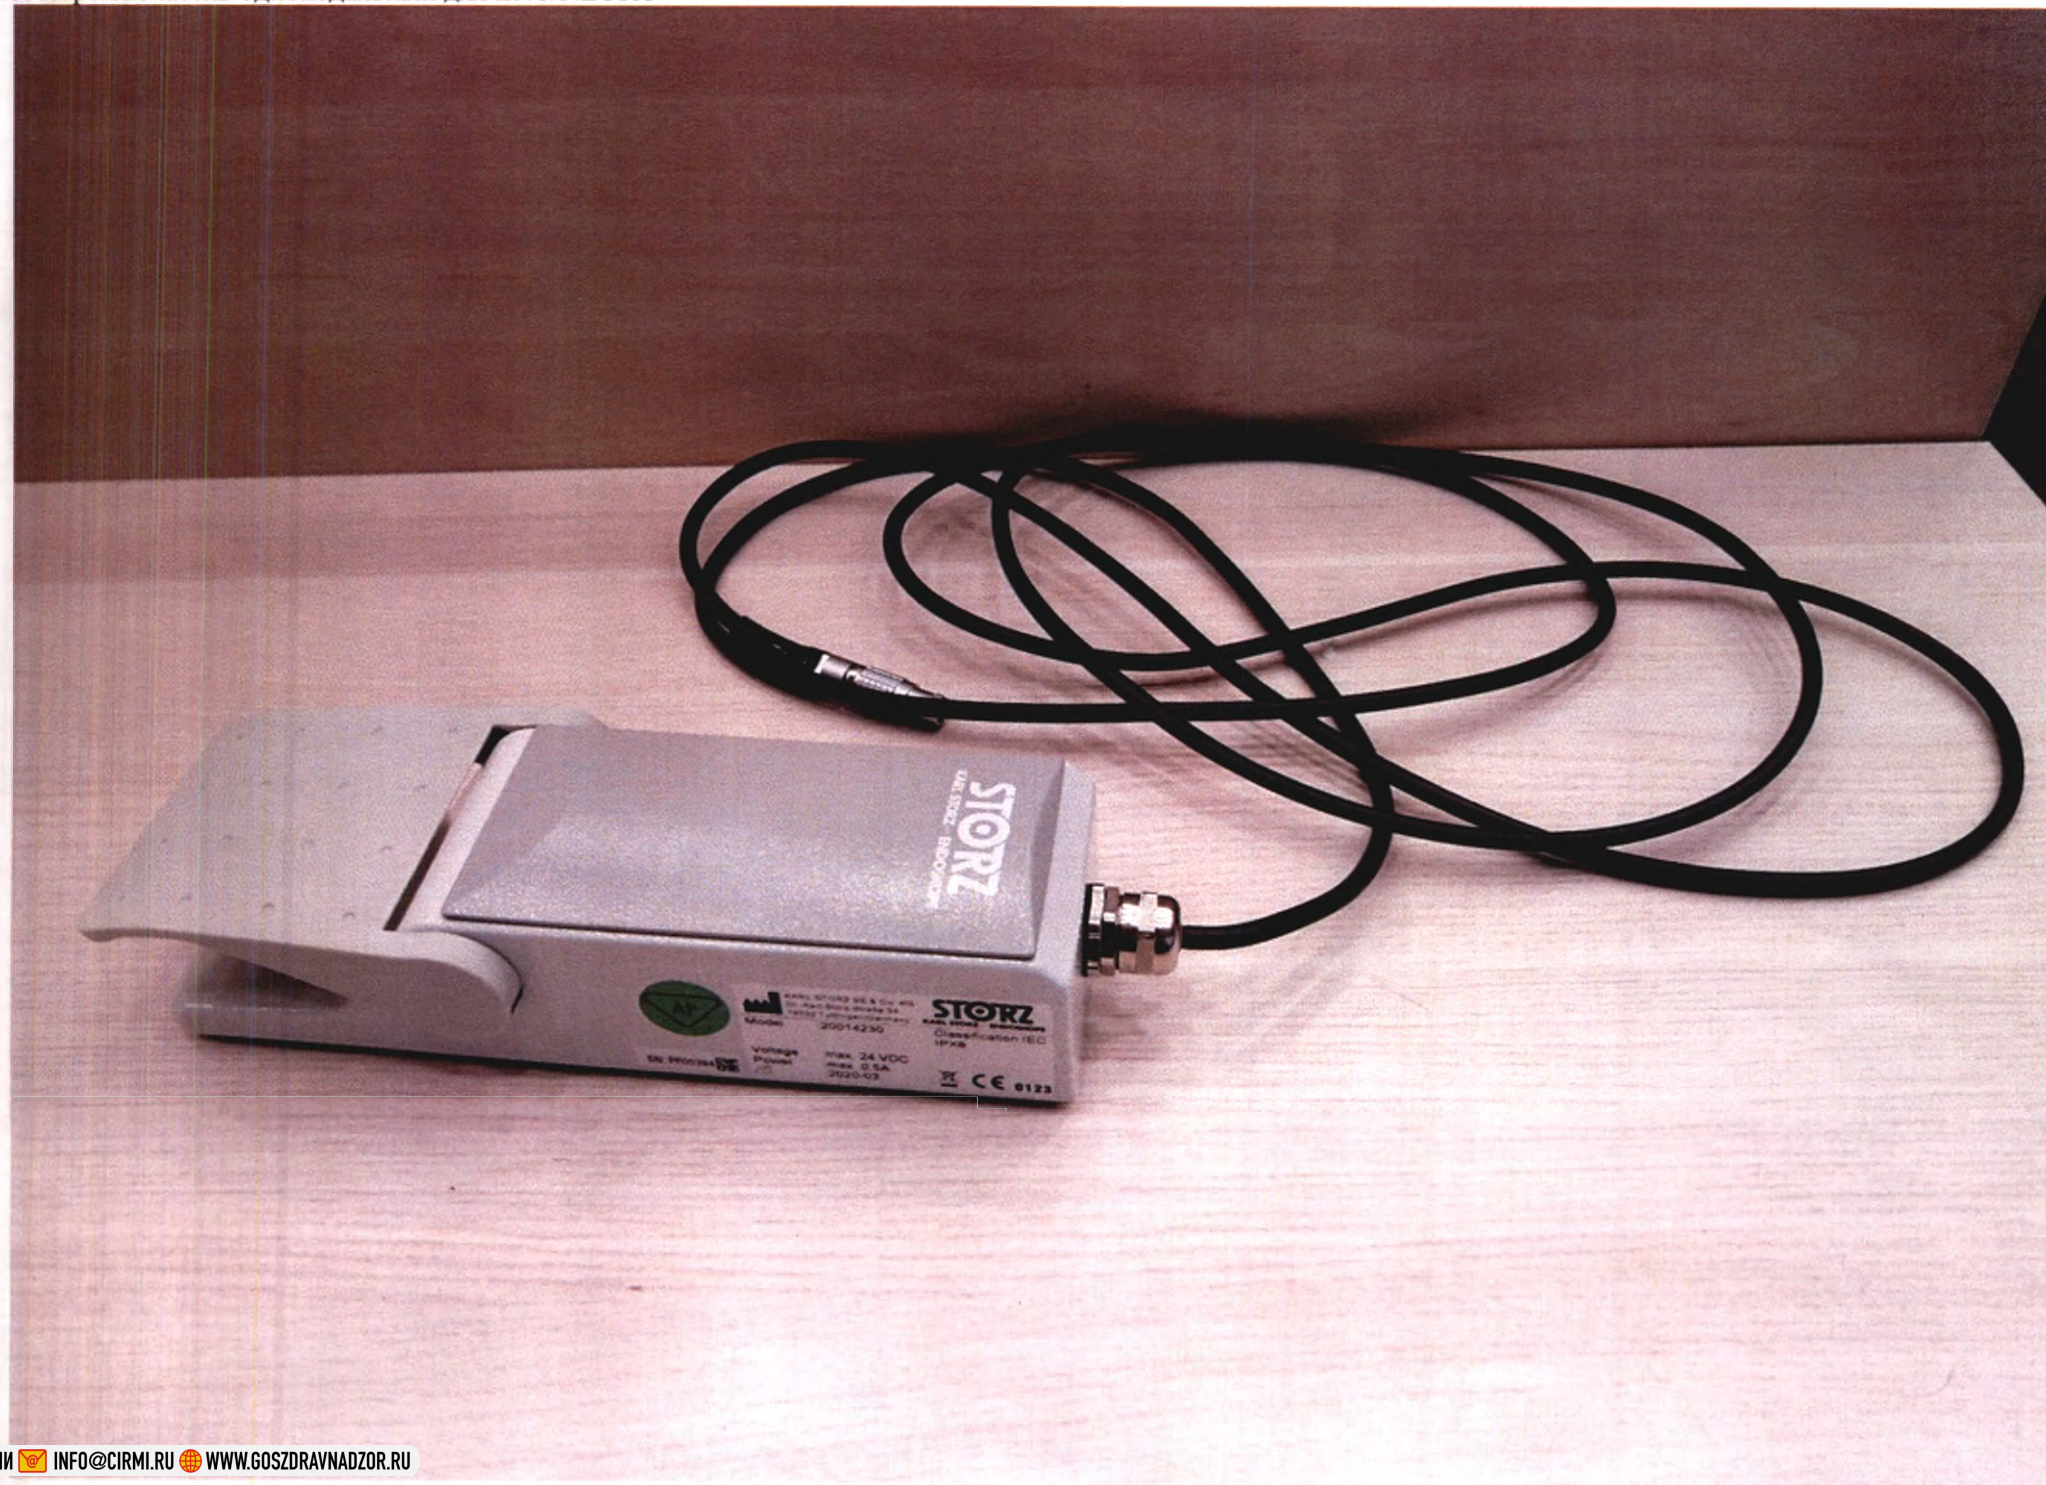



(01) 04048551262016
(21) PP05394
AN: 20014230



16. Переключатель однопедальный для GI





(01) 04048551262023
(21) A06XLG
AN: 20014130





SN: A06XLG



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

Model :20014130

Classification IEC
IPX8

Voltage :max. 24 VDC

Power :max. 0,5A




:2020-04



CE 0123

17. Кабель соединительный SCB, длина 100 см

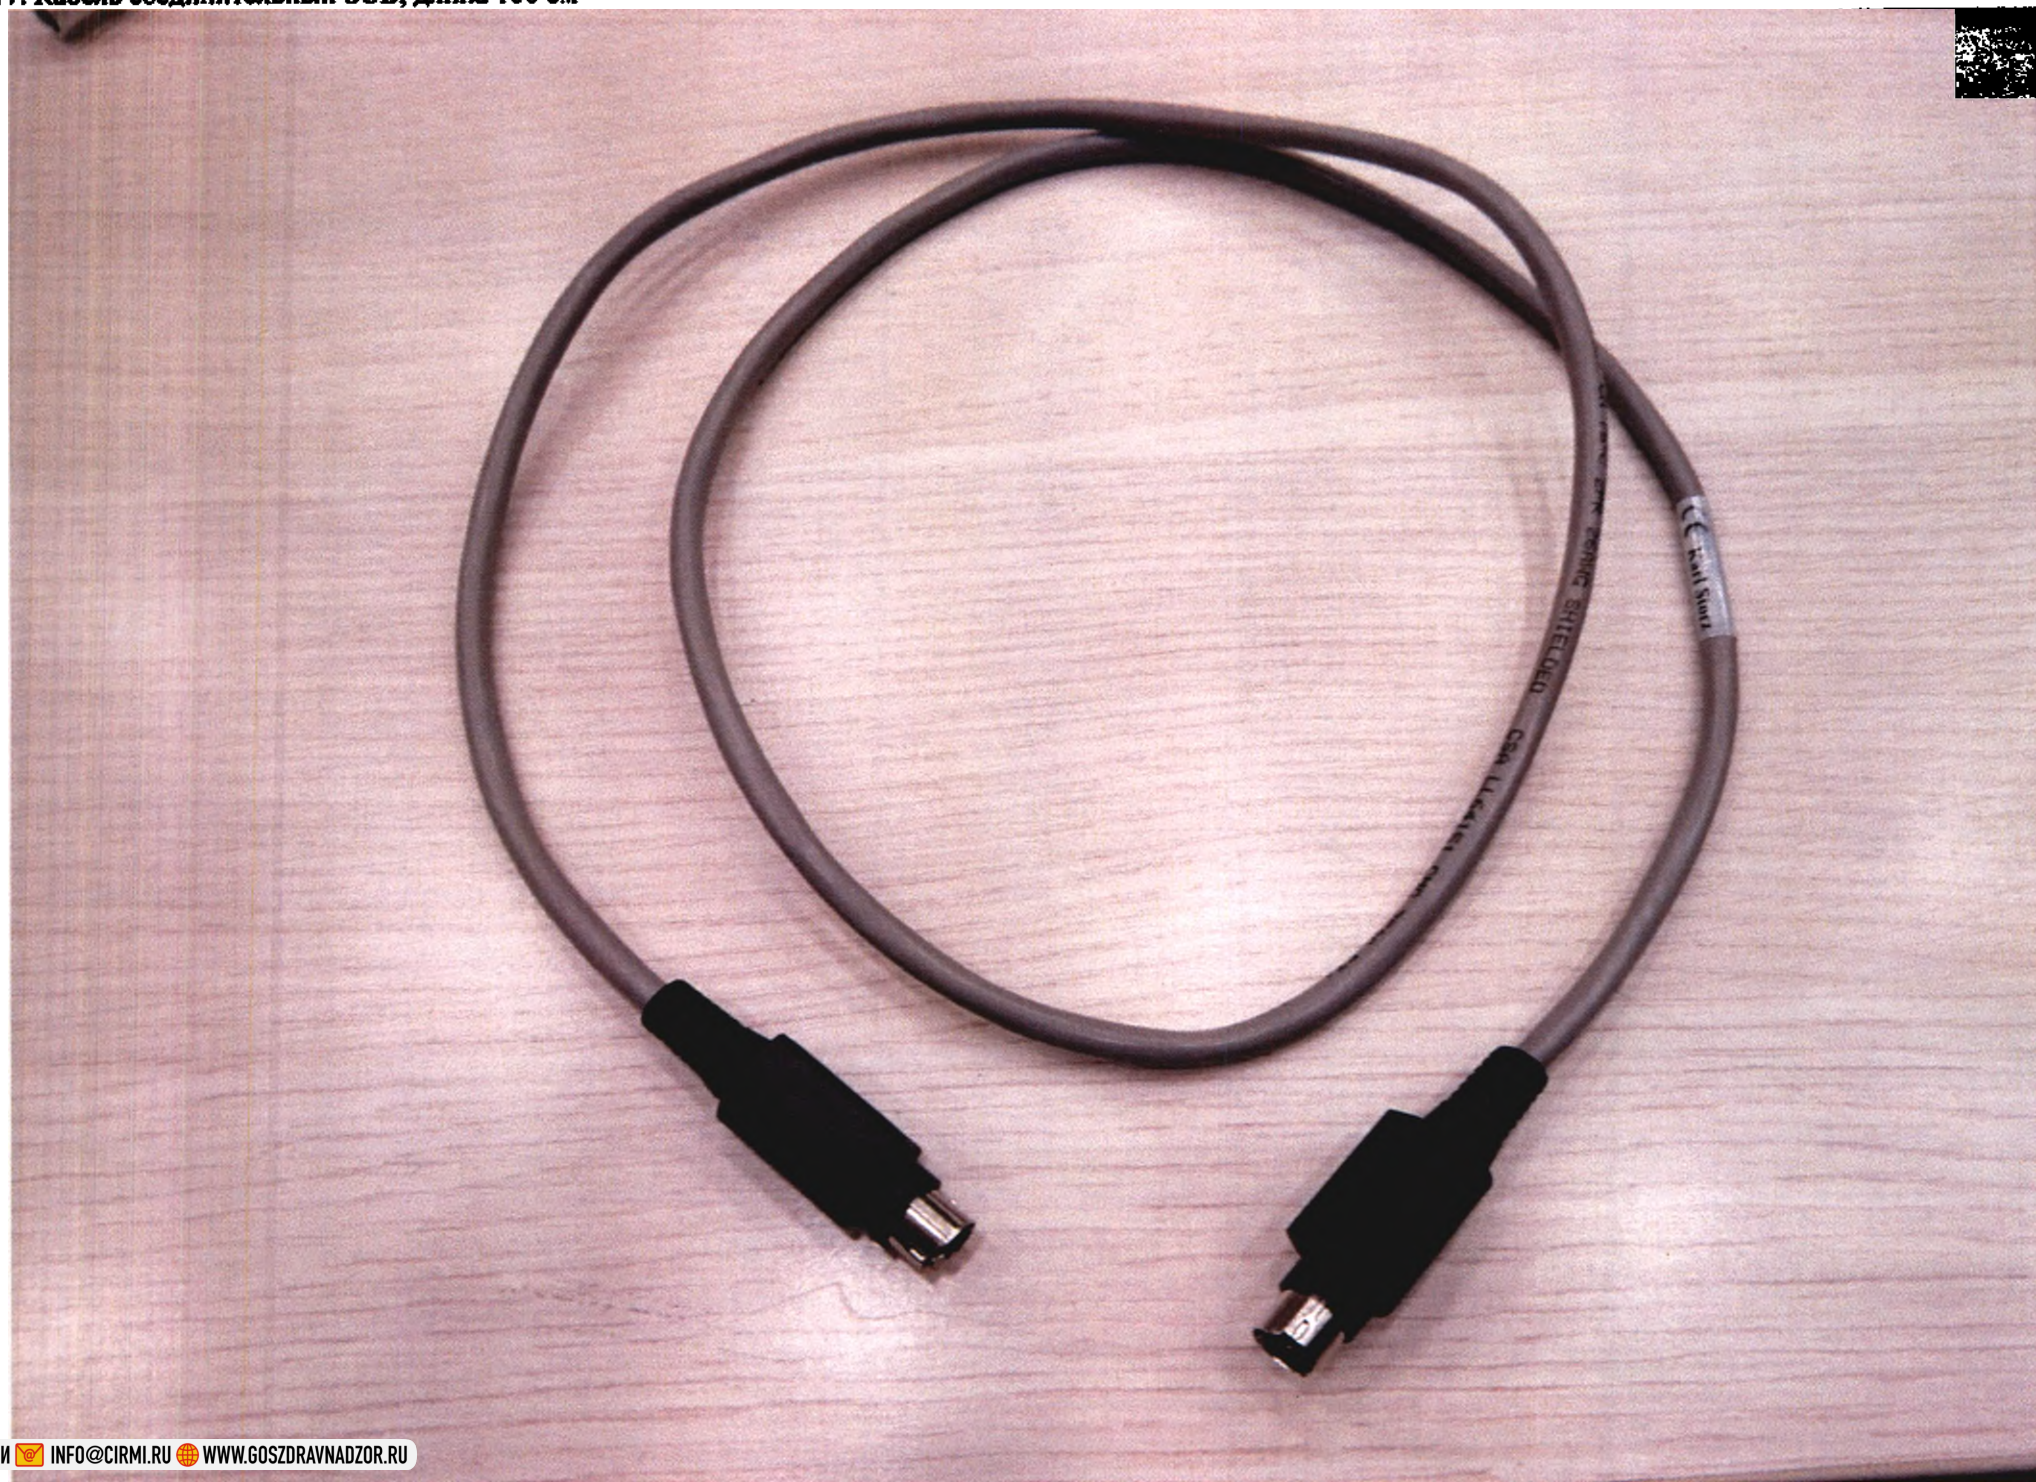



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ ENDOSKOPE

Помпа ENDOMAT SELECT UP210

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ ENDOSKOPE

Производитель

Karl Storz SE & Co.KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34,
78532 Tuttlingen, Germany (Германия)

Уполномоченный пред-
ставитель на
территории РФ

Общество с ограниченной ответственностью
«Карл Шторц – Эндоскопы Восток» (ООО «КШТЭ ВО-
СТОК»).
Россия, 115114, Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 4.

Информация о сроке
службы

См. инструкцию по применению

Сделано в

Швейцария

Сайт

<https://www.karlstorz.com/de/ru/index.htm>




Вариант исполнения 2: Помпа ENDOMAT SELECT UP220 в составе:

1. Помпа ENDOMAT SELECT, модель UP220



STORZ
Model: LP720
Voltage: 100-240 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Power: 82 VA
2001-08
Classification: EEC
Class: I
IP21D
CE
01122



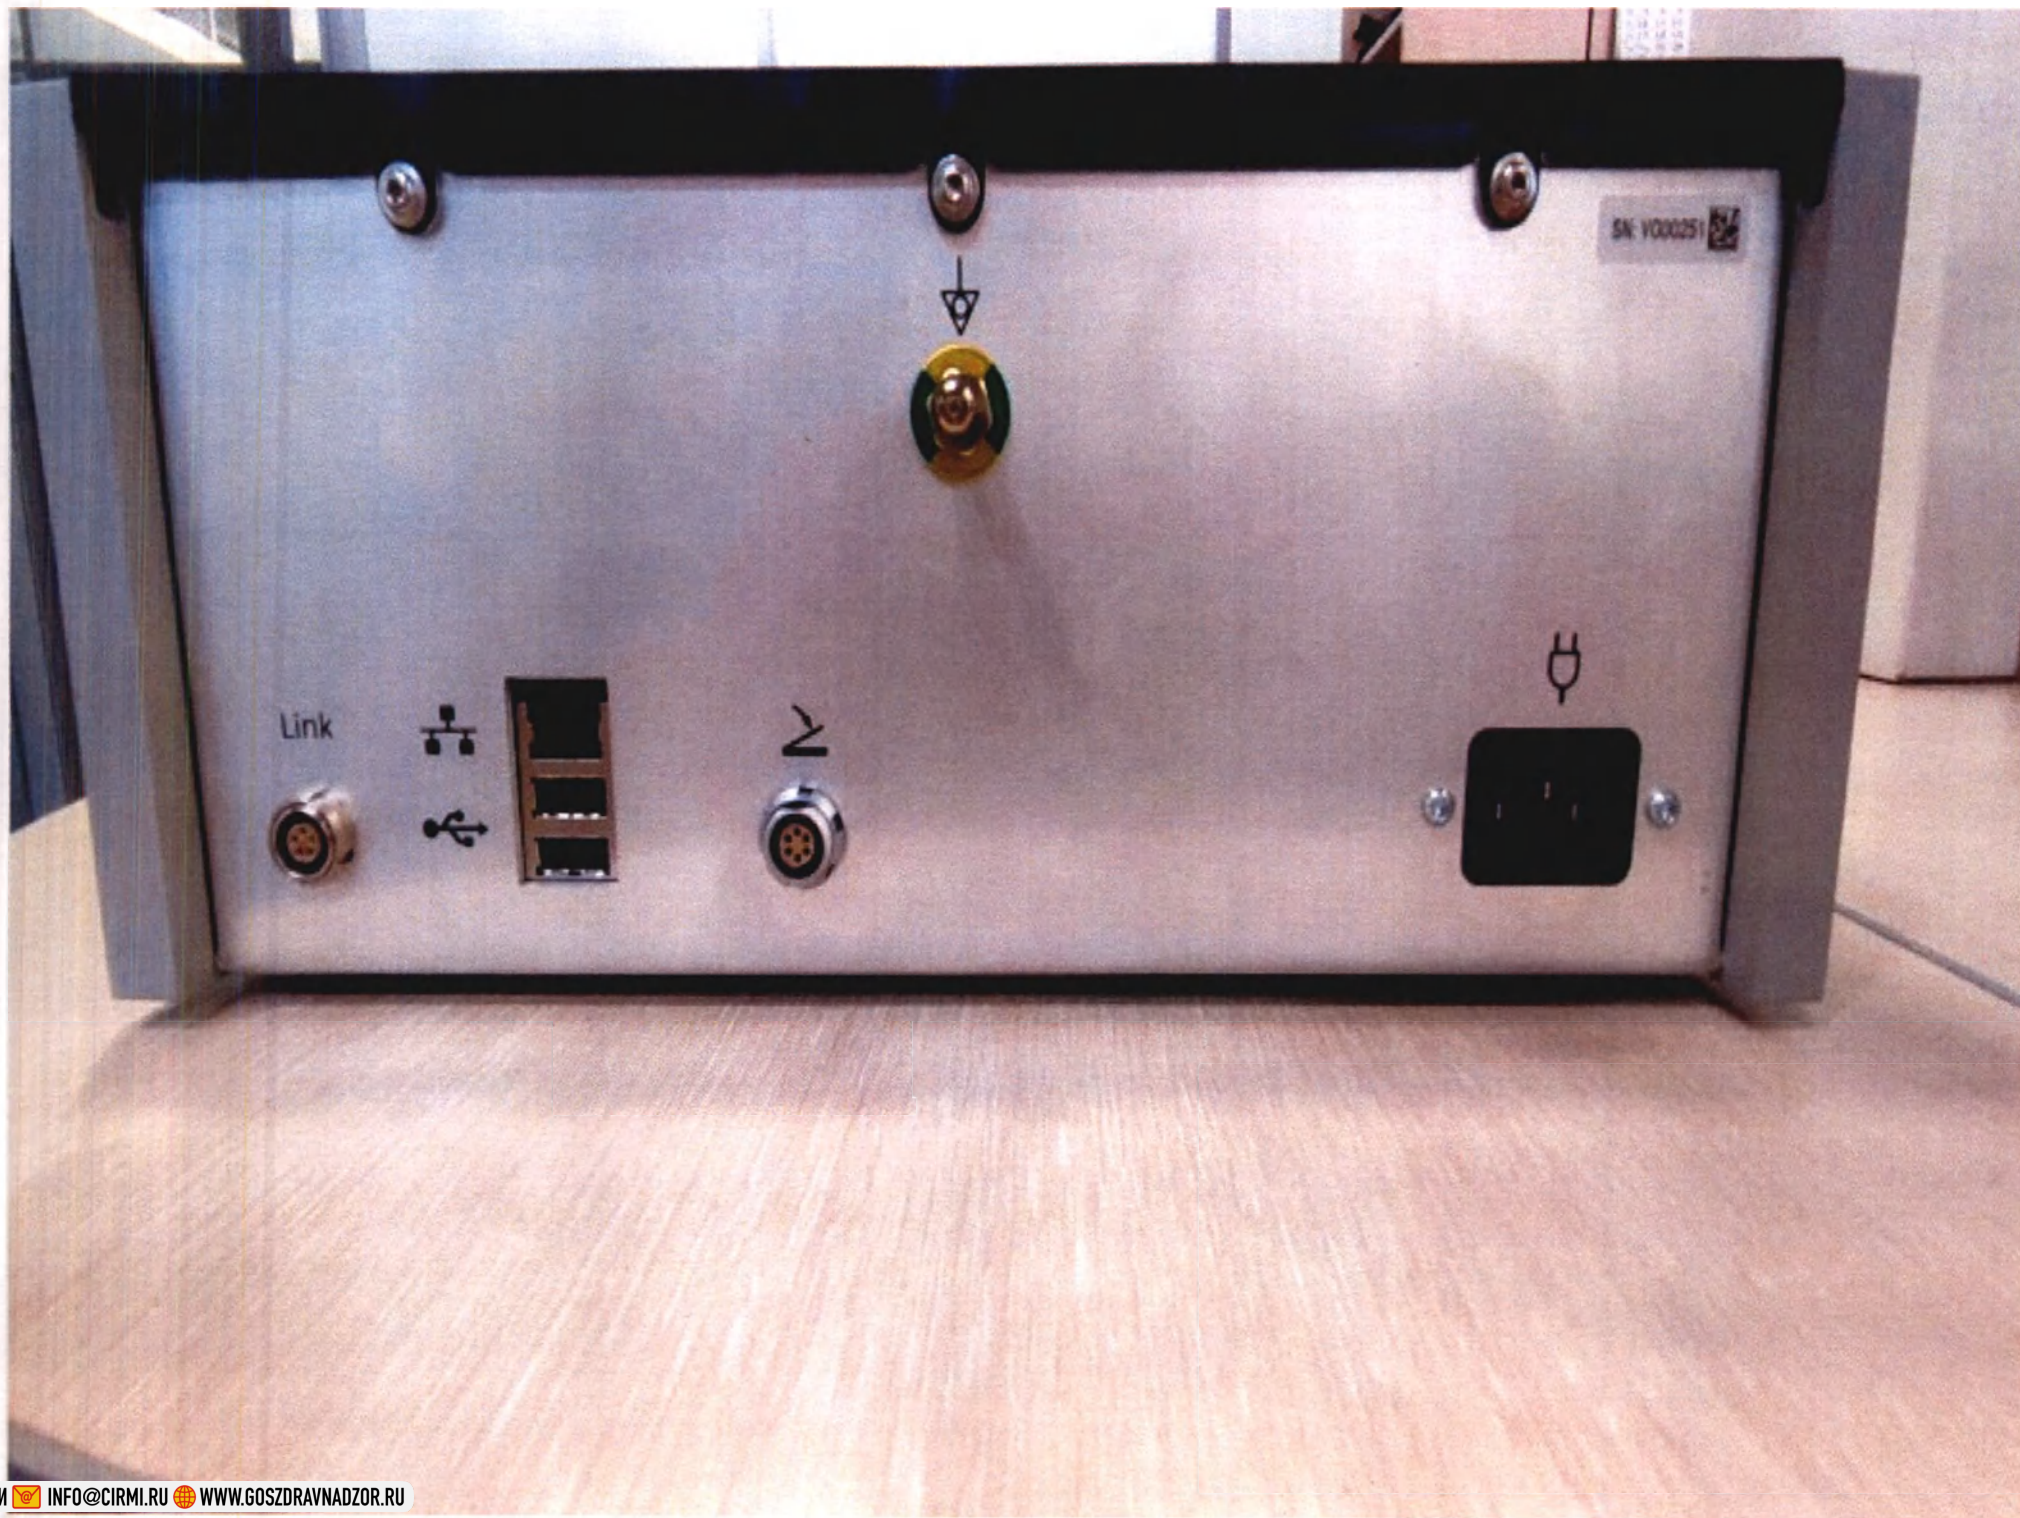



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany


STORZ

KARL STORZ — ENDOSCOPE

Model : UP220
Voltage : 100-240 VAC

Classification IEC
Class I IP21D

Frequency : 50/60 Hz
Power : 82 VA
Date : 2021-08



0123



C

US




(01) 04048551432822
(21) VO00251
AN UP220

SN: VO00251



2. Кабель сетевой, длина 300 см

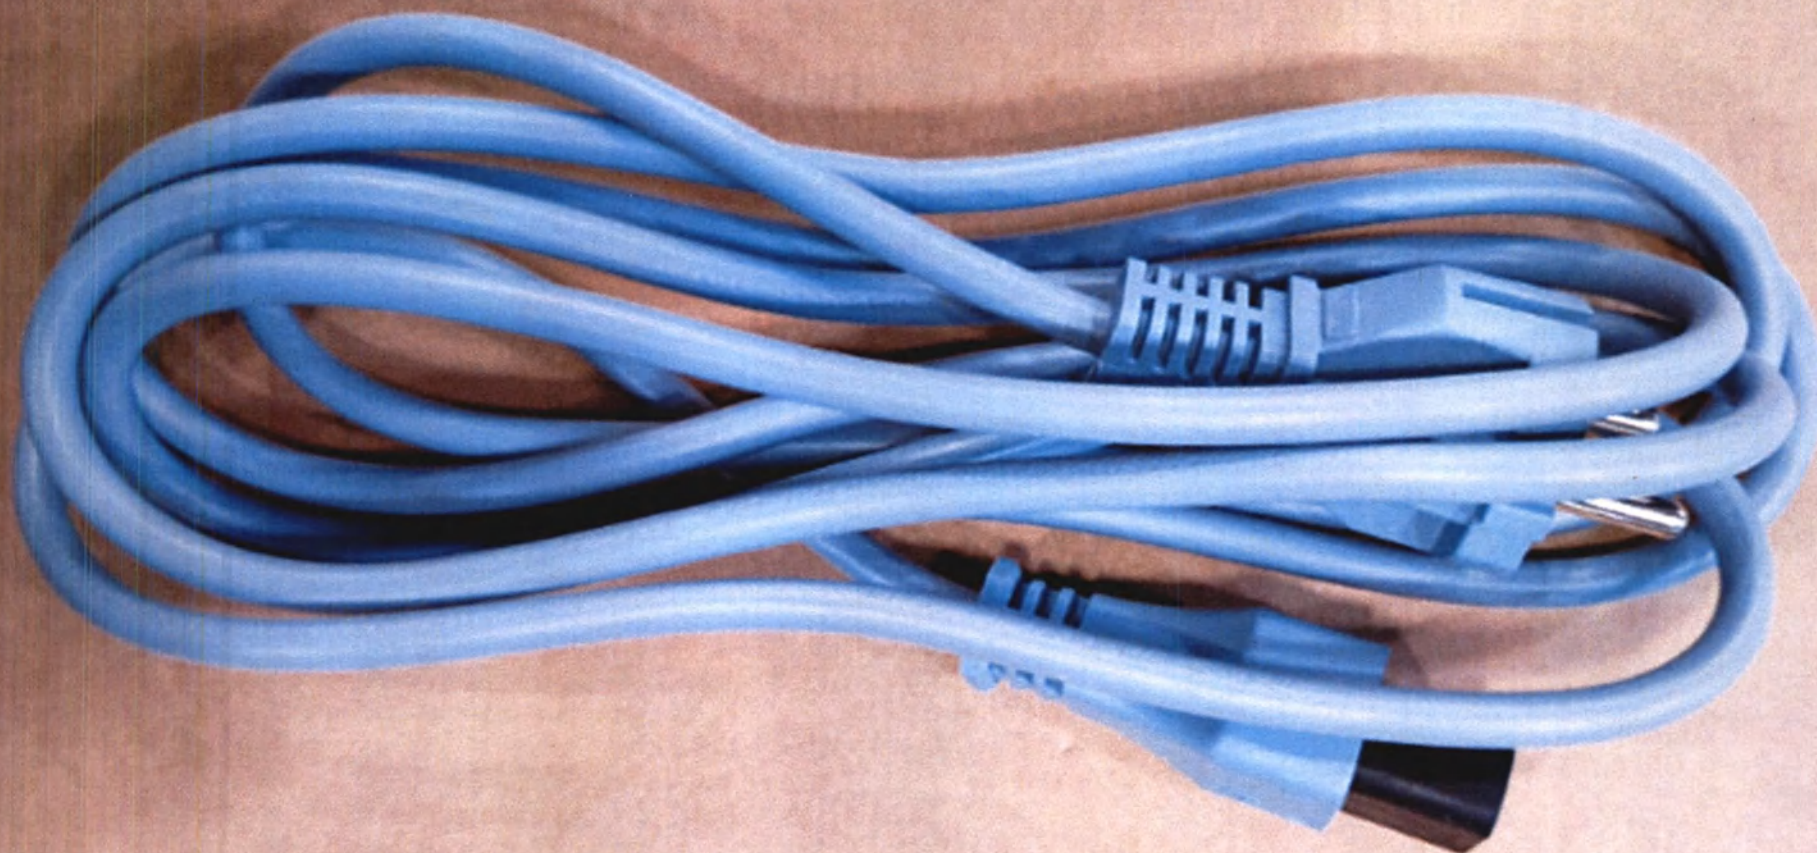

3. Инструкция по эксплуатации. Иллюстративный вид может быть изменен, содержание может быть приведено в соответствие с документом в регистрационном досье.


STORZ

KARL STORZ — ENDOSKOPE


en Instructions for use
ENDOMAT SELECT
UP220



4. Прибор проверки герметичности

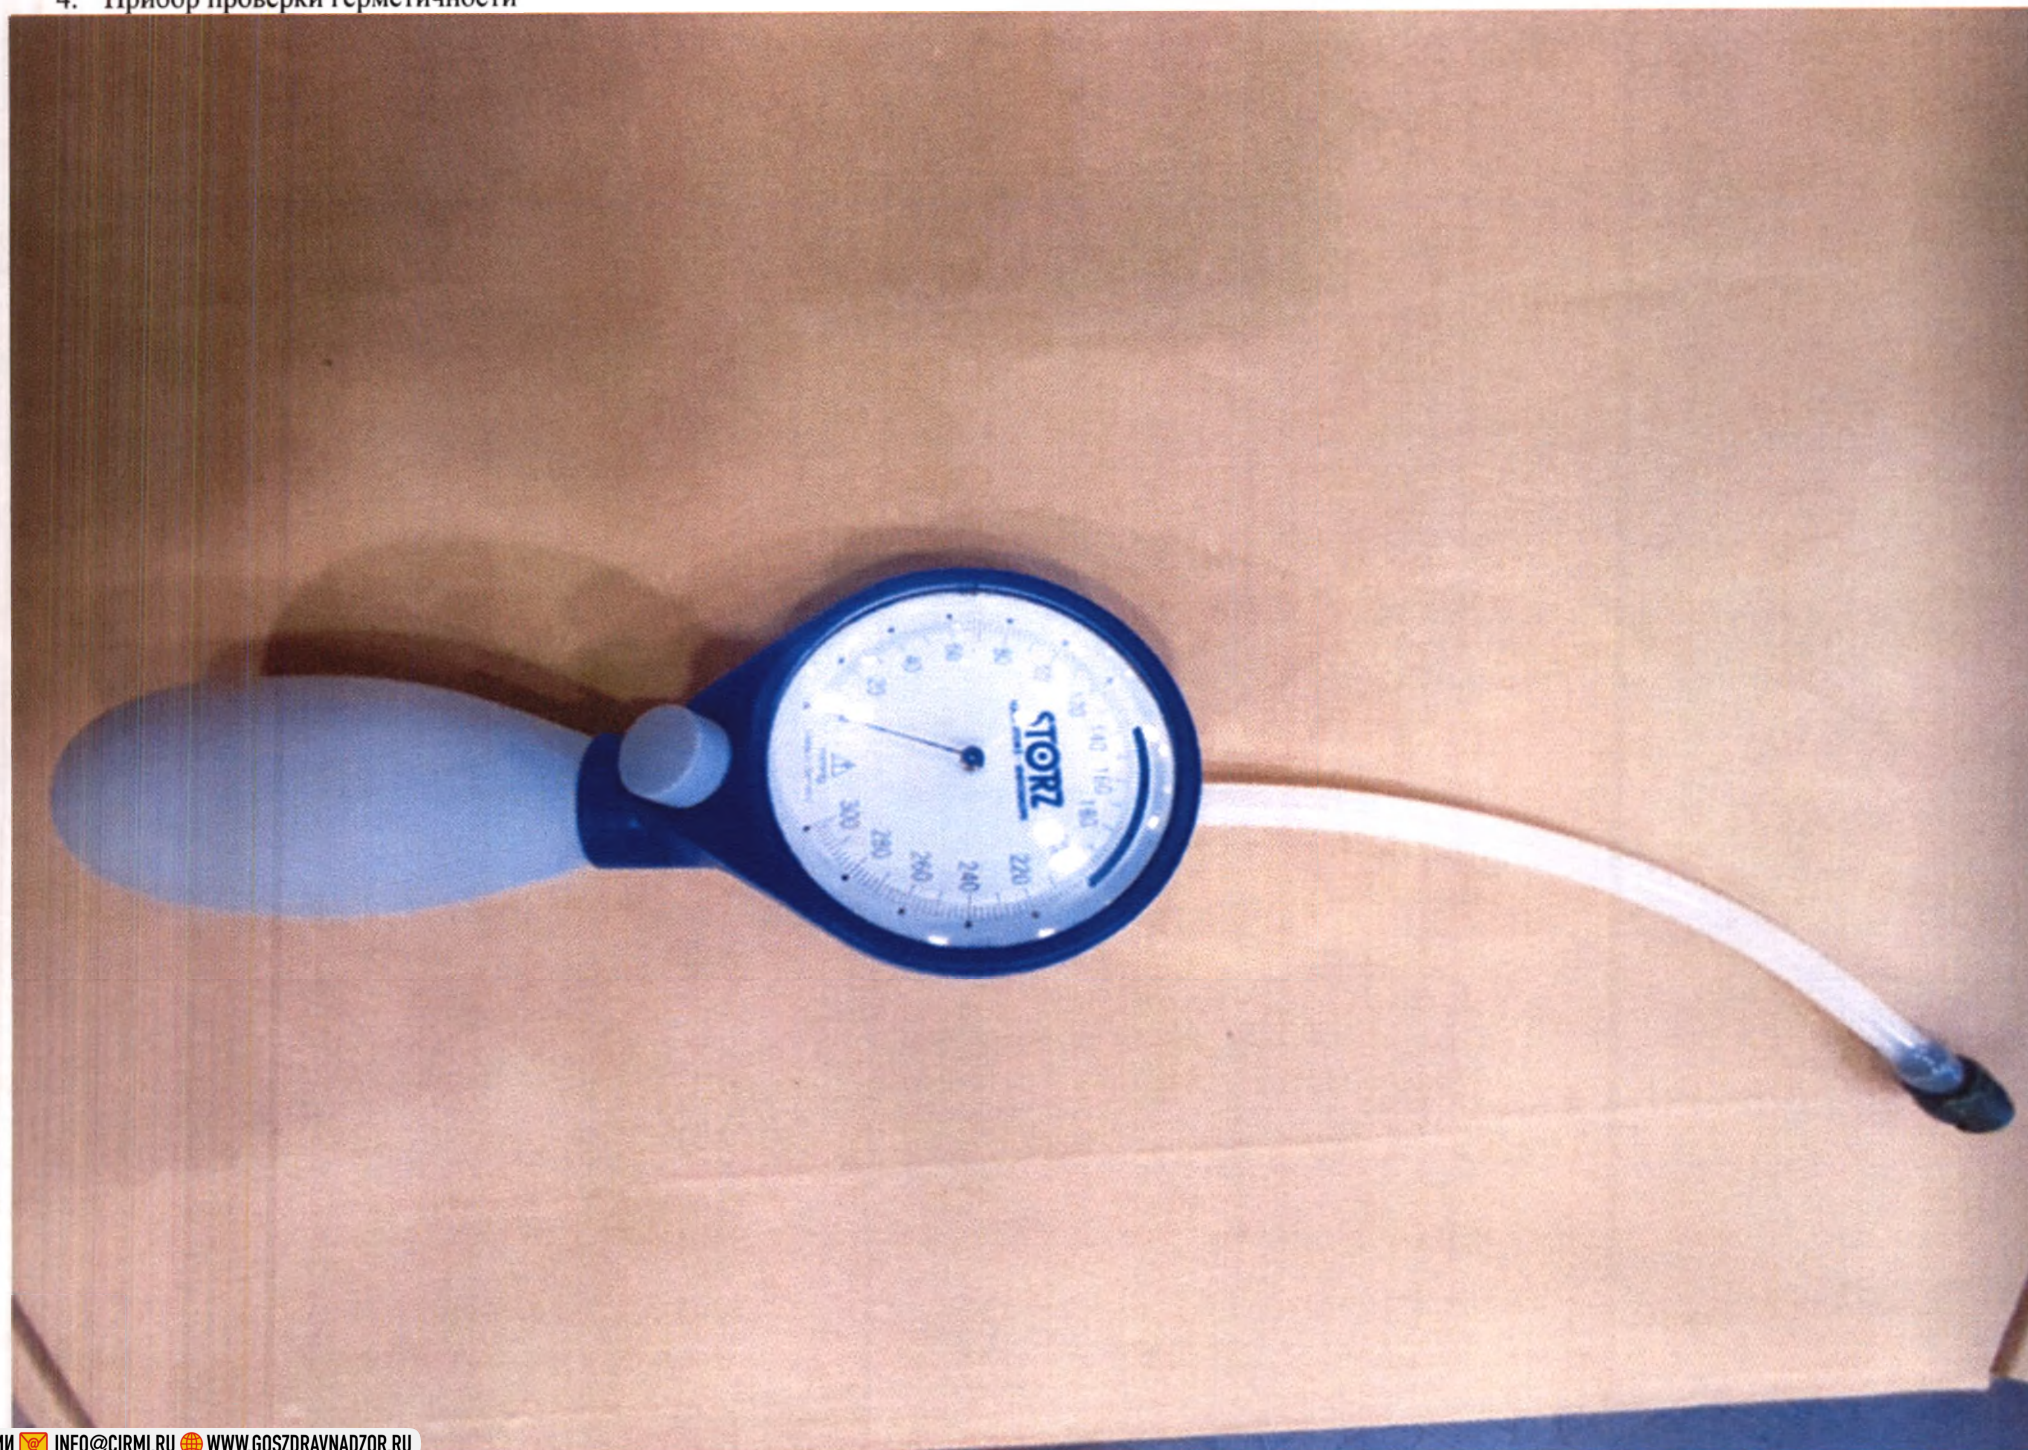

5. Банка аспирационная, 5 л, стерилизуемая – не более 20 шт.

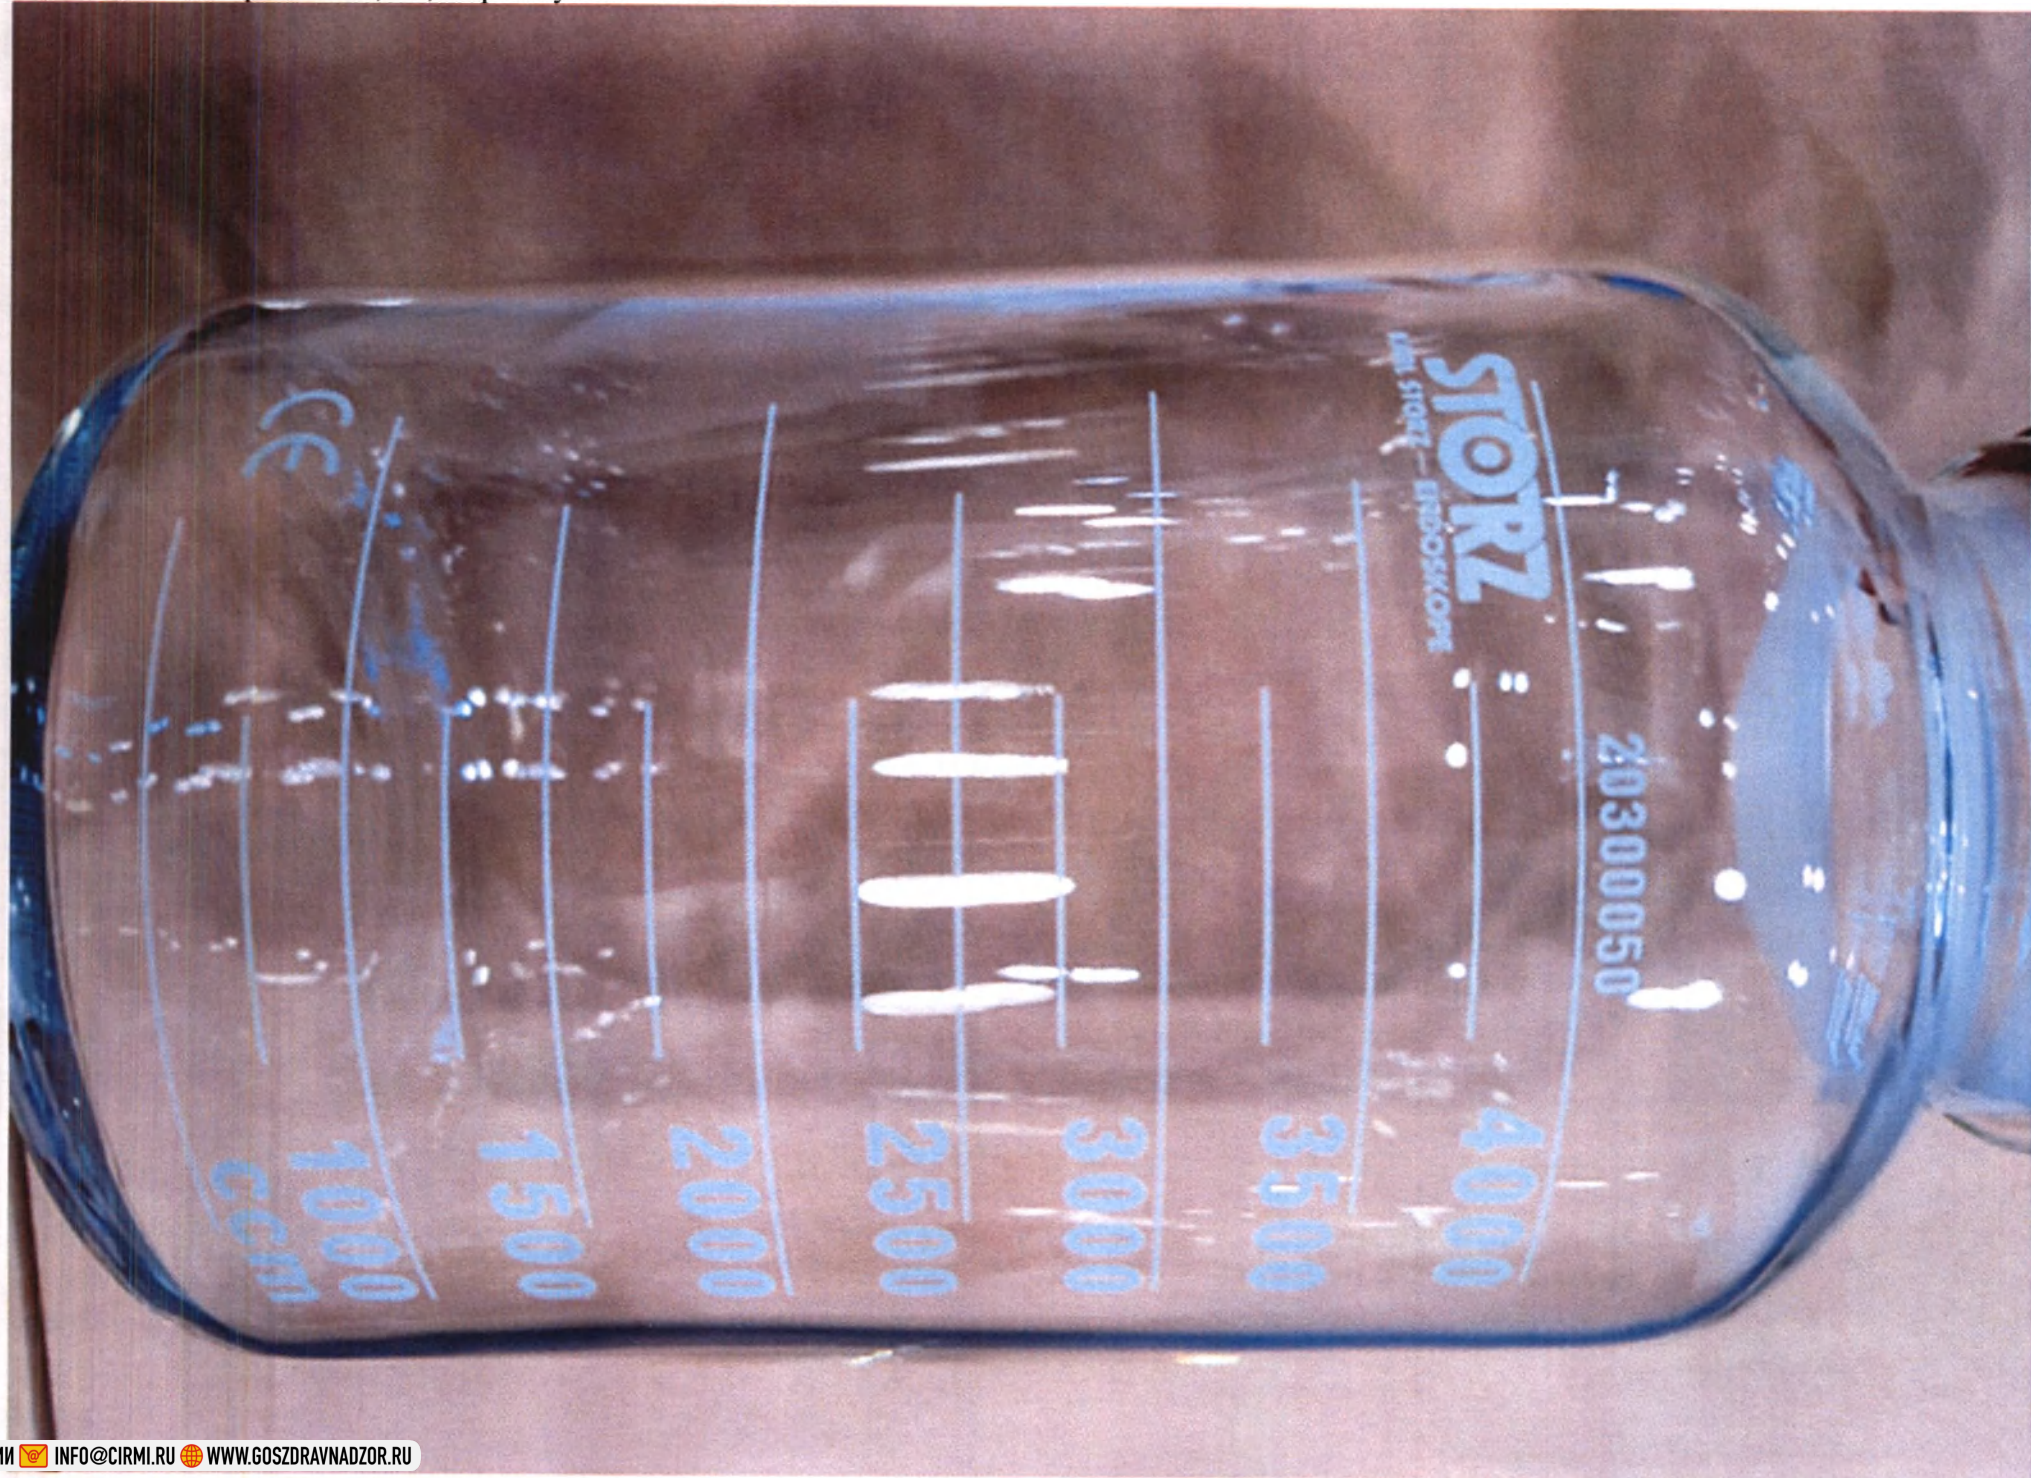

6. Крышка для применения с аспирационной банкой, 5 л, стерилизуемая




7. Фильтр металлический



8. Держатель для аспирационной банки, 5 л




9. Элемент несущий для держателя банки

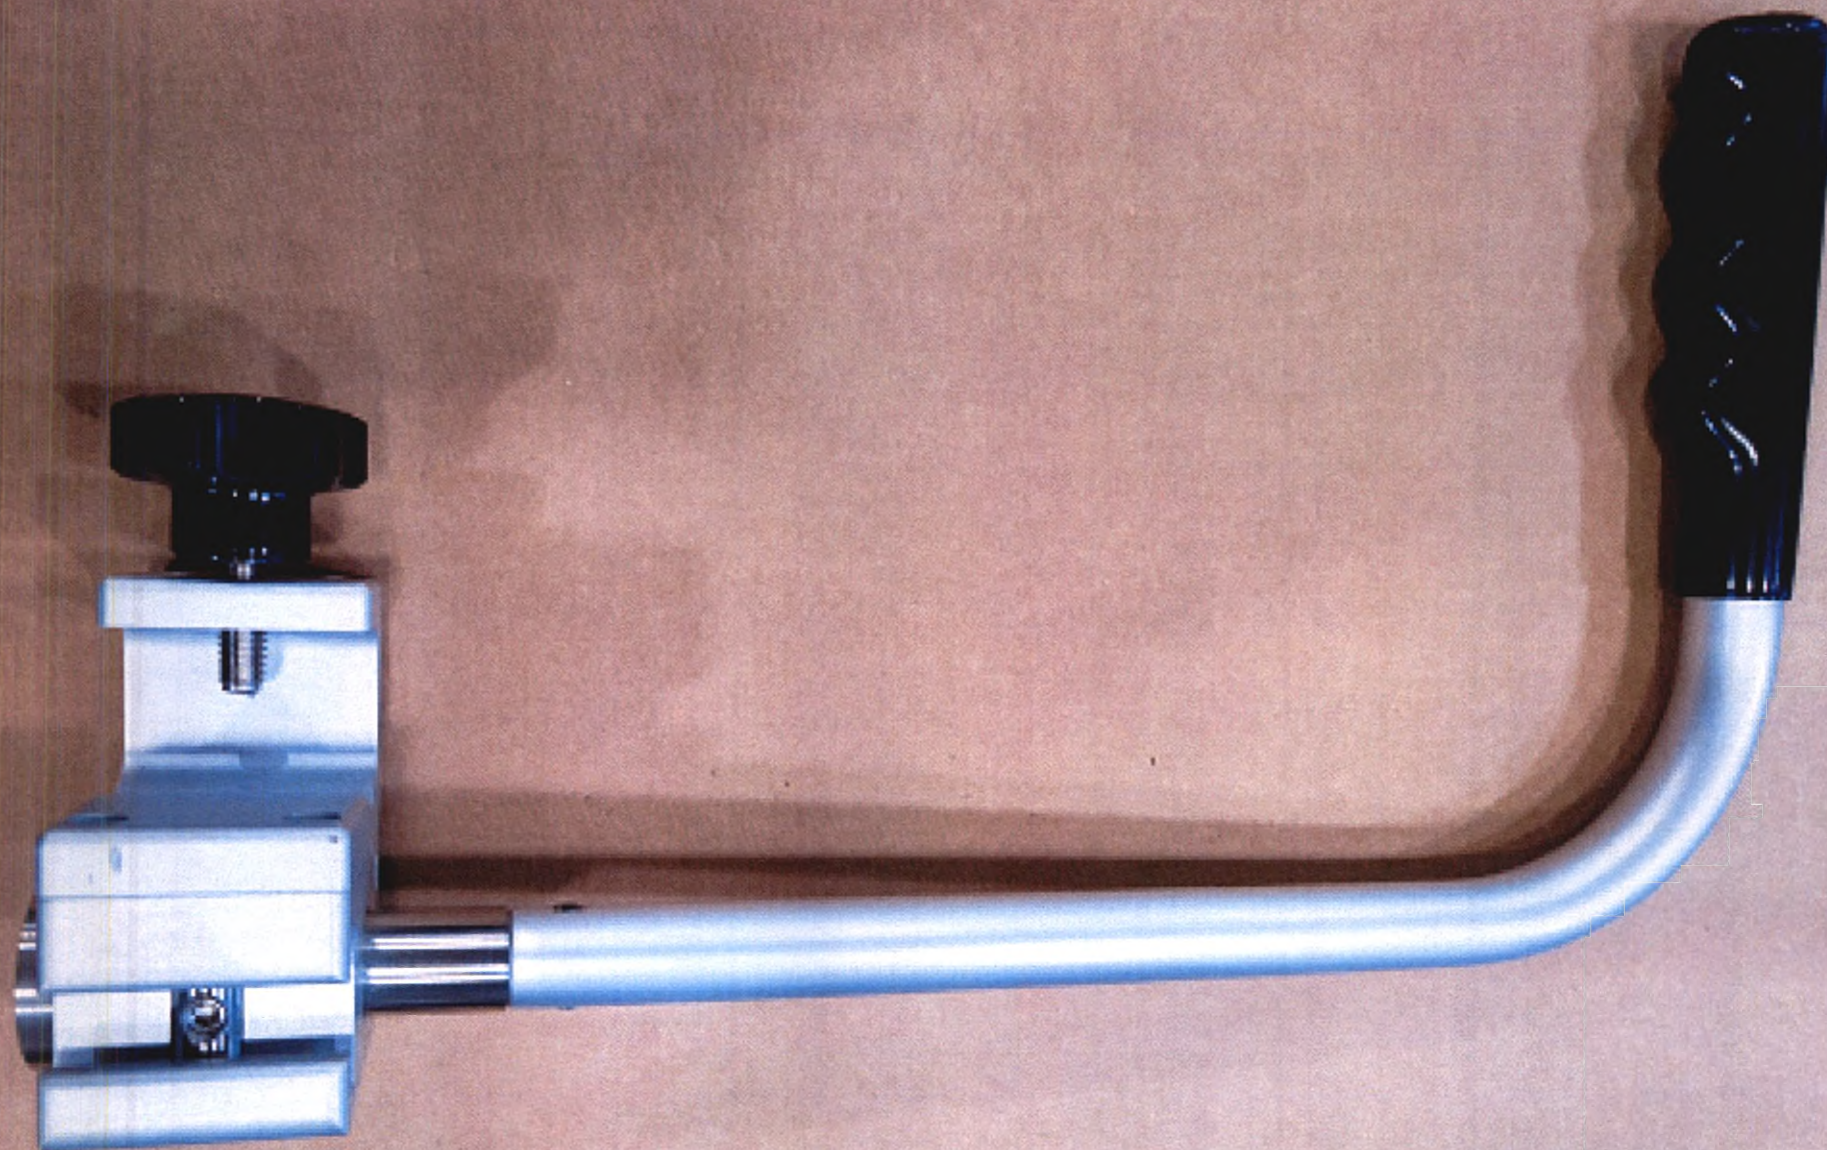


10. Банка аспирационная, 0,5 л, стерилизуемая



11. Крышка для применения с аспирационной банкой, 0,5 л

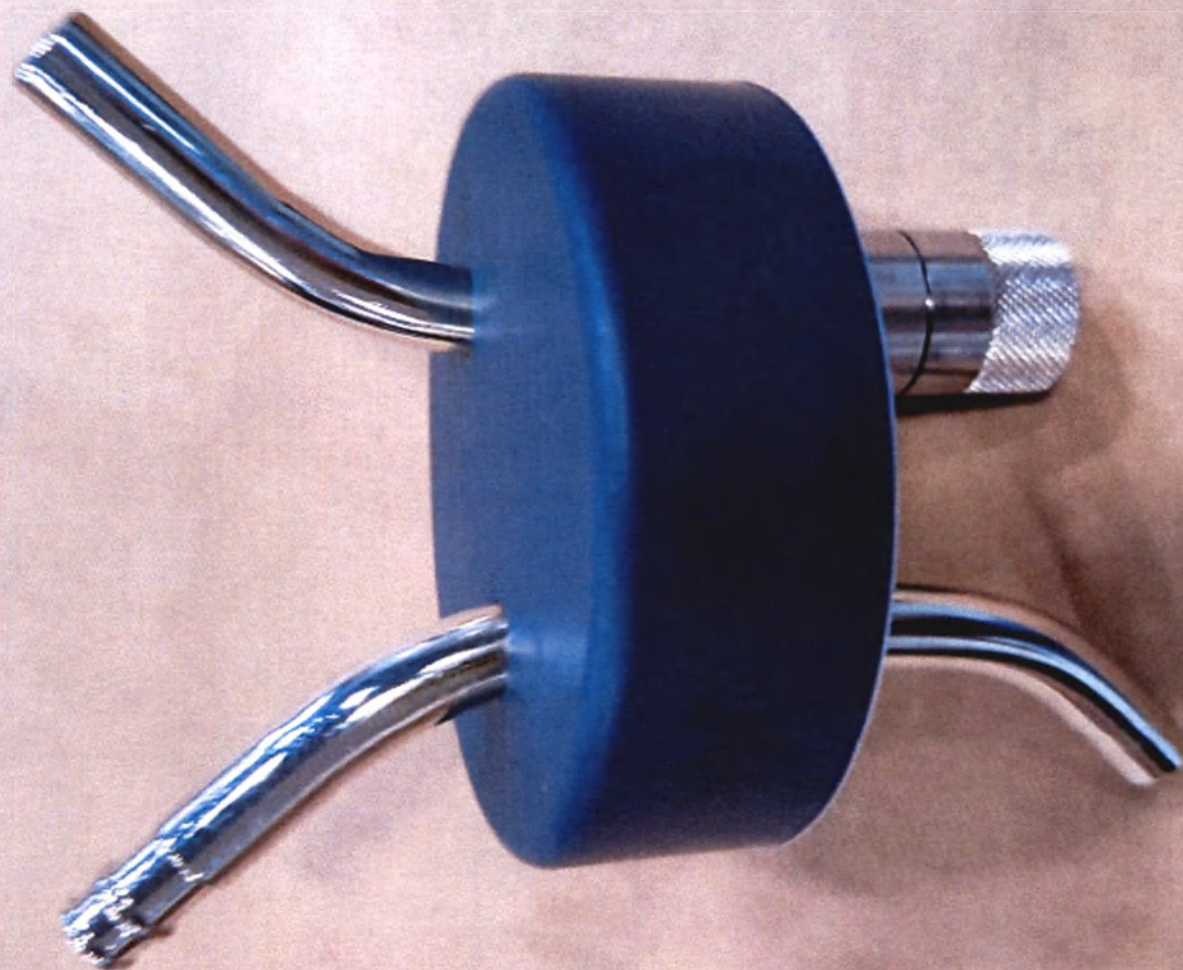

12. Держатель, для аспирационной банки 0,5 л

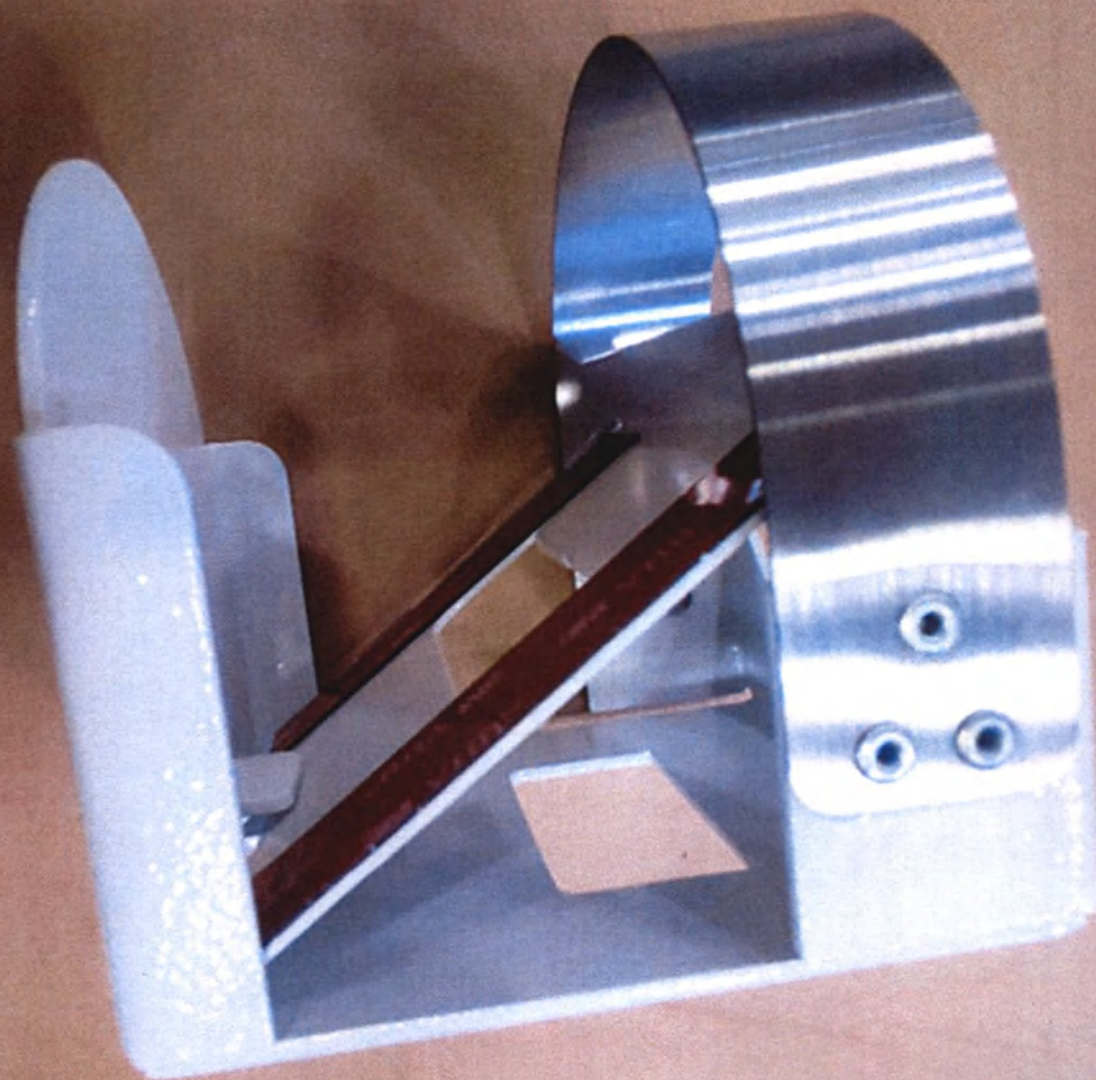

13. Переключатель одноступенчатый



KARL STORZ SE & CO. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen / Germany
STORZ
KARL STORZ – ENDOSCOPE

REF UF101W **SN** R000012
Voltage: 9 V DC
Power: 7.2 VA

MD1040855143580
I219000012
AN: UF101W
MO: Rx Only

2021-04 IPX8
FCC ID: XK5-SW24LE
IC: 5159A-SW24LE


CE 0123

UN 180133

SA

14. Переключатель одноступенчатый, беспроводной в составе:
- Переключатель одноступенчатый, беспроводной



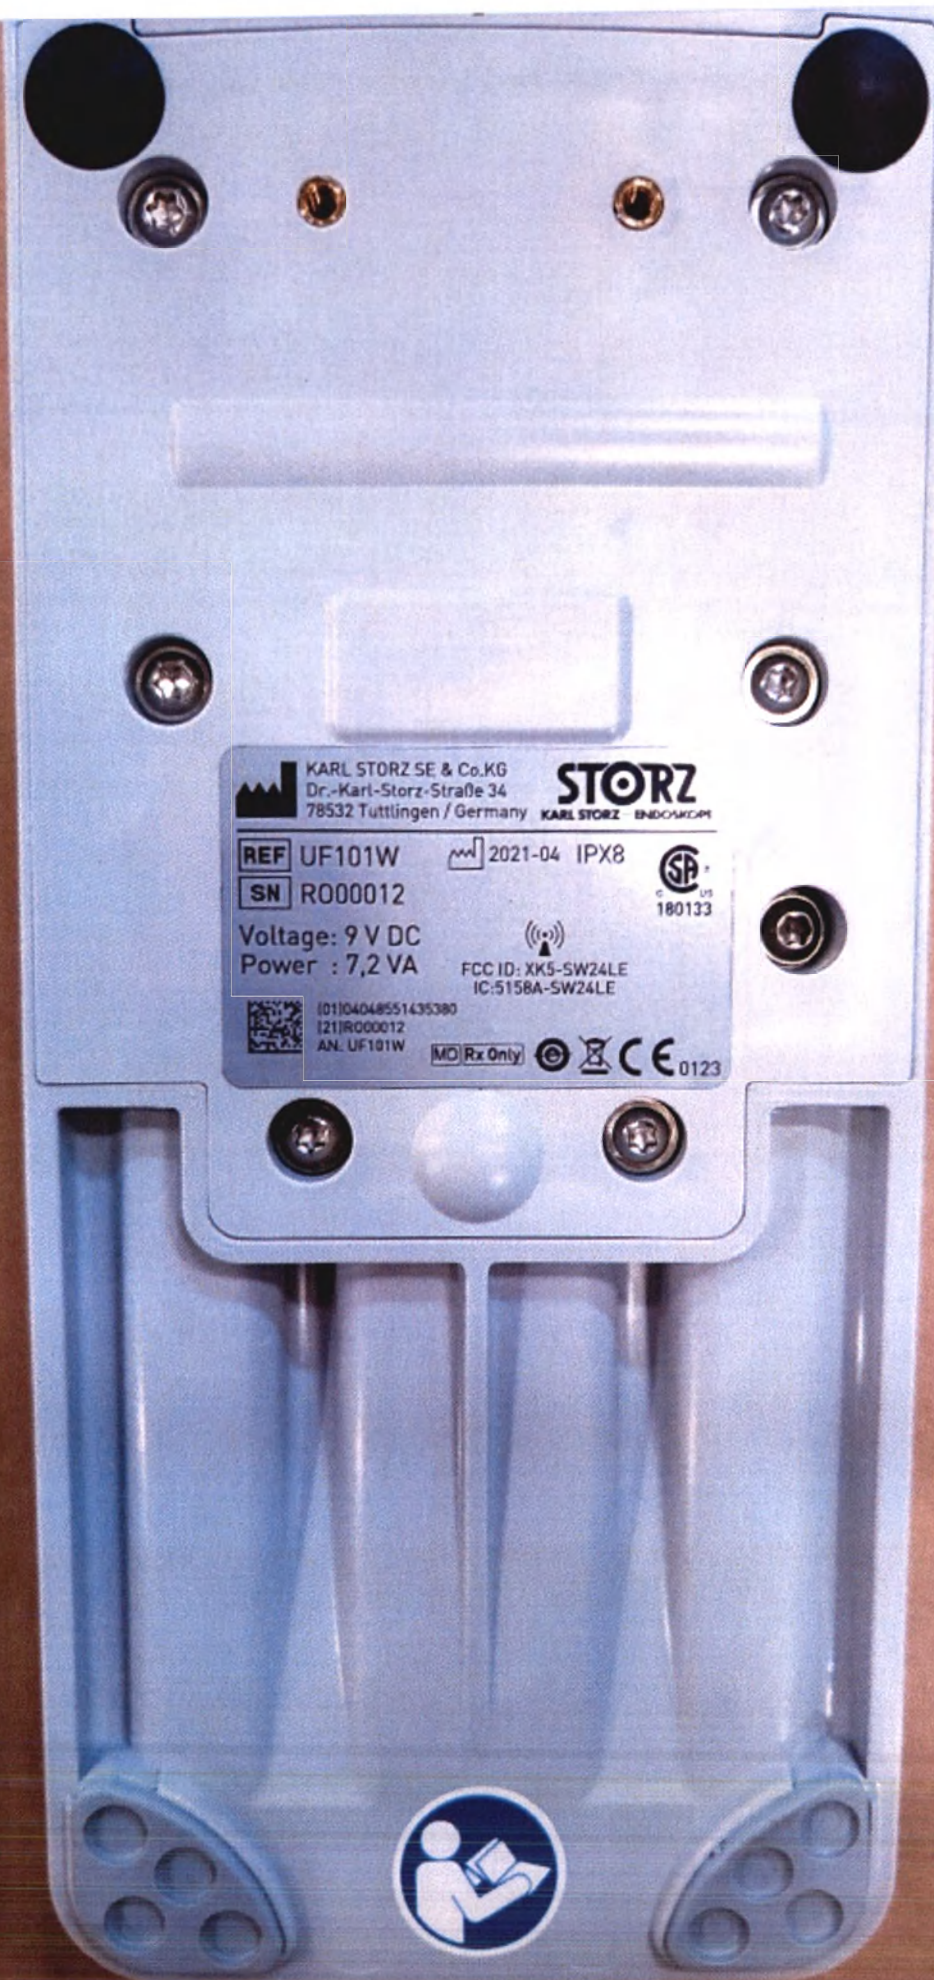


14. Переключатель одноступенчатый, беспроводной в составе:
- Ресивер






15. Переключатель двухступенчатый



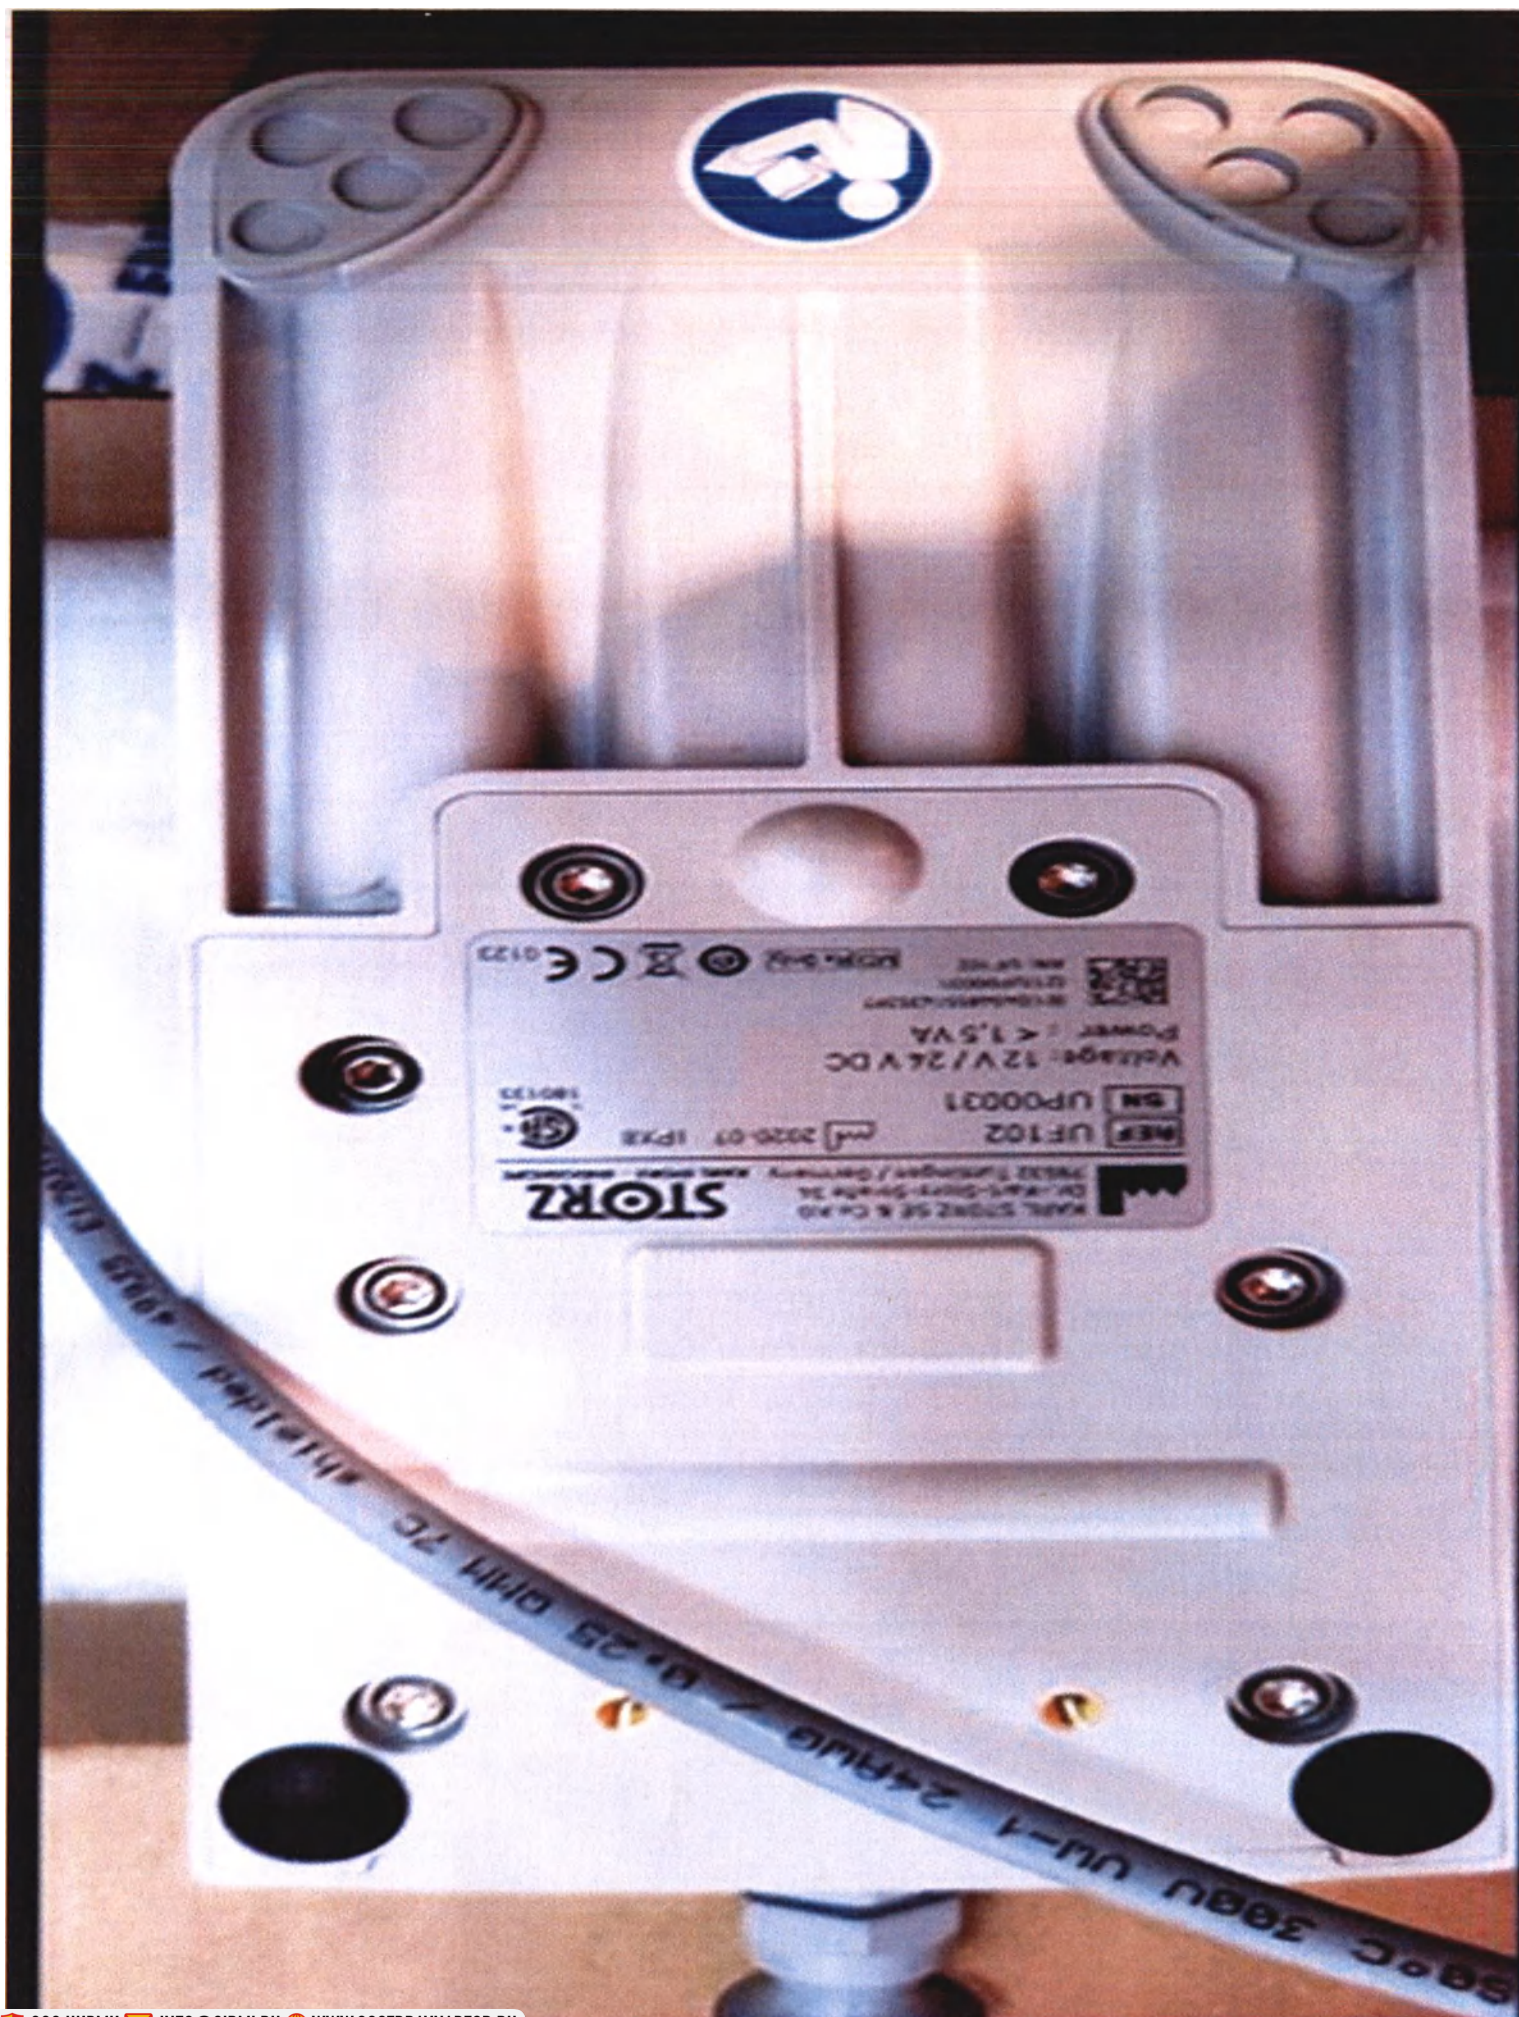

16. Переключатель двухступенчатый, беспроводной в составе:
- Переключатель двухступенчатый , беспроводной



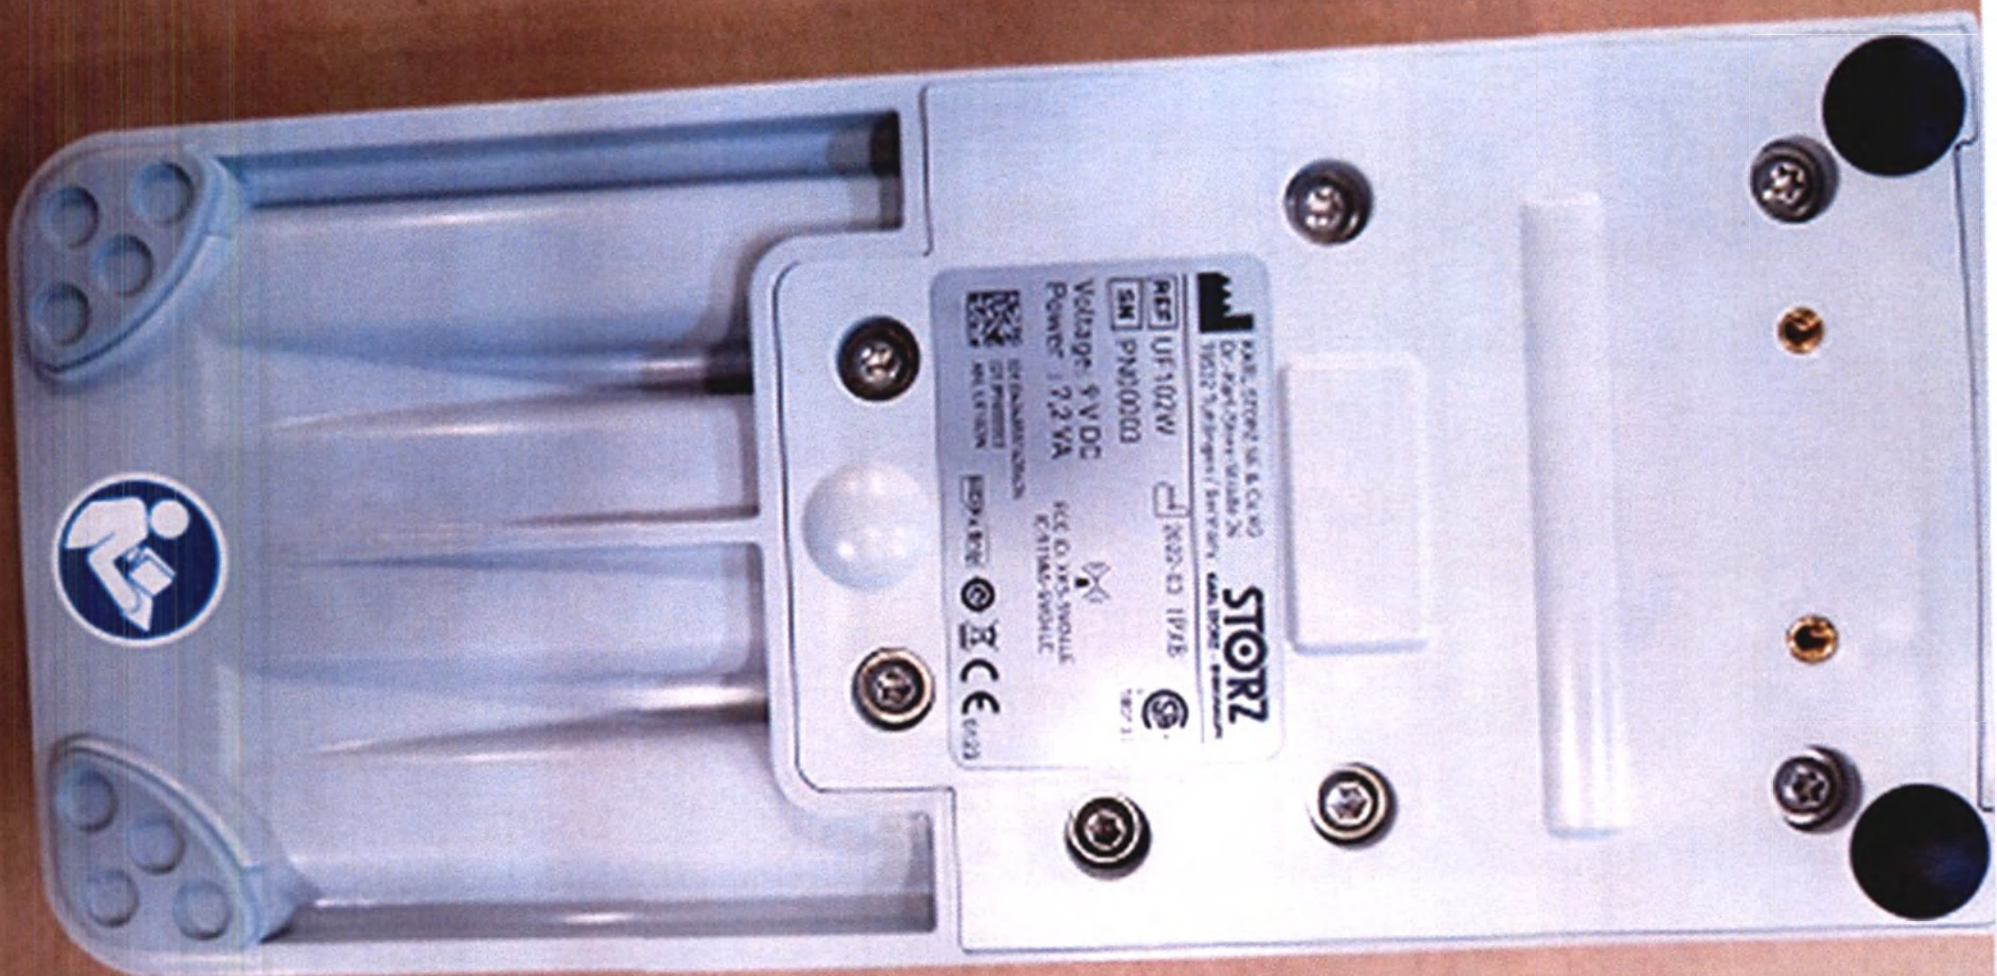

16. Переключатель двухступенчатый, беспроводной в составе:
- Ресивер





KARL STORZ SE & Co.KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ - ENDOSKOPIE

REF ET92-1204907 2020-09

SN WP00061 IP21

Voltage : 12 V / 24 V DC


Power : < 0,5 VA

FCC ID: XK5-SW24LE
IC:5158A-SW24LE

MD Rx Only



0123

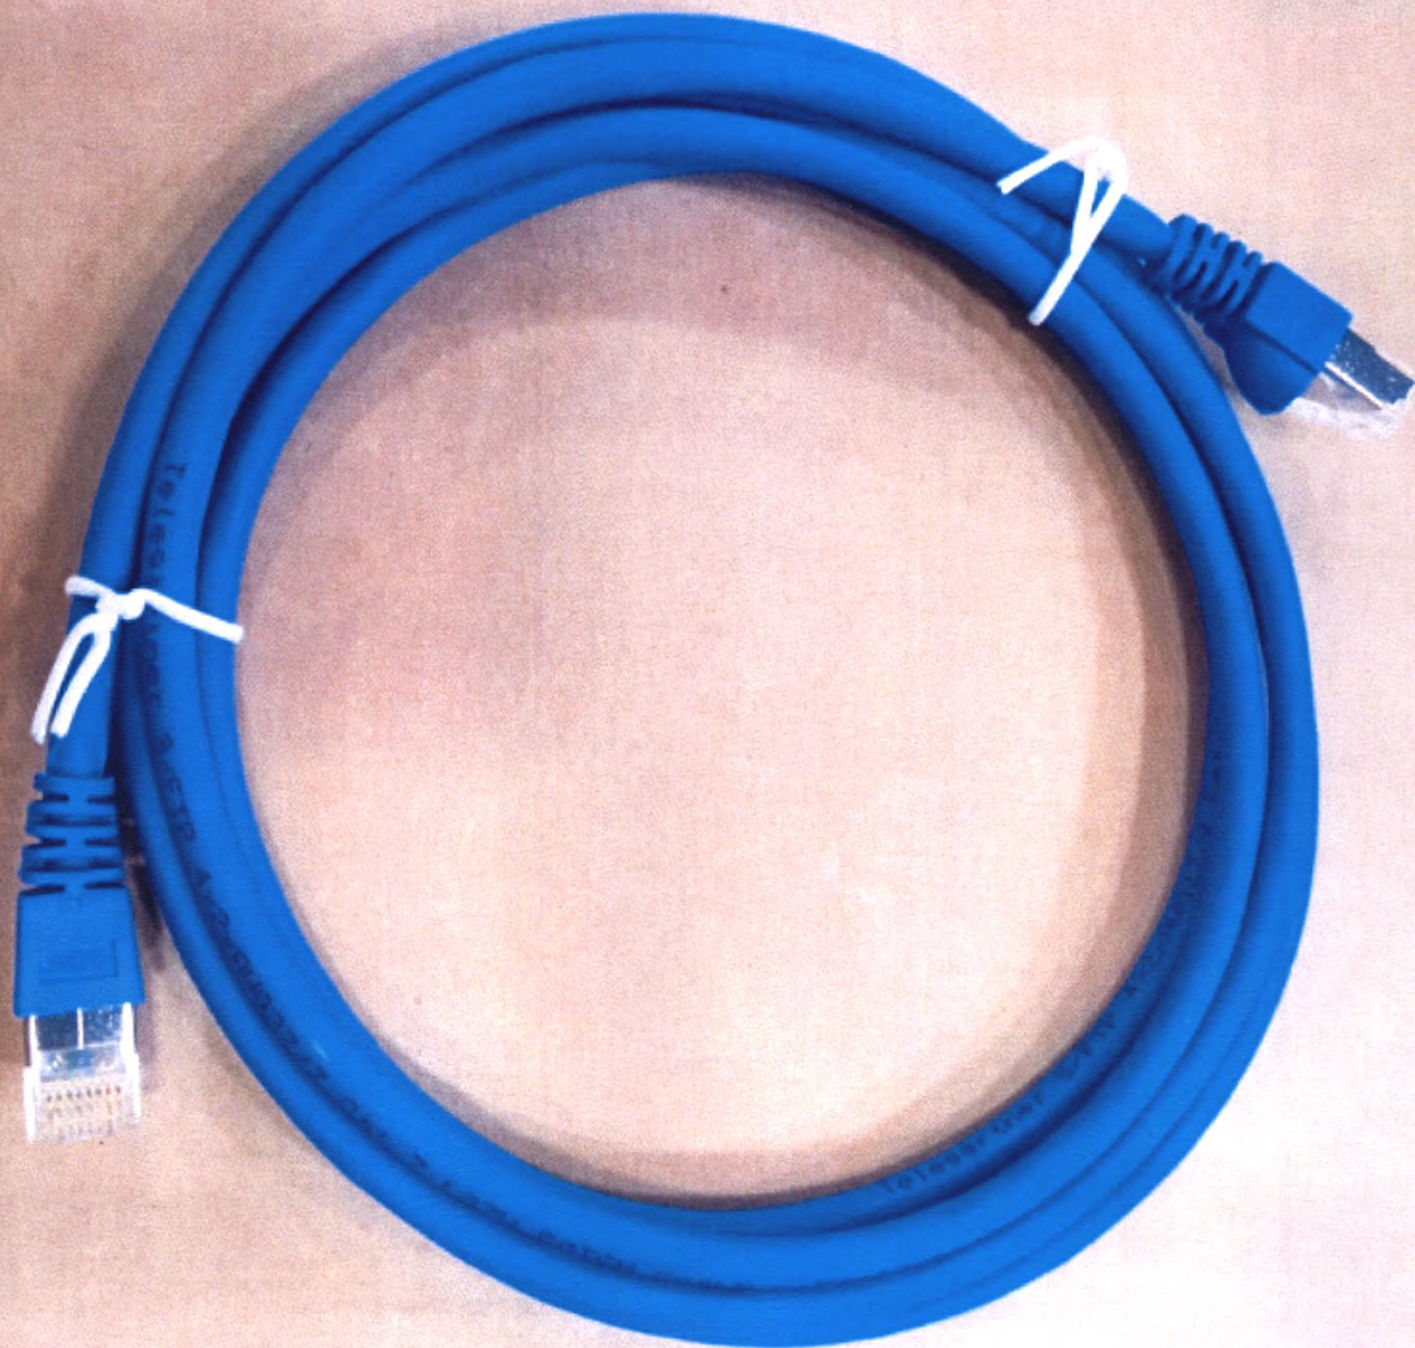


18. Блок питания в составе:

- Блок питания
- Евроадаптер
- Адаптер Великобритании
- Адаптер США/Япония
- Адаптер Австралия
- Адаптер IEC



19. Блок питания в составе:
-Блок питания

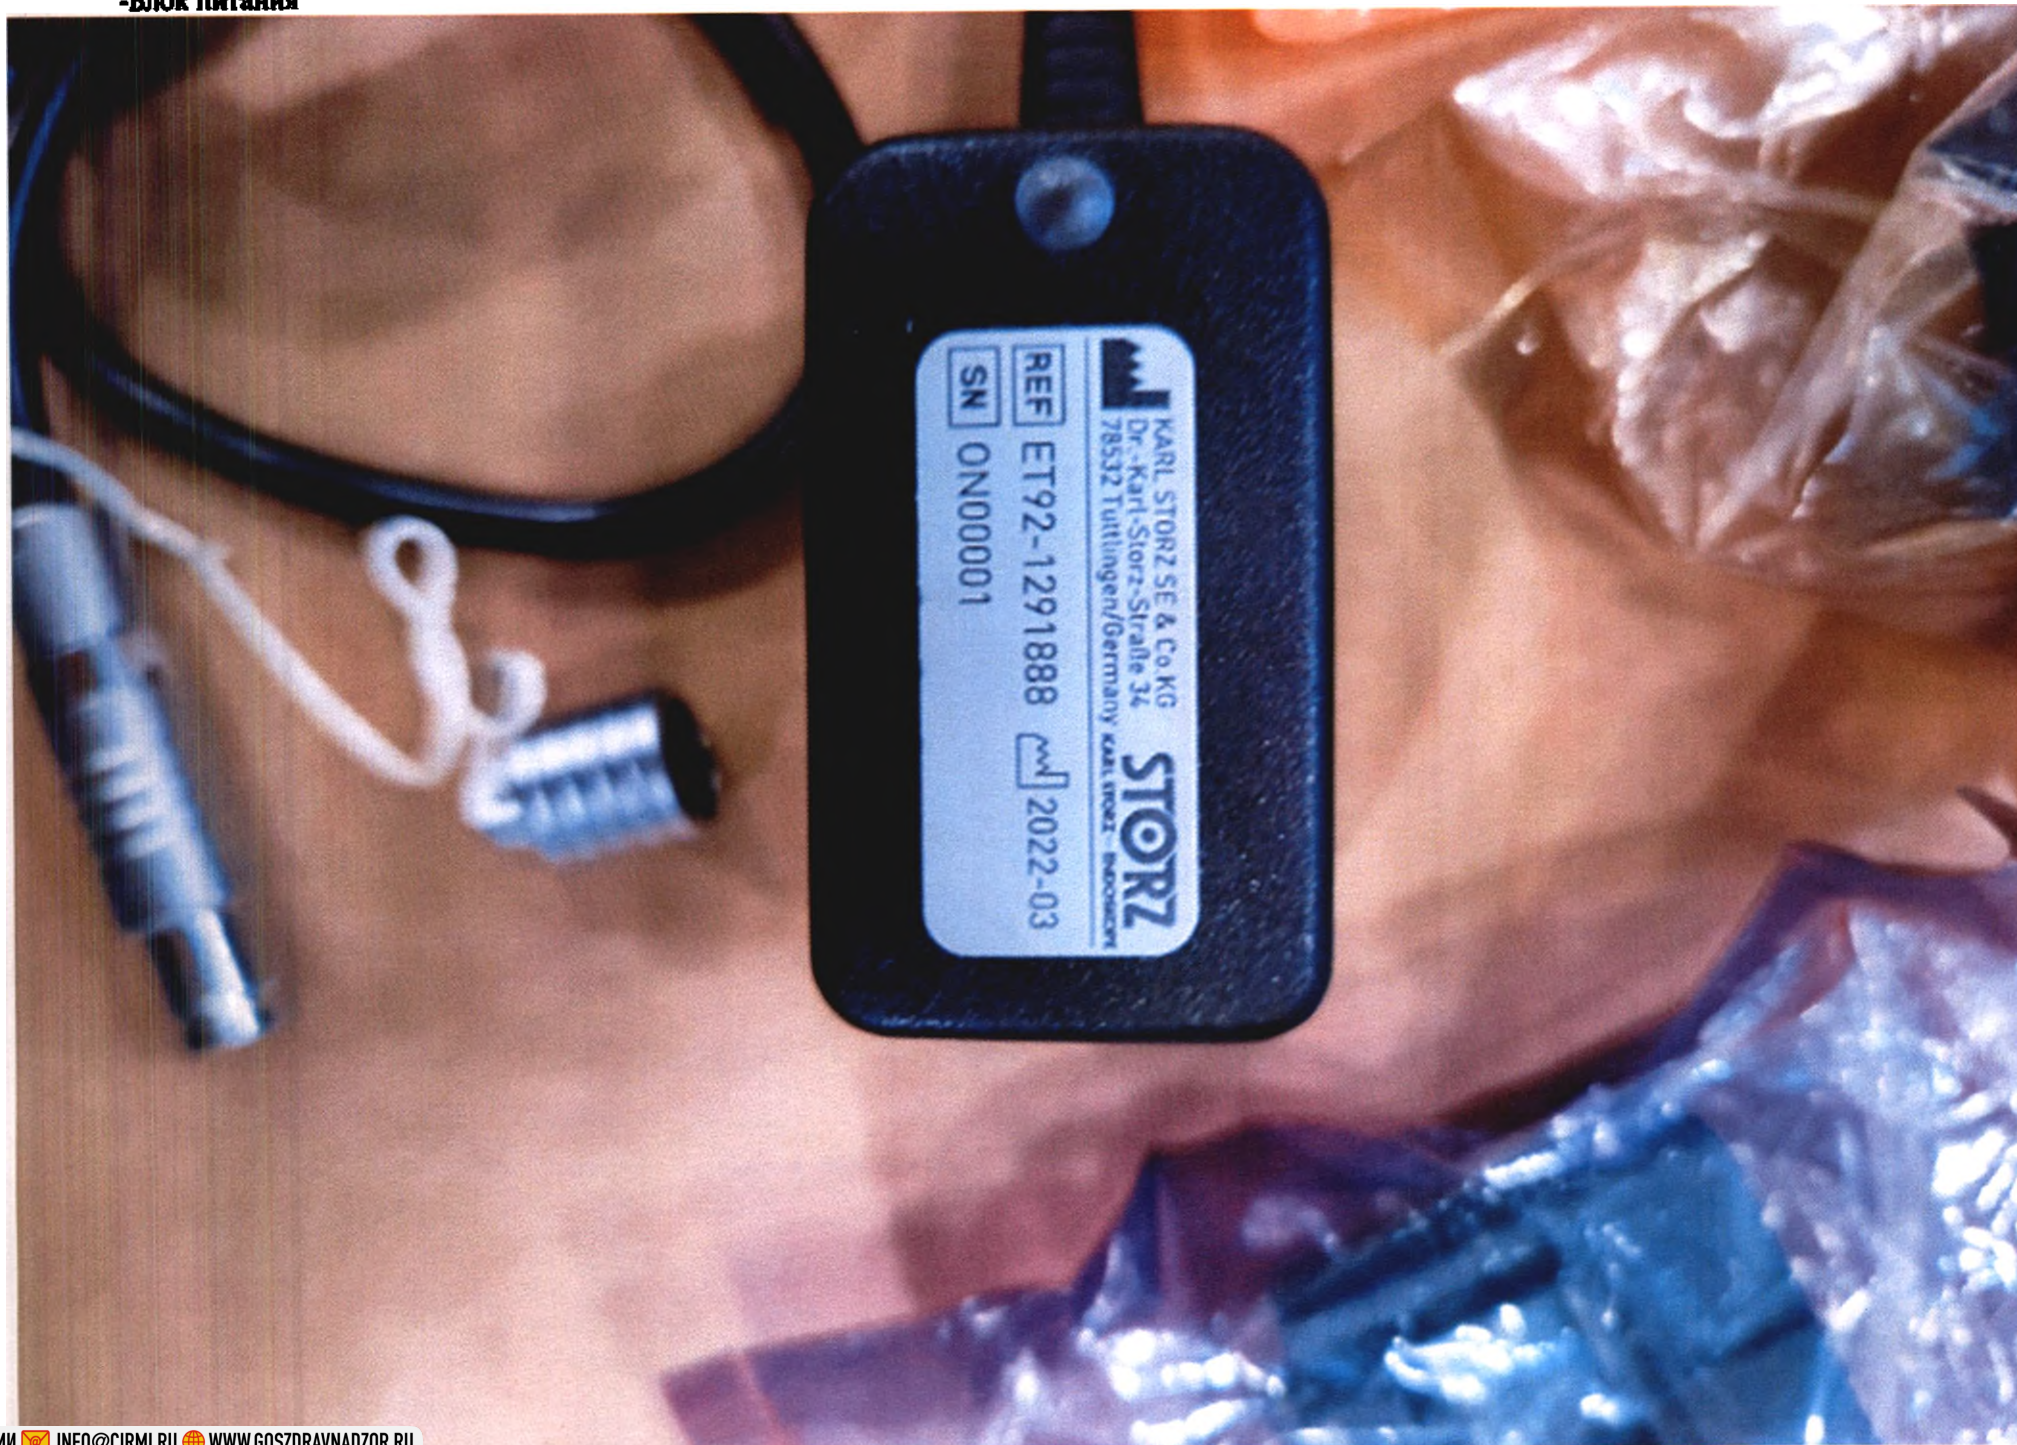



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

Помпа ENDOMAT SELECT UP220

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

Производитель

Karl Storz SE & Co.KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34.
78532 Tuttlingen, Germany (Германия)

Уполномоченный пред-
ставитель на
территории РФ

Общество с ограниченной ответственностью
«Карл Шторц – Эндоскопы Восток» (ООО «КШТЭ ВО-
СТОК»).
Россия, 115114, Москва, Тербневская набережная, 7, стр. 4.

Информация о сроке
службы

См. инструкцию по применению

Сделано в

Швейцария

Сайт

<https://www.karlstorz.com/de/ru/index.htm>





ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 57 Л.

07.11.2023

