
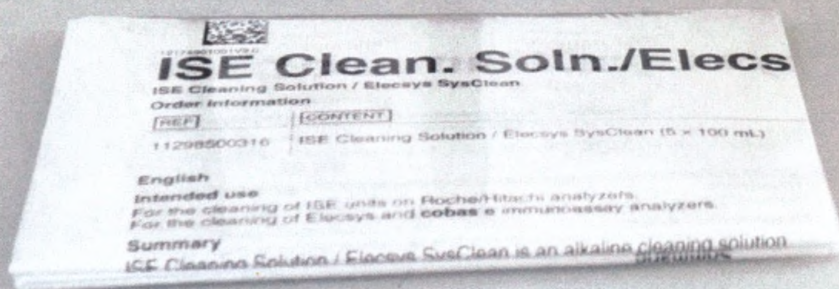


Фотографические изображения

« Раствор чистящий для модулей ISE анализаторов биохимических cobas c, анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean Roche systems/SySClean Roche/Hitachi Elecsys), флакон, объем - 100 мл, 5 шт.»

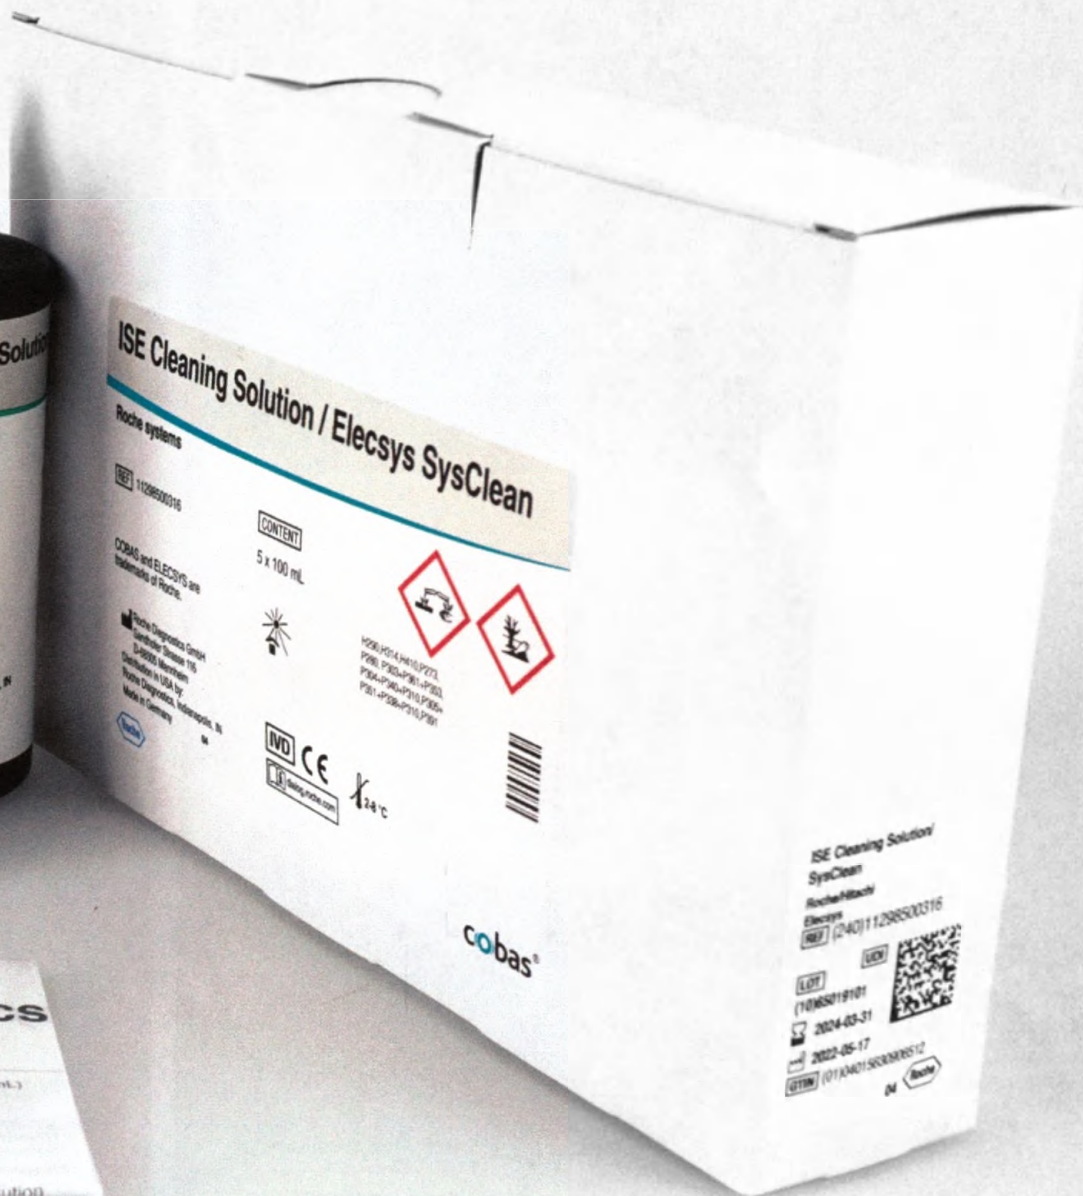

ISE Cleaning Solution/
SysClean

Roche/Hitachi

Elecsys

REF (240)11298500316

LOT

(10)70840001

UDI



2024-11-30

2023-01-17

GTIN (01)04015630906512

04



For USA:

REF 11298500316

CONTENT

Sodium hydroxide 3 mol/L


Sodium hypochlorite solution (<2% act. chlorine)



Rx only

02



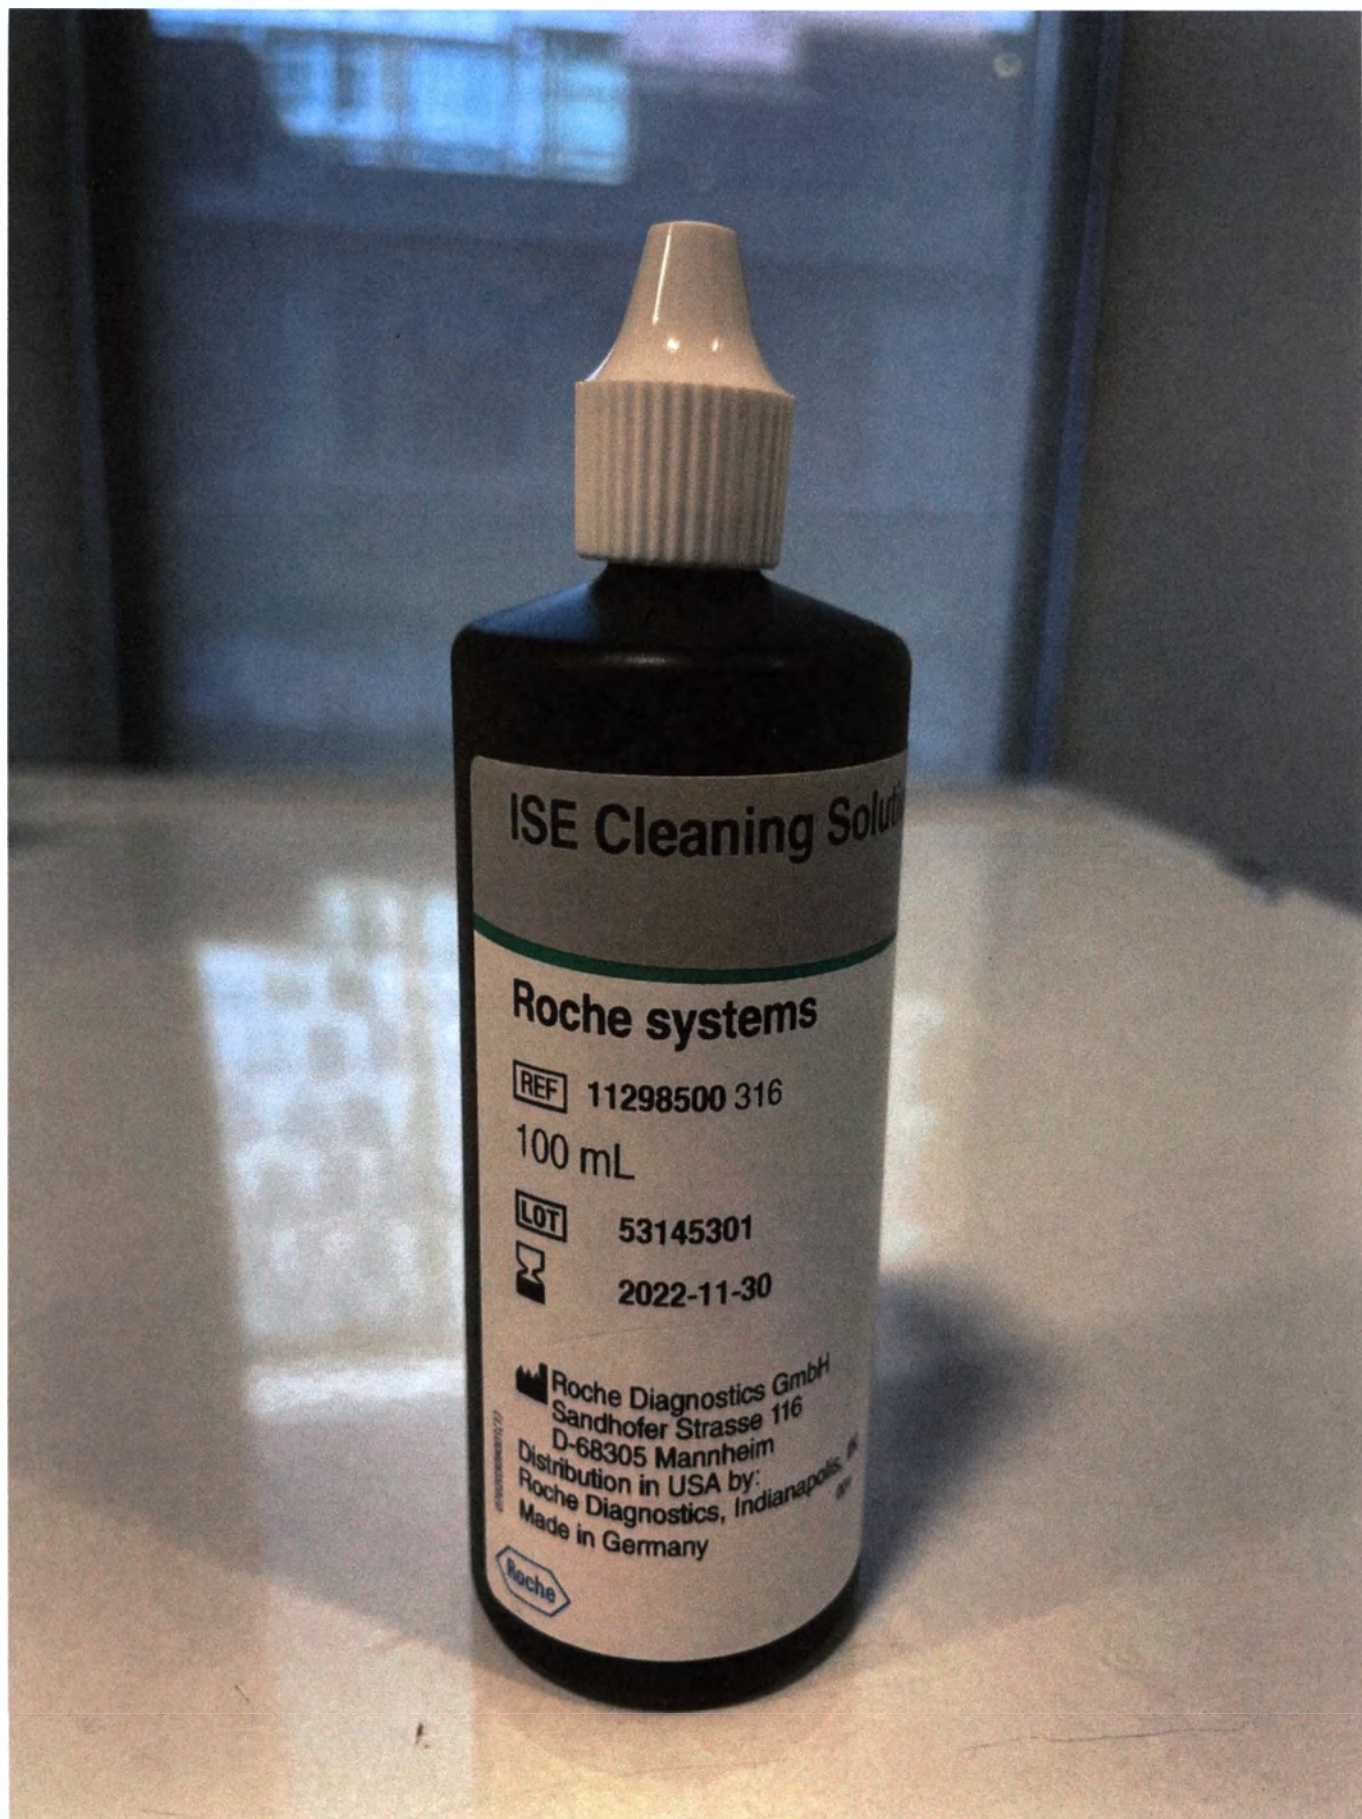

ISE Cleaning Solution

Roche systems

REF 11298500 316

100 mL

LOT 53145301

2022-11-30

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Germany



Макет маркировки на русском языке

Раствор чистящий для модулей ISE анализаторов биохимических cobas c, анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean Roche systems/SysClean Roche/Hitachi Elecsys), флакон, объем - 100 мл, 5 шт.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 11298500316

Маркировка картонной упаковки

Раствор чистящий для модулей ISE анализаторов биохимических cobas c, анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean Roche systems/SySClean Roche/Hitachi Elecsys), флакон, объем - 100 мл, 5 шт

ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean

Roche systems

REF 11298500316

CONTENT

5 x 100 mL

COBAS and ELECSYS are trademarks of Roche.



H290, H314, H410, P273,
P280, P303+P361+P353,
P304+P340+P310, P305+
P351+P338+P310, P391



Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Germany 04

IVD

CE

2-8 °C

dialog.roche.com



cobas®

ISE Cleaning Solution/ SysClean

Roche/Hitachi
Elecsys

REF (240)11298500316

For USA:

CONTENT

Sodium hydroxide 3 mol/L
Sodium hypochlorite solution (<2% act. chlorine)

REF 11298500316

LOT

UDI

(10)00000000

2000-01-31

2000-01-01

GTIN (01)04015630906512

04



Rx only

02



Маркировка флакона

Раствор чистящий для модулей ISE анализаторов биохимических cobas c, анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean Roche systems/SySClean Roche/Hitachi Elecsys), флакон, объем - 100 мл, 5 шт

ISE Cleaning Solution / Elecsys SysClean

Roche systems

REF 11298500316

100 mL

LOT 00000000

 2000-01-31

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim


09859365001(1)
Distribution in USA by:
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN
Made in Germany 04



H290, H314, H410, P273,
P280, P303+P361+P353,
P304+P340+P310, P305+
P351+P338+P310, P391



IVD



cobas[®]

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
листа (ов)

