


**Фотографические изображения
медицинского изделия
«Чехол для рукоятки
медицинского оборудования
одноразовый стерильный
по ТУ 32.50.50-028-51834327-2023»**




Вид медицинского изделия «Чехол для рукоятки медицинского оборудования (красный)», производства АО «ЗМТ»

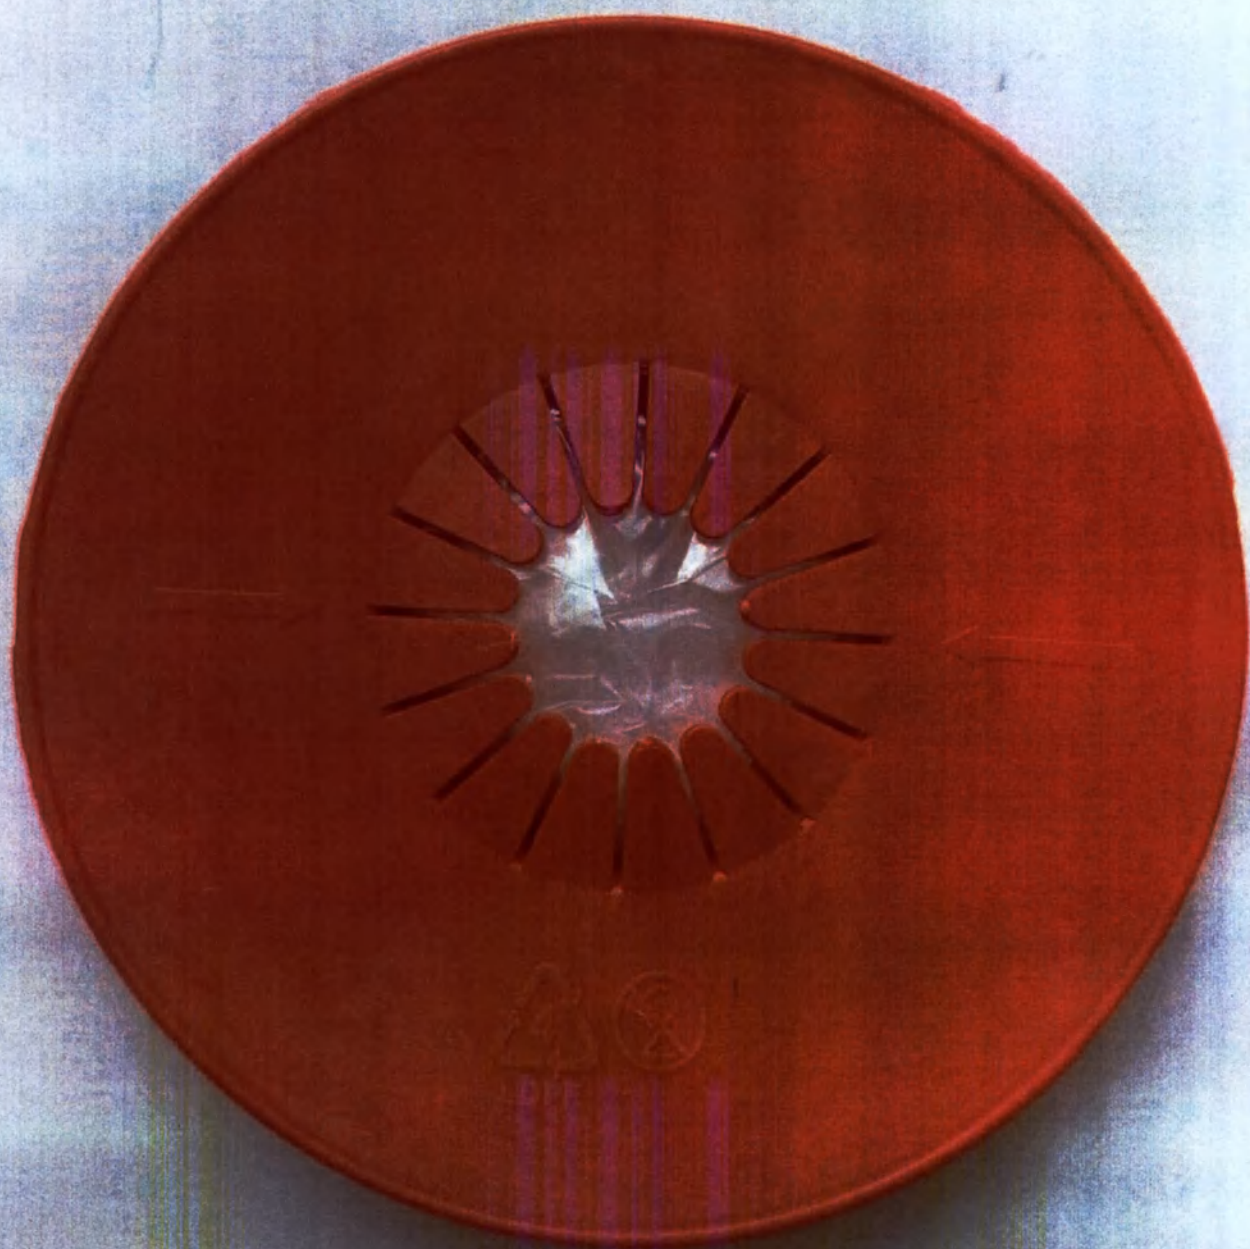


Общий вид медицинского изделия «Чехол для рукоятки медицинского оборудования (красный)», производства АО «ЗМТ»



Общий вид медицинского изделия «Чехол для рукоятки медицинского оборудования (красный)», производства АО «ЗМТ»

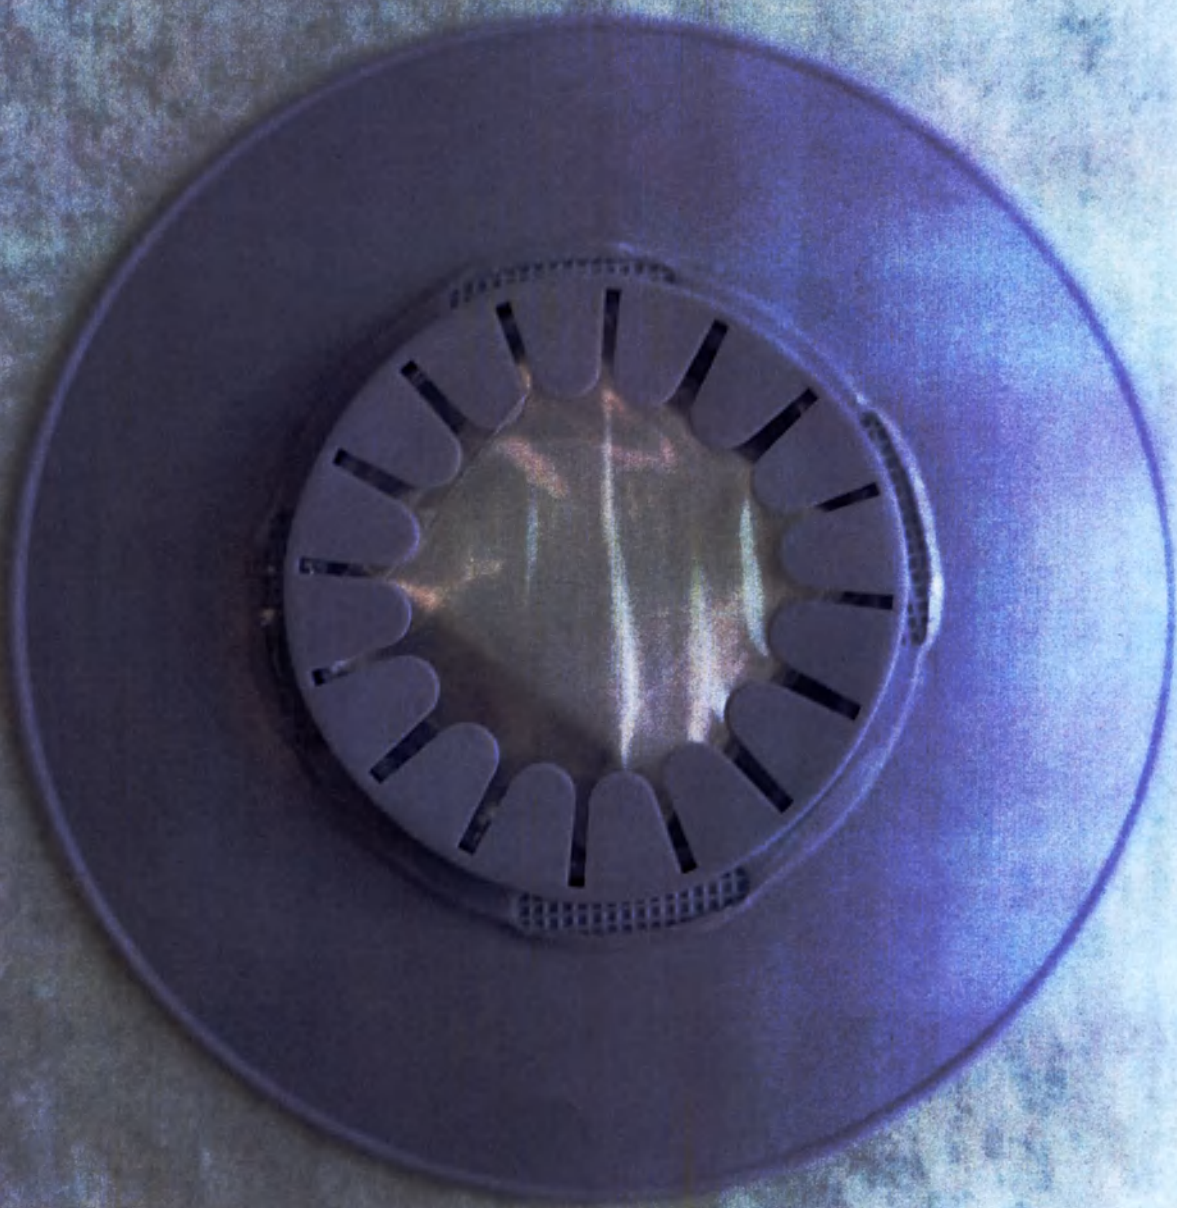

Вид медицинского изделия «Чехол для рукоятки медицинского оборудования (лиловый)», производства АО «ЗМТ»

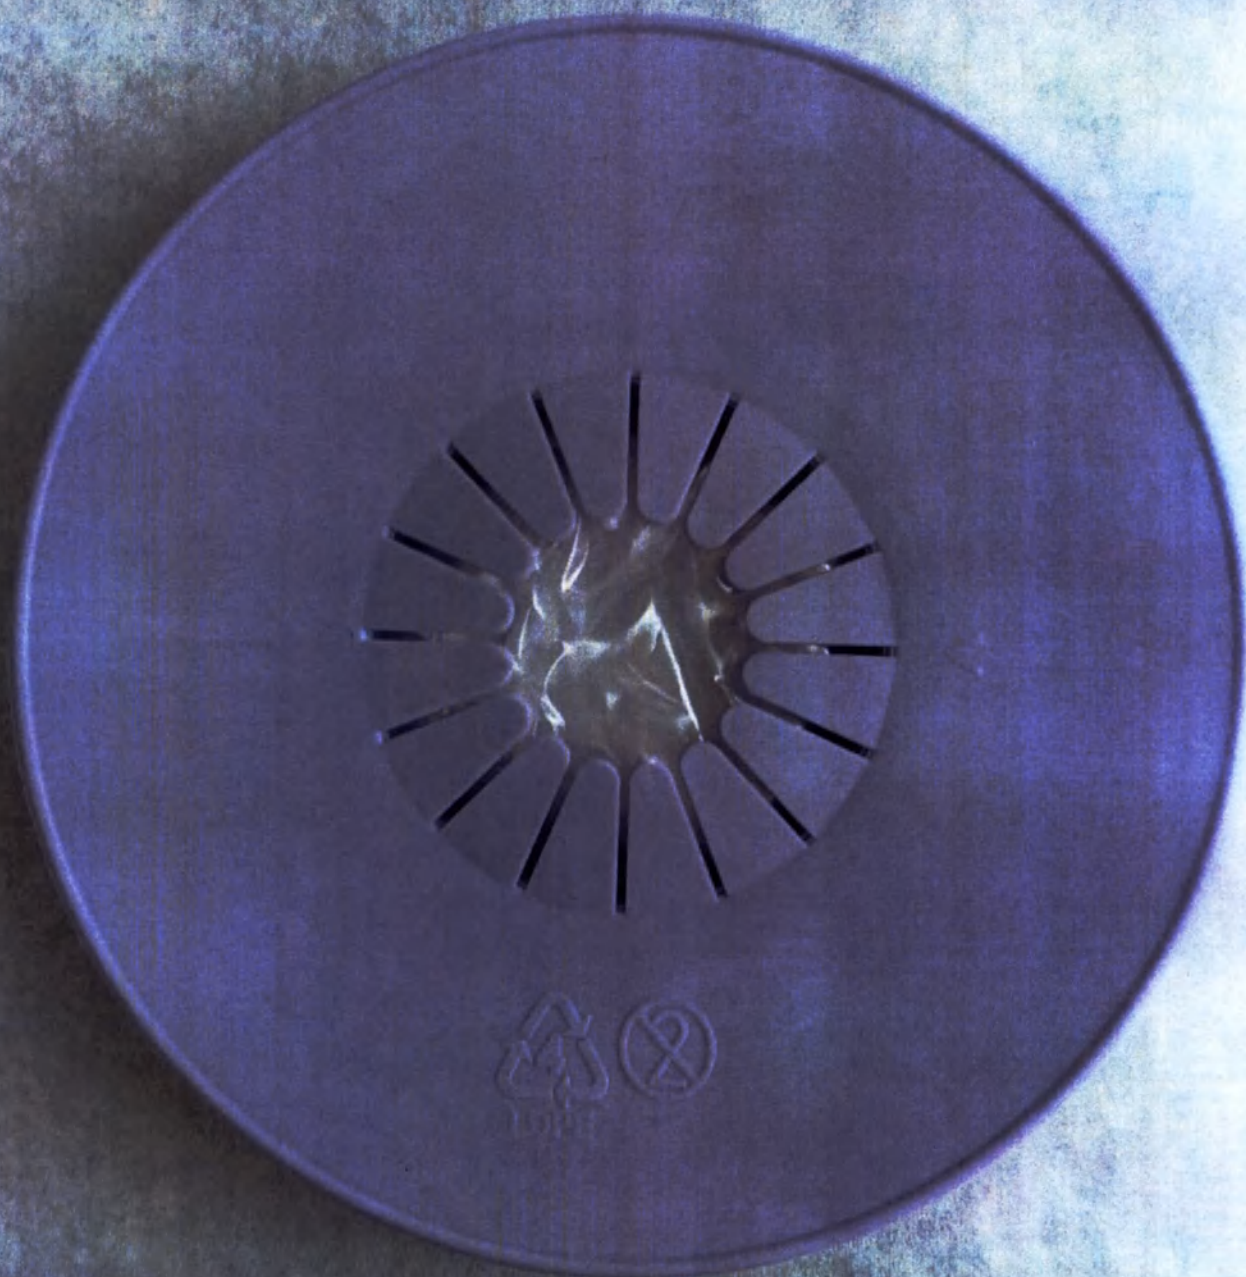


Общий вид медицинского изделия «Чехол для рукоятки медицинского оборудования (лиловый)», производства АО «ЗМТ»



Вид медицинского изделия «Чехол для рукоятки медицинского оборудования (лиловый)», производства АО «ЗМТ»



Общий вид медицинского изделия «Чехол для рукоятки медицинского оборудования (синий)», производства АО «ЗМТ»

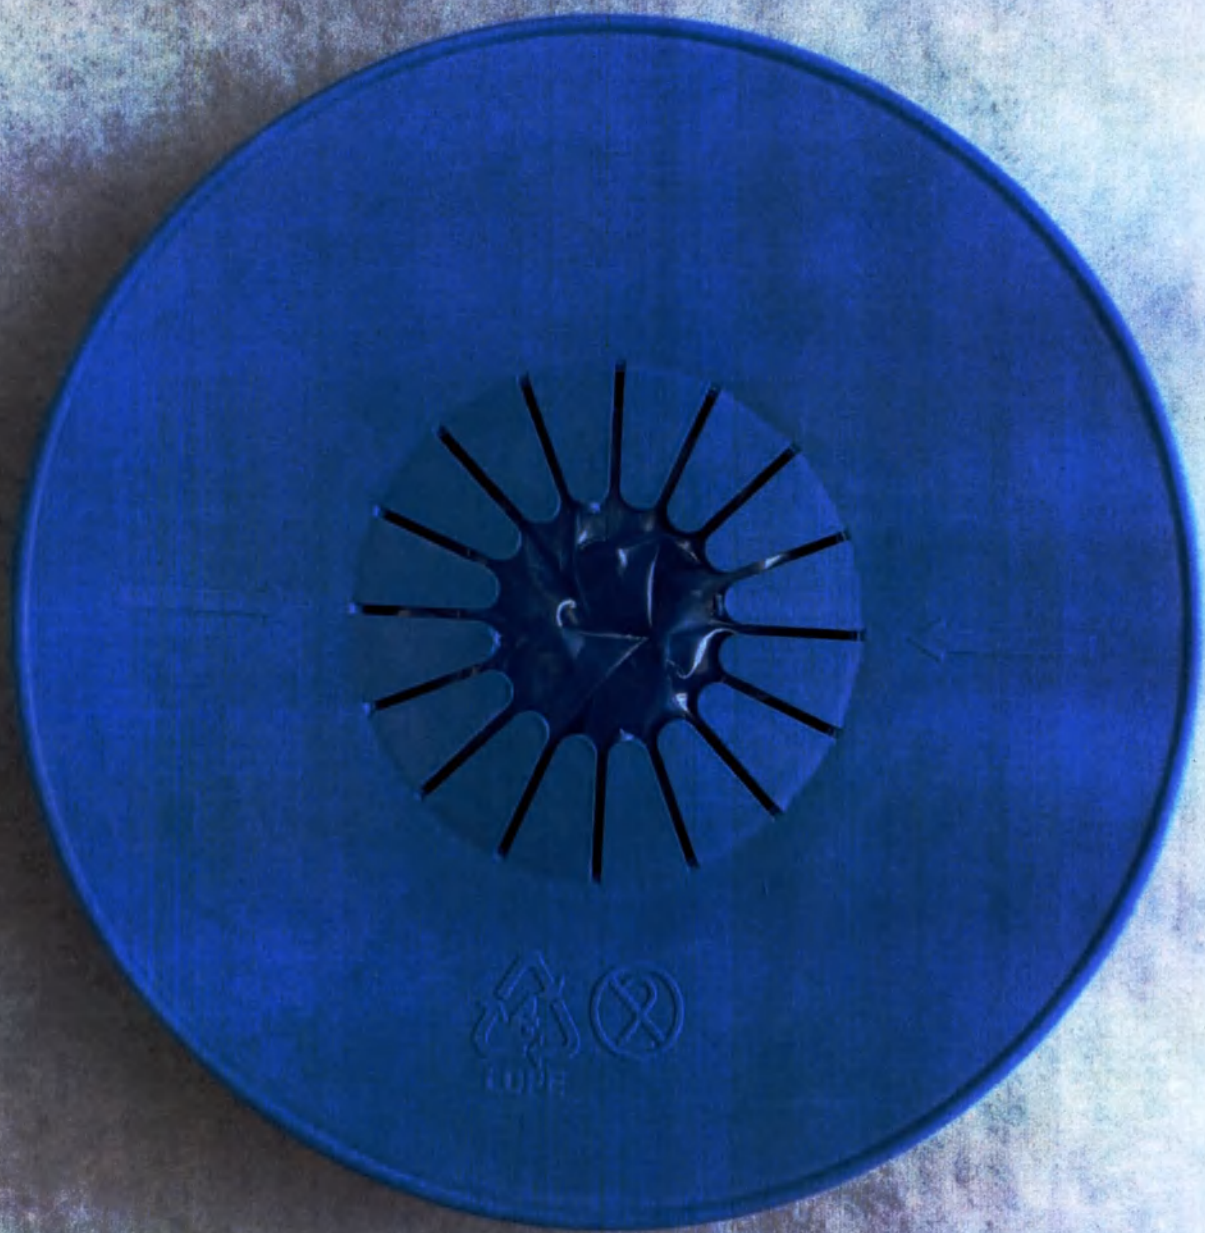

Вид медицинского изделия «Чехол для рукоятки медицинского оборудования (синий)», производства АО «ЗМТ»



Общий вид медицинского изделия «Чехол для рукоятки медицинского оборудования (синий)», производства АО «ЗМТ»



4 620762 560015



СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ EN 13795-2011

ру № К3Н от Чехол для рукоятки медицинского оборудования
одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-028-51834327-2023

Чехол для рукоятки медицинского оборудования (красный)

Количество в упаковке 1 шт

К30



4621592000140000000026

Дата выпуска: 2023-01

ТУ 32.50.50-028-51834327-2023

Хранить и транспортировать при t от -50°C до +40°C и влажности не более 80%

Перед применением выдерживать при комнатной температуре не менее 24 часов

	STERILE			2028-01	Партия (LOT) 1147 Код: 25853
--	---------	--	--	---------	------------------------------

АО «ЗМТ», 620135, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 17
тел.: (343) 268-22-00, www.zmt.ru
Им подлежат обязательной сертификации

Сделано в России

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ КАЧЕСТВОМ

«Чехол для рукоятки медицинского оборудования (красный)» в потребительской упаковке, производства АО «ЗМТ»



4 620762 560015



СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ EN 13795-2011

ПУ № РЗН от Чехол для рукоятки медицинского оборудования
одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-028-51834327-2023

Чехол для рукоятки медицинского оборудования (лиловый)

Количество в упаковке 1 шт

K30



462159200014000000026

Дата выпуска : 2023-01

ТУ 32.50.50-023-51834327-2023

Хранить и транспортировать при t от -50°C до +40°C и влажности не более 80%

Перед применением выдерживать при комнатной температуре не менее 24 часов



STERILE

E



2028-01

Партия (LOT) 14017 M02:31803

АО «ЗМТ», 620135, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 77

тел.: 8(343) 288-22-00, www.zmt.ru

Не подлежит обязательной сертификации

Сделано в России

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ КАЧЕСТВОМ

«Чехол для рукоятки медицинского оборудования (лиловый)» в потребительской упаковке, производства АО «ЗМТ»



4 620762 560015



СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ EN 13795-2011

РУ № РЗН от Чехол для рукоятки медицинского оборудования
одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-023-51834327-2023

Чехол для рукоятки медицинского оборудования (синий)

Количество в упаковке 1 шт

K30



462159200014000000025

Дата выпуска : 2023-01

ТУ 32.50.50-023-51834327-2023

Хранить и транспортировать при t от -50°C до +40°C и влажности не более 80%

Перед применением выдерживать при комнатной температуре не менее 24 часов



STERILE



2028-01

Партия (LOT) 4917

Код : 25653

АО "ЗМТ". 620135, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д.77
тел.: 8(343) 266-22-00, www.zmt.ru
Не подлежит обязательной сертификации

Сделано в России

БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ КАЧЕСТВОМ

«Чехол для рукоятки медицинского оборудования (синий)» в потребительской упаковке, производства АО «ЗМТ»




Транспортная упаковка

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 14 листов


Генеральный директор Н.В.Поляков



**Дополнение № 1 к фотографическим
изображениям
медицинского изделия
«Чехол для рукоятки
медицинского оборудования
одноразовый стерильный
по ТУ 32.50.50-028-51834327-2023»**

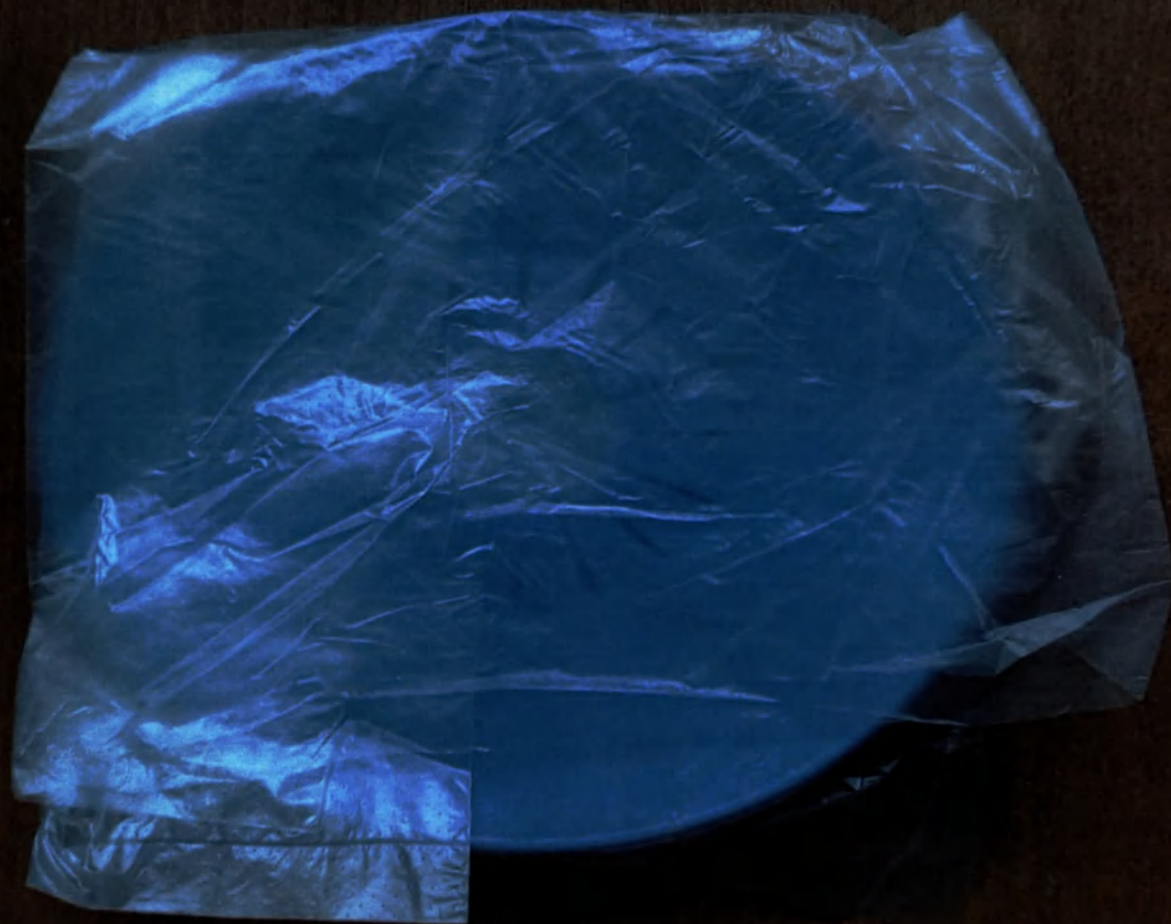

«Чехол для рукоятки медицинского оборудования (синий)» в первичной потребительской упаковке из полиэтиленового пакета, производства АО «ЗМТ»

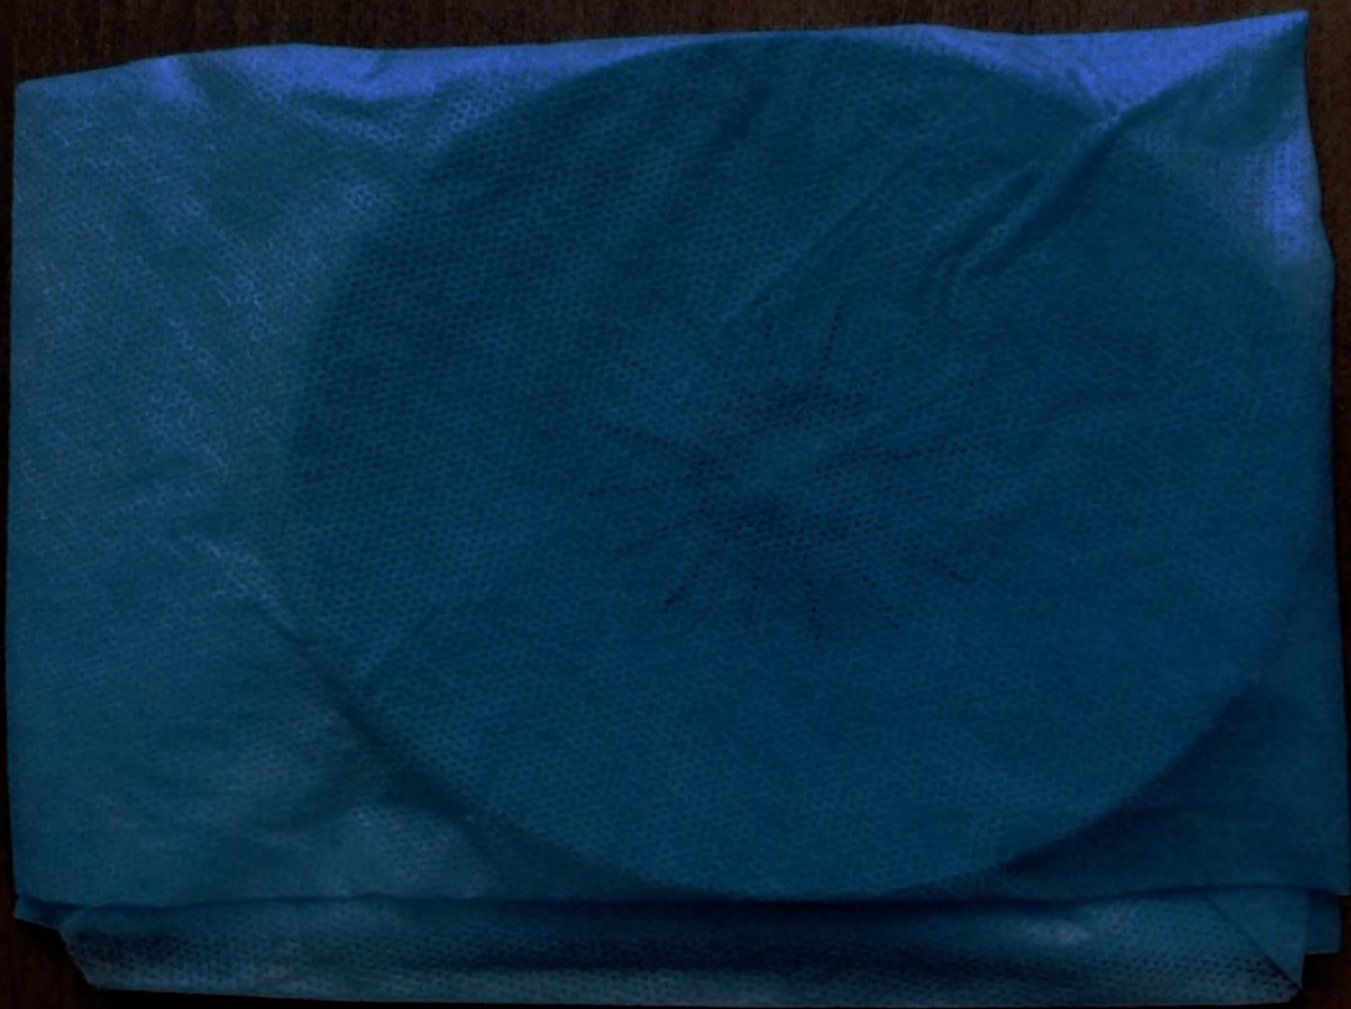

«Чехол для рукоятки медицинского оборудования (синий)» в первичной потребительской упаковке из нетканого материала, производства АО «ЗМТ»



«Чехол для рукоятки медицинского оборудования (синий)» в потребительской упаковке в виде лотка, производства АО «ЗМТ»

Всего пронумеровано, прошнуровано, скреплено
печатью 4 листа(ов)

Генеральный директор Н.В.Боляков



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «ЗМТ»

Н. В. Поляков

2023 г.



**МАКЕТ МАРКИРОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Чехол для рукоятки
медицинского оборудования
одноразовый стерильный
по ТУ 32.50.50-028-51834327-2023**

2023 г.

№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.	Инв. № дуч.	Подпись и дата

Настоящий макет маркировки составлен в соответствии с требованиями ТУ 32.50.50-028-51834327 -2023.

Маркировка на изделии (Приложение 1).

На держатель чехла нанесена следующая маркировка:

1. Стрелки 2 шт (указание входа);
2. Графический знак: «повторно не использовать»;
3. Графический знак материала изготовления.

Маркировка на этикетке (Приложение 2), содержит следующую информацию:

1. Наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
2. Номер регистрационного удостоверения, дата выдачи и наименование изделия;
3. Цвет изделия;
4. Номер технических условий;
5. Юридический адрес предприятия-изготовителя;
6. Графическое обозначение «Запрет на повторное применение»;
7. Графическое обозначение «Радиационная стерилизация»;
8. Графическое обозначение «Использовать до...»;
9. Графическое обозначение «Не использовать при повреждении упаковки»;
10. Количество штук в упаковке;
11. Номер партии;
12. Код (при заказе в производство);
13. Дата выпуска;
14. Условия хранения и транспортирования;
15. Надпись «Перед применением выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов»; «Сделано в России», «Безопасность, подтвержденная качеством»;
16. Надпись «Не подлежит обязательной сертификации»;
17. Штрих-код;
18. Рисунок (при наличии);
19. QR-код (для быстрого перехода на сайт производителя с полной версией инструкции по применению).
20. Надпись: «Соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ EN 13795-2011»

Подпись и дата

Дуб.

Взам. инв.

Подпись и дата

В. № подл.

ТУ 32.50.50-028-51834327-2023

					ТУ 32.50.50-028-51834327-2023			
Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Хамидуллина		20.11.23	Чехол для рукоятки медицинского оборудования одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-028-51834327-2023	Лит.	Лист	Листов
Пров.		Кочнева		20.11.23		A	2	7
						АО «ЗМТ»		
Н. контр.		Грибова		20.11.23				
ПМН  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU								


Маркировка на бумажном ярлыке транспортной упаковки (Приложение 3), содержит следующую информацию:

1. Наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
2. Юридический адрес предприятия-изготовителя;
3. Номер регистрационного удостоверения, дата выдачи, наименование изделия;
4. Цвет изделия;
5. Графическое обозначение «Радиационная стерилизация»;
6. Графическое обозначение «Использовать до»;
7. Графическое обозначение «Запрет на повторное применение»;
8. Наименование заказчика;
9. Номер партии или номер заказа;
10. Номер комплектовщика;
11. Код (при заказе в производство);
12. Дата выпуска;
13. Условия хранения и транспортирования;
14. Надпись: «Перед применением выдержать при комнатной температуре не менее 24 часов»;
15. Надпись: «Не подлежит обязательной сертификации»;
16. Количество изделий, вложенных в транспортную тару;
17. Штрих-код;
18. Масса брутто транспортного ящика.

№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.	Инв. № дуб.	Подпись и дата

Приложение 1

Пример маркировки на изделии

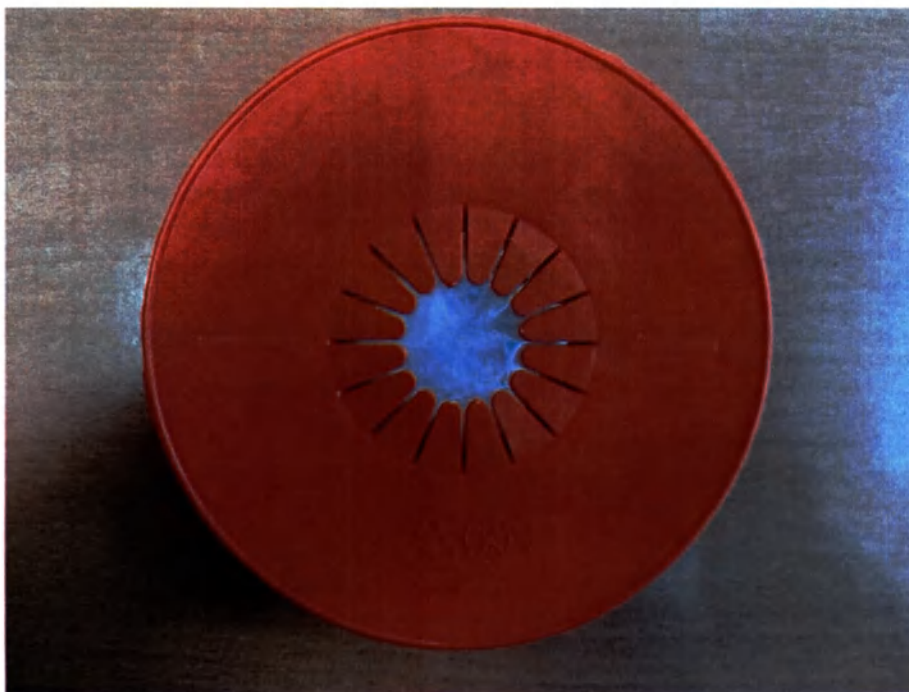

Подпись и дата

Инв № дуб.

Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. № подл.

Приложение 2

Пример маркировки на этикетке потребительской упаковки



СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ ГОСТ EN 13795-2011

РУ № РЗН от Чехол для рукоятки медицинского оборудования
одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-028-51834327-2023

Чехол для рукоятки медицинского оборудования (красный)

Количество в упаковке 1 шт



Дата выпуска : 2023-01

ТУ 32.50.50-028-51834327-2023

Хранить и транспортировать при t от -50°C до +40°C и влажности не более 80%

Перед применением выдерживать при комнатной температуре не менее 24 часов

	STERILE			2028-01	Партия (LOT) 4917 Код : 25653
--	---------	--	--	---------	-------------------------------

АО "ЗМТ". 620135, г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, д.77

тел.: 8(343) 288-22-00, www.zmt.ru

Не подлежит обязательной сертификации

Сделано в России

БЕЗОПАСНОСТЬ , ПОДТВЕРЖДЕННАЯ КАЧЕСТВОМ

Подпись и дата

Инв № дуб.

Взам.инв.

Подпись и дата

Инв.№ подл.

ТУ 32.50.50-028-51834327-2023

Лист

5

Приложение 3

Пример маркировки на этикетке транспортной упаковки

	17.01.23	 14620762560029
 46023252000004293		
Чехол для рукоятки медицинского оборудования (красный)		
		20 шт
Заказчик Завод медицинских технологий АО		Комплектовщик № 1
РУ № от Чехол для рукоятки медицинского оборудования одноразовый стерильный по ТУ 32.50.50-028-51834327-2023 Хранить и транспортировать при t от -50°C до +40°C и влажности не более 80% Перед применением выдерживать при комнатной температуре не менее 24 часов		
	STERILE R 	 2028-01 Код 25653 Заказ 14098 Партия 4917
АО "ЗМТ", 620135, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д.77, тел: 8(343) 288-22-00, www.zmt.ru Не подлежит обязательной сертификации		

Подпись и дата

Инв № Дуб.

Взам. инв.

Подпись и дата

Инв. № подл.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

Подпись и дата

THE NO. 1

Взаим. инв.

Подпись и дата

התחנה

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 7 листа(ов)

Генеральный директор Н.В. Поляков

