

УТВЕРЖДЕНО

Ген. директор Я. И. Пэвват

ООО «АЛЬФАМЕДЭКС»

М.П.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аппарат сшивающе-режущий Prime Power VOLKMANN

Версия 2

Внешний вид медицинского изделия

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, длина шва 45 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPWM45-BPWL, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, длина шва 45 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPWM45-BPWL – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

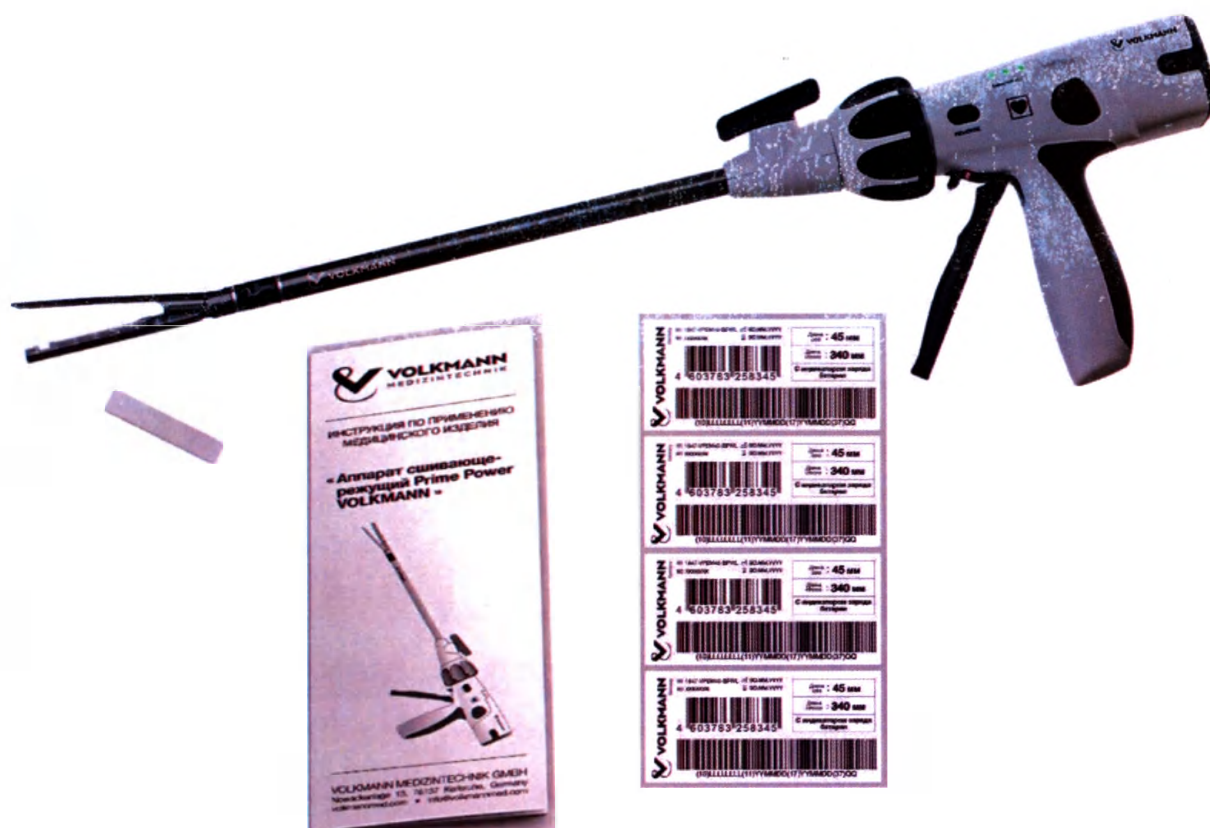



«АЛЬФАМЕДЭКС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

197229, РФ, г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр.-т, д. 113, ЛИТЕРА оф. 2
ИНН/КПП: 7814664356/781401001; Банк: Филиал АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Санкт-Петербург
БИК: 044030786; Р/С: 40702810132060005097; К/С: 30101810600000000786

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, длина шва 45 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPWM45-BPWL, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, длина шва 45 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPWM45-BPWL – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

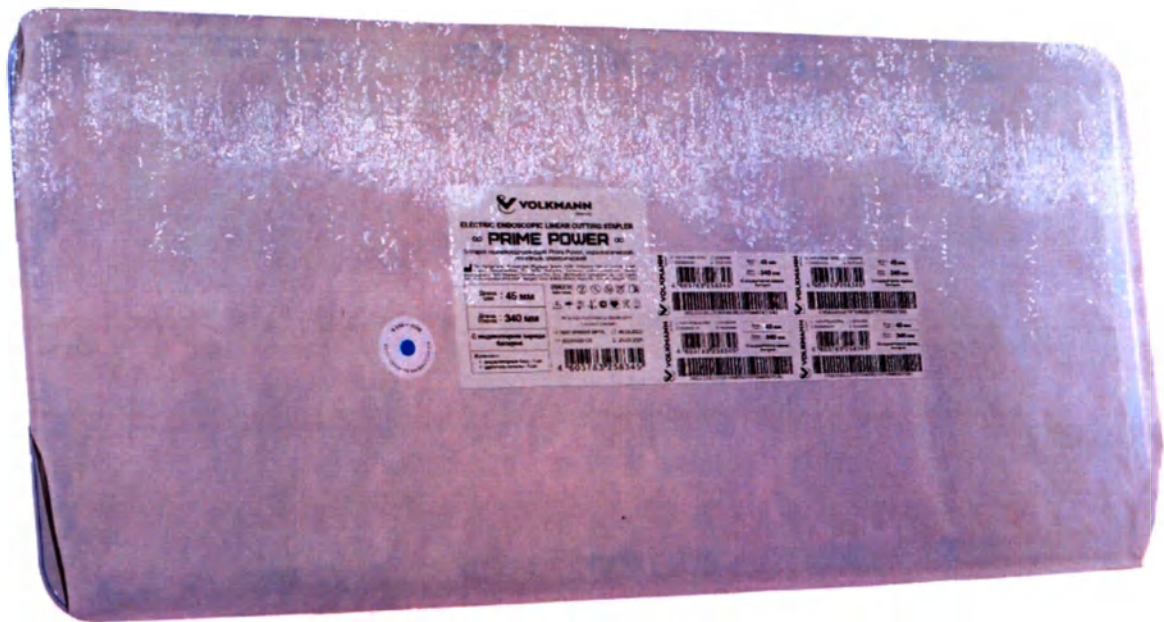

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, длина шва 45 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPWM45-BPWL, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, длина шва 45 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPWM45-BPWL – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

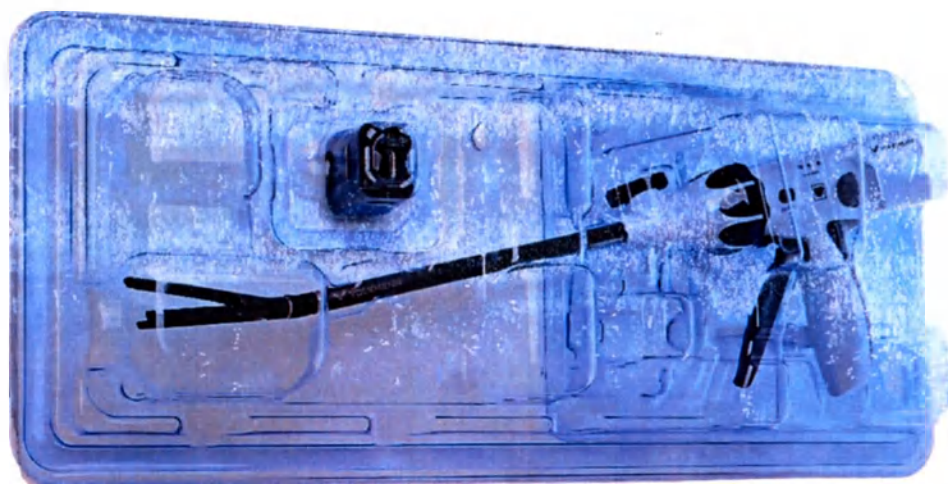

Внешний вид медицинского изделия

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPWM60-BPWL, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPWM60-BPWL – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

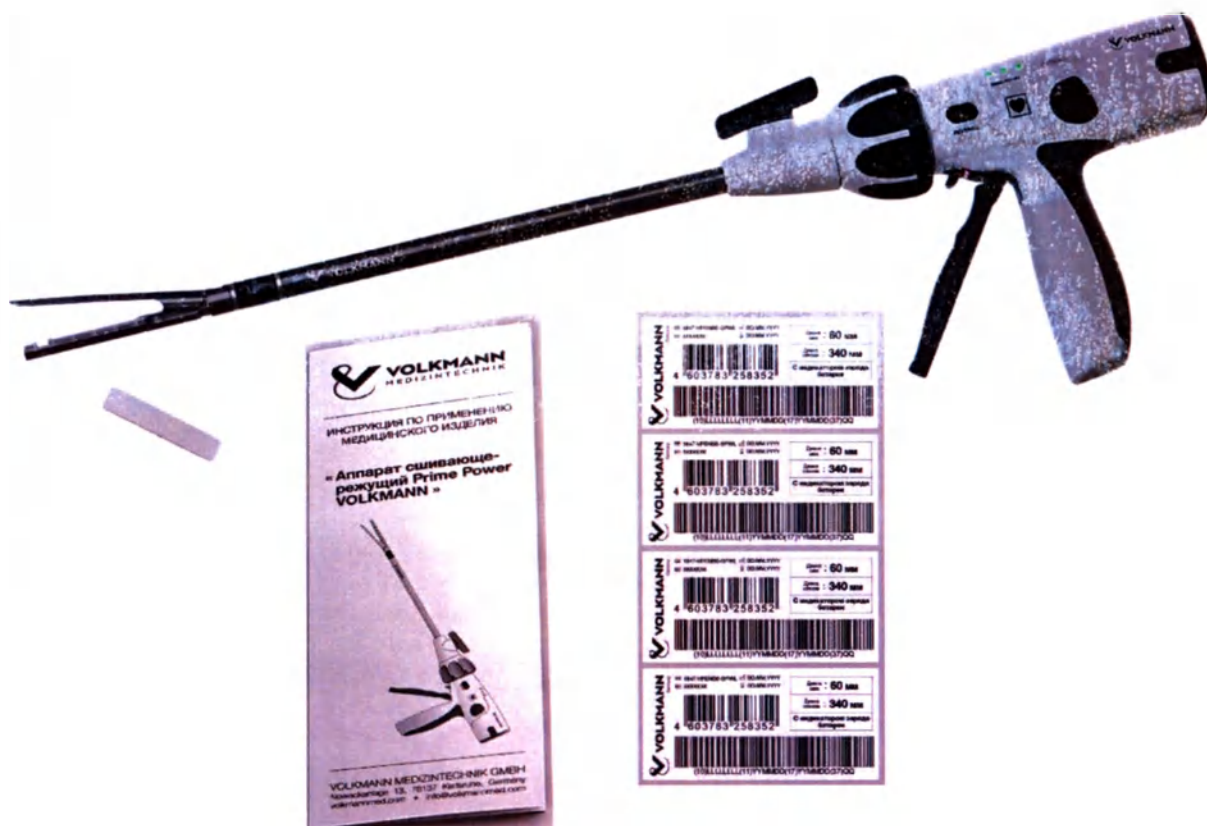

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPWM60-BPWL, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPWM60-BPWL – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

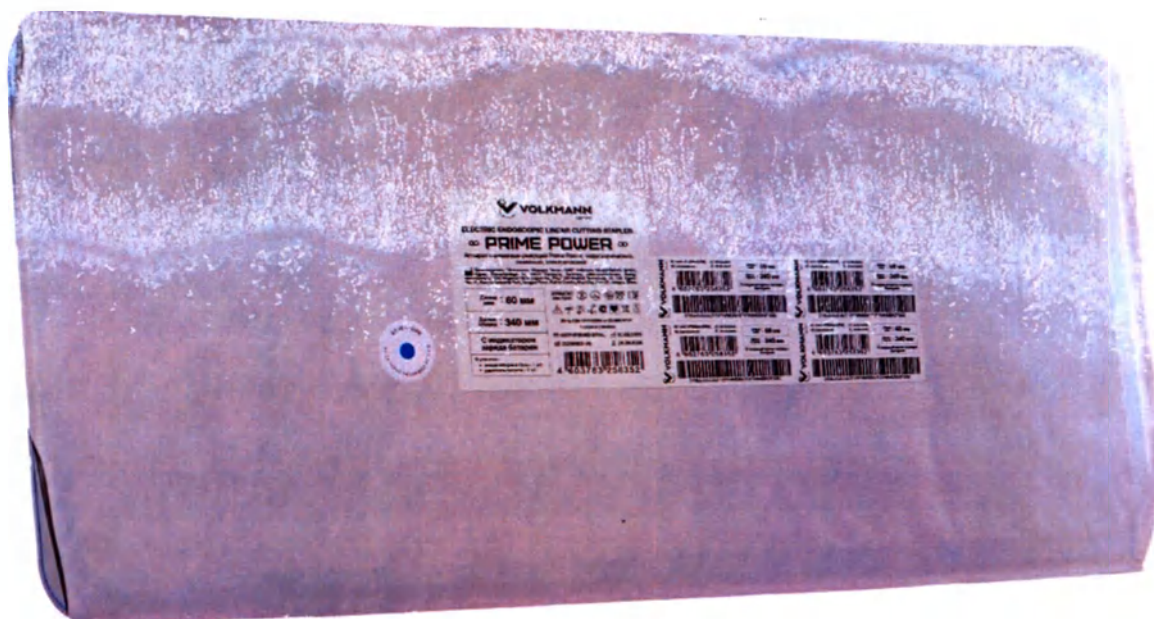



«АЛЬФАМЕДЭКС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

197229, РФ, г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр.-т, д. 113, ЛИТЕРА оф. 2
ИНН/КПП: 7814664356/781401001; Банк: Филиал АО «АЛФА-БАНК» в г. Санкт-Петербург
БИК: 044030786; Р/С: 40702810132060005097; К/С: 30101810600000000786

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPWM60-BPWL, в упаковке:

- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPWM60-BPWL – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»



Внешний вид медицинского изделия

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, удлиненный, длина шва 45 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPEL45-BPWL, в упаковке:

- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, удлиненный, длина шва 45 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPEL45-BPWL – 1 шт.
- Аккумуляторный блок – 1 шт.
- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»





«АЛЬФАМЕДЭКС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

197229, РФ, г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр.-т, д. 113, ЛИТЕР А оф. 2
ИНН/ОГРН: 7814664356/781401001; Банк: Филиал АО «АЛФА-БАНК» в г. Санкт-Петербург
БИК 044030786; Р/С: 40702810132060005097; К/С: 30101810600000000786

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)
«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, удлиненный, длина шва 45 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPEL45-BPWL, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, удлиненный, длина шва 45 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPEL45-BPWL – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

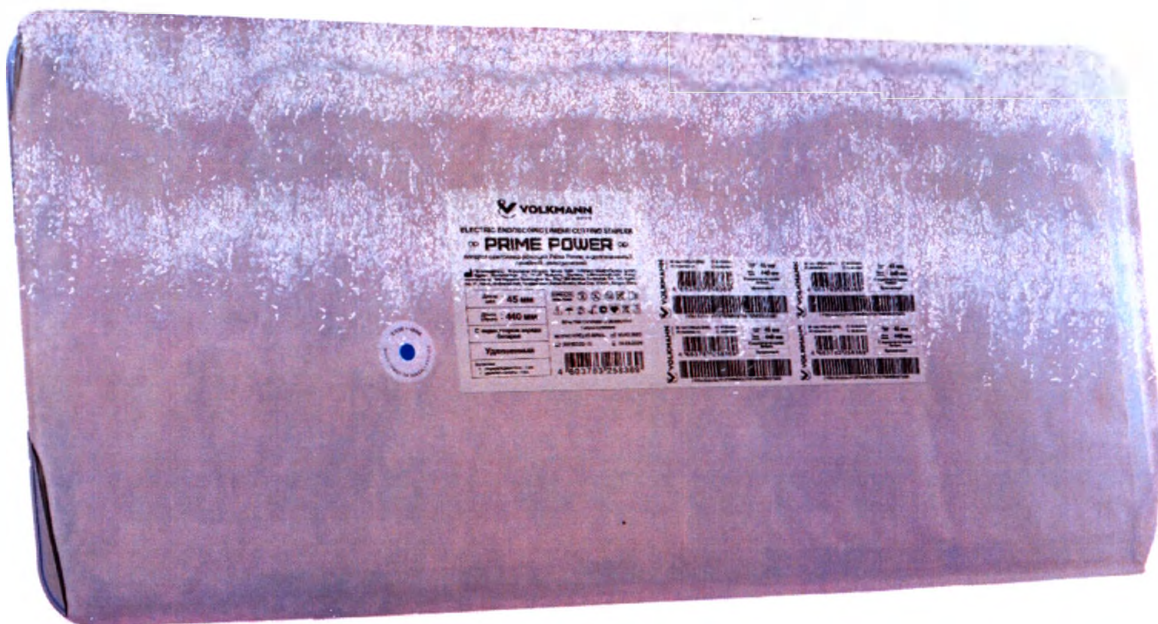

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, удлиненный, длина шва 45 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPWL, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, удлиненный, длина шва 45 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPWL – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

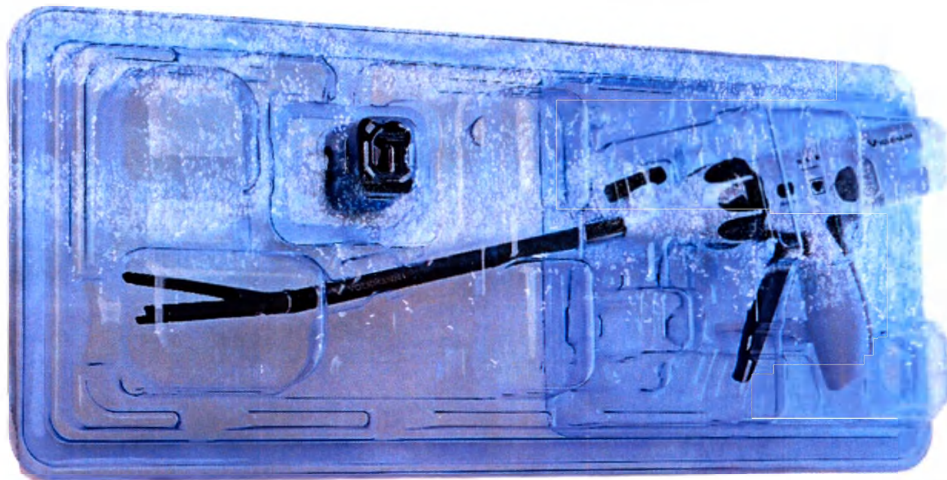

Внешний вид медицинского изделия

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, удлиненный, длина шва 60 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPEL60-BPWL, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, удлиненный, длина шва 60 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPEL60-BPWL – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

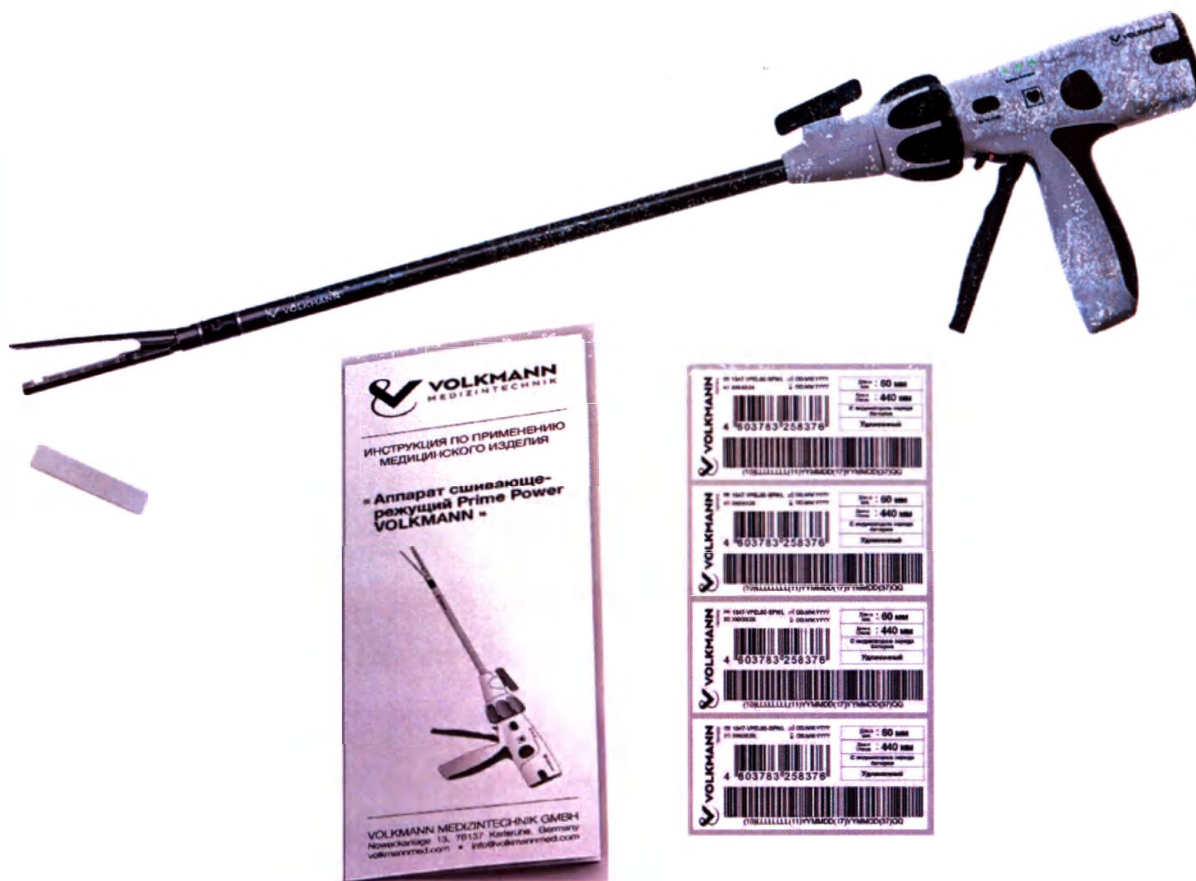

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)
«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, удлиненный, длина шва 60 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPWL-60-BPWL, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, удлиненный, длина шва 60 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPWL-60-BPWL – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

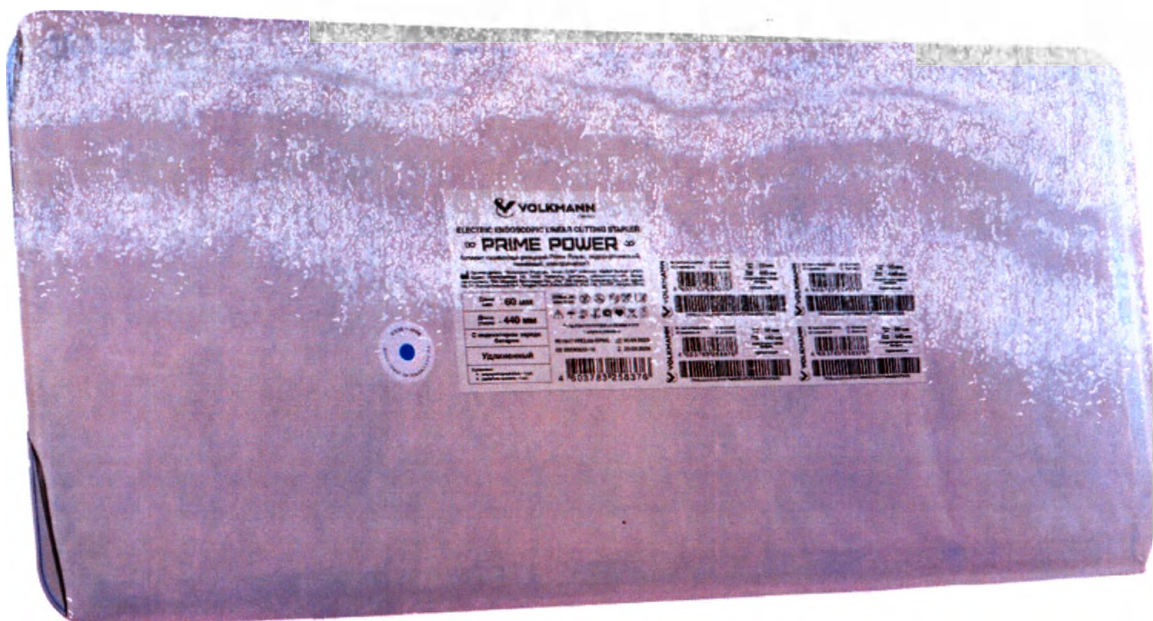

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, удлиненный, длина шва 60 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPEL60-BPWL, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический с индикатором заряда батареи, удлиненный, длина шва 60 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPEL60-BPWL – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

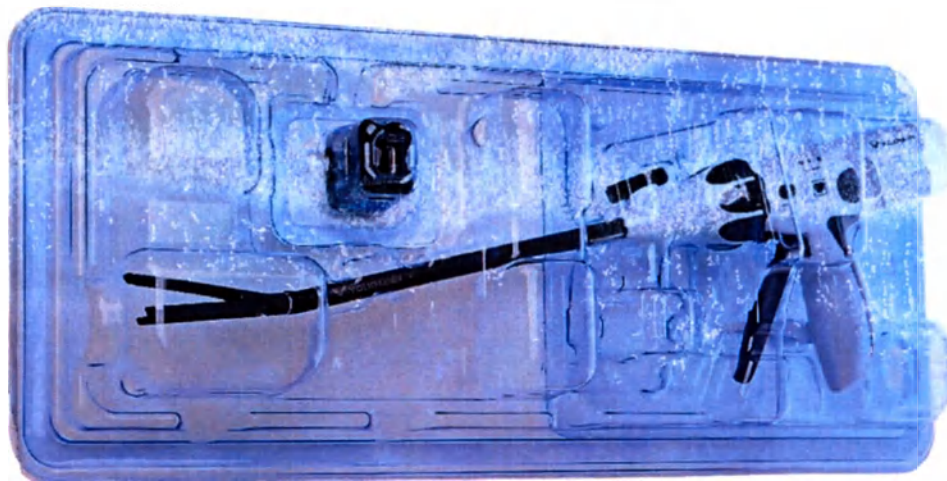

Внешний вид медицинского изделия

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, длина шва 45 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPEM45-BPW, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, длина шва 45 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPEM45-BPW – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

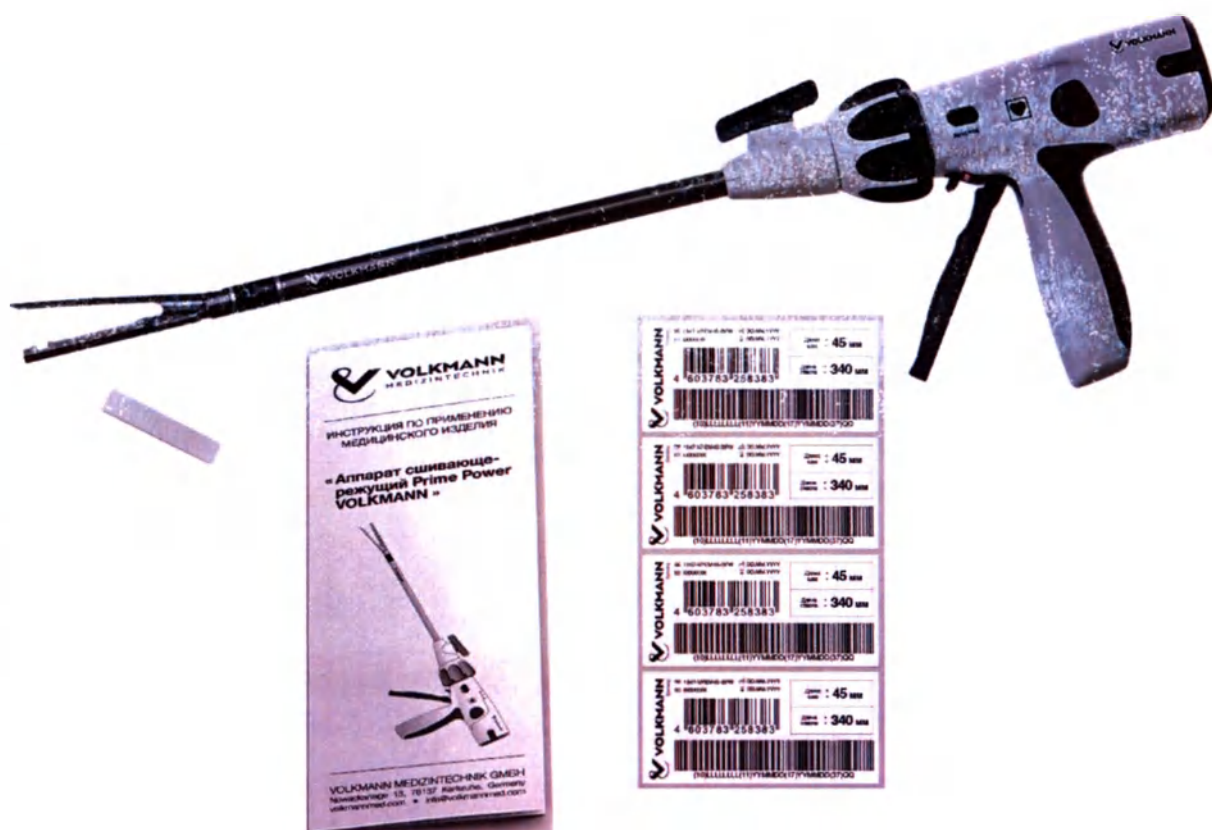

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)
«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, длина шва 45 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPМ45-BPW, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, длина шва 45 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPМ45-BPW – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

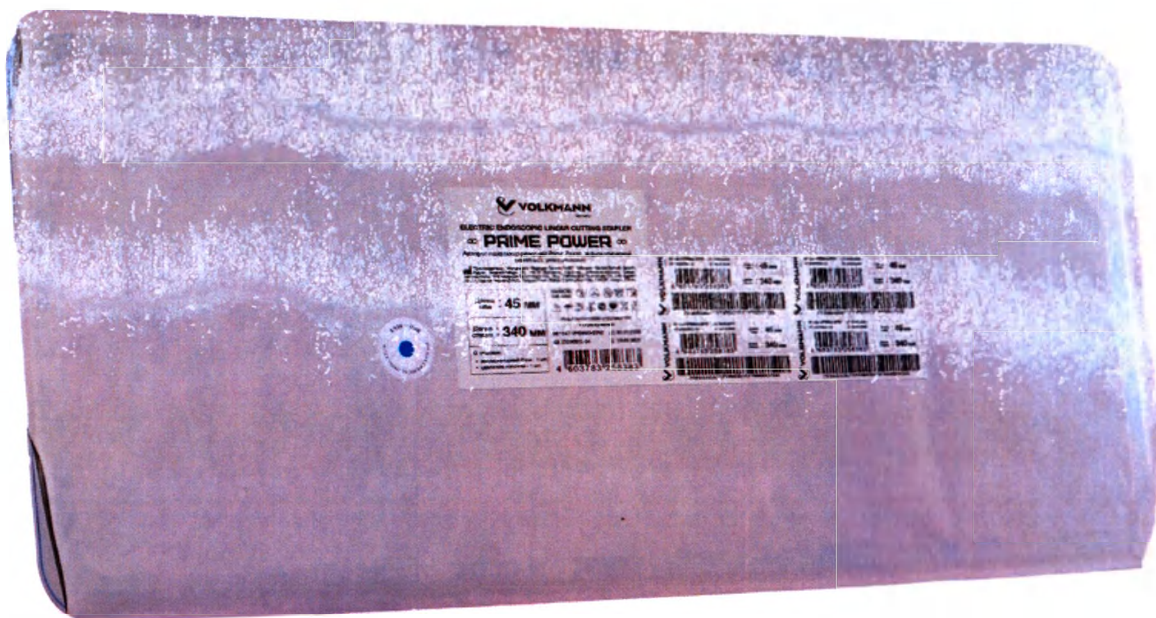



«АЛЬФАМЕДЭКС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

197229, РФ, г. Санкт-Петербург, Лахтинский пр.-т, д. 113, ЛИТЕРА оф. 2

ИНН/ОТГ 7814664356/781401001; Банк Филиал АО «АЛЬФА-БАНК» в г. Санкт-Петербург

БИК 044030786, Р/С 40702810132060005097, К/С 30101810600000000786

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, длина шва 45 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPREM45-BPW, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, длина шва 45 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPREM45-BPW – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

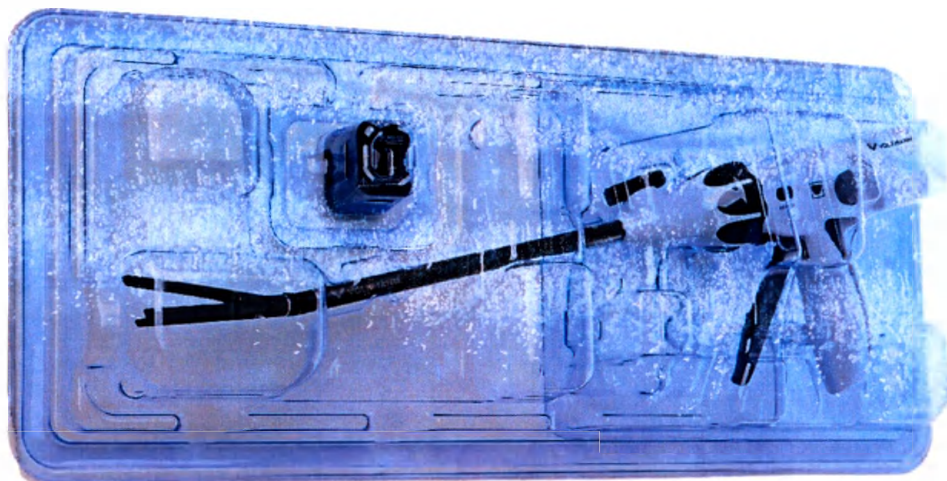

Внешний вид медицинского изделия

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPREM60-BPW, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPREM60-BPW – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

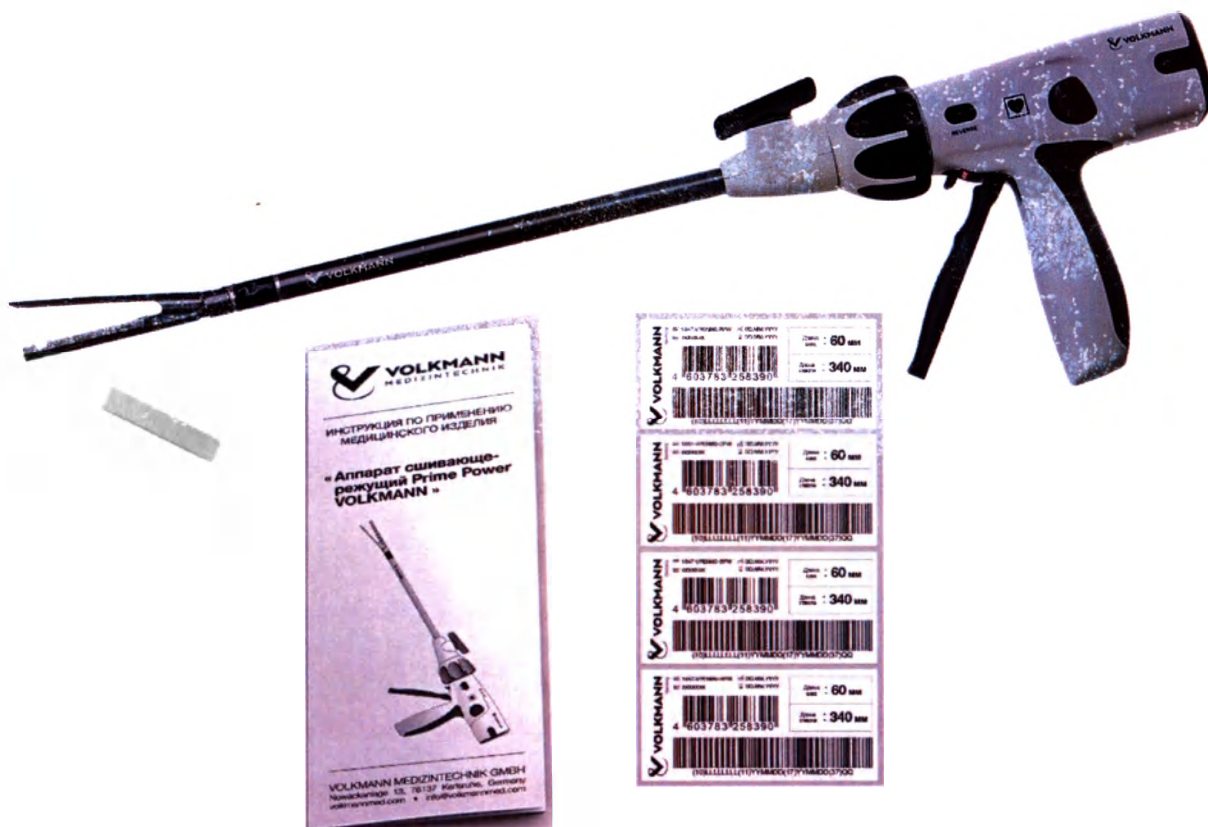

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPEM60-BPW, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VPEM60-BPW – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

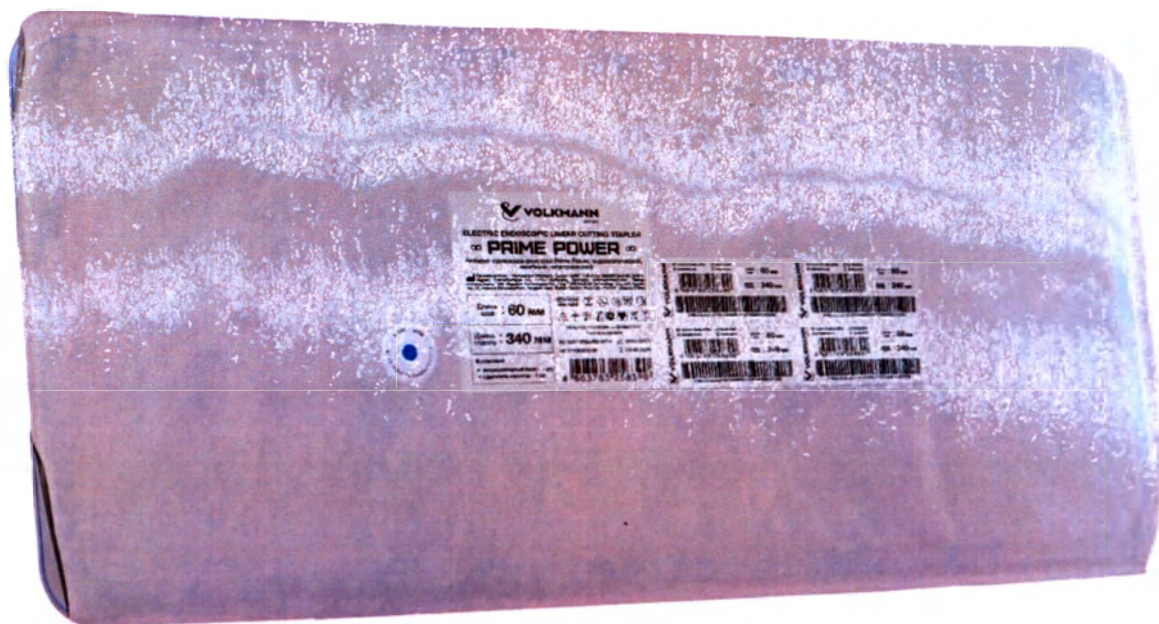

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VREM60-BPW, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, длина шва 60 мм, длина ствола 340 мм, REF - 1847-VREM60-BPW – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

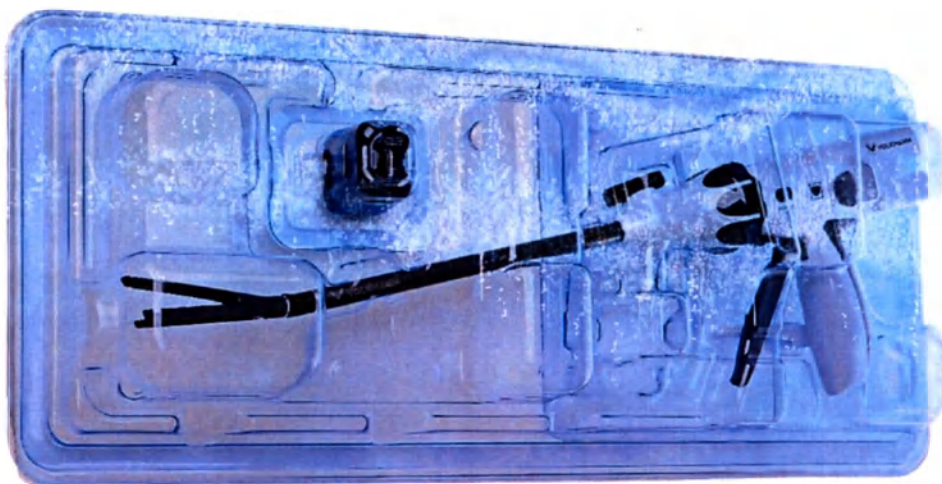

Внешний вид медицинского изделия

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, удлиненный, длина шва 45 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPEL45-BPW, в упаковке:

- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, удлиненный, длина шва 45 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPEL45-BPW – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.


- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)
«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, удлиненный, длина шва 45 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPEL45-BPW, в упаковке:
- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, удлиненный, длина шва 45 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPEL45-BPW – 1 шт.
- Аккумуляторный блок – 1 шт.
- Удалитель кассеты – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.
Мини-стикеры – 4 шт.»

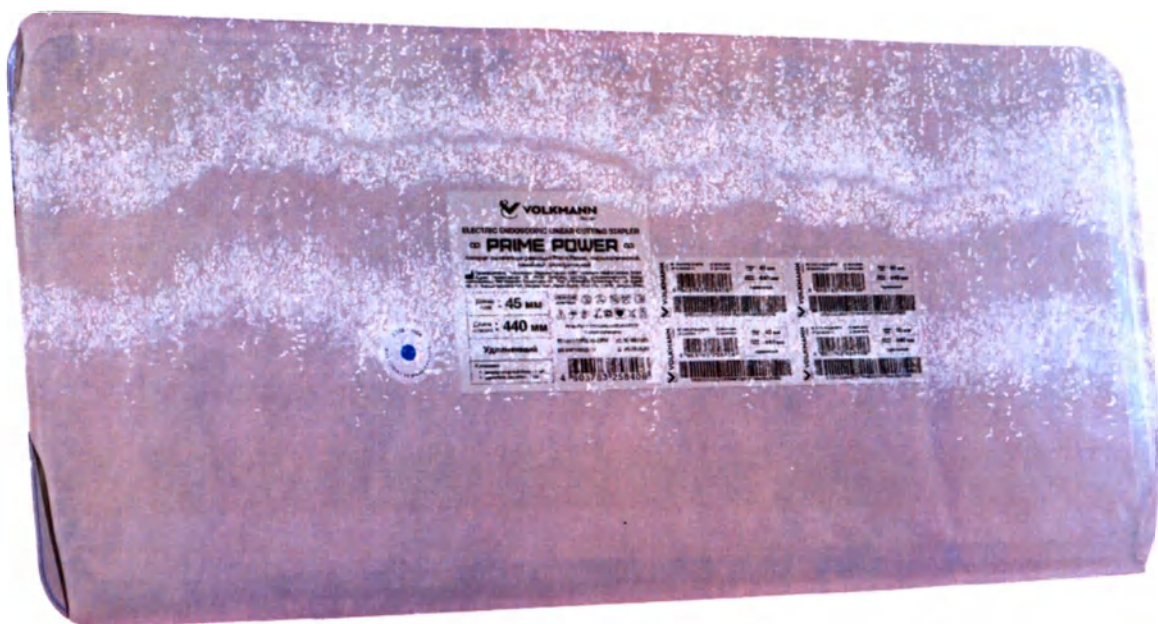

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, удлиненный, длина шва 45 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPCL45-BPW, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, удлиненный, длина шва 45 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VPCL45-BPW – 1 шт.

- Аккумуляторный блок – 1 шт.

- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

Мини-стикеры – 4 шт.»

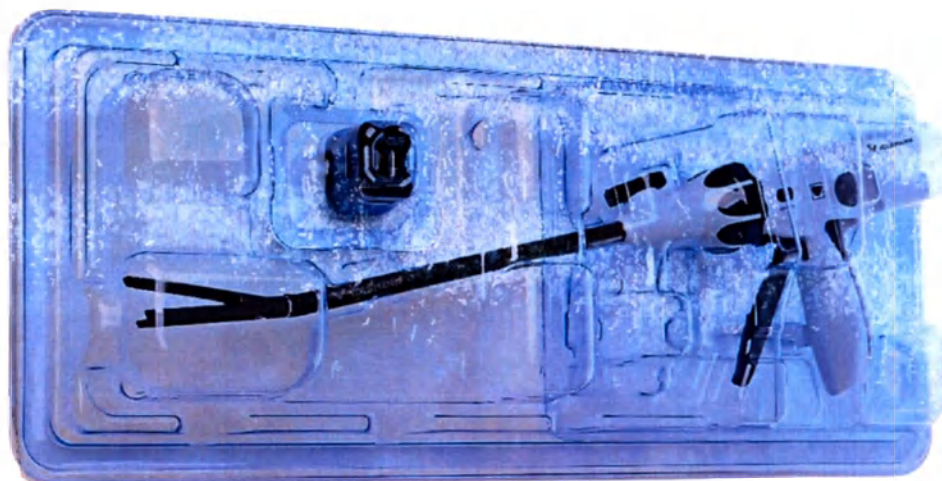

Внешний вид медицинского изделия

«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, удлиненный, длина шва 60 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VP60-BPW, в упаковке:


- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, удлиненный, длина шва 60 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VP60-BPW – 1 шт.
- Аккумуляторный блок – 1 шт.
- Удалитель кассеты – 1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.


Мини-стикеры – 4 шт.»



Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона маркировки)
«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, удлиненный, длина шва 60 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VP60-BPW, в упаковке:
- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, удлиненный, длина шва 60 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VP60-BPW – 1 шт.
- Аккумуляторный блок – 1 шт.
- Удалитель кассеты – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.
Мини-стикеры – 4 шт.»

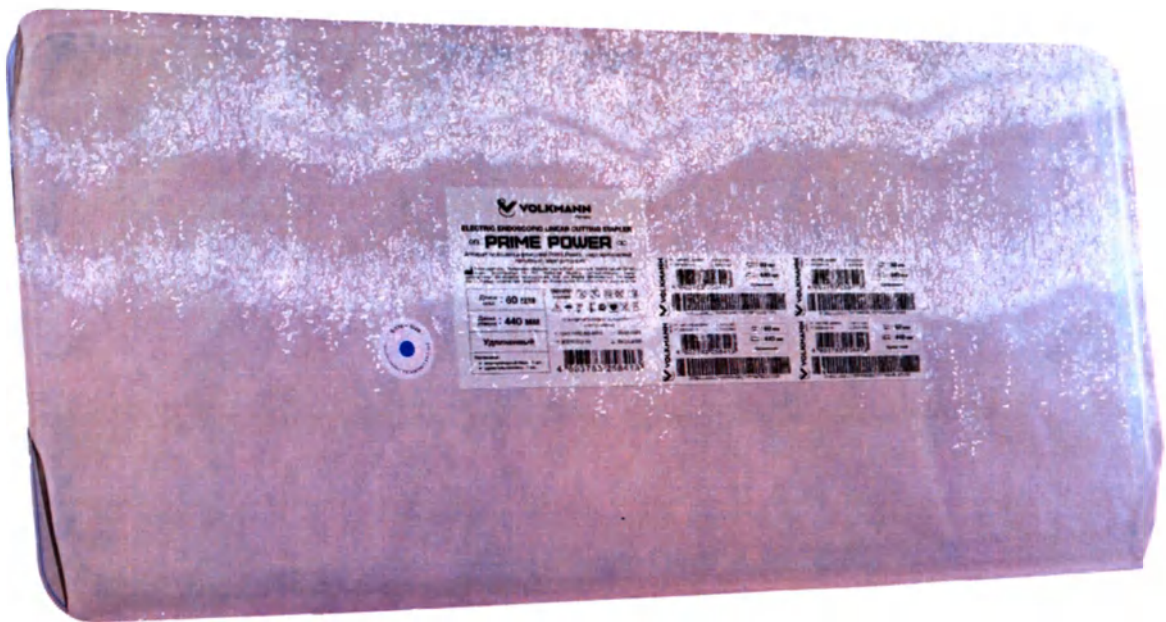

Внешний вид индивидуальной упаковки медицинского изделия (сторона изделия)
«Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, удлиненный, длина шва 60 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VP60-BPW, в упаковке:
- Аппарат сшивающе-режущий Prime Power, эндоскопический, линейный, электрический, удлиненный, длина шва 60 мм, длина ствола 440 мм, REF - 1847-VP60-BPW – 1 шт.
- Аккумуляторный блок – 1 шт.
- Удалитель кассеты – 1 шт.
Инструкция по применению – 1 шт.
Мини-стикеры – 4 шт.»

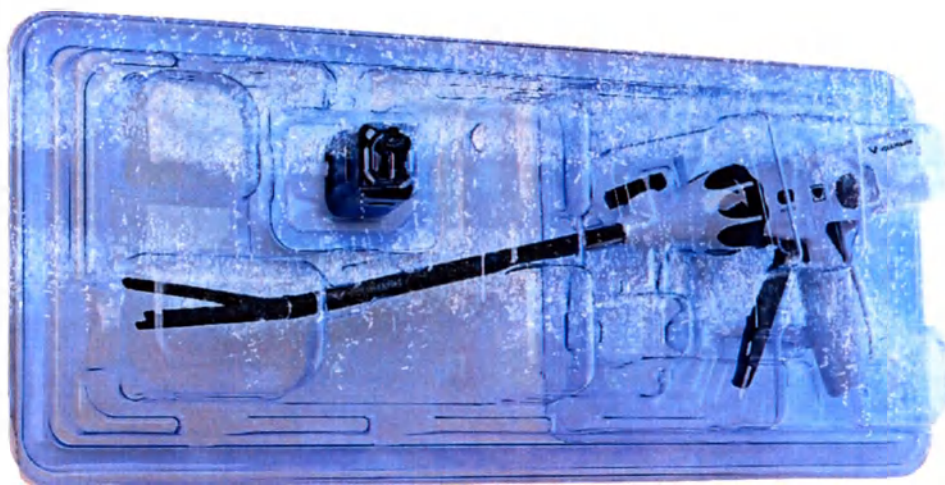

Внешний вид индивидуальной упаковки аккумуляторного блока



Прошито и пронумеровано

26/ двадцать шесть

листов

Генеральный директор

Пэвват Я.И.

