

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЭМС»


Галынин А.И.



Дефибриллятор автоматический наружный
Deficor-AED-A по ЛТБВ.941135.001 ТУ

Альбом фотографий

Общий вид



Рисунок 1 — Общий вид изделия со всеми составными частями и принадлежностями

Составные части



Рисунок 2 — Основной блок (ЛТБВ.941135.002-01, панель управления)

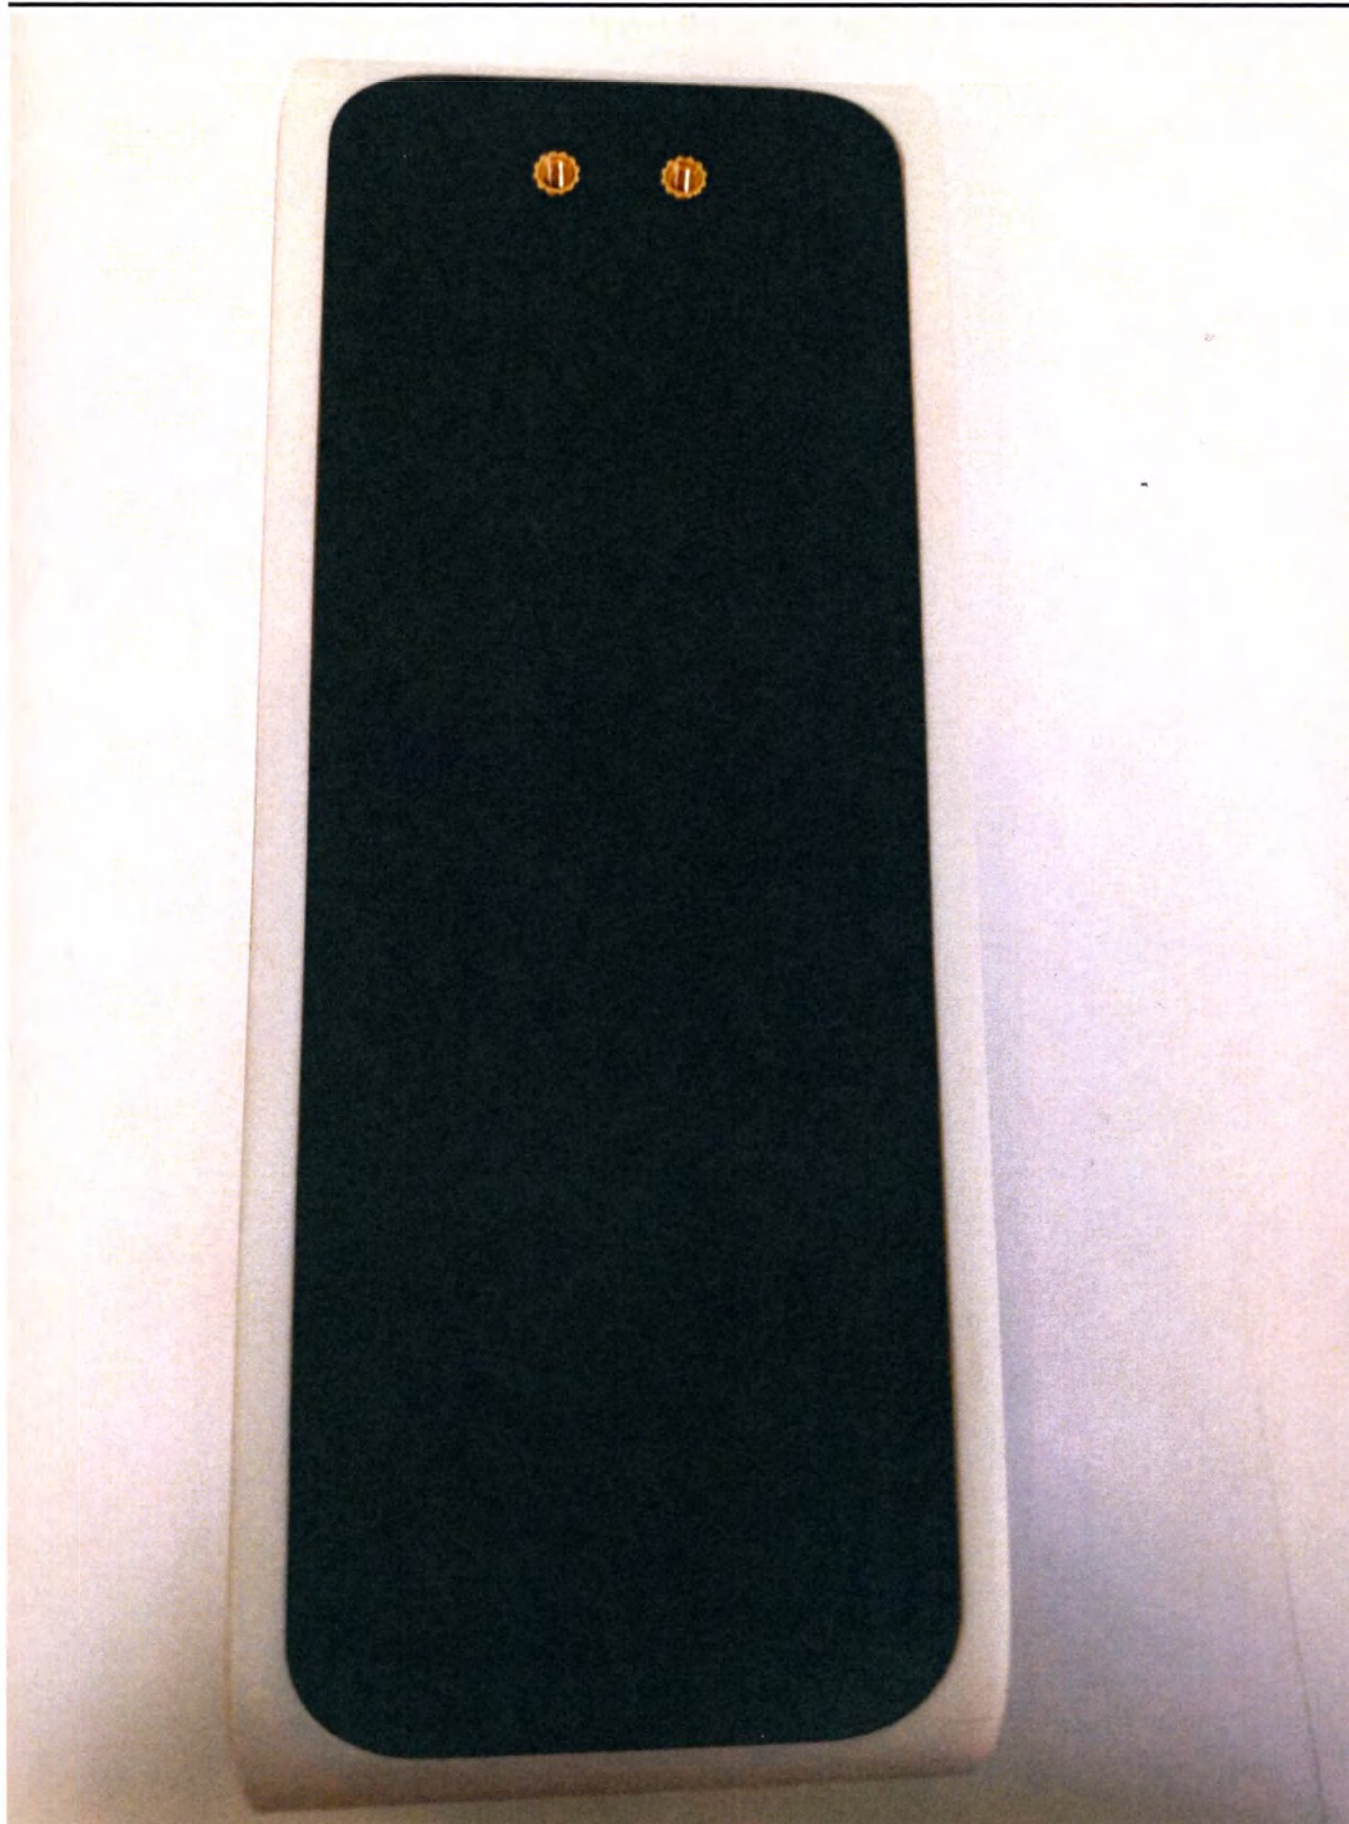


Рисунок 3 — Основной блок (ЛТБВ.941135.002-01, левая панель)



Рисунок 4 — Основной блок (ЛТБВ.941135.002-01, правая панель)

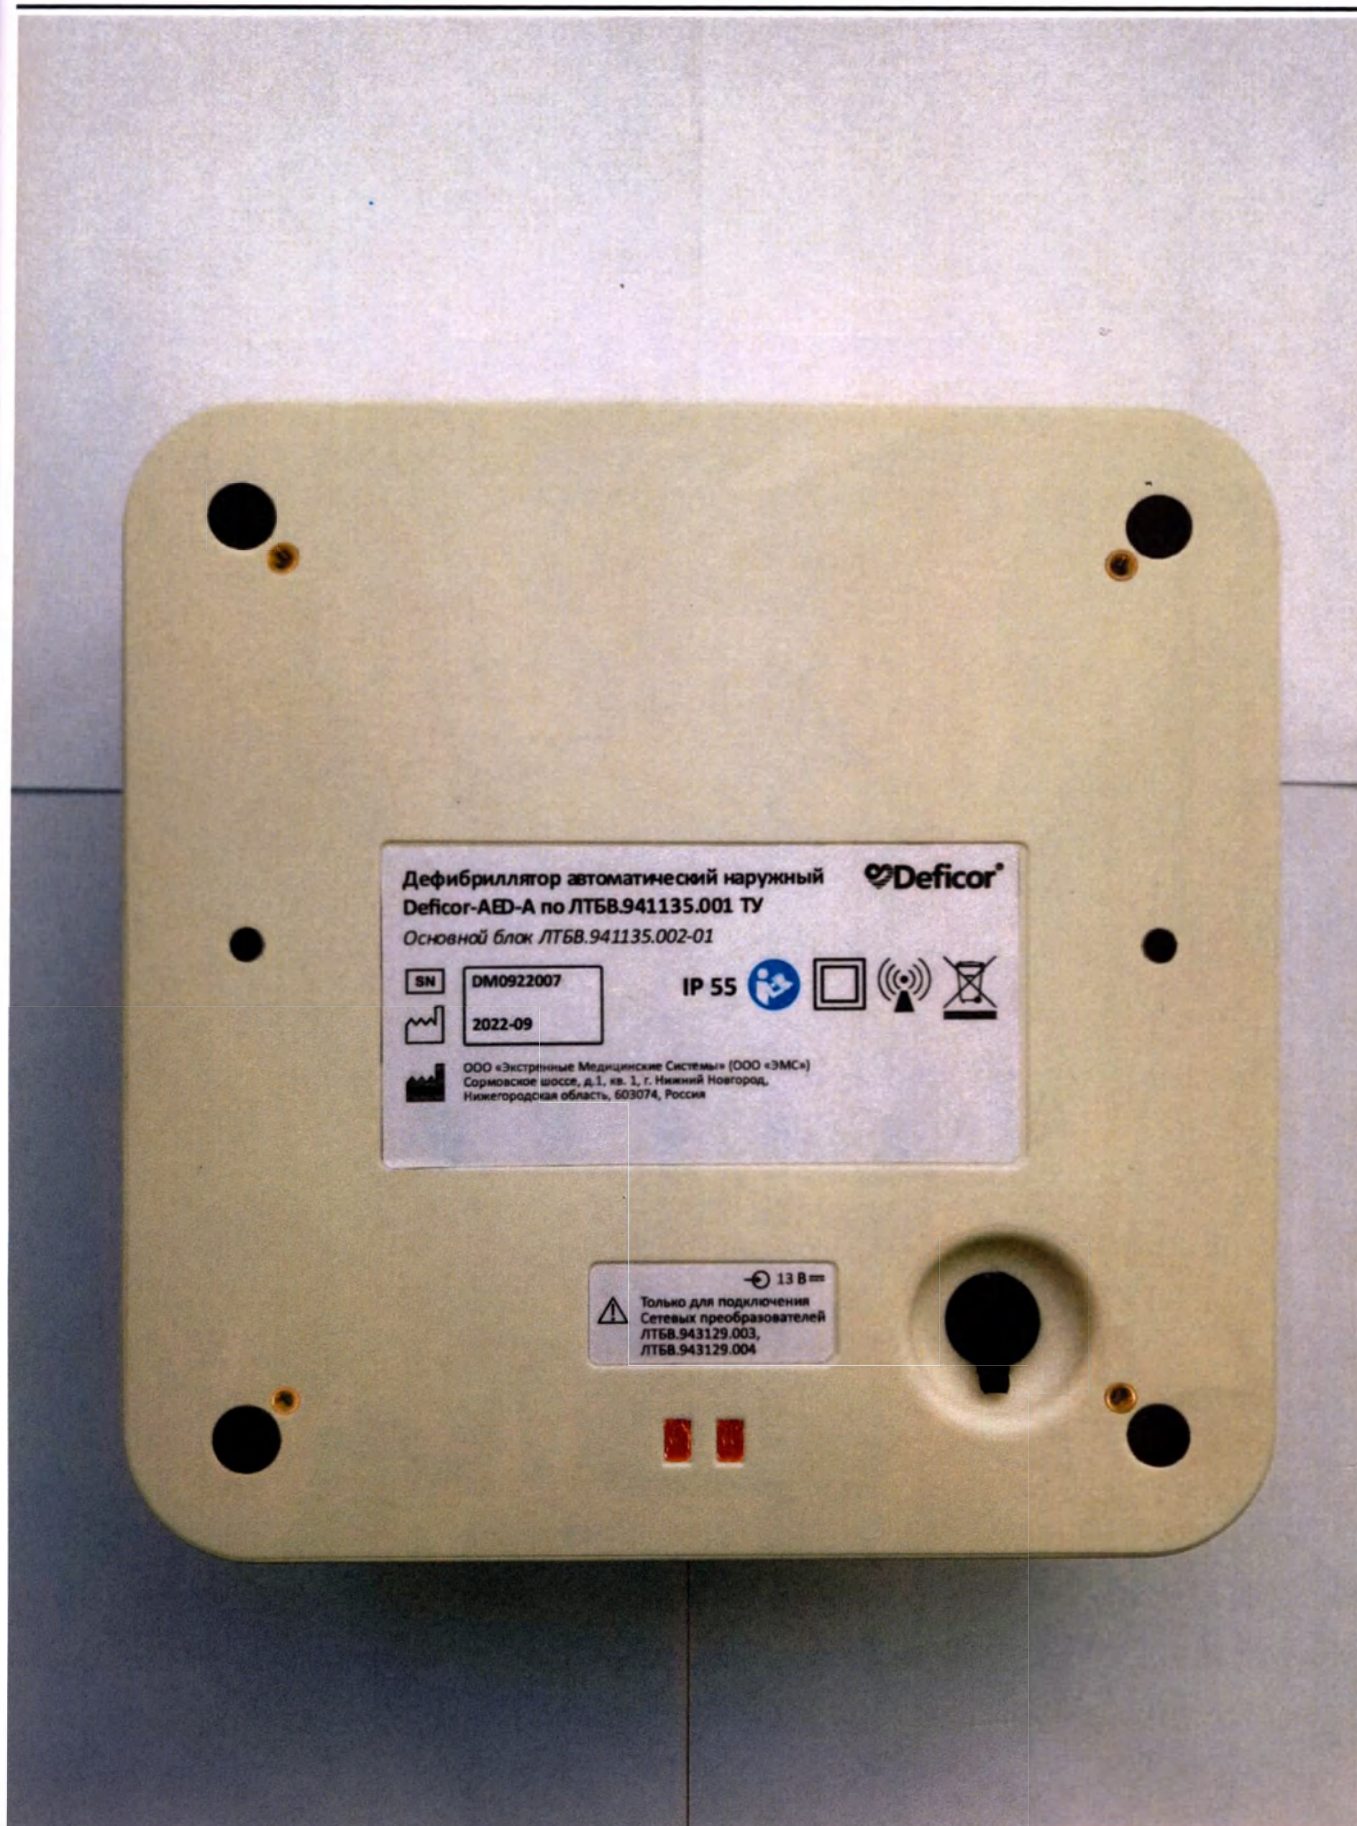


Рисунок 5 — Основной блок (ЛТБВ.941135.002-01, задняя крышка)



Рисунок 6 — Электроды дефибрилляции, мониторинга и стимуляции одноразовые для взрослых (ЛТБВ.943.132.002, в упаковке)



Рисунок 7 — Электрод дефибрилляции OBS-DE/P (303A1525, в упаковке)



Рисунок 8 — Одноразовые многофункциональные электроды для наружной дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, кардиостимуляции и мониторинга ЭКГ Lessa Defi-Pad (99.835.102, в упаковке)

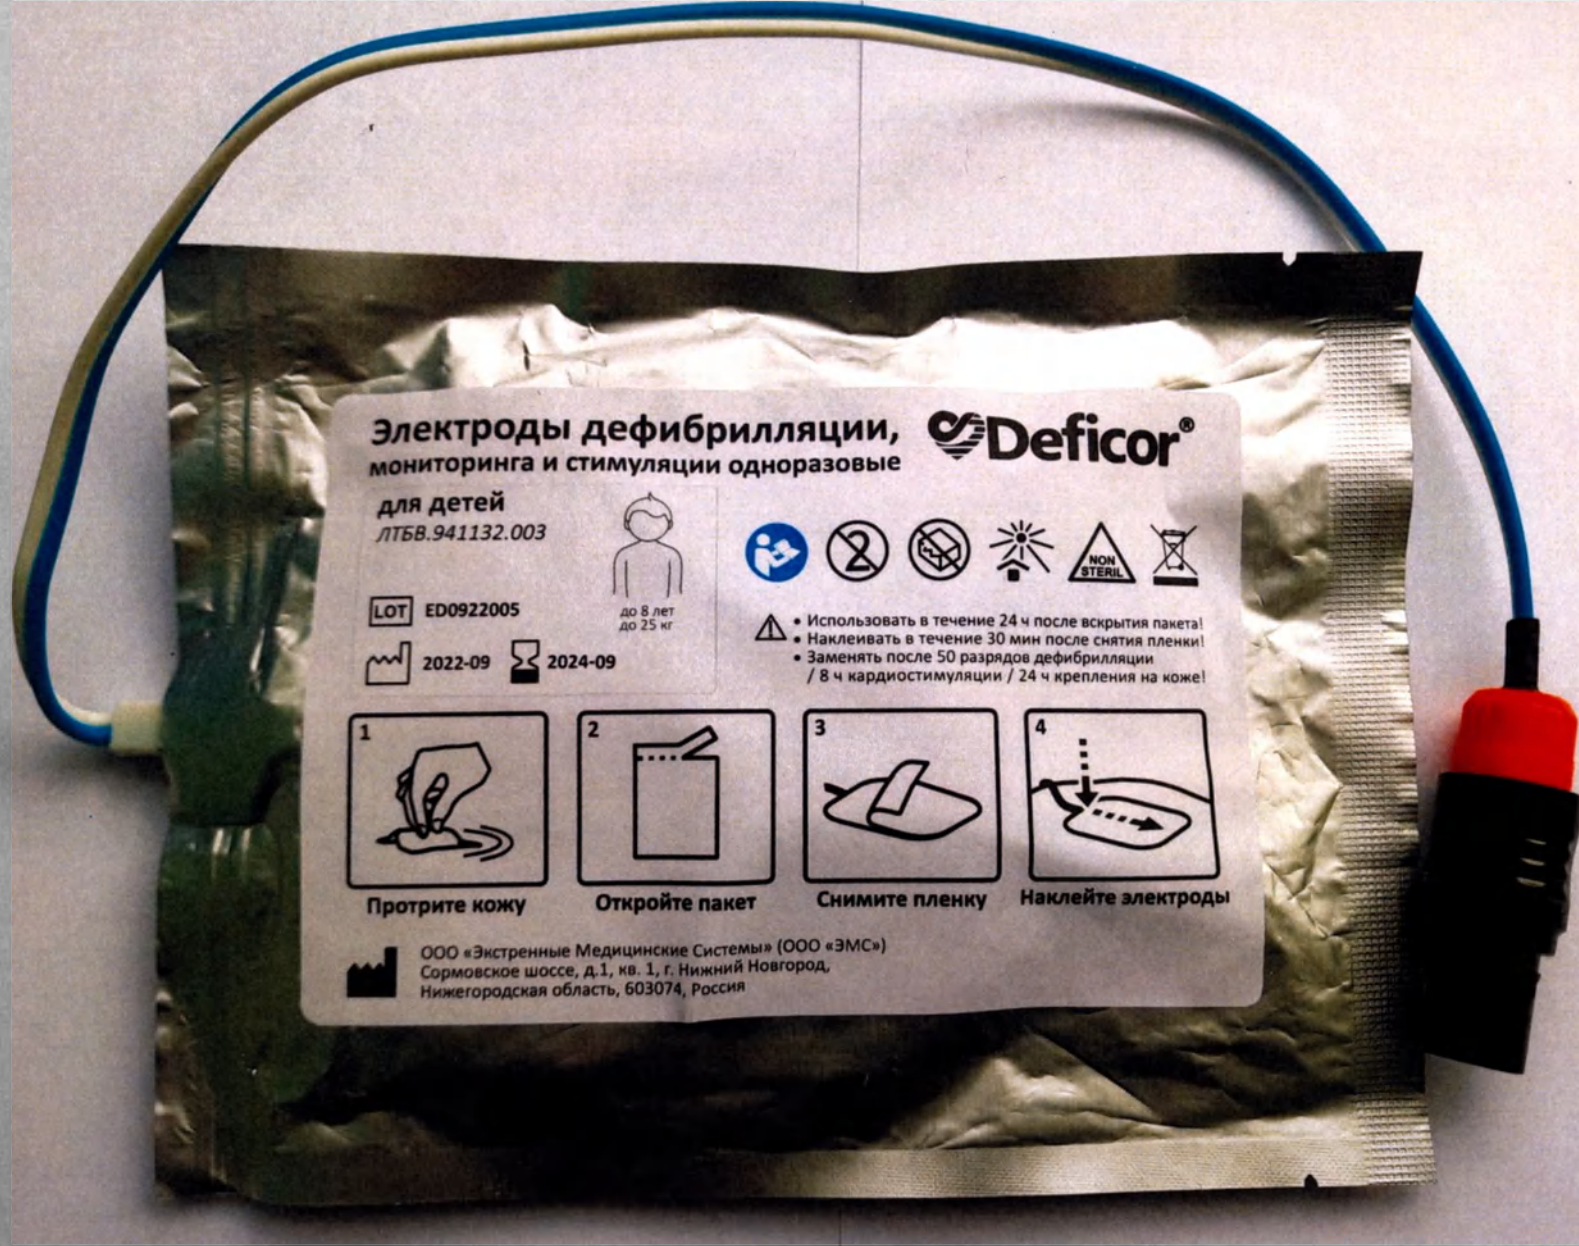


Рисунок 9 — Электроды дефибрилляции, мониторинга и стимуляции одноразовые для детей (ЛТБВ.943.132.003, в упаковке)

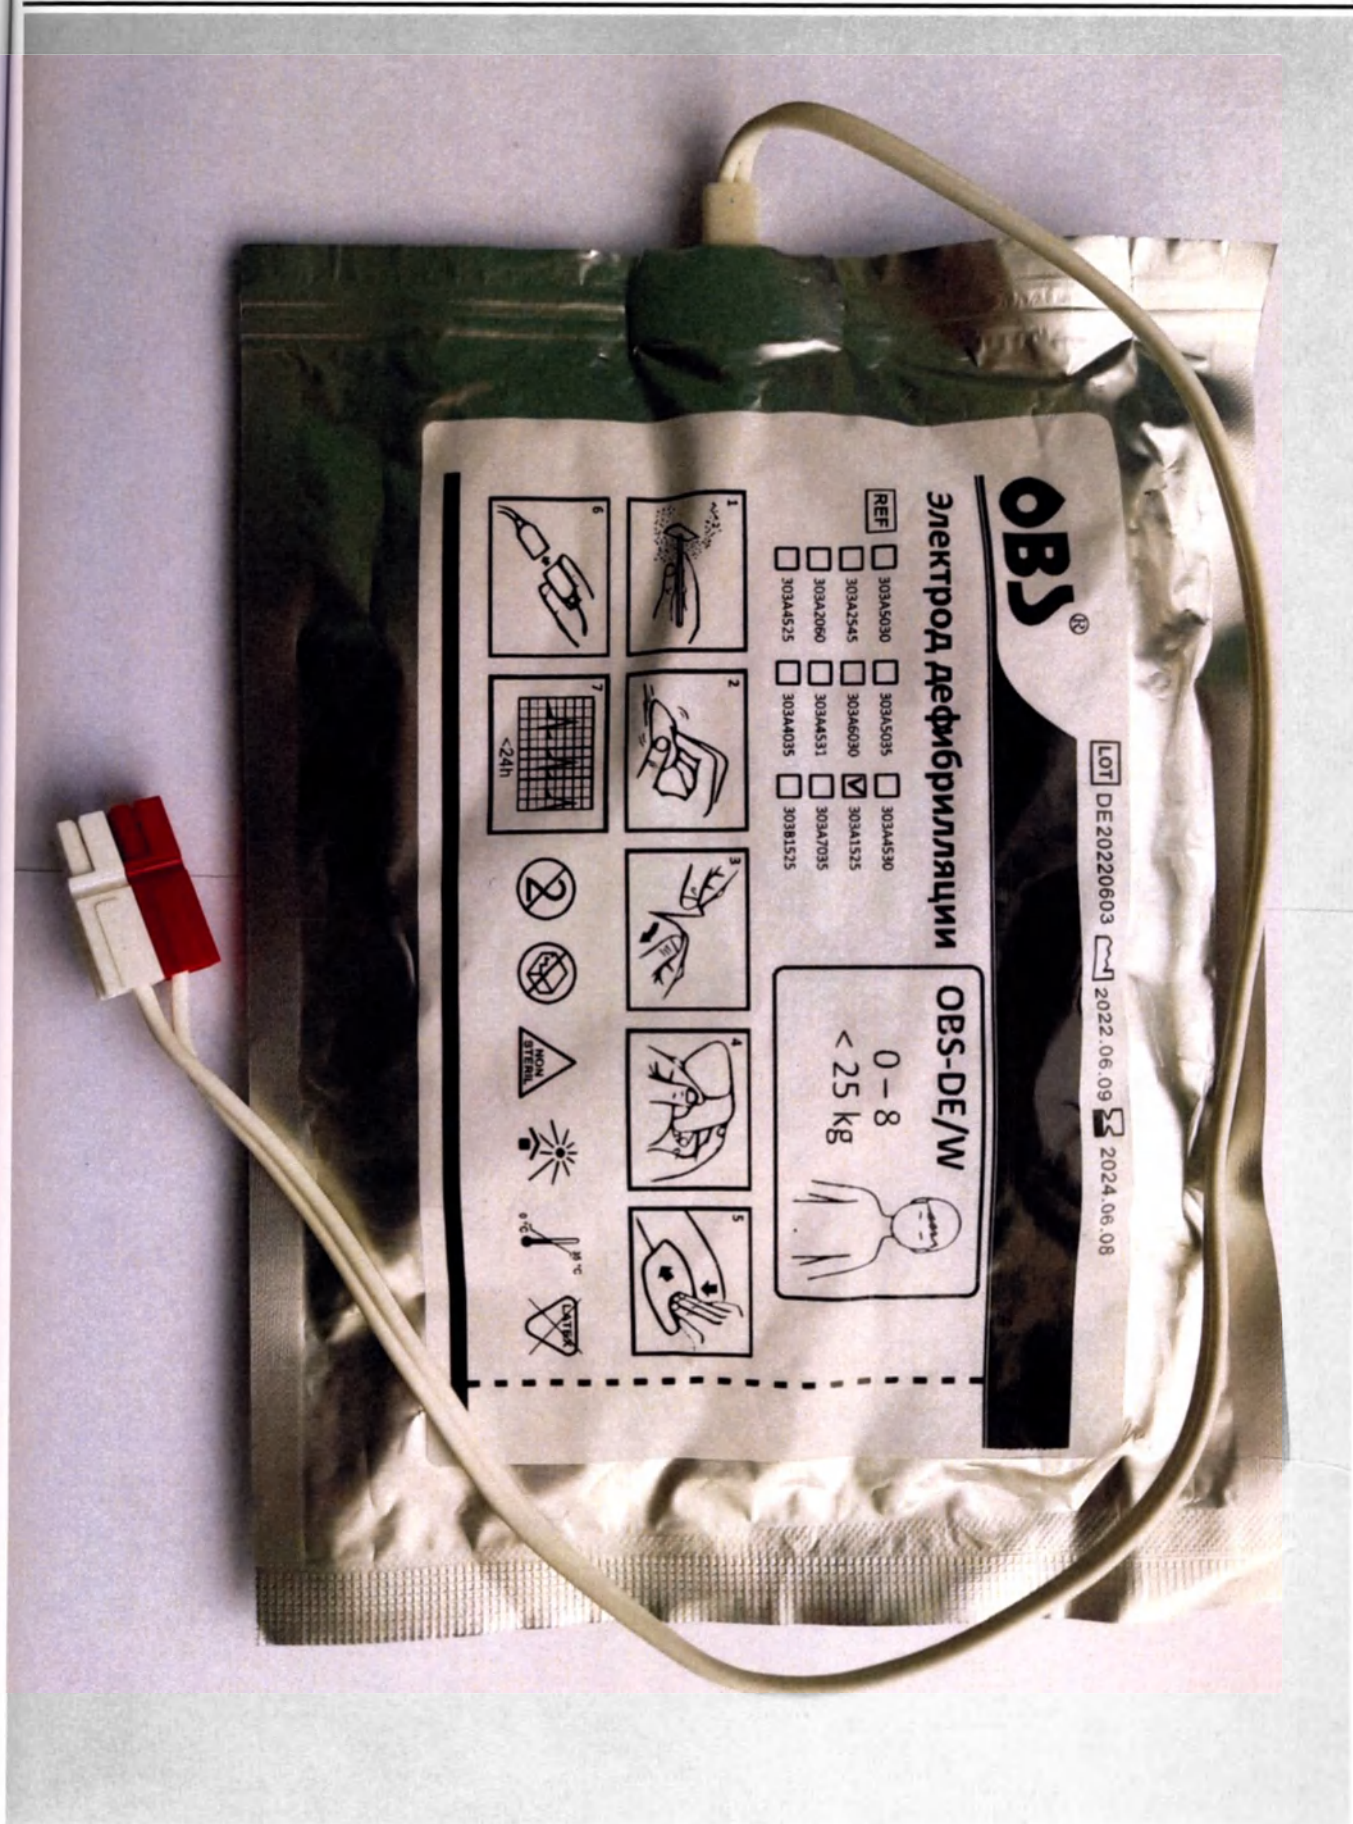


Рисунок 10 — Электрод дефибрилляции OBS-DE/W (303A1525, в упаковке)



Рисунок 11 — Одноразовые многофункциональные электроды для наружной дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, кардиостимуляции и мониторинга ЭКГ Lessa Defi-Pad (99.835.103, в упаковке)



Рисунок 12 — Аккумуляторная батарея (ЛТБВ.943129.001)

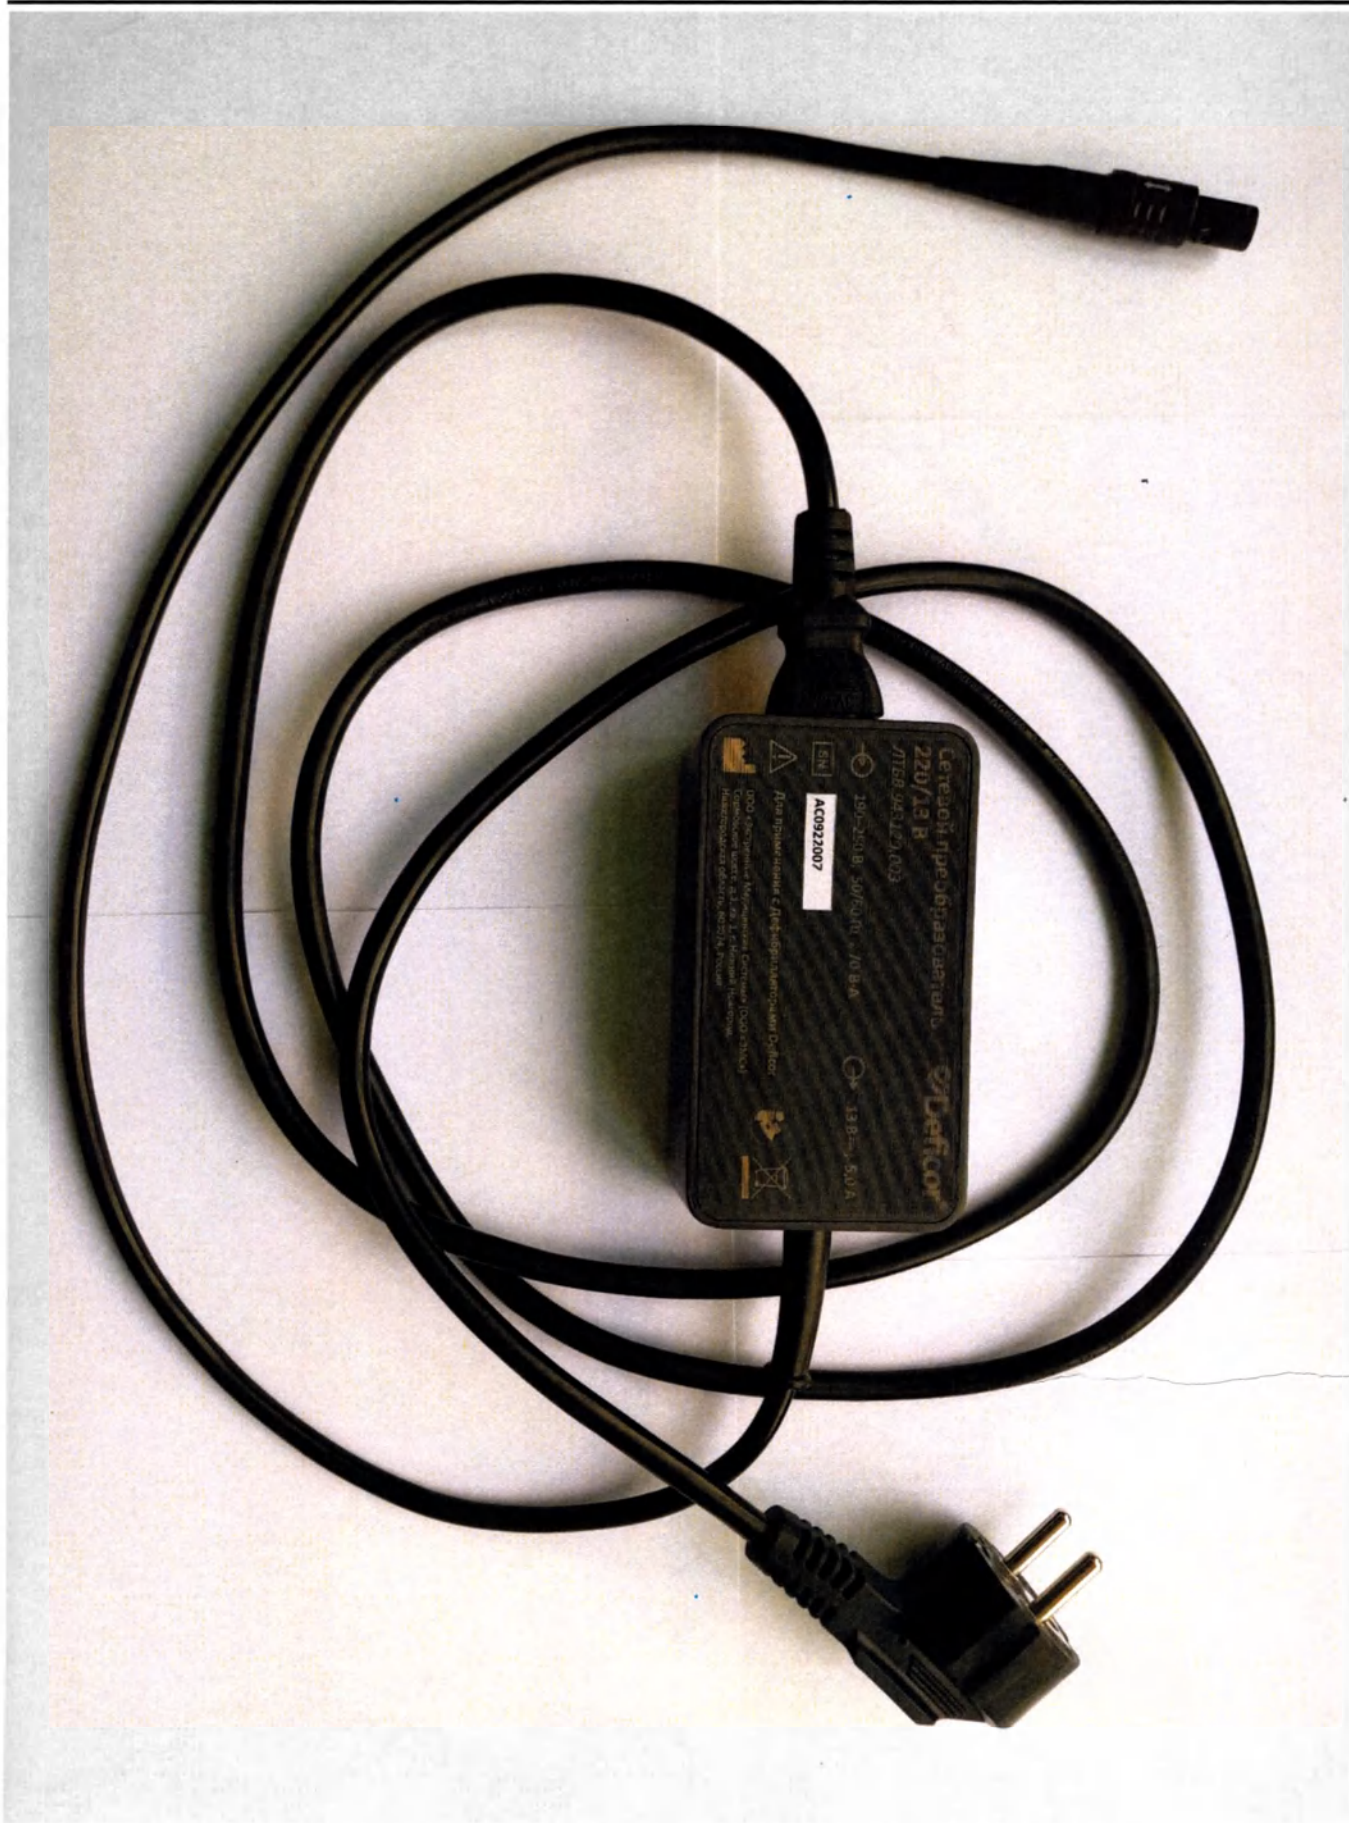


Рисунок 13 — Сетевой преобразователь 220/13 В (ЛТБВ.943129.003)

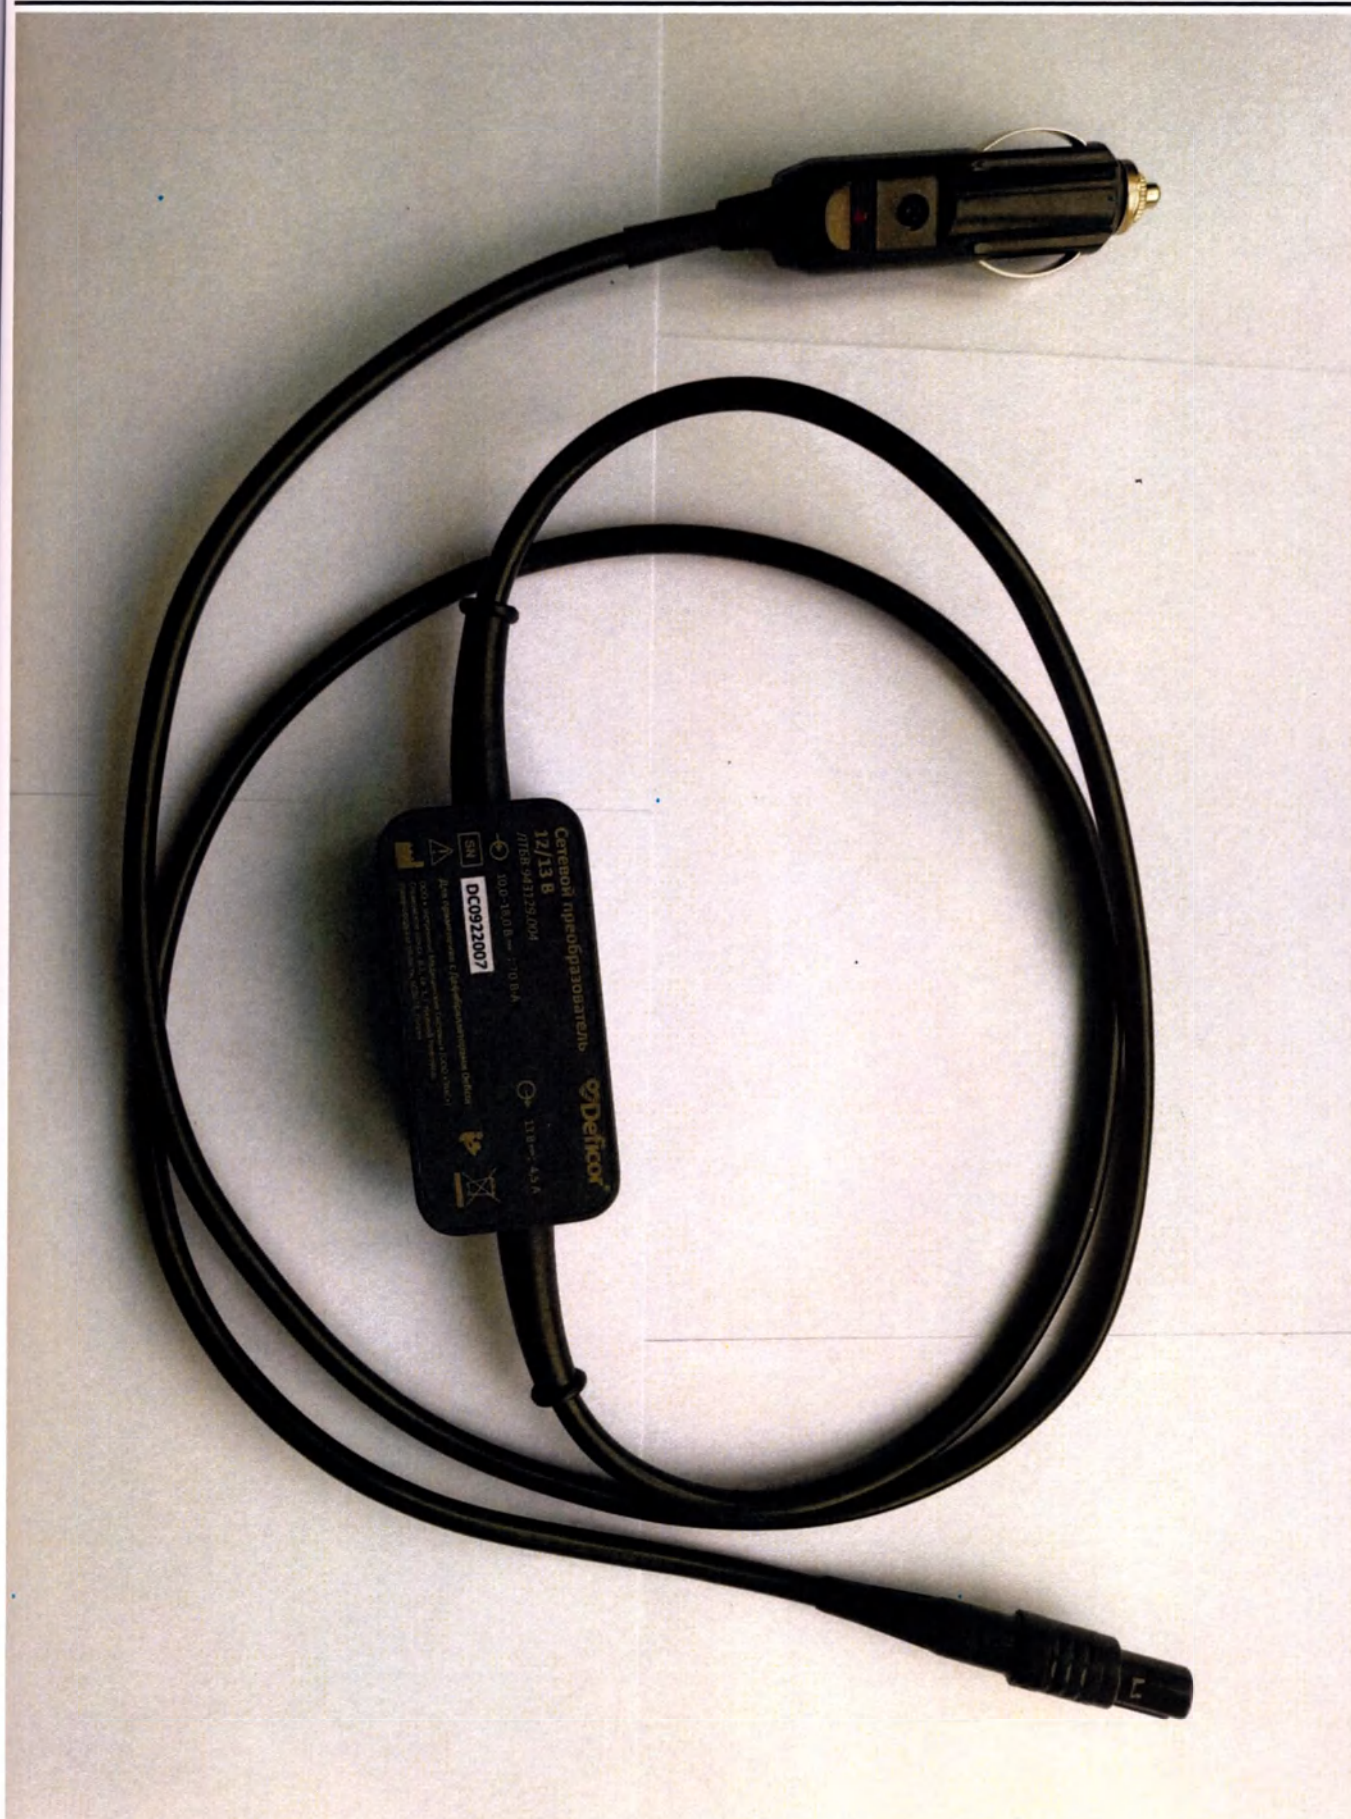


Рисунок 14 — Сетевой преобразователь 12/13 В (ЛТБВ.943129.004)

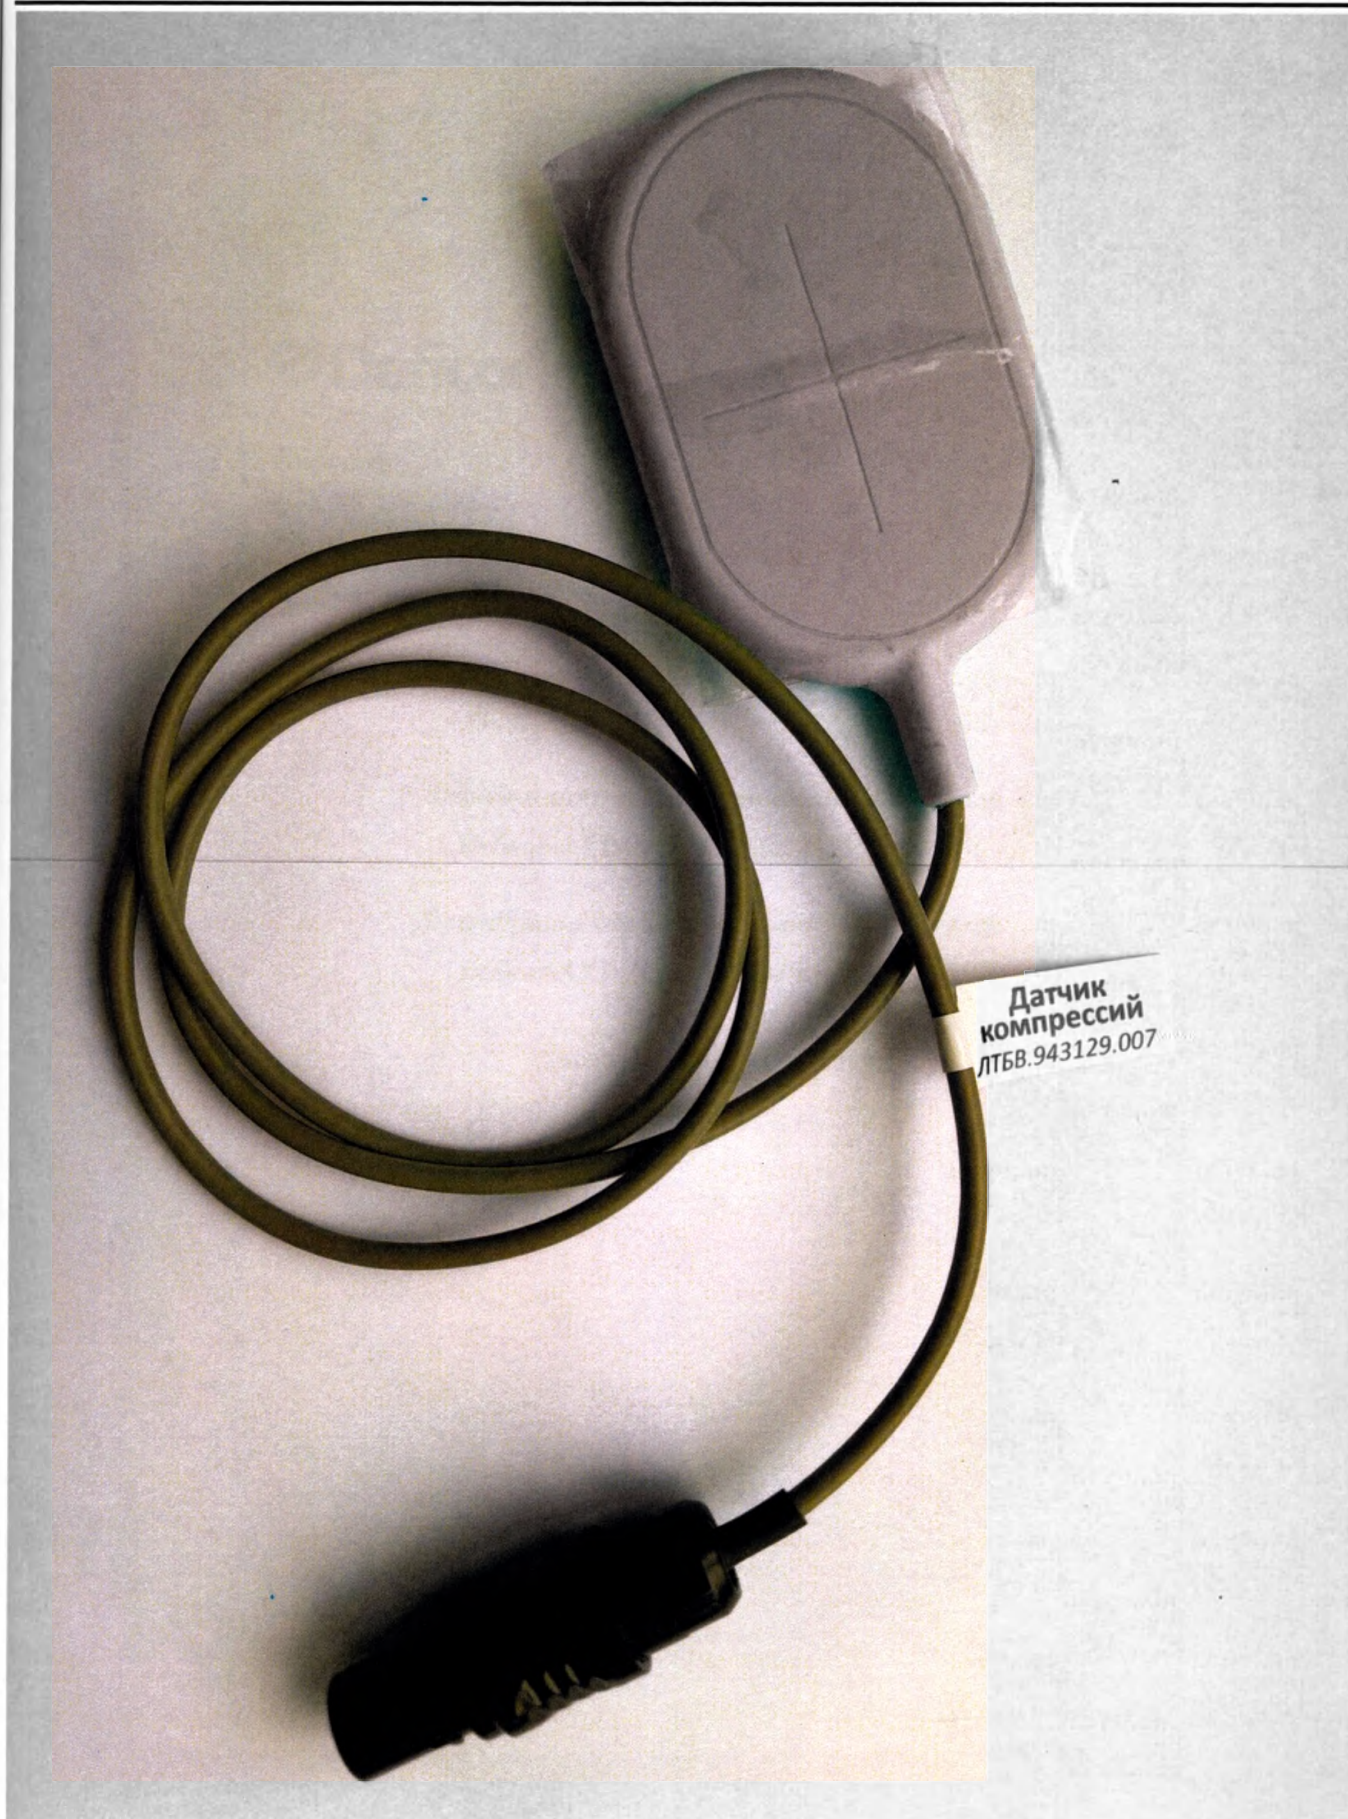


Рисунок 15 — Датчик компрессий (ЛТБВ.943119.007)



УТВЕРЖДЕН
ЛТБВ 941135.001-02 РЭ-ЛУ

Дефибриллятор автоматический наружный
Deficor-AED-A по ЛТБВ.941135.001 ТУ

Дефибриллятор автоматический наружный
Deficor-AED-N по ЛТБВ.941135.001 ТУ

Руководство по эксплуатации

ЛТБВ.941135.001-02 РЭ

Редакция от 01.2024

Рисунок 16 — Руководство по эксплуатации (ЛТБВ.941135.001-02 РЭ)

Принадлежности

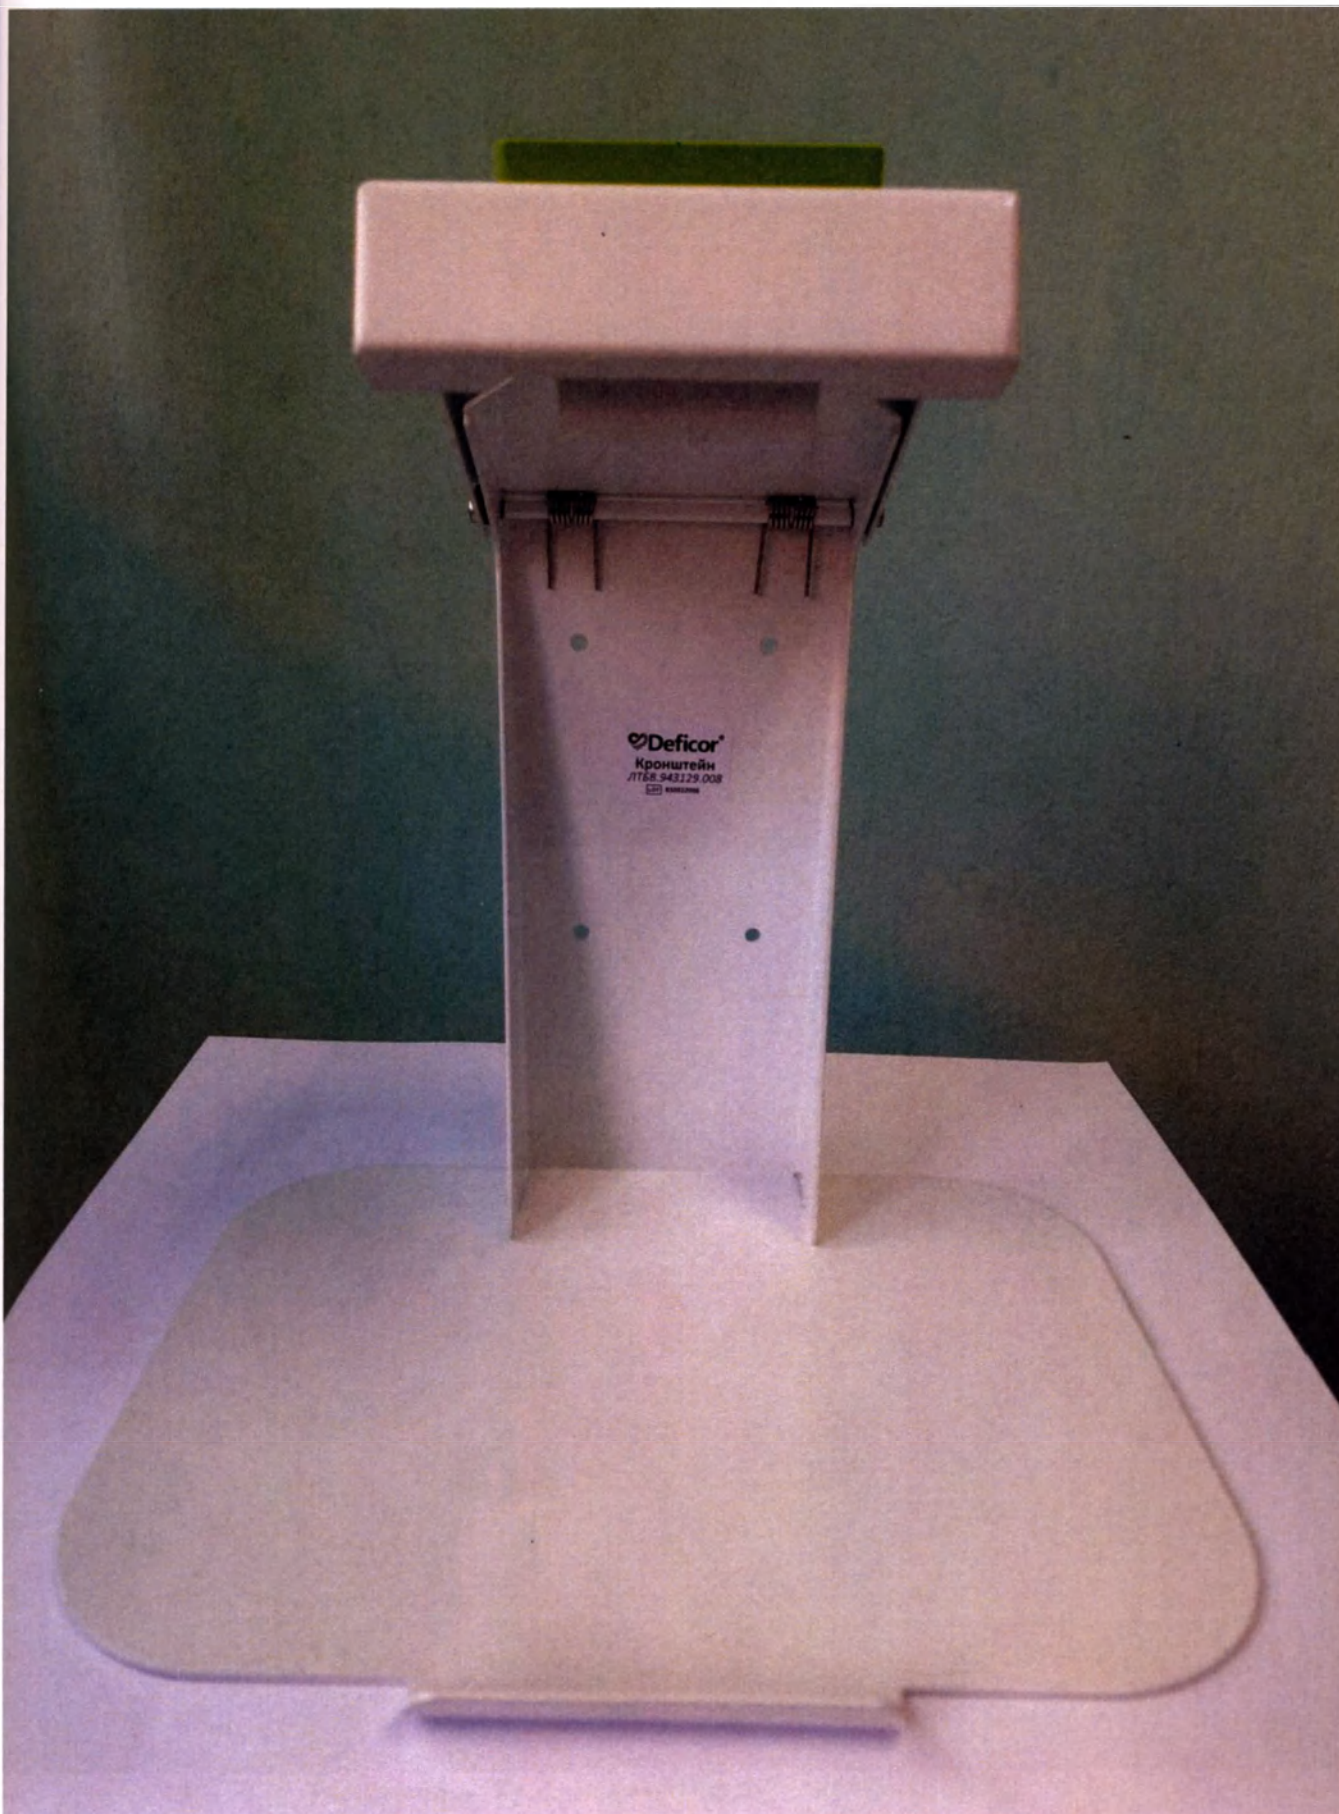


Рисунок 17 — Кронштейн (ЛТБВ.943129.008, вид спереди)



Рисунок 18 — Кронштейн (ЛТБВ.943129.008, вид сбоку)



Рисунок 19 — Ручка для переноски (ЛТБВ.943129.009)

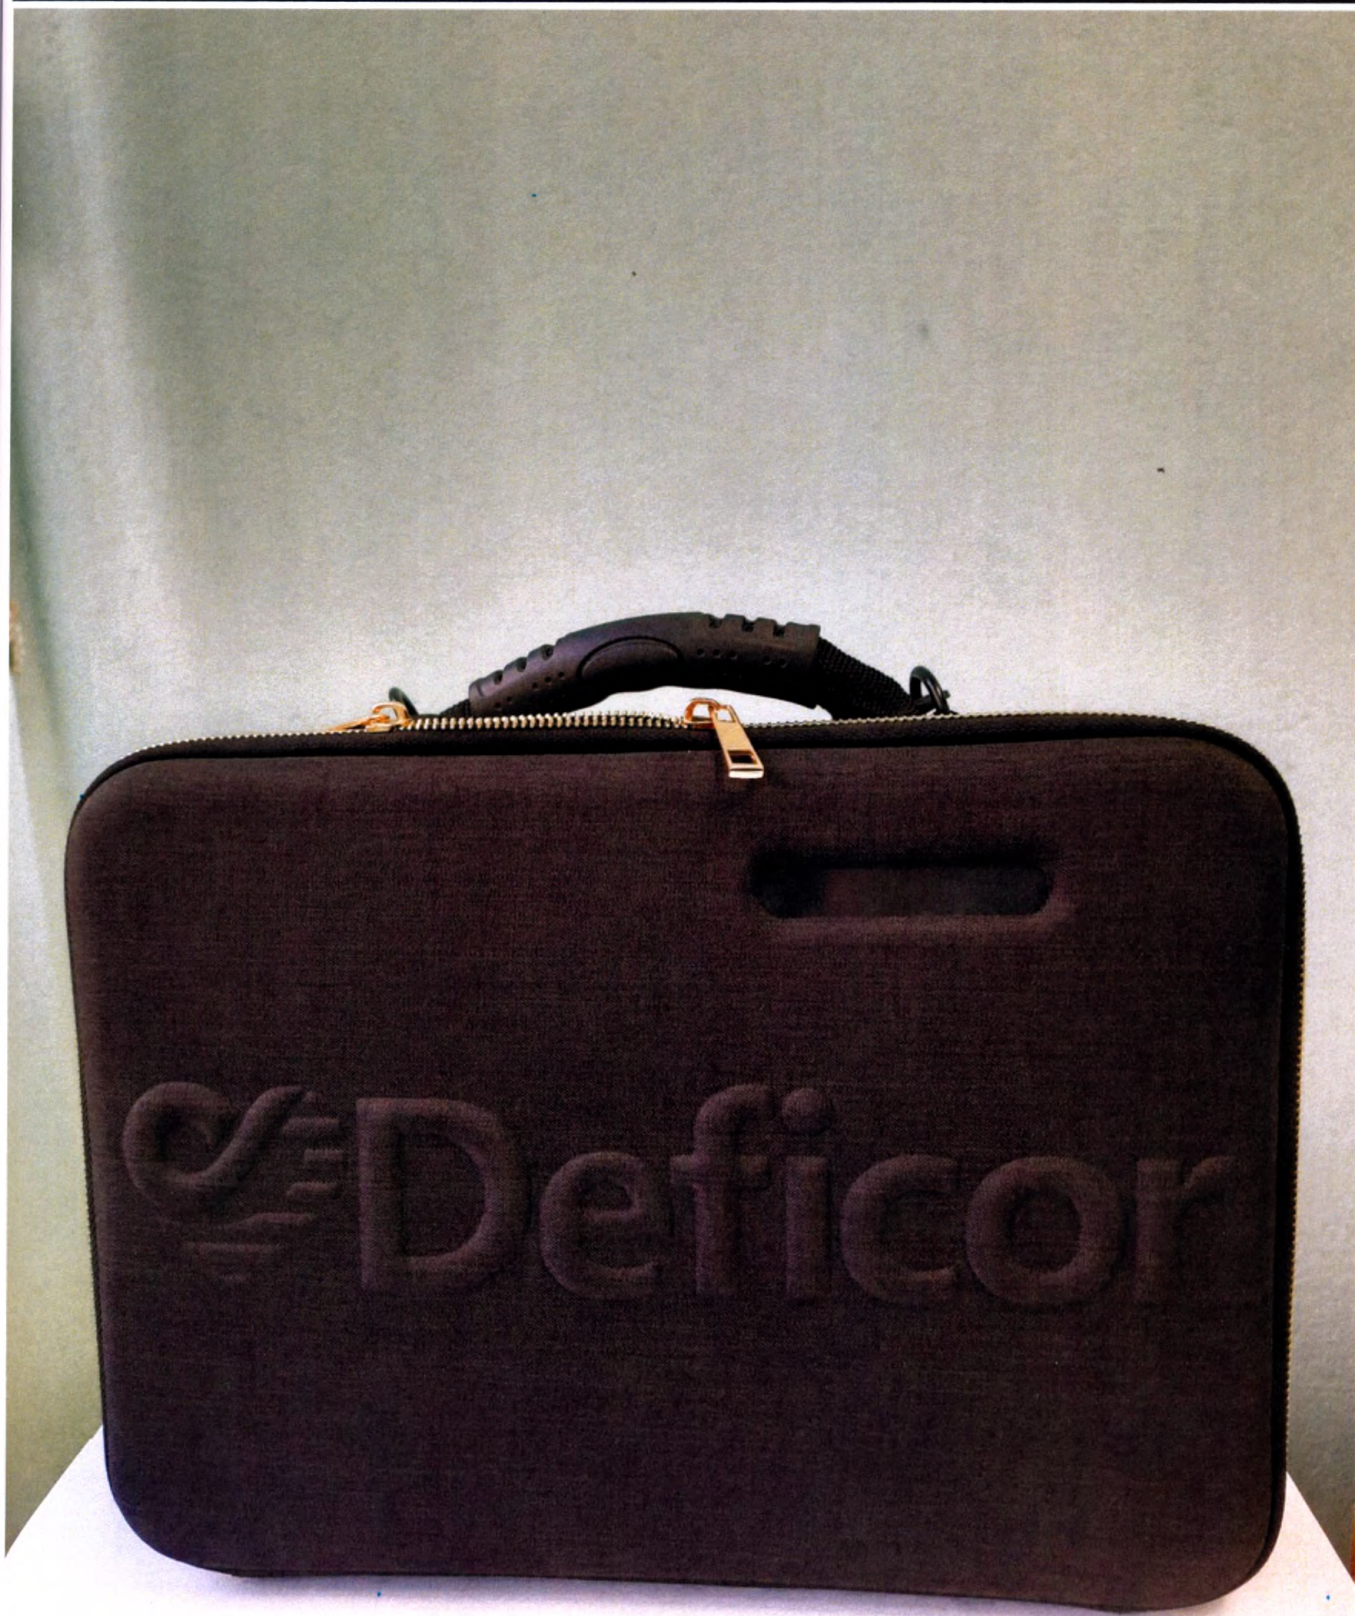


Рисунок 20 — Сумка для переноски (ЛТБВ.943129.010, вид спереди)



Рисунок 21 — Сумка для переноски (ЛТБВ.943129.010, вид сбоку)

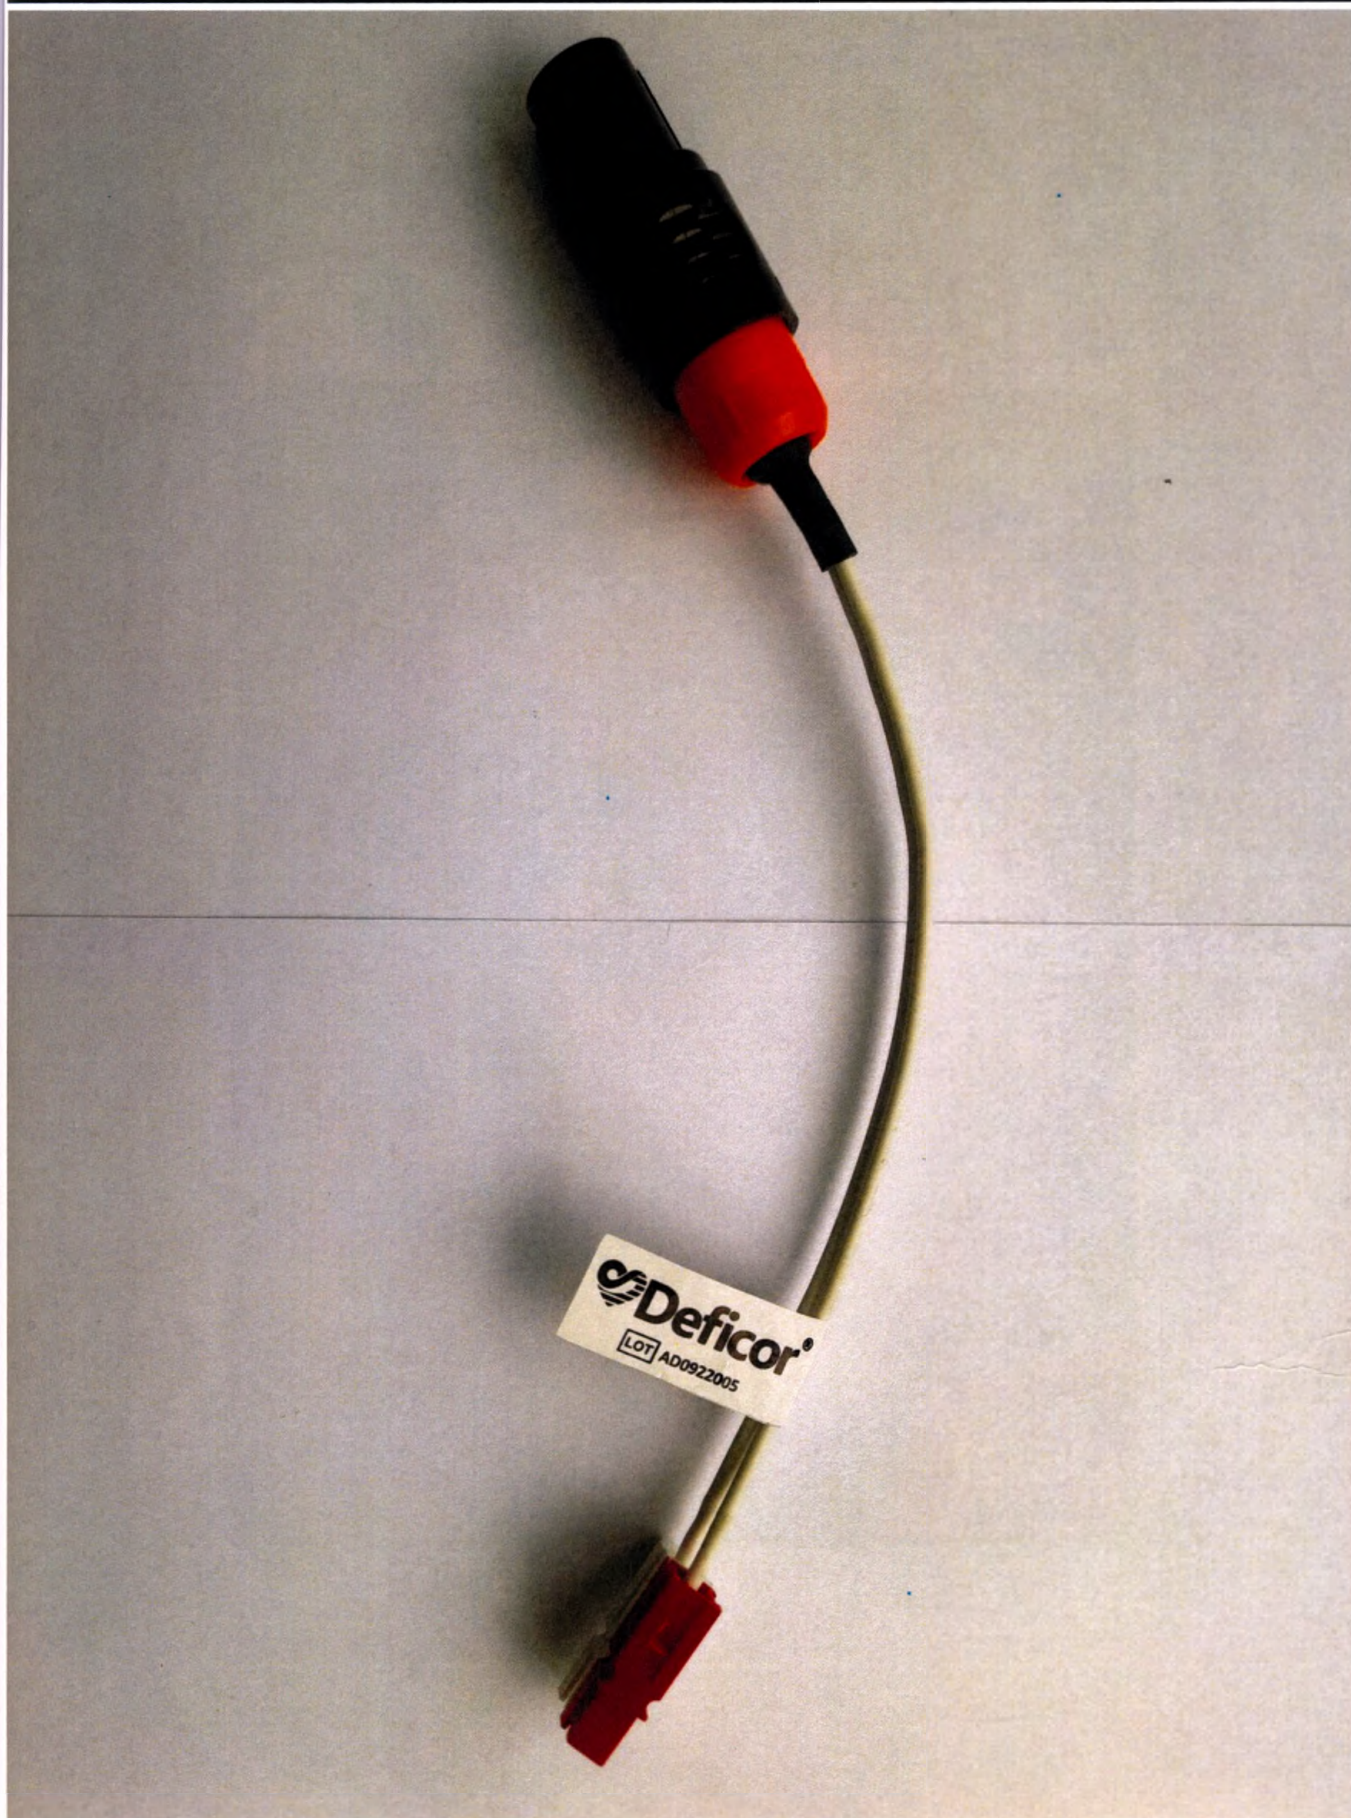


Рисунок 22 — Адаптер для электродов дефибриляции (ЛТБВ.943129.013)



Рисунок 23 — Карта памяти



Рисунок 24 — Кабель USB

Упаковка



Рисунок 25 — Пример первичной упаковки (основной блок изделия в первичной упаковке)



Рисунок 26 — Потребительская тара

Маркировка

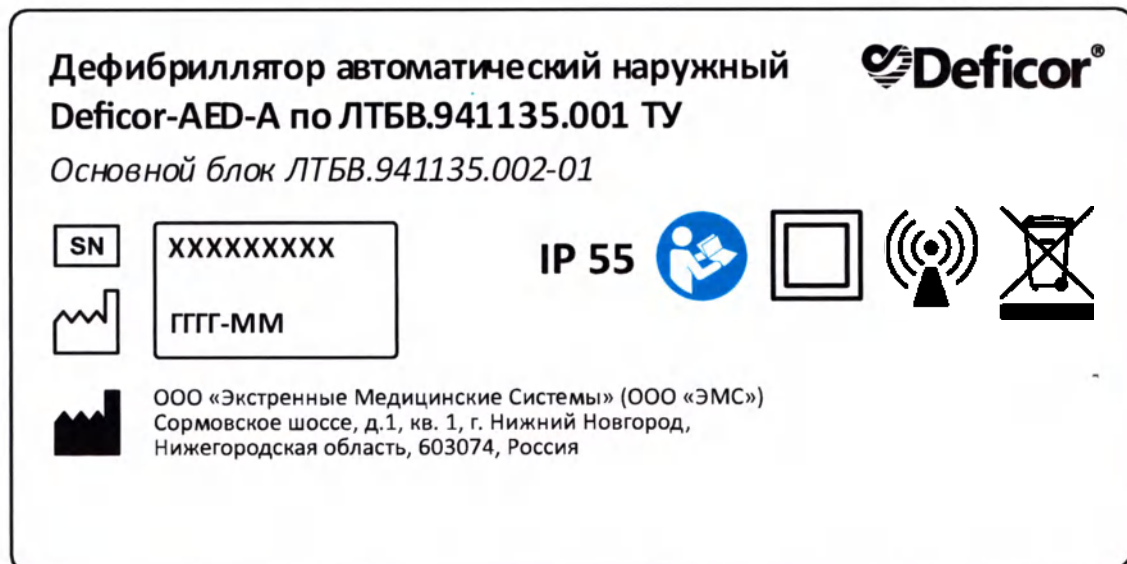


Рисунок 27 — Макет этикетки на задней крышке основного блока (ЛТБВ.941135.002-01)



Рисунок 28 — Макет маркировки электродов дефибрилляции, мониторинга и стимуляции одноразовых для взрослых (ЛТБВ.943.132.002)



Рисунок 29 — Макет маркировки электродов дефибрилляции, мониторинга и стимуляции одноразовых для детей (ЛТБВ.943.132.003)



Рисунок 30 — Макет маркировки аккумуляторной батареи (ЛТБВ.943129.001)

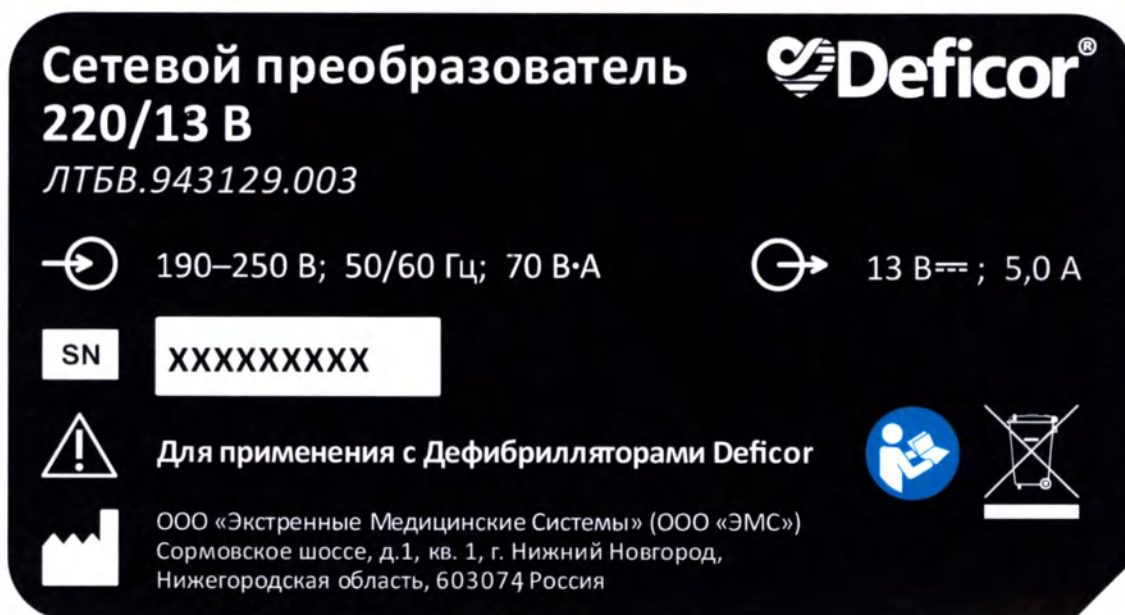


Рисунок 31 — Макет маркировки сетевого преобразователя 220/13 В (ЛТБВ.943129.003)

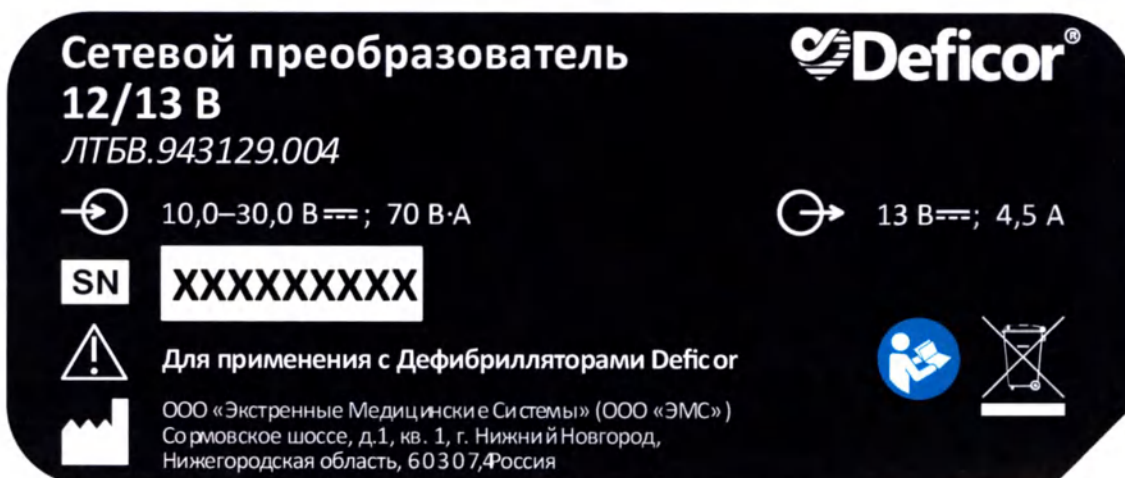


Рисунок 32 — Макет маркировки сетевого преобразователя 12/13 В (ЛТБВ.943129.004)



Рисунок 33 — Макет маркировки датчика компрессий (ЛТБВ.943119.007)



Рисунок 34 — Макет маркировки кронштейна (ЛТБВ.943129.008)



Рисунок 35 — Макет маркировки ручки для переноски (ЛТБВ.943129.009)



Рисунок 36 — Макет маркировки сумки для переноски (ЛТБВ.943129.010)

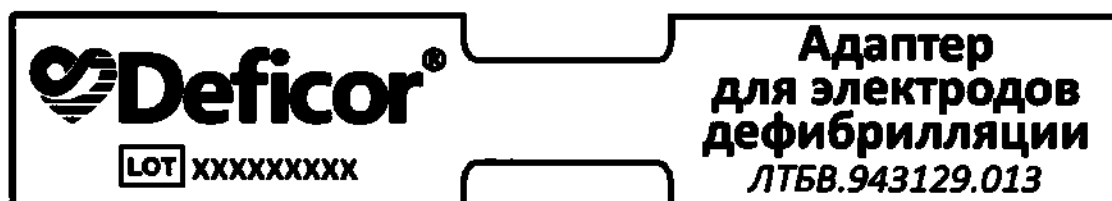


Рисунок 37 — Макет маркировки адаптера для электродов дефибрилляции (ЛТБВ.943129.013)

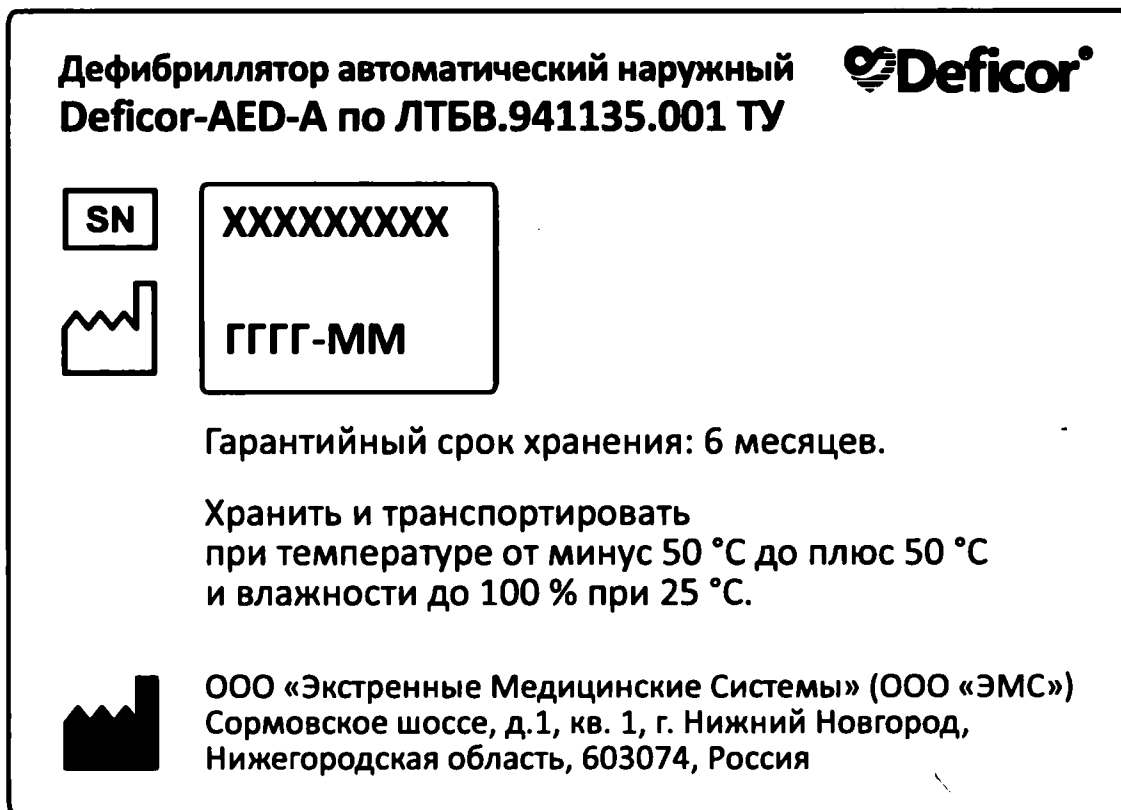


Рисунок 38 — Макет маркировки потребительской тары

