

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МЕДБИОСИСТЕМ»

Миронова Ю. А.

«05» февраля 2024г



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Имплантат интрадермальный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты
NOVACUTAN, в вариантах исполнения

1. Маркировка (стикер) потребительской упаковки

1.1. Имплантат интрадермальный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты

NOVACUTAN Fbio DVS Volume

Имплантат интрадермальный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Volume, в составе:

- шприц 1 мл с гелем – 1 шт.;
- игла 25G x 13 мм (0,5 x 13 мм) – 2 шт.;
- этикетки самоклеящиеся – 2 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гиалуронат натрия 20мг/мл, дивинилсульфон, хлорид натрия, одноосновный дигидрат фосфата натрия, двухосновный дигидрат фосфата натрия, очищенная вода

Назначение: для восполнения утраченных объемов мягких тканей, коррекции овала лица, увлажнения кожи, коррекции дефектов кожи (поверхностных, средне – глубоких и глубоких морщин, складок, шрамов), возникших в процессе старения, в результате травмы или дегенеративных повреждений кожи

Производитель: «ЛАБОРАТУАР ФИЖИ, САС», Франция,
LABORATOIRES FIJIE, SAS, 91 rue de Monceau, 75008 Paris, France

Адрес места производства Био Плюс, Ко., Лтд., Республика Корея,
BioPlus Co., Ltd. A-# 901, # 902, # 903, # 904, # 905, # 906, # 907, 14 Sagimakgol-ro, 45 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of KOREA

Регистрационное удостоверение № **от**

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «МЕДБИОСИСТЕМ,
125315, г. МОСКВА, пр-кт ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 80, К. Г, Э ТЕХ П Х II К 13 ОФ А1А,
8(495)968-75-05, skolkovo_fijie@mail.ru



Апирогенно
Нетоксично

Дата изготовления: XX. XXXX (месяц, год)

1.2. Имплантат интрадермальный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты

NOVACUTAN Fbio DVS Medium

Имплантат интрадермальный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Medium, в составе:

- шприц 1 мл с гелем – 1 шт.;
- игла 27G x 13 мм (0,4 x 13 мм) – 2 шт.;
- этикетки самоклеящиеся – 2 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гиалуронат натрия 20мг/мл, дивинилсульфон, хлорид натрия, одноосновный дигидрат фосфата натрия, двухосновный дигидрат фосфата натрия, очищенная вода

Назначение: для восполнения утраченных объемов мягких тканей, коррекции овала лица, увлажнения кожи, коррекции дефектов кожи (поверхностных, средне – глубоких и глубоких морщин, складок, шрамов), возникших в процессе старения, в результате травмы или дегенеративных повреждений кожи

Производитель: «ЛАБОРАТУАР ФИЖИ, САС», Франция,
LABORATOIRES FIJIE, SAS, 91 rue de Monceau, 75008 Paris, France

Адрес места производства Био Плюс, Ко., Лтд., Республика Корея,
BioPlus Co., Ltd. A-# 901, # 902, # 903, # 904, # 905, # 906, # 907, 14 Sagimakgol-ro, 45 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of KOREA

Регистрационное удостоверение № **от**

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «МЕДБИОСИСТЕМ,
125315, г. МОСКВА, пр-кт ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 80, К. Г, Э ТЕХ П XII К 13 ОФ А1А,
8(495)968-75-05, skolkovo_fijie@mail.ru



Апирогенно
Нетоксично

Дата изготовления: XX. XXXX (месяц, год)

1.3. Имплантат интрадермальный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты
NOVACUTAN Fbio DVS Light

Имплантат интрадермальный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Light, в составе:

- шприц 1 мл с гелем – 1 шт.;
- игла 30G x 13 мм (0,3 x 13 мм) – 2 шт.;
- этикетки самоклеящиеся – 2 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гиалуронат натрия 20мг/мл, дивинилсульфон, хлорид натрия, одноосновный дигидрат фосфата натрия, двухосновный дигидрат фосфата натрия, очищенная вода

Назначение: для восполнения утраченных объемов мягких тканей, коррекции овала лица, увлажнения кожи, коррекции дефектов кожи (поверхностных, средне – глубоких и глубоких морщин, складок, шрамов), возникших в процессе старения, в результате травмы или дегенеративных повреждений кожи

Производитель: «ЛАБОРАТУАР ФИЖИ, САС», Франция,
LABORATOIRES FIJIE, SAS, 91 rue de Monceau, 75008 Paris, France

Адрес места производства Био Плюс, Ко., Лтд., Республика Корея,
BioPlus Co., Ltd. A-# 901, # 902, # 903, # 904, # 905, # 906, # 907, 14 Sagimakgol-ro, 45 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of KOREA

Регистрационное удостоверение № **от**

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «МЕДБИОСИСТЕМ,
125315, г. МОСКВА, пр-кт ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 80, К. Г, Э ТЕХ П XII К 13 ОФ А1А,
8(495)968-75-05, skolkovo_fijie@mail.ru



Апирогенно
Нетоксично

Дата изготовления: XX. XXXX (месяц, год)

**1.4. Имплантат интрадермальный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты
NOVACUTAN BioPRO**

Имплантат интрадермальный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN BioPRO, в составе:

- шприц 3 мл с гелем 2 мл – 1 шт.;
- игла 31G x 6 мм (0,25 x 6 мм) – 2 шт.;
- этикетки самоклеящиеся – 2 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.

Состав: гиалуронат натрия 20мг/мл, дивинилсульфон, хлорид натрия, одноосновный дигидрат фосфата натрия, двухосновный дигидрат фосфата натрия, очищенная вода

Назначение: для восполнения утраченных объемов мягких тканей, коррекции овала лица, увлажнения кожи, коррекции дефектов кожи (поверхностных, средне – глубоких и глубоких морщин, складок, шрамов), возникших в процессе старения, в результате травмы или дегенеративных повреждений кожи

Производитель: «ЛАБОРАТУАР ФИЖИ, САС», Франция,
LABORATOIRES FIJIE, SAS, 91 rue de Monceau, 75008 Paris, France

Адрес места производства Био Плюс, Ко., Лтд., Республика Корея,
BioPlus Co., Ltd. A-# 901, # 902, # 903, # 904, # 905, # 906, # 907, 14 Sagimakgol-ro, 45 beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of KOREA

Регистрационное удостоверение № **от**

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «МЕДБИОСИСТЕМ,
125315, г. МОСКВА, пр-кт ЛЕНИНГРАДСКИЙ, Д. 80, К. Г, Э ТЕХ П XII К 13 ОФ А1А,
8(495)968-75-05, skolkovo_fijie@mail.ru





Апирогенно
Нетоксично

Дата изготовления: XX. XXXX (месяц, год)

2. Маркировка транспортной упаковки

2.1. Пример макета маркировки транспортной упаковки для имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Volume

NOVACUTAN Fbio DVS Volume		
		
	ЛАБОРАТУАР ФИЖИ, САС, Франция / LABORATOIRES FIJIE, SAS, France	
Количество, шт. –	Грузополучатель ООО "МЕДБИОСИСТЕМ", Россия, Москва	
   		

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 листа (-ов)



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "МЕДБИОСИСТЕМ"

Миронова Ю. А.

2023 г.



**Имплантат интрадермальный на основе стабилизированной
гиалуроновой кислоты NOVACUTAN, в вариантах исполнения
производства LABORATOIRES FIJIE, SAS (ЛАБОРАТУАР ФИЖИ,
САС)**

Фотографические изображения


1. Имплантат интрадермальный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Volume
- 1.1. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Volume, вид спереди



1.2. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Volume, вид сзади




1.3. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Volume, вид слева

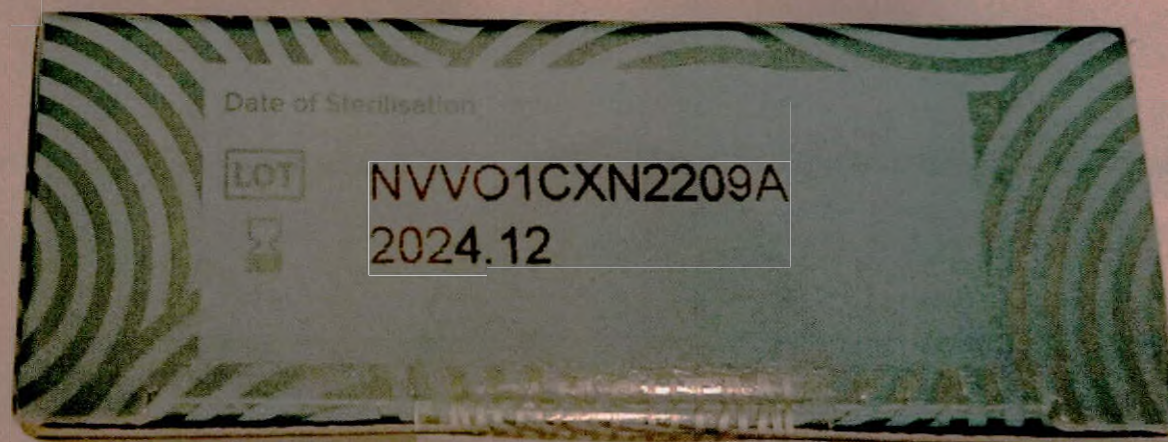

1.4. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Volume, вид справа




1.5. Индивидуальная упаковка – блистер имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Volume

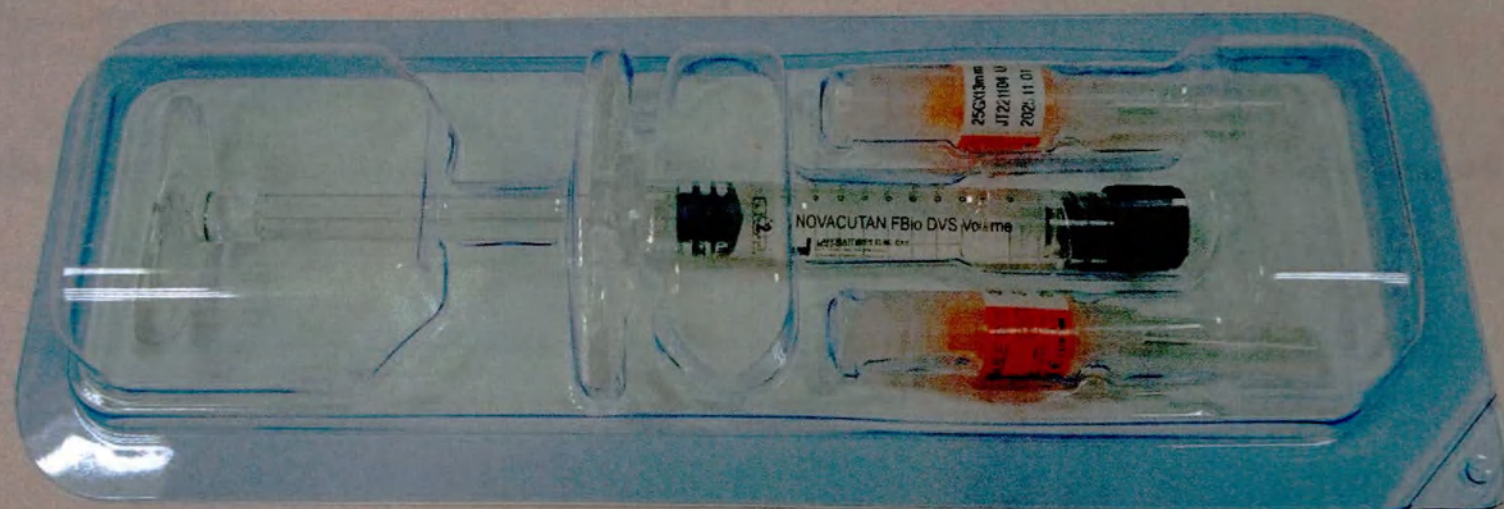


1.6. Маркировка блистера имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Volume



1.7. Этикетки самоклеящиеся имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Volume

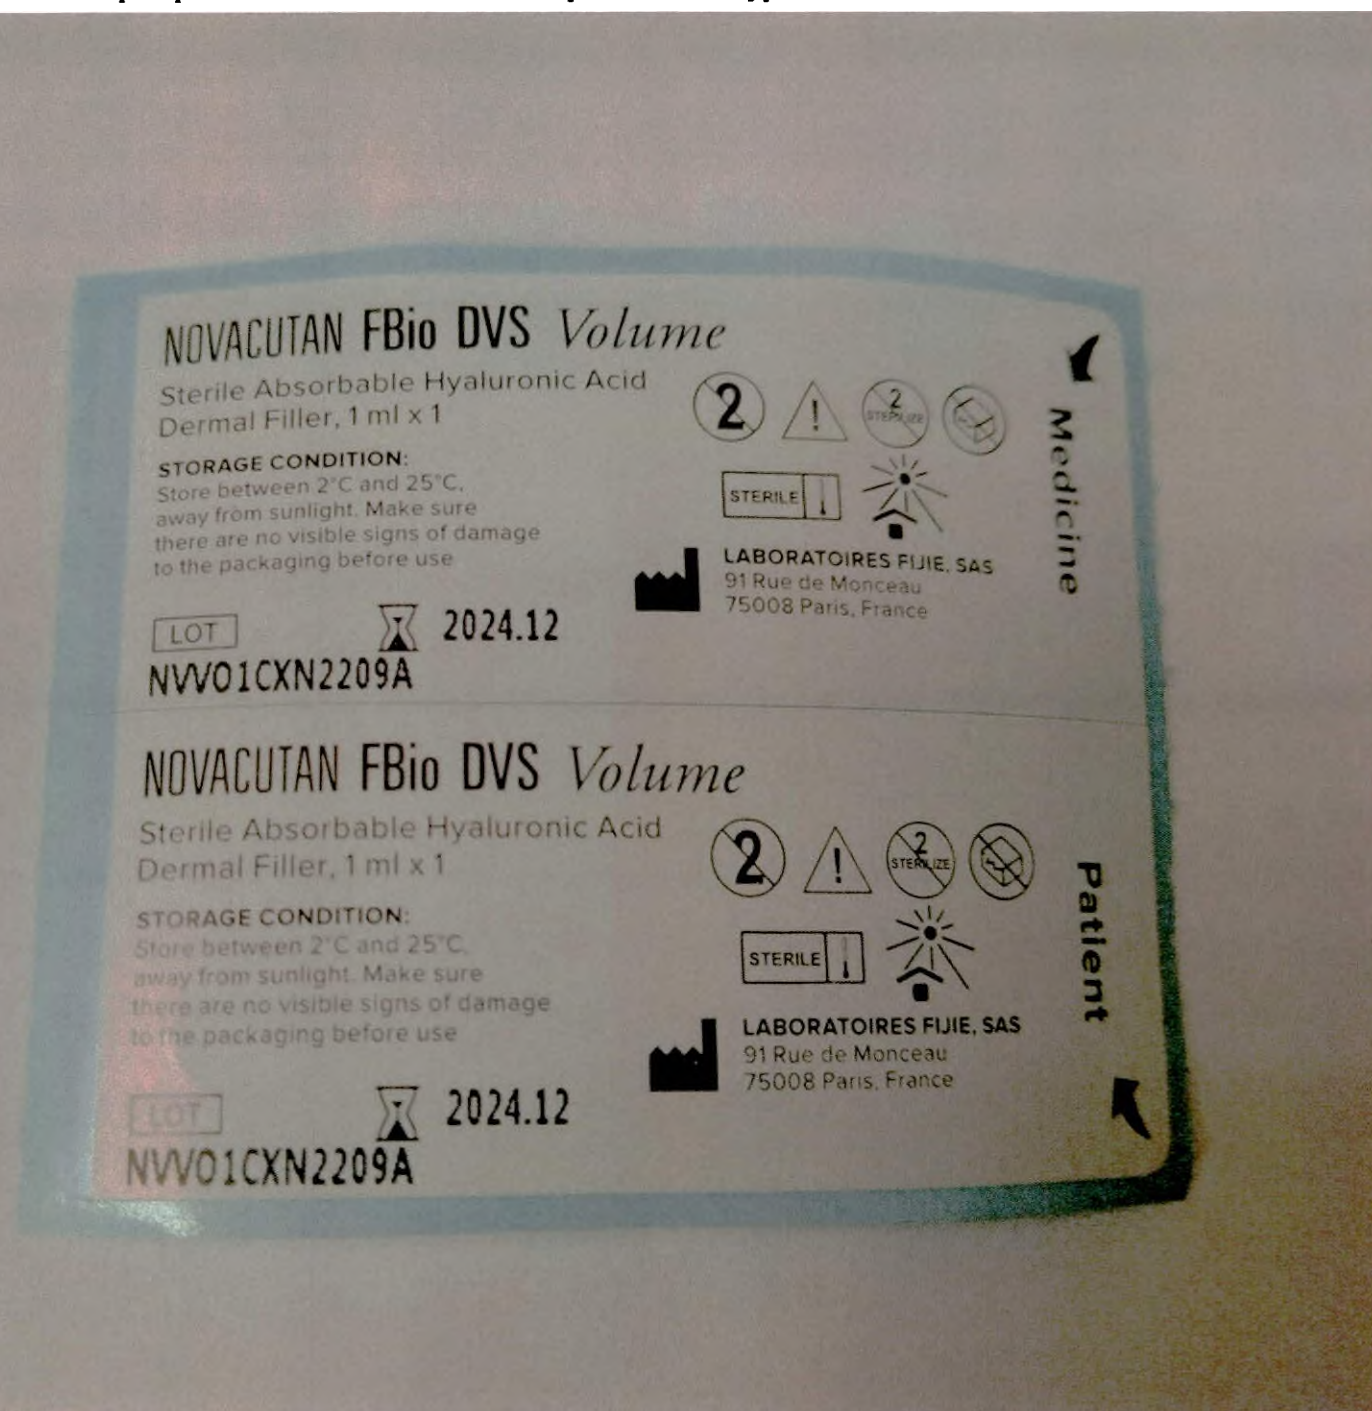

1.8. Шприц 1 мл с гелем, без индивидуальной упаковки - блистера

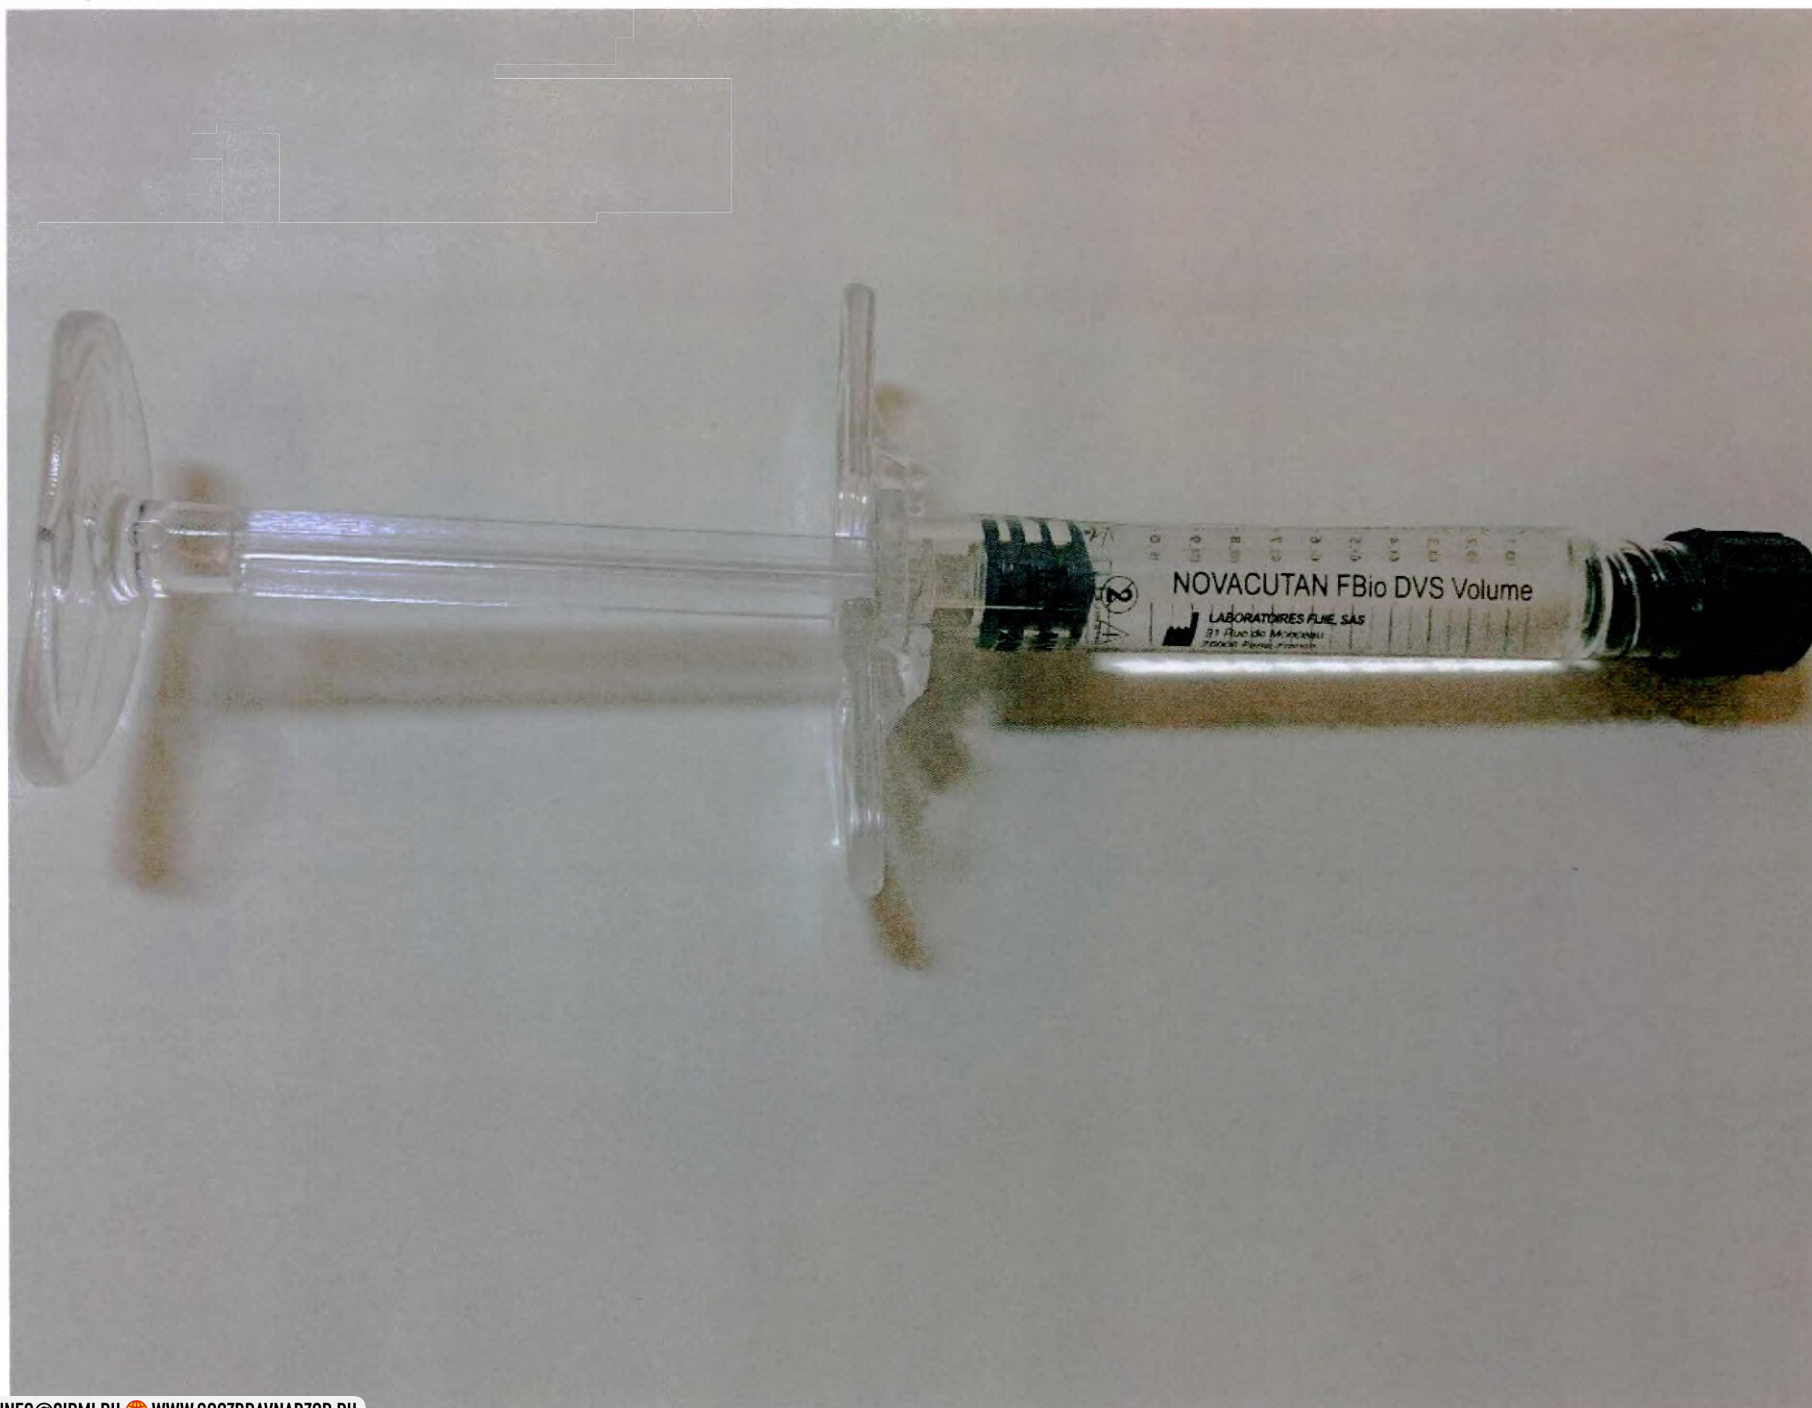

1.9. Игла 25G x 13 мм (0,5 x 13 мм) без индивидуальной упаковки - блистера, в защитном колпачке



1.10. Игла 25G x 13 мм (0,5 x 13 мм) без индивидуальной упаковки - блистера, без защитного колпачка




2. Имплантат интрадермальный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Medium
- 2.1. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Medium, вид спереди



2.2. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Medium, вид сзади




2.3. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Medium, вид слева

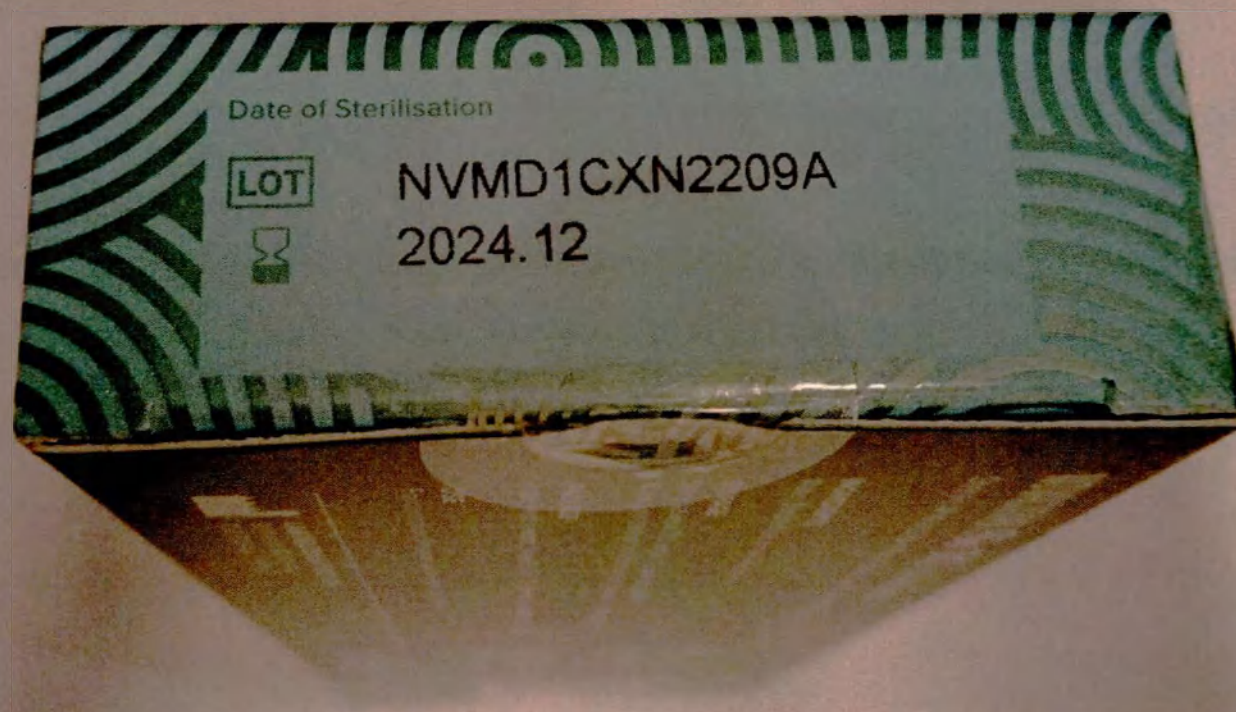

2.4. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Medium, вид справа



2.5. Индивидуальная упаковка – блистер имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Medium

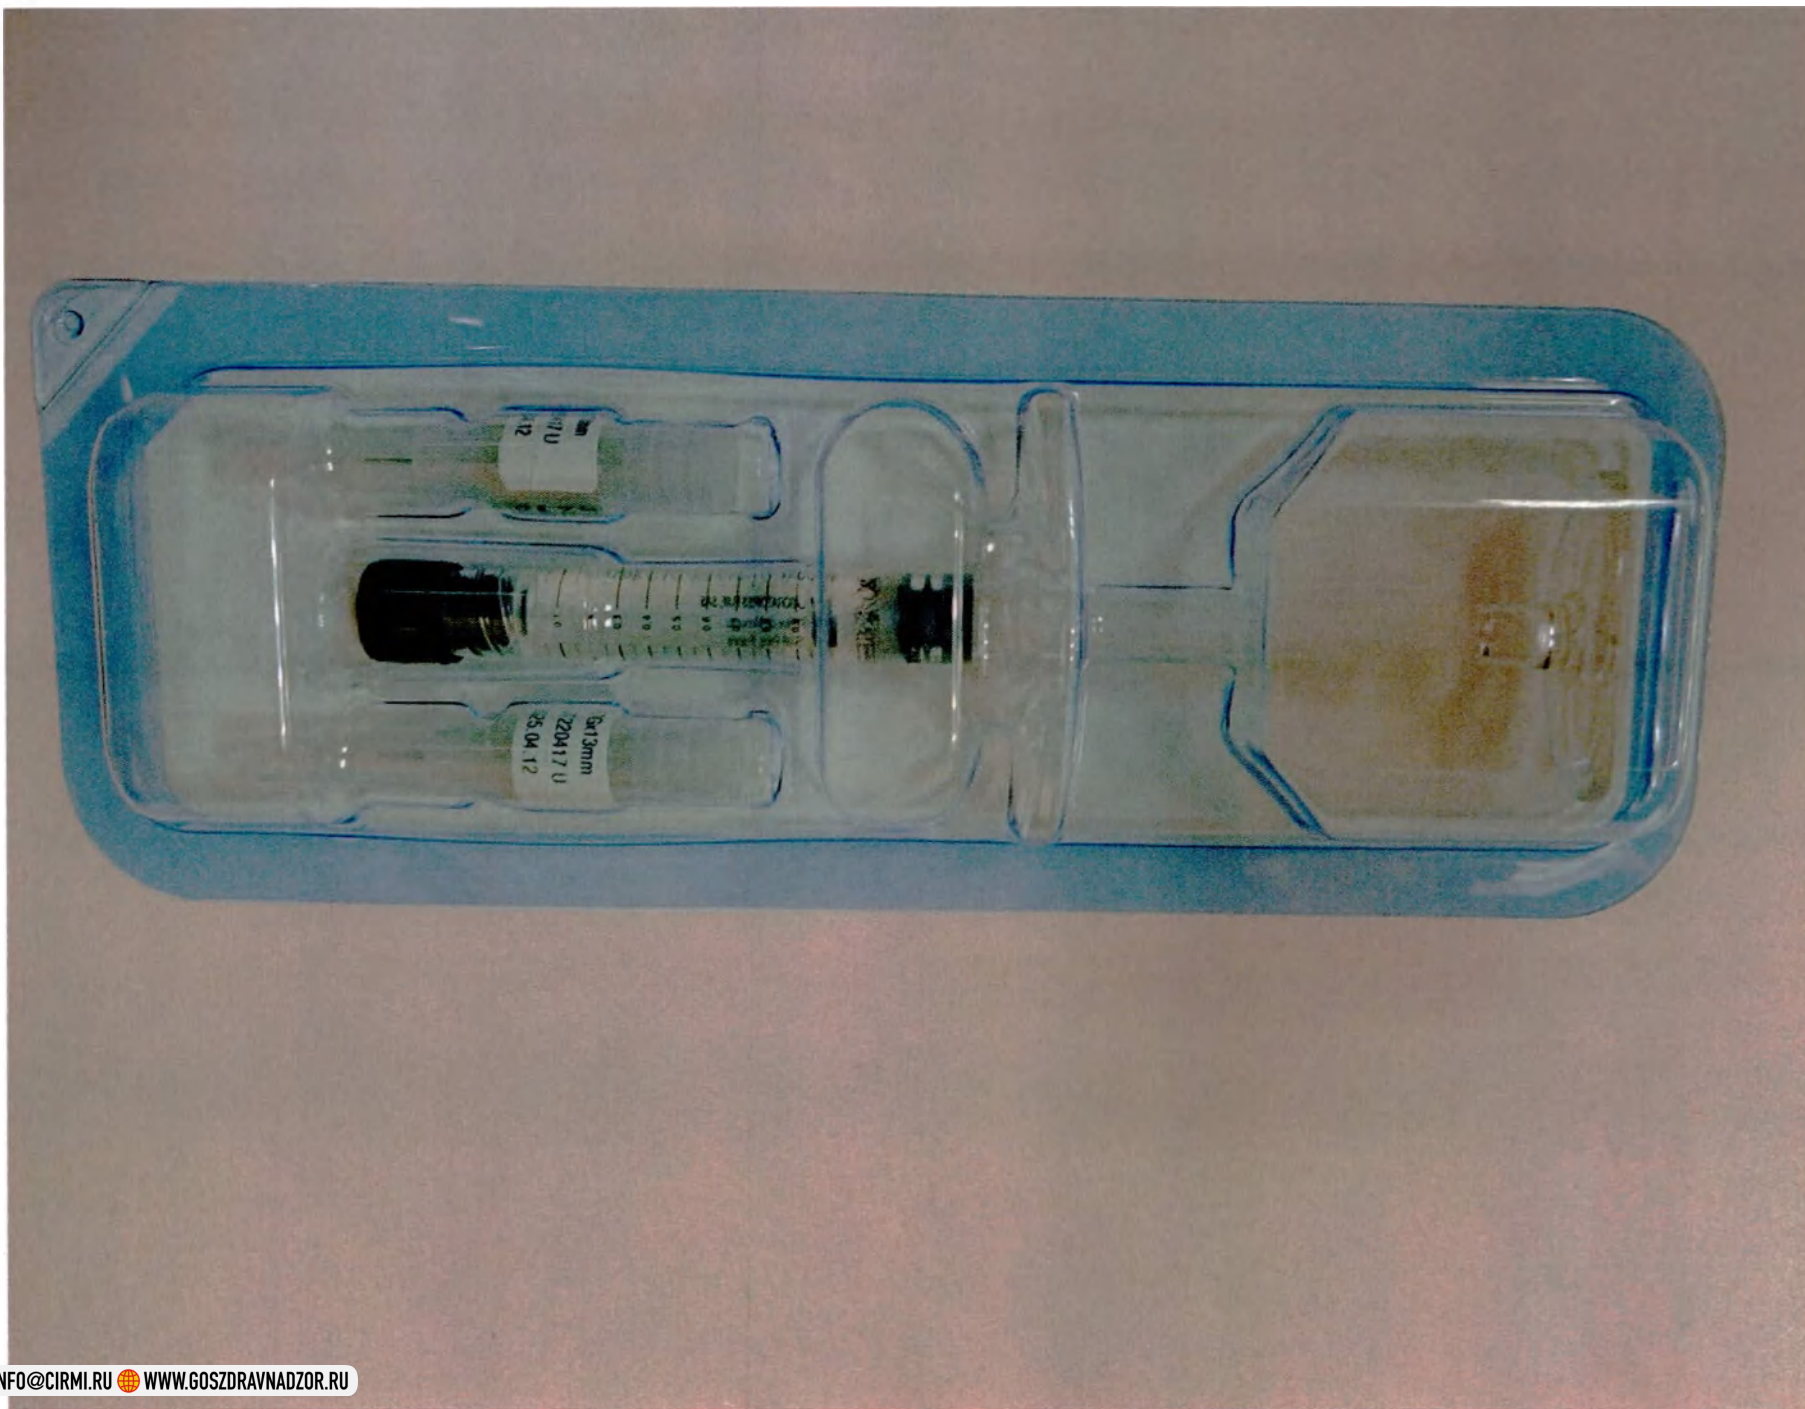


2.6. Маркировка блистера имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Medium



2.7. Этикетки самоклеящиеся имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Medium



2.8. Шприц 1 мл с гелем без индивидуальной упаковки - блистера

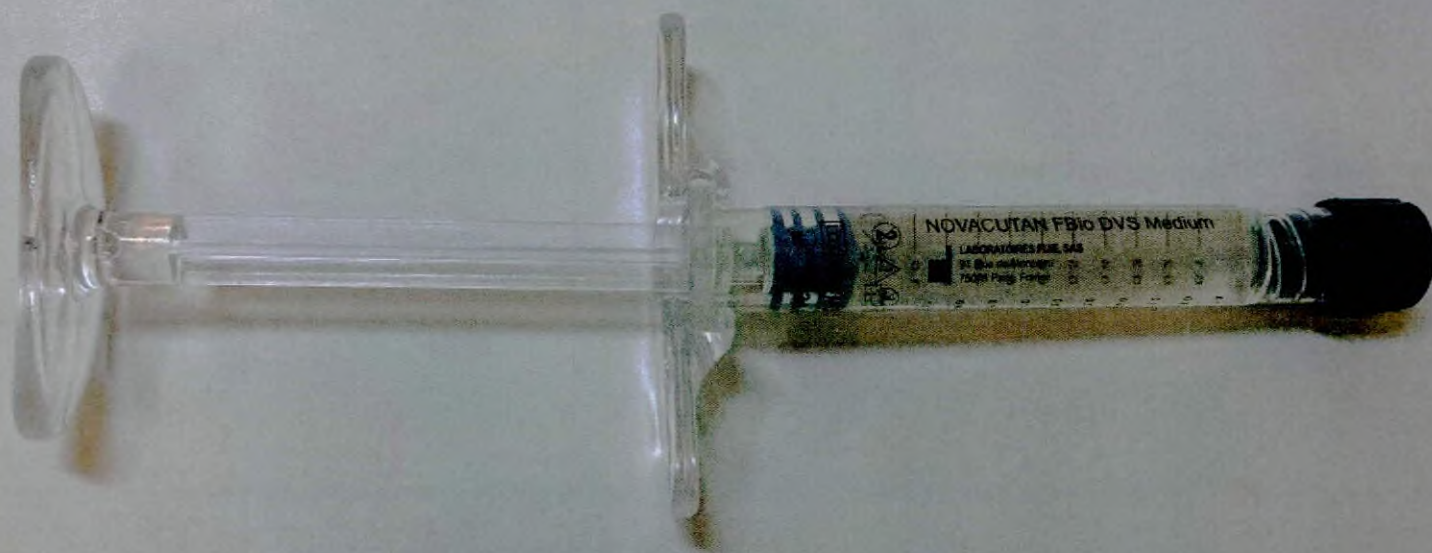


2.9. Игла 27G x 13 мм (0,4 x 13 мм) без индивидуальной упаковки – блистера, в защитном колпачке



2.10. Игла 27G x 13 мм (0,4 x 13 мм) без индивидуальной упаковки – блистера, без защитного колпачка



3. Имплантат интрадермальный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Light
- 3.1. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Light, вид спереди

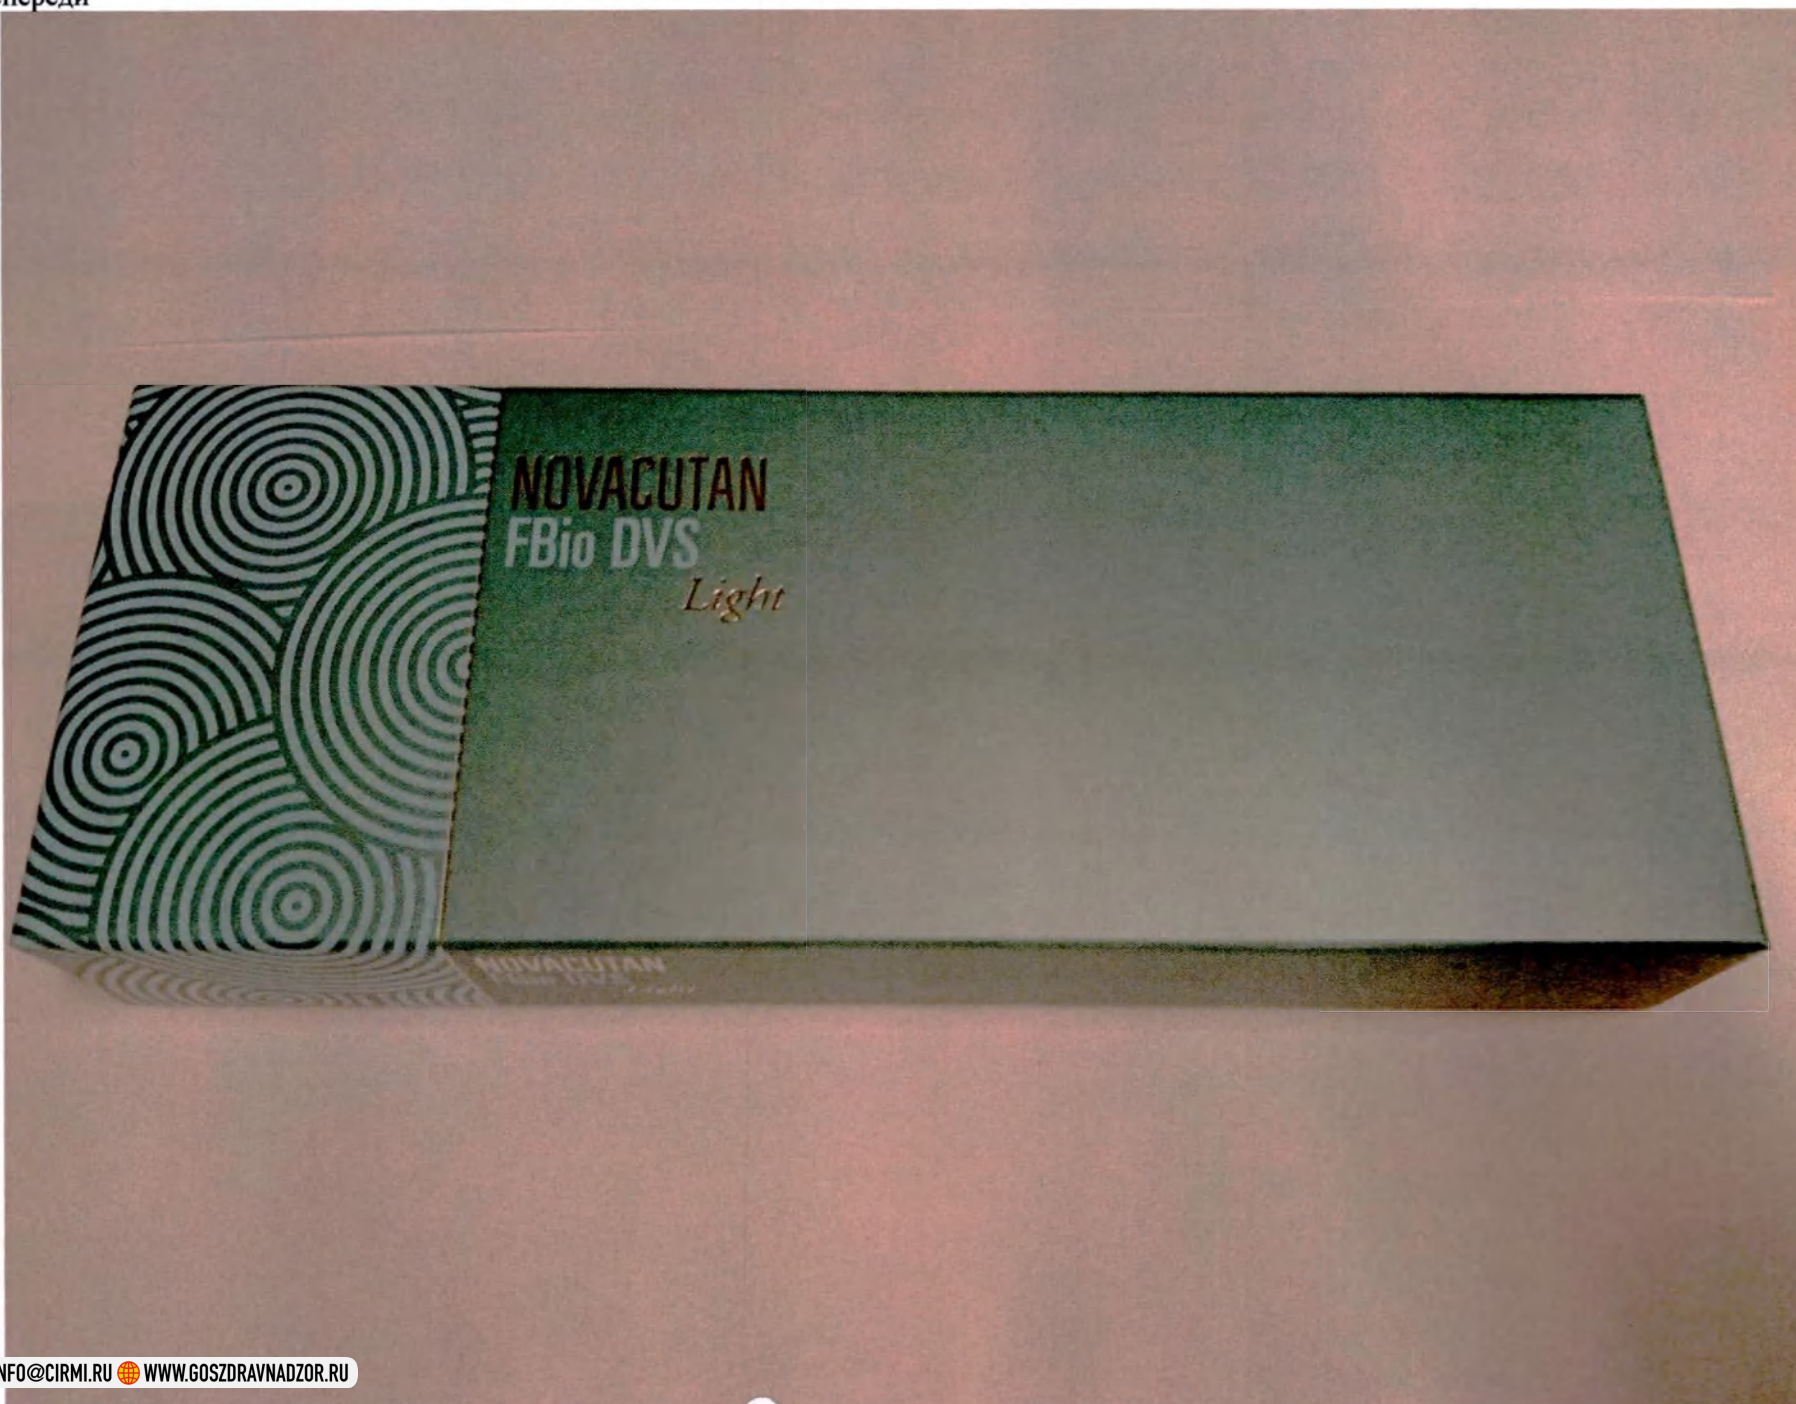

3.2. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Light, вид сзади




3.3. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Light, вид слева



3.4. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Light, вид справа




3.5. Индивидуальная упаковка – блистер имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Light

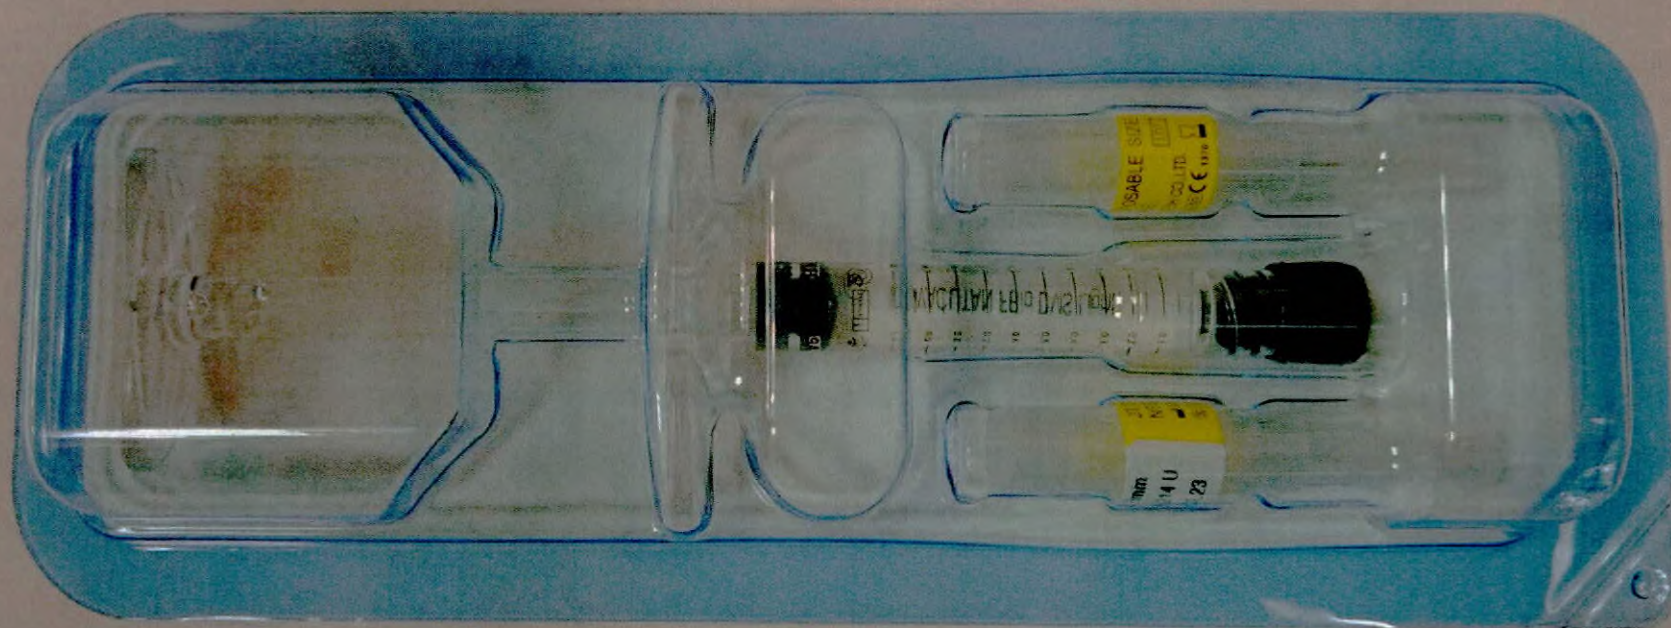


3.6. Маркировка блистера имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Light



3.7. Этикетки самоклеящиеся имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN Fbio DVS Light

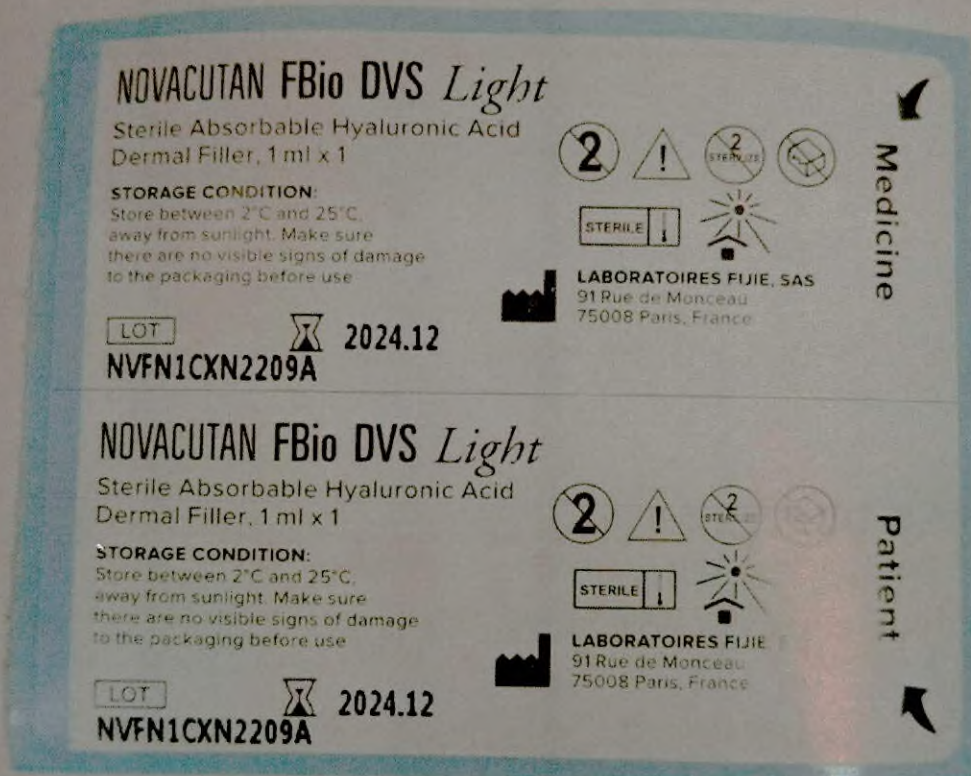

3.8. Шприц 1 мл с гелем без индивидуальной упаковки - блистера

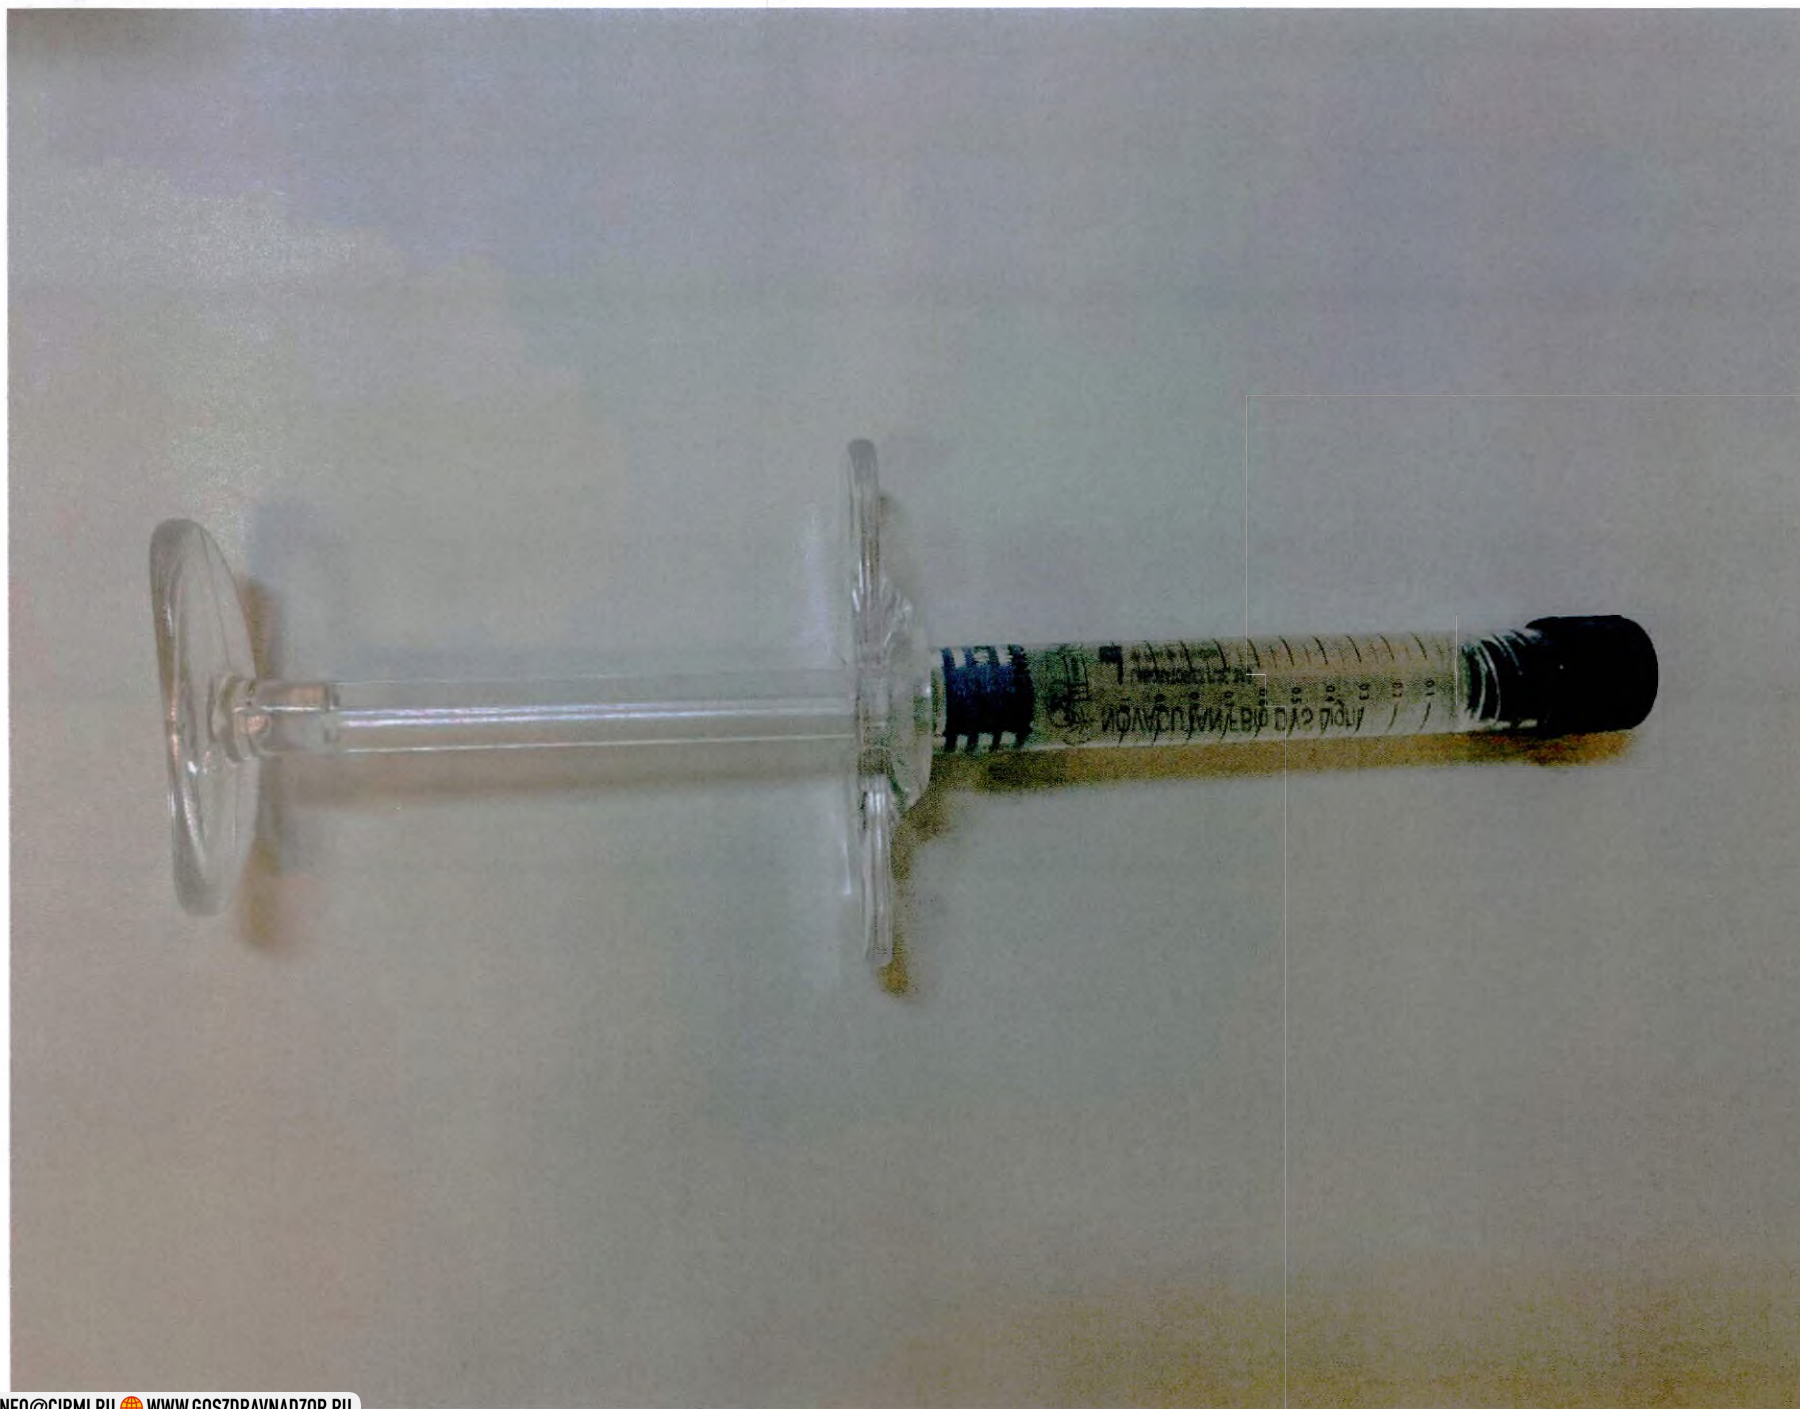


3.9. Игла 30G x 13 мм (0,3 x 13 мм) без индивидуальной упаковки – блистера, в защитном колпачке




3.10. Игла 30G x 13 мм (0,3 x 13 мм) без индивидуальной упаковки – блистера, без защитного колпачка




4. Имплантат интрадермальный на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN BioPRO
- 4.1. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN BioPRO, вид спереди

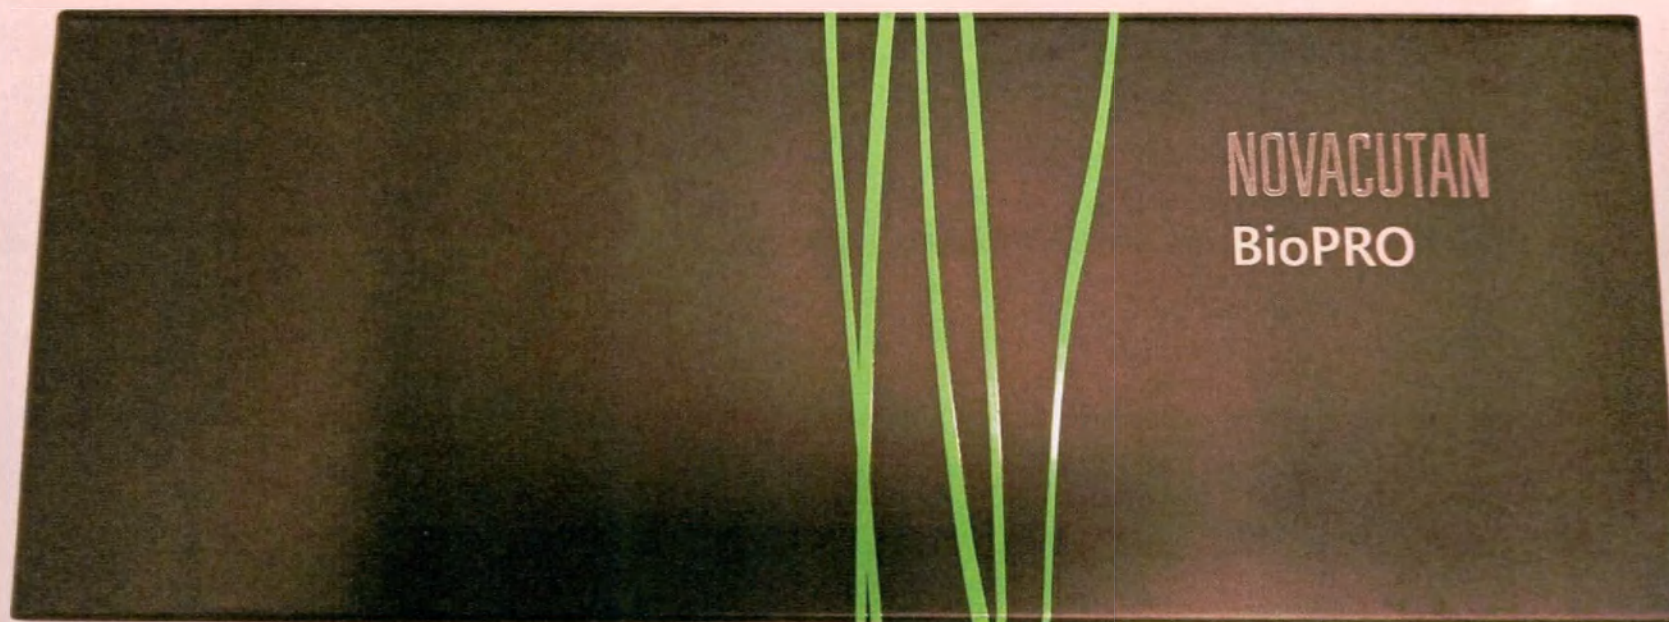


4.2. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN BioPRO, вид сзади

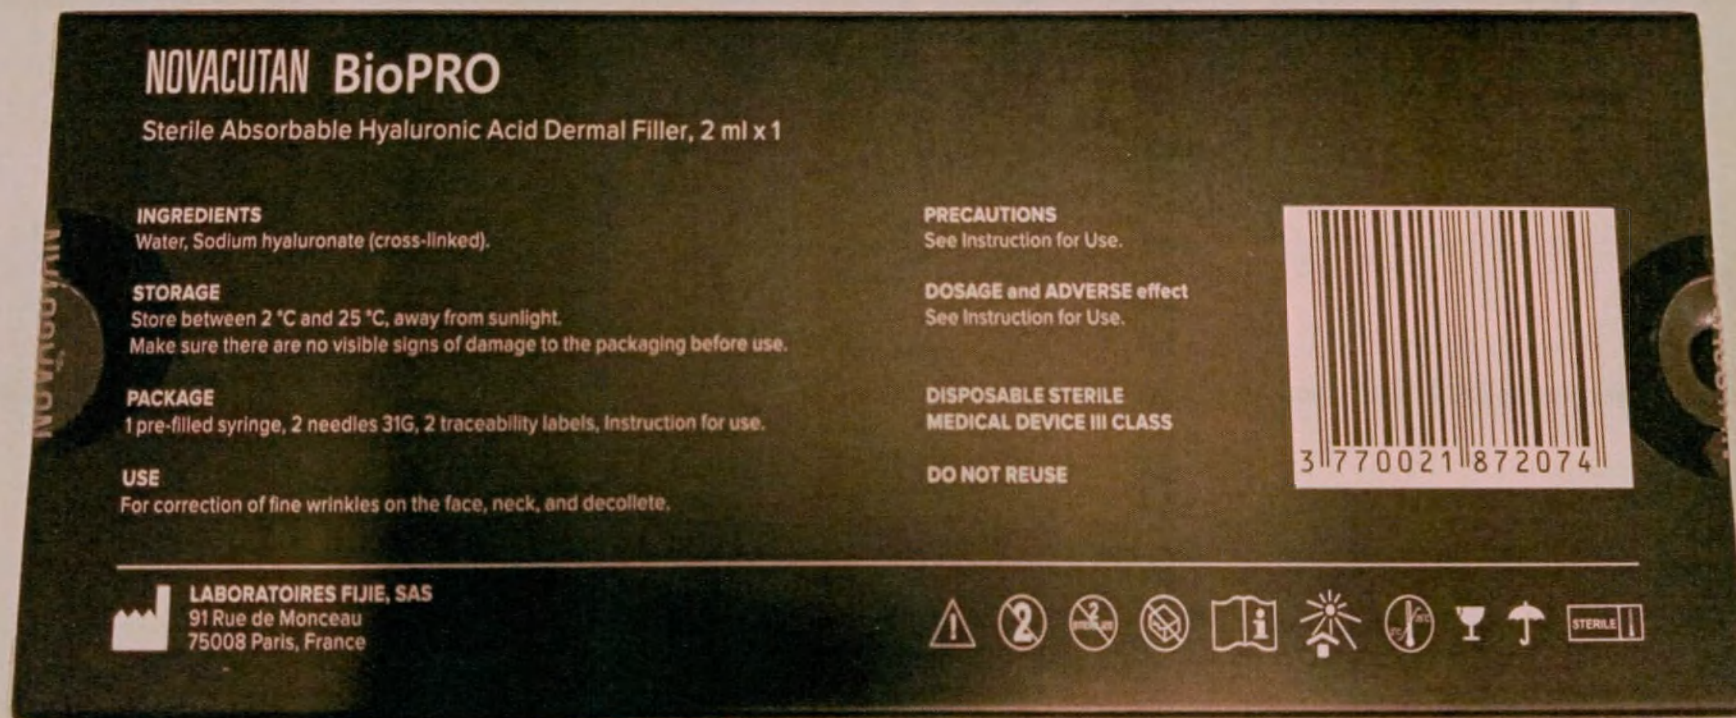


4.3. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN BioPRO, вид слева

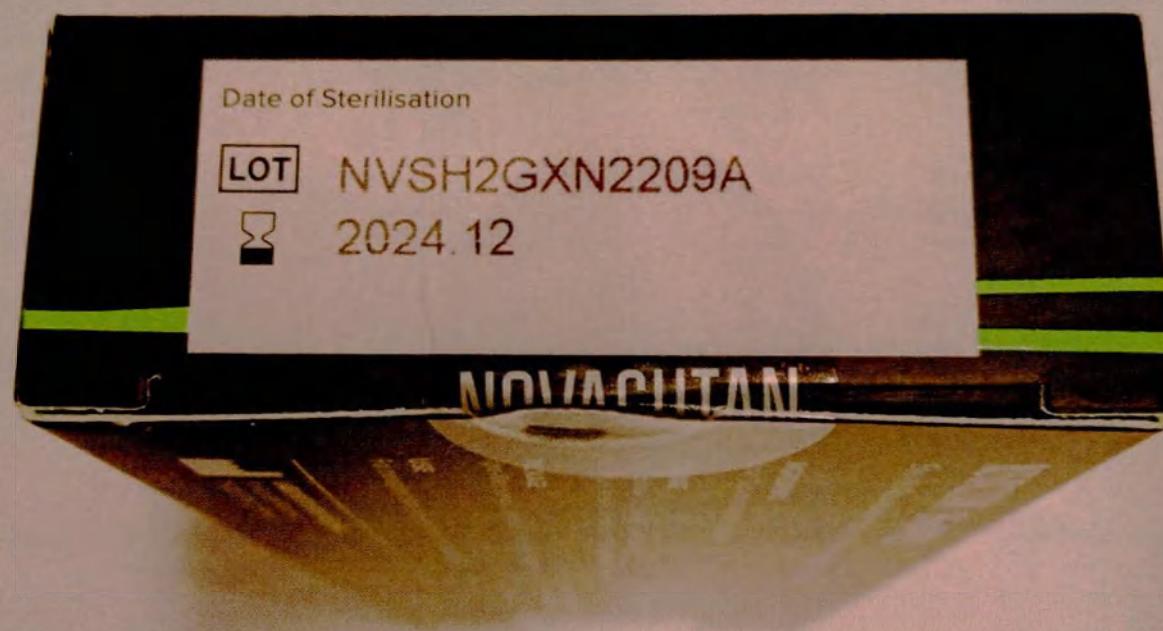


4.4. Потребительская упаковка имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN BioPRO, вид справа

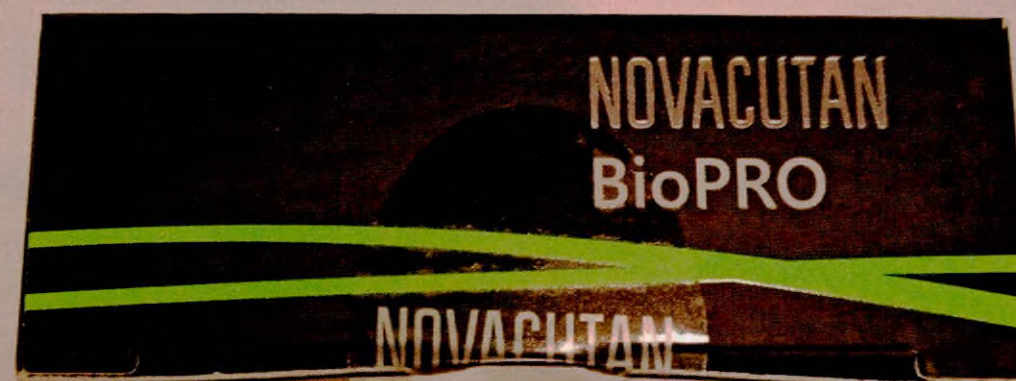


4.5. Индивидуальная упаковка – блистер имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN BioPRO

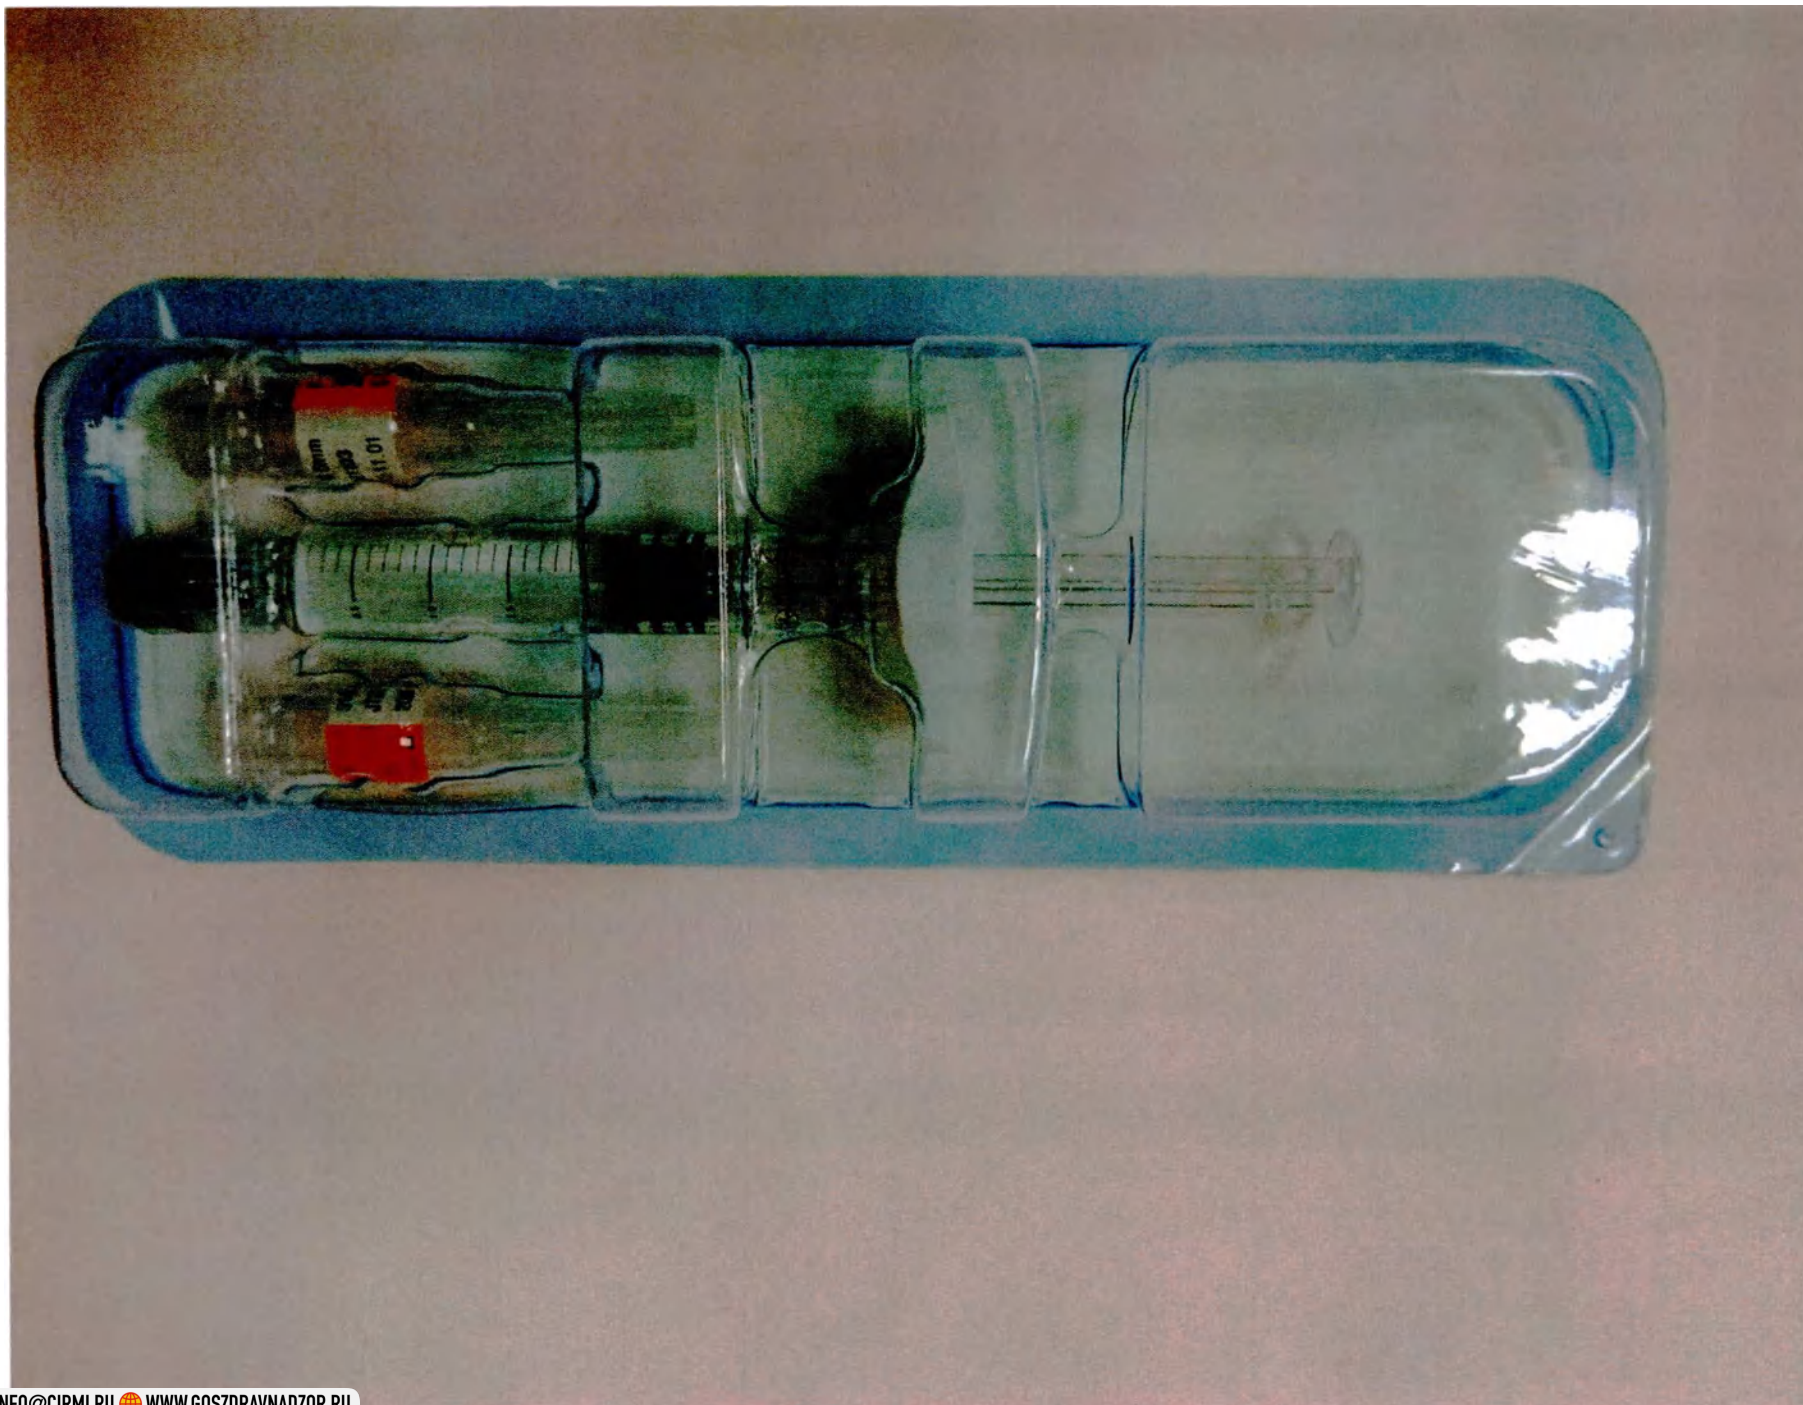


4.6. Маркировка блистера имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN BioPRO

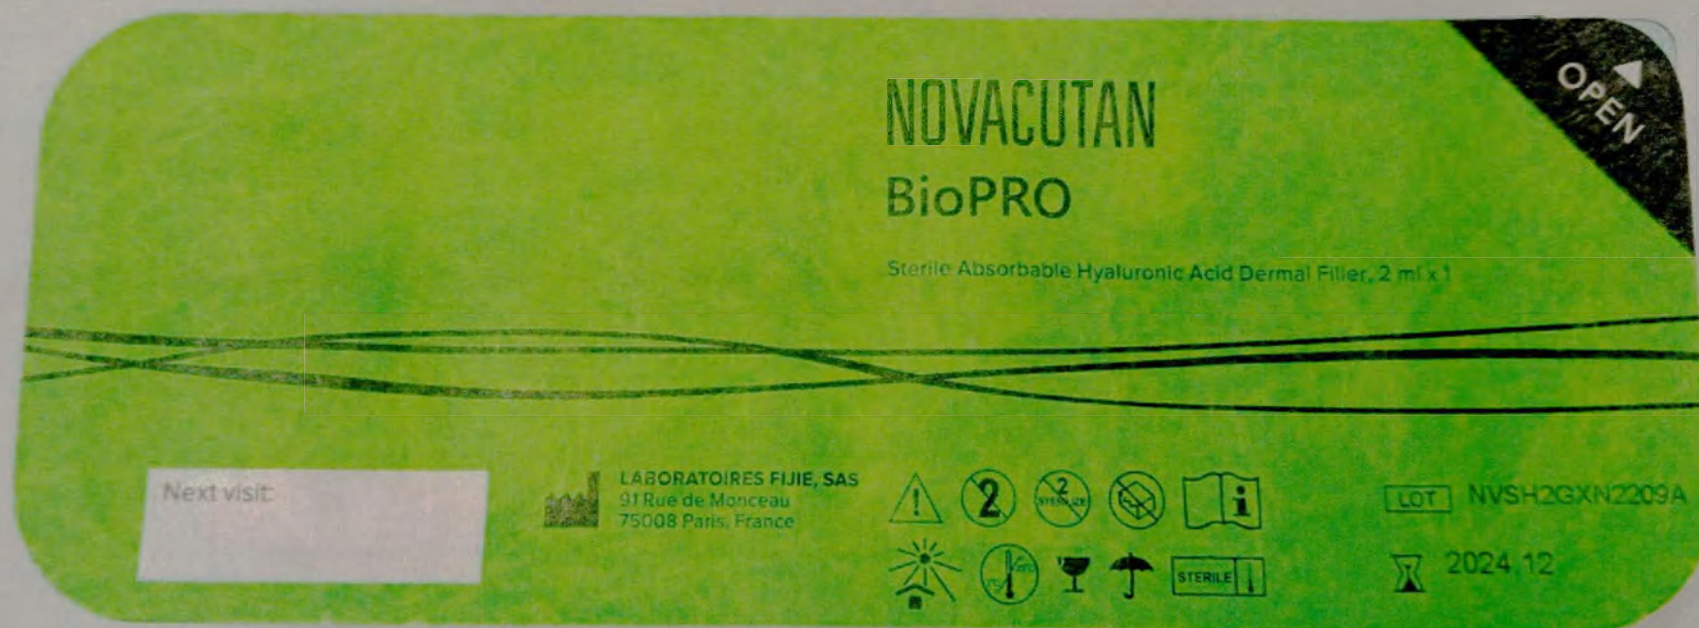

4.7. Этикетки самоклеящиеся имплантата интрадермального на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты NOVACUTAN BioPRO

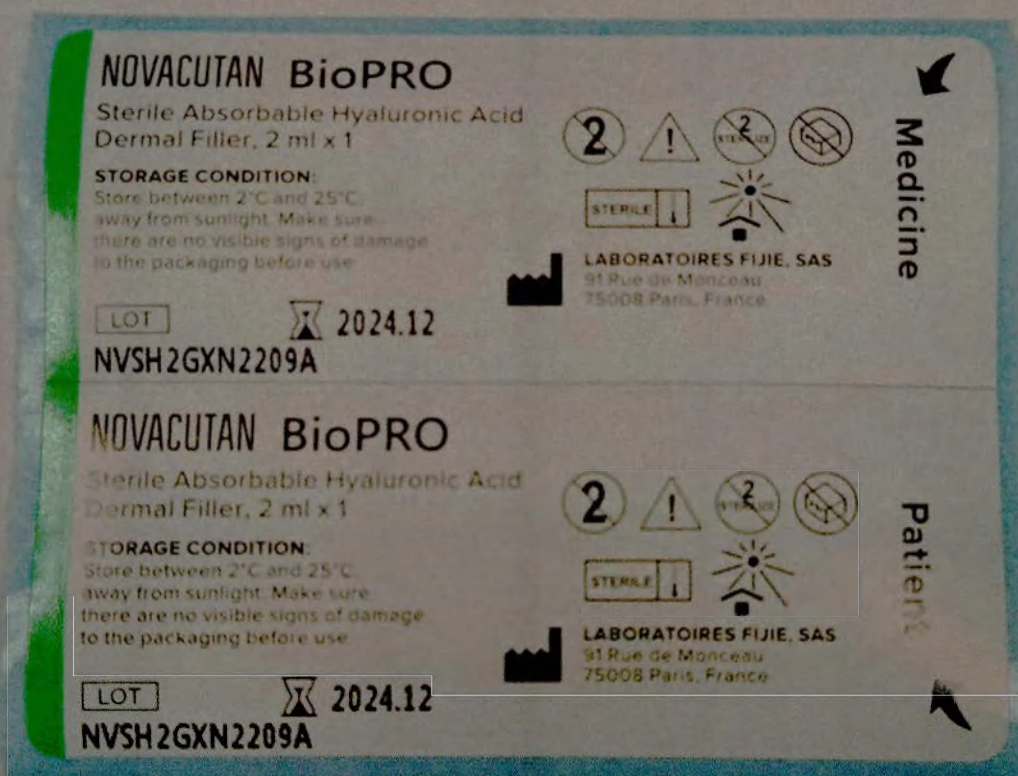

4.8. Шприц 3 мл с гелем 2 мл без индивидуальной упаковки - блистера

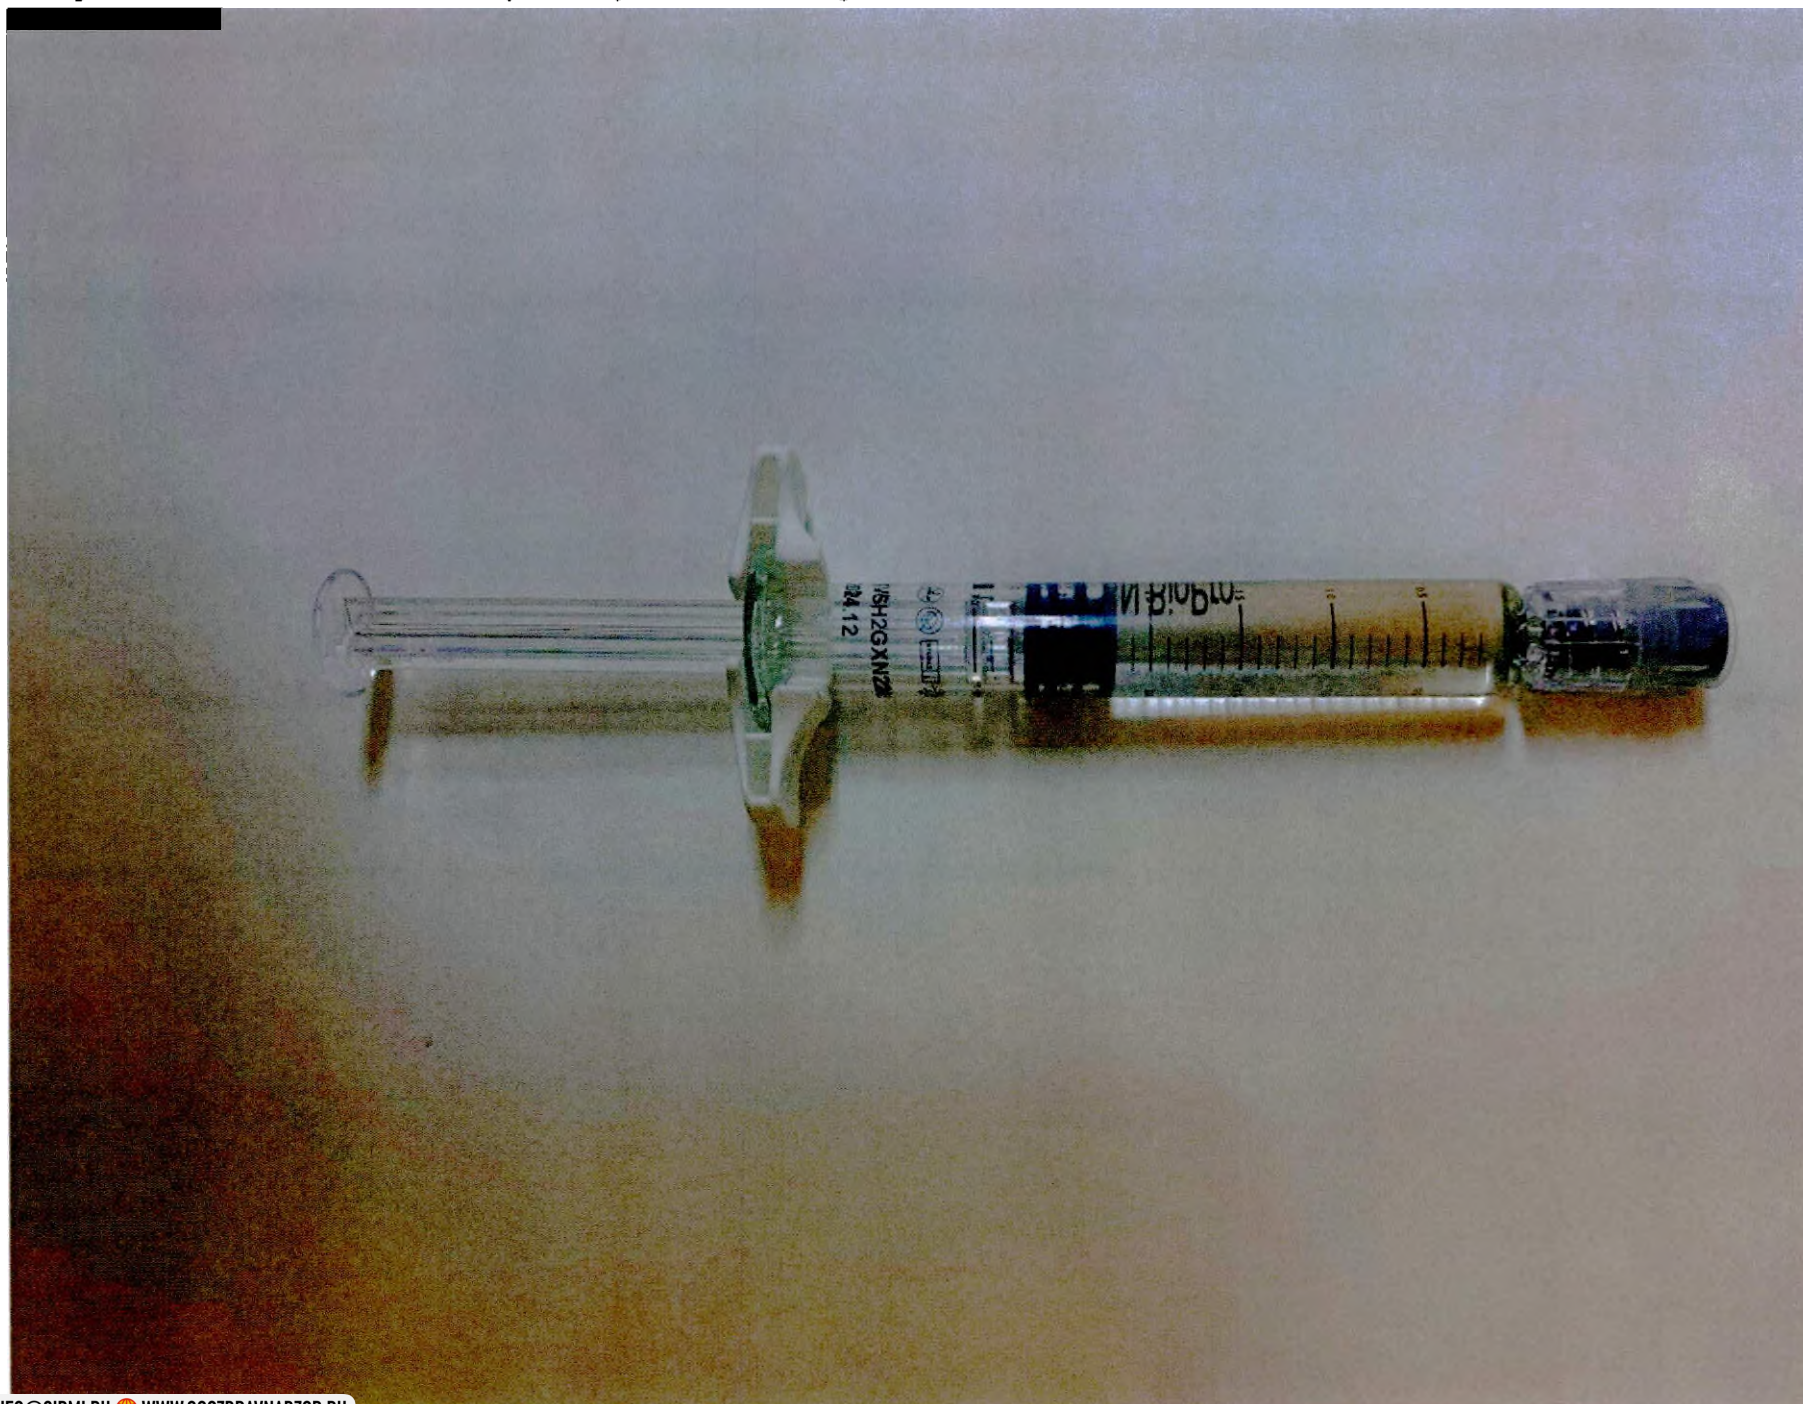


4.9. Игла 31G x 6 мм (0,25 x 6 мм) без индивидуальной упаковки – блистера, в защитном колпачке



4.10. Игла 31G x 6 мм (0,25 x 6 мм) без индивидуальной упаковки – блистера, без защитного колпачка



5. Транспортная тара

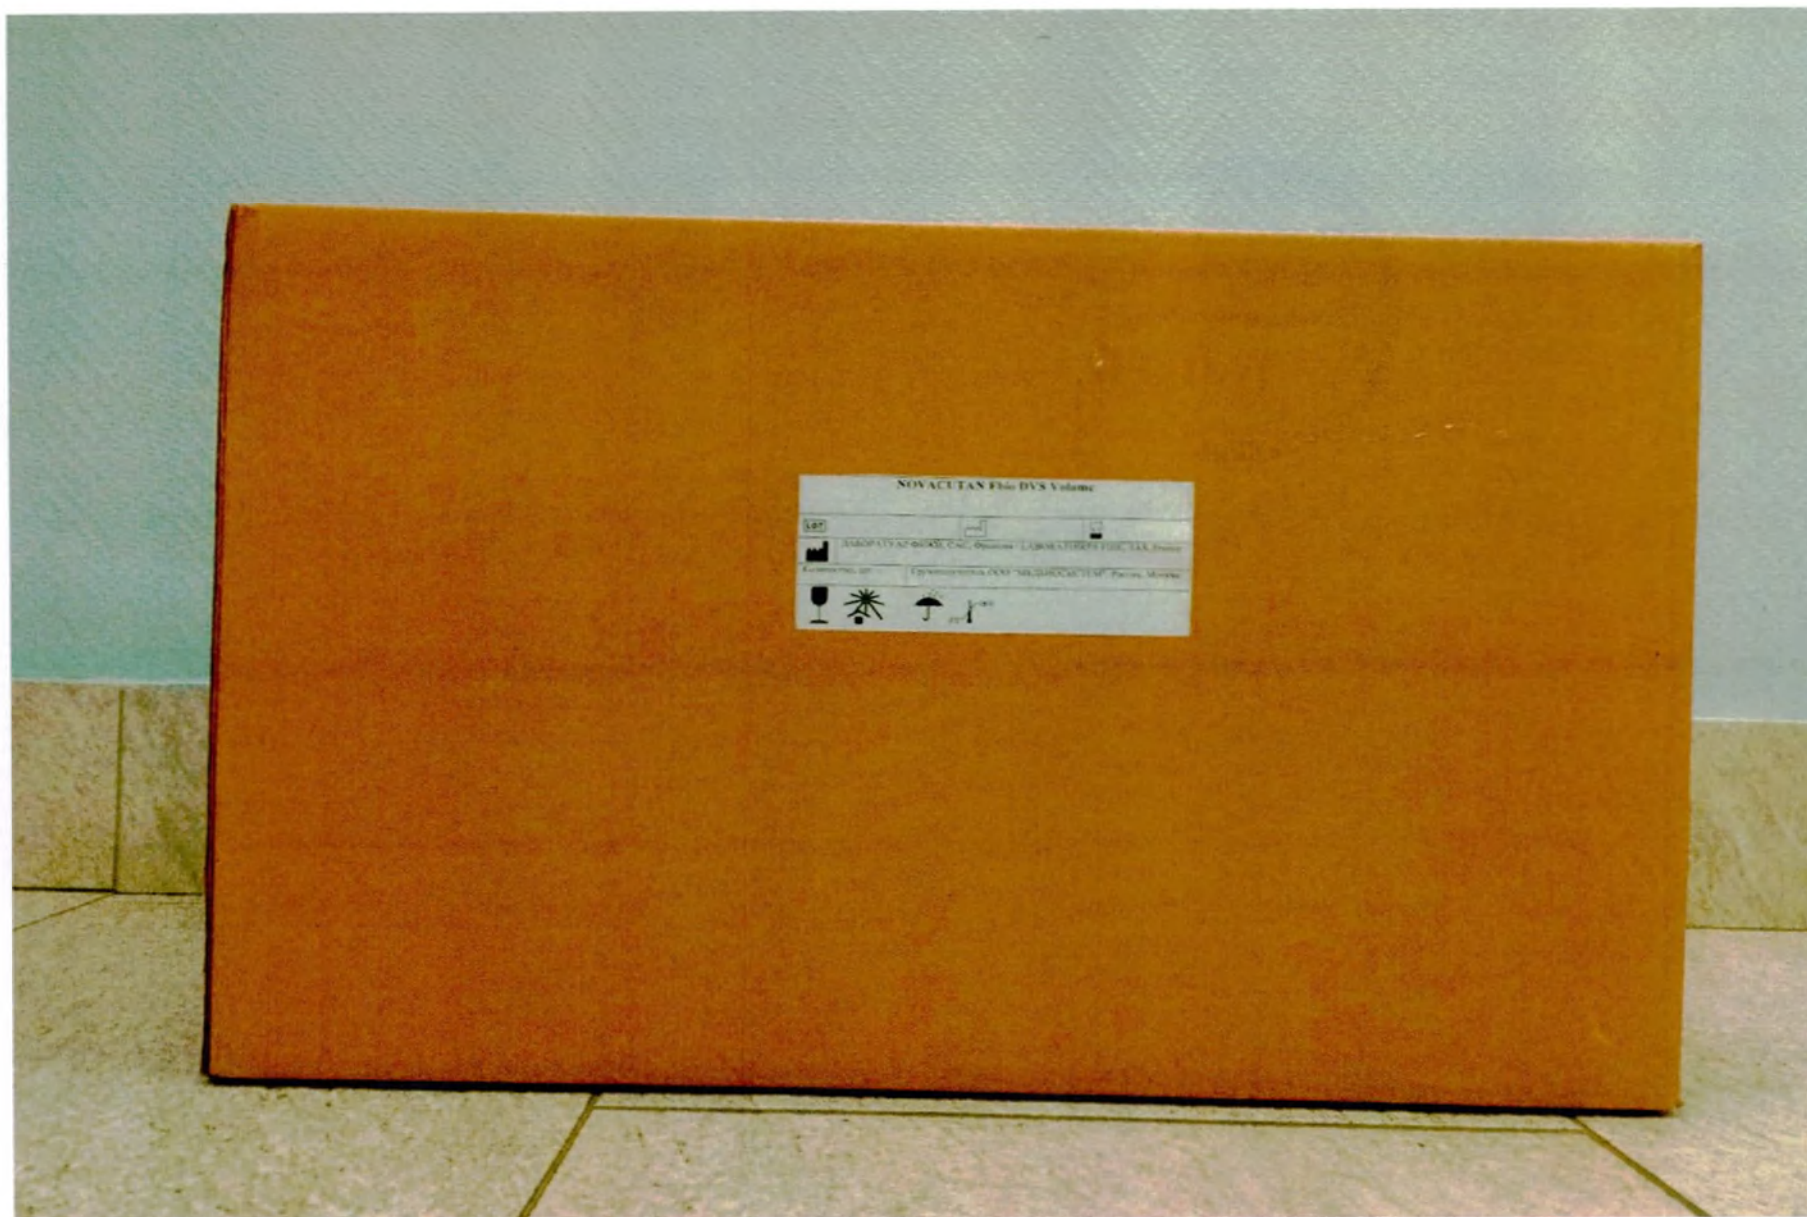



Прошито, пронумеровано
42) листа (-ов)