

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.
«25» 2023 г.



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA HE4», по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

Вариант исполнения 1

Кат. № 1430201

На коробку:

винченемири олончленоисрефори вит
оиневоечлолси х овогол



Набор реагентов для контроля
качества анализа
«Контроли MagnoLIA HE4»,
по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023

Комплект поставки:

Контроль 1	1 фл.
Контроль 2	1 фл.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

LOT E003 2023-04-24 2023-04-24 2024-04-24

REF 1430201 2024-04-24

IVD 20

ТУ 21 20 23-693-98539446-2023
РУ №XXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
HE4
Контроль 1
объем 0,5 мл
+2[°]С
000 «Компания Алкор Био»



Контроли
MagnoLIA
HE4
Контроль 2
объем 0,5 мл
+2[°]С
000 «Компания Алкор Био»



«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA HE4», по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Вариант исполнения 2

Кат. № 1430205

На коробку:



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Контроли MagnoLIA HE4

LOT E003

REF 1430205

IVD

2024-04-24

+2/+8 °C



Комплект поставки:

Контроль 1	5 фл.
Контроль 2	5 фл.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

ТУ 21.20.23-693-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXXXXX

**Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA HE4»,
по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023**

LOT E003

REF 1430205

IVD

2023-04-24

2024-04-24

+2/+8 °C

100

**Готово к использованию
Для профессионального применения**



На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
HE4
Контроль 1
объем 0,5 мл

+2/+8 °C

ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Контроли
MagnoLIA
HE4
Контроль 2
объем 0,5 мл

+2/+8 °C

ООО «Компания Алкор Био»



-5 шт.

«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA HE4», по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Вариант исполнения 3

Кат. № 1430210

На коробку:

REF 1430210
LOT E003
2024-04-24
+2/+8 °C
Контроли MagnoLIA HE4

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А,
тел./факс: +7(812)6787879, 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru



Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA HE4»,
по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023

Комплект поставки:

Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

LOT E003

REF 1430210

IVD

2023-04-24

2024-04-24

Σ 200

+2/+8 °C



ТУ 21.20.23-693-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.


На флаконы:

Контроли
MagnoLIA
HE4
Контроль 1
объем 0,5 мл
+2/+8 °C



-10 шт.

Контроли
MagnoLIA
HE4
Контроль 2
объем 0,5 мл
+2/+8 °C



-10 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

4 (457000) лист 0

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынцев Д.Г.
«13» 2023 г.

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*


**«Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA HE4», по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA HE4», по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023

Кат. № 1430201 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

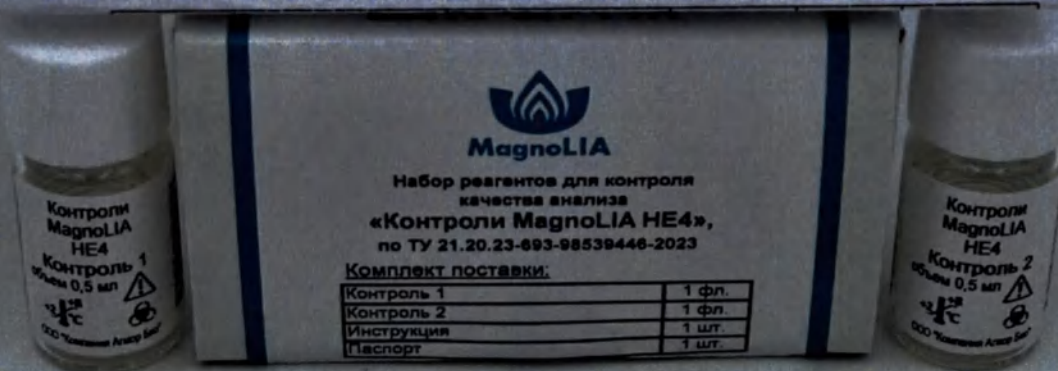



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли MagnoLIA HE4», по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA HE4», по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023

Кат. № 1430201 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

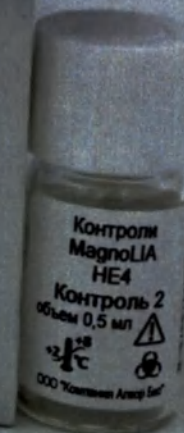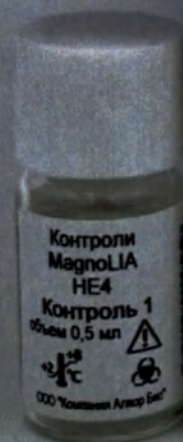


ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA HE4», по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023

Кат. № 1430201 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.

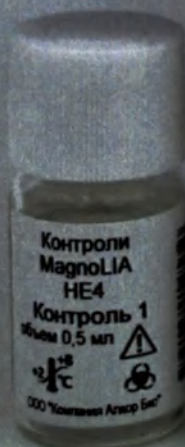

Готово к использованию.
Для профессионального применения.

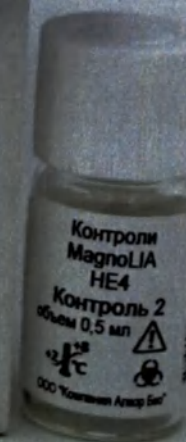

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA HE4», по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023

Кат. № 1430205 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Комплект поставки:

Контроль 1	5 шт.
Контроль 2	5 шт.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

ТУ 21.20.23-693-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXX000000

LOT E003

REF 1430205

IVD



2023-04-24



2024-04-24



100



Готово к использованию
Для профессионального применения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики *in vitro*

«Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли
MagnoLIA HE4», по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023»

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA HE4», по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023

Кат. № 1430205 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA HE4», по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023

Кат. № 1430205 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E003

Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA HE4», по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023

Кат. № 1430210 Серия № E003 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Набор реагентов для контроля качества анализа
«Контроли MagnoLIA HE4»,
по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023

Комплект поставки:

Контроль 1	10 фл.
Контроль 2	10 фл.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

LOT E003

2023-04-24



REF 1430210

2024-04-24



IVD





ТУ 21.20.23-693-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXX


Готово к использованию.
Для профессионального применения.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для контроля качества анализа «Контроли
MagnoLIA HE4», по ТУ 21.20.23-693-98539446-2023»

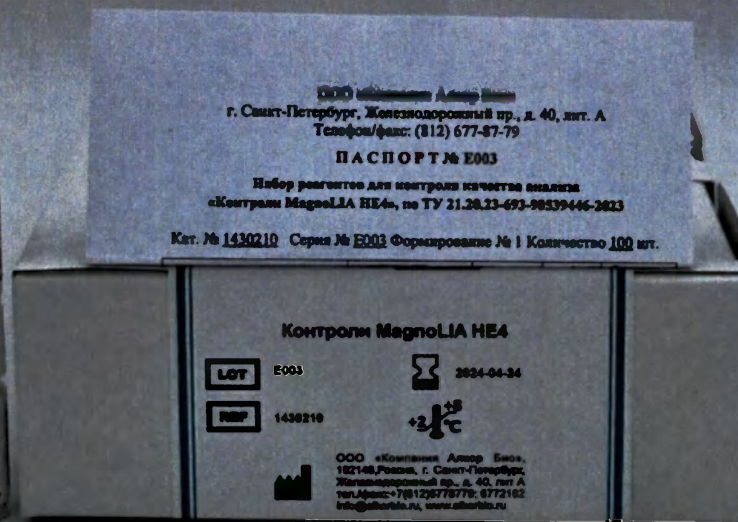

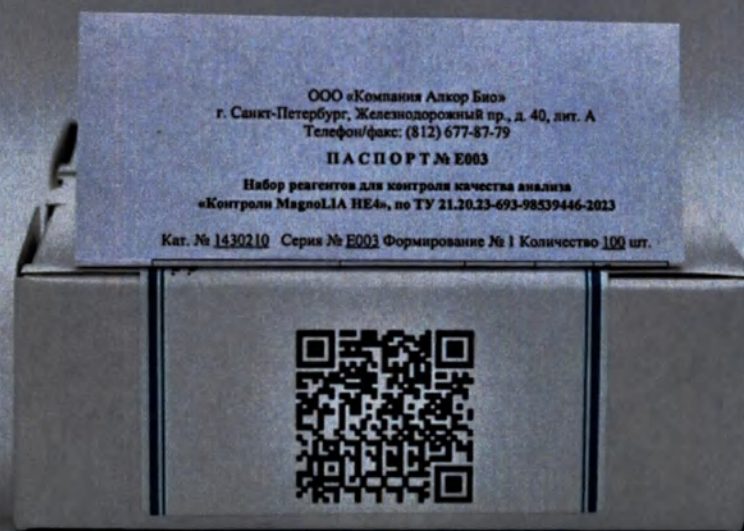

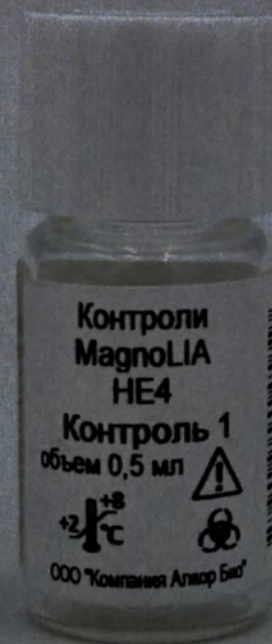

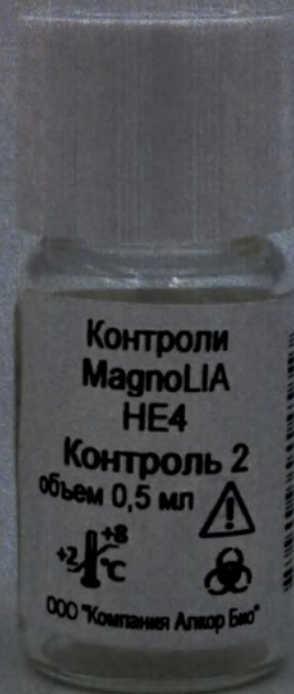

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

12 (двадцать) лист 8

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полынцев

