

## Фотографические изображения медицинского изделия

1. Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift®  
® неопудренные текстурированные, с покрытием Алое Вера, цвет зеленый, размер:  
XS, S, M, L, XL



Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift®  
по ТУ 22.19.60-002-06663635-2022 в вариантах исполнения, партия 164001, 164002, 164003

Регистрационное удостоверение  
ГОСТ Р 52239

Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85

Условия утилизации: Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). Неиспользованные изделия (не имеющие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешивание отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших обязательный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Производитель: ООО «СОФТЛИФТ», 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, оф. 224  
Место производства:  
1. ООО «СОФТЛИФТ», Россия, 123423, Москва, ул. Народного ополчения, д.34, стр.2, офис 224.  
2. Армянский филиал ОП ООО «СМД», Тбилиское шоссе /29/38 Канакер-Зейтун 0091, Ереван, Армения  
3. ООО «СОФТЛИФТ», ДНР, г. Донецк, ул. Потыльская, д. 89

Тел.: +7(499) 192-81-83, +7 (499) 197 32-71  
E-mail: gsk.med@bk.ru

LOT 164001

02.2022

02.2027



2. Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift<sup>®</sup> неопудренные текстурированные, с покрытием Алое Вера, цвет синий, размер: XS, S, M, L, XL



Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift®  
по ТУ 22.19.60-002-06663635-2022 в вариантах исполнения, партия 164001, 164002, 164003

Регистрационное удостоверение

ГОСТ Р 52239

LOT

164001



02.2022



02.2027

Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85

Условия утилизации: Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). Нестерилизованные изделия (не имеющие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к экологическим опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Производитель: ООО «СОФТЛИФТ», 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, оф. 224  
Место производства:

1. ООО «СОФТЛИФТ», Россия, 123423, Москва, ул. Народного ополчения, д.34, стр.2, офис 224.
2. Армянский филиал ОП ООО «СМД», Тбилисское шоссе /29/38 Катакер-Зейгун 0091, Ереван, Армения
3. ООО «СОФТЛИФТ», ДНР, г. Донецк, ул. Потийская, д. 89

Тел.: +7(499) 192-81-83, +7 (499) 197 32-71

E-mail: gskmed@bk.ru




ЦВЕТ



ТЕКСТУРА



XS S (checked) M L XL



ПЕРЧАТКИ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ


С ВНУТРЕННИМ  
ПОКРЫТИЕМ АЛЮ ВЕР

УДЛИНЕННЫЕ

СТ



3. Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift®  
® неопудренные гладкие, цвет белый, размер: XS, S, M, L, XL

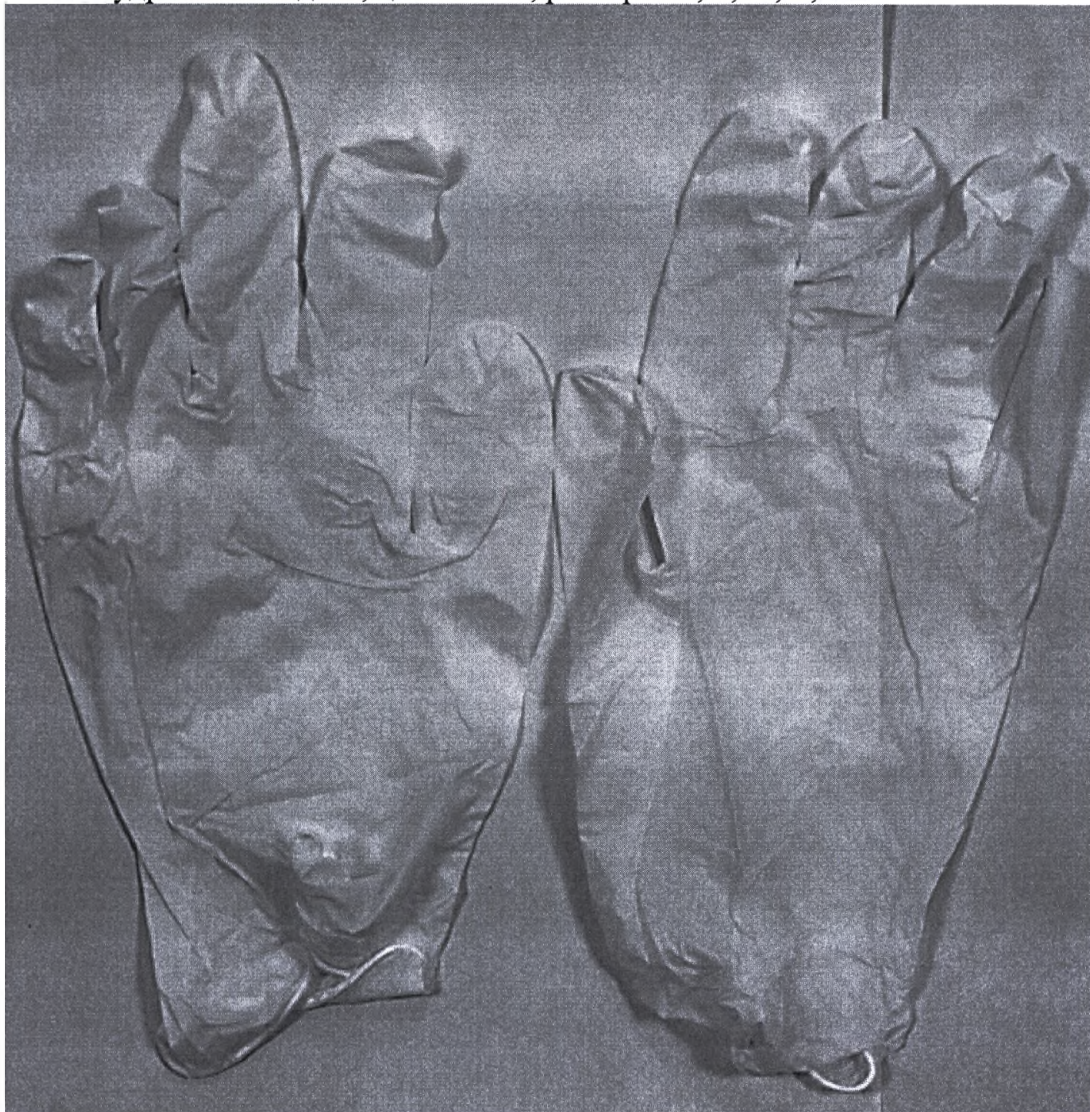

Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift®  
по ТУ 22.19.60-002-06663635-2022 в вариантах исполнения, партия 164001, 164002, 164003

Регистрационное удостоверение  
ГОСТ Р 52239

LOT

164001

EXP

02.2022

EXP

02.2027

Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85

Условия утилизации: Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). Непользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускаются привлеченные лица, не прошедшие предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Производитель: ООО «СОФТЛИФТ», 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, оф. 224  
Место производства:

1. ООО «СОФТЛИФТ», Россия, 123423, Москва, ул. Народного ополчения, д.34, стр.2, офис 224.
2. Арамянский филиал ОП ООО «СМД», Тбилиское Шоссе /29/38 Канакер-Зейтун 0091, Ереван, Армения
3. ООО «СОФТЛИФТ», ДНР, г. Донецк, ул. Потыбская, д. 89

Тел.: +7(499) 192-81-83, +7 (499) 197 32-71  
E-mail: gmkmed@bk.ru





4. Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift<sup>®</sup> неопудренные гладкие, цвет синий, размер: XS, S, M, L, XL



Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift<sup>®</sup>  
по ТУ 22.19.60-002-06663635-2022 в вариантах исполнения, партия 164001, 164002, 164003

Регистрационное удостоверение  
ГОСТ Р 52239

Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85

Условия утилизации: Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). Непользованные изделия (не имеющие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Производитель: ООО «СОФТЛИФТ», 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, оф. 224

Место производства:

1. ООО «СОФТЛИФТ», Россия, 123423, Москва, ул. Народного ополчения, д.34, стр.2, офис 224.
2. Армянский филиал ОП ООО «СМД», Тбилиское шоссе (29/38 Кавак-Зейтун 0091), Ереван, Армения
3. ООО «СОФТЛИФТ», ДНР, г. Донецк, ул. Потыльская, д. 89

Тел.: +7(499) 192-81-83, +7 (499) 197 32-71


E-mail: gnlmed@bk.ru

LOT 164001

02.2022

02.2027



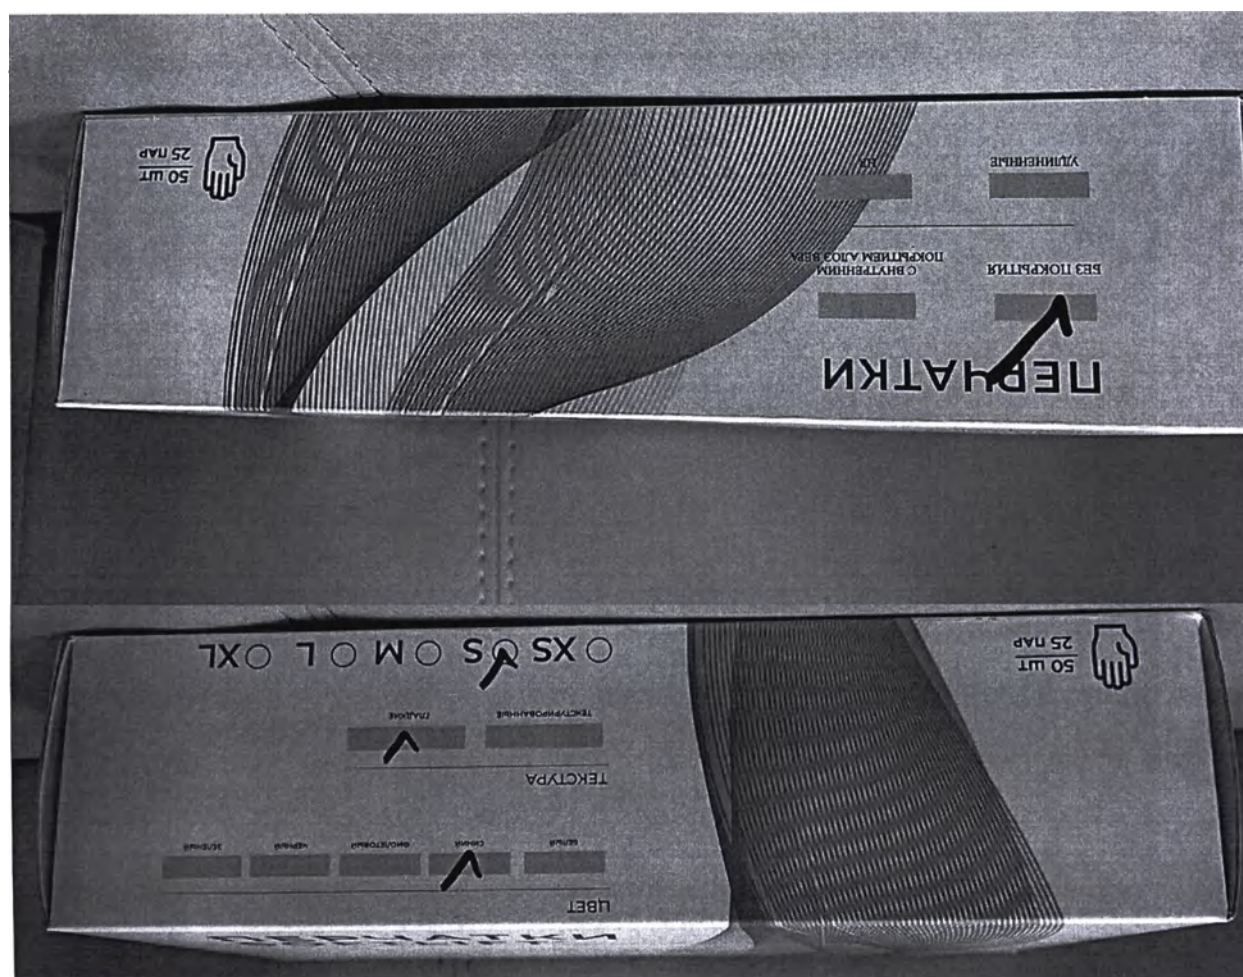

5. Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift<sup>®</sup> неопудренные гладкие, цвет зеленый, размер: XS, S, M, L, XL



Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift® по ТУ 22.19.60-002-06663635-2022 в вариантах исполнения, партия 164001, 164002, 164003

Регистрационное удостоверение  
ГОСТ Р 52239

LOT 164002

02.2022

02.2027

Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85



Условия утилизации: Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). Неиспользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускаются привлечение лиц, не прошедших обязательный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.


Производитель: ООО «СОФТИЛIFT», 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, оф. 224  
Место производства:

1. ООО «СОФТИЛIFT», Россия, 123423, Москва, ул. Народного ополчения, д.34, стр.2, офис 224.
2. Арамянский филиал ОП ООО «СМД», Тбилиское шоссе /29/38 Канакер-Зейтун 0091, Ереван, Армения
3. ООО «СОФТИЛIFT», ДНР г. Донецк, ул. Потийская, д. 89

Тел.: +7(499) 192-81-83, +7 (499) 197 32-71  
E-mail: gnlmed@bk.ru

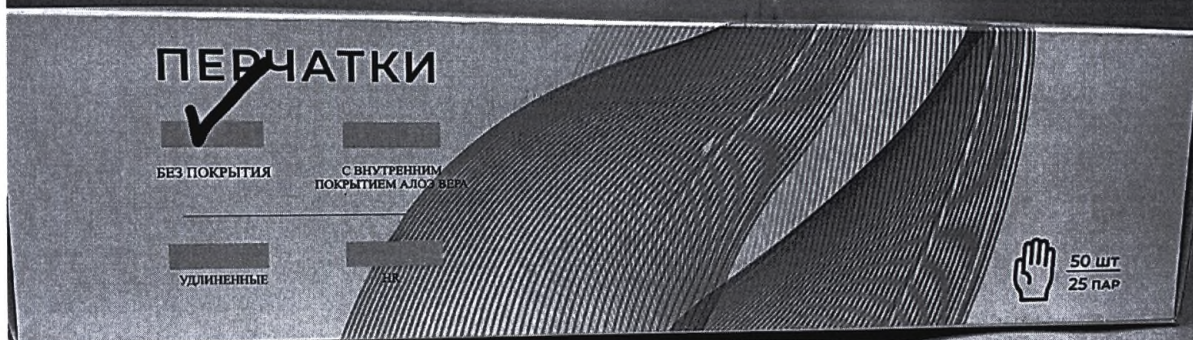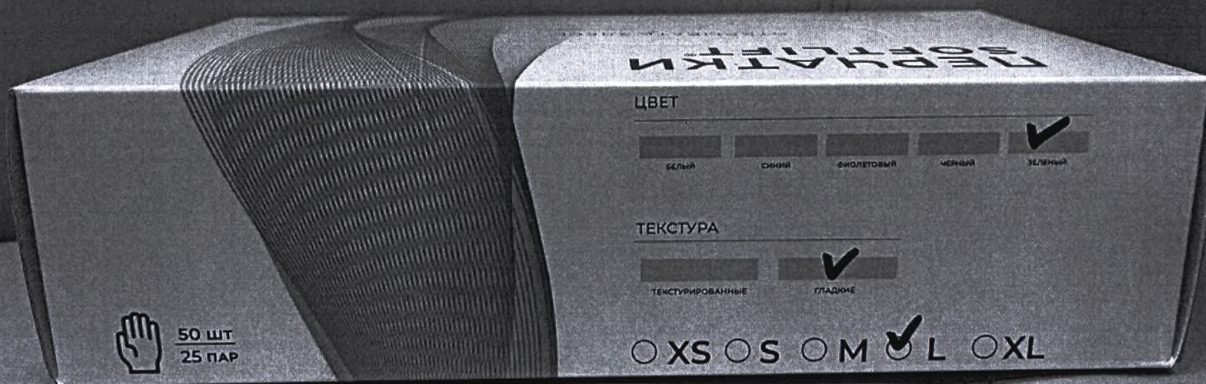

6. Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift®  
® неопудренные текстурированные, цвет белый, размер: XS, S, M, L, XL

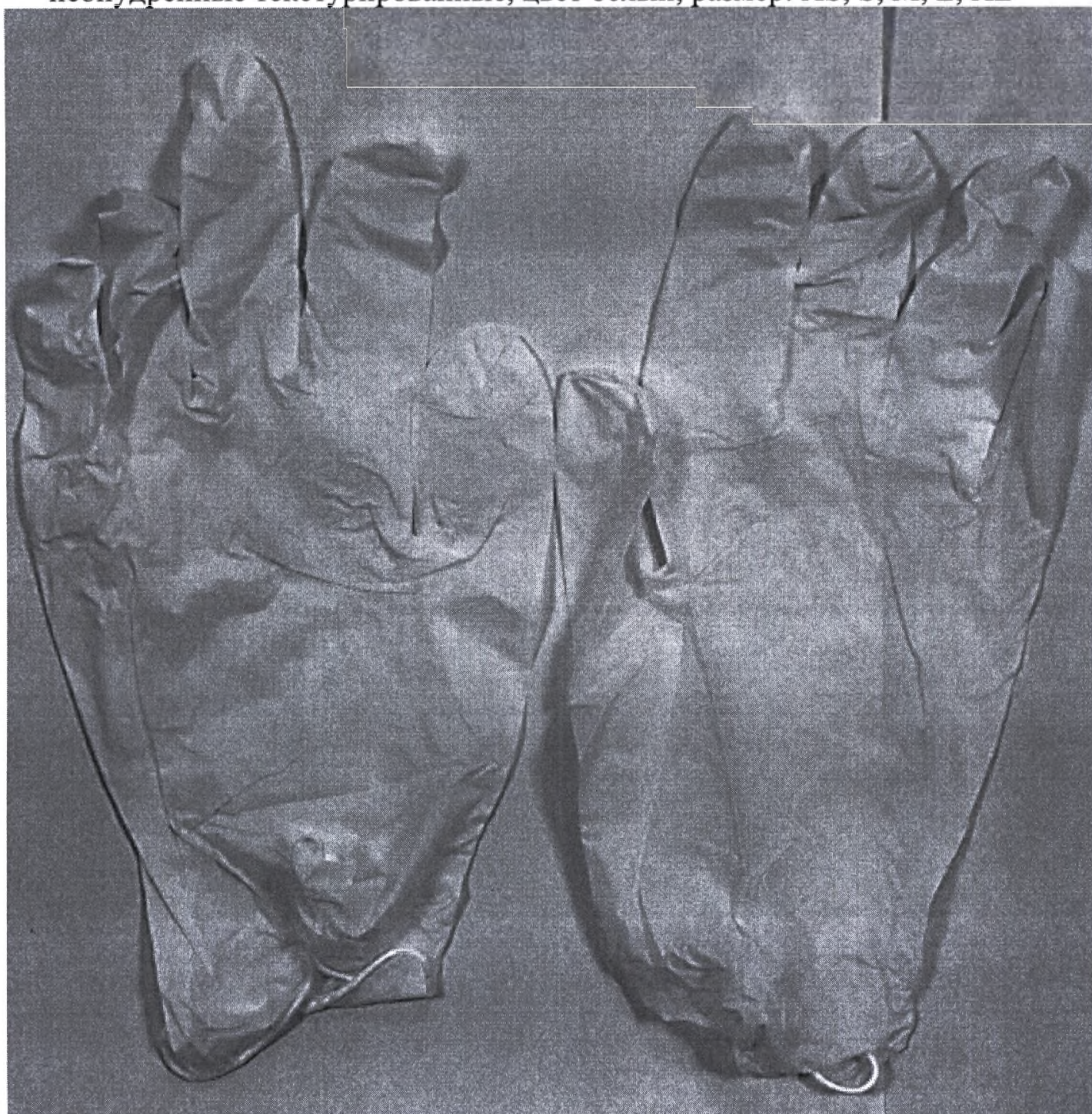

Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift®  
по ТУ 22.19.60-002-06663635-2022 в вариантах исполнения, партия 164001, 164002, 164003

Регистрационное удостоверение  
ГОСТ Р 52239

Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85

Условия утилизации: Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). Нестерилизованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускаются привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Производитель: ООО «СОФТИЛIFT», 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, оф. 224  
Место производства:

1. ООО «СОФТИЛIFT», Россия, 123423, Москва, ул. Народного ополчения, д.34, стр.2, офис 224.
2. Армянский филиал ОП ООО «СМД», Тбилиское шоссе 29/38 Камакер-Зейгун 0091, Ереван, Армения
3. ООО «СОФТИЛIFT», ДНР, г. Донецк, ул. Потыльская, д. 89

Тел.: +7(499) 192-81-83, +7(499) 197-32-71  
E-mail: gmkmed@bmk.ru

LOT

164002



02.2022



02.2027





7. Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift®  
 ® неопудренные текстурированные, цвет синий, размер: XS, S, M, L, XL;



Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift®  
 по ТУ 22.19.60-002-06663635-2022 в вариантах исполнения, партия 164001, 164002, 164003

Регистрационное удостоверение  
 ГОСТ Р 52239

Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85

Условия утилизации: Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). Непользованные изделия (не имевшие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имевшие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших обязательный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.


Производитель: ООО «СОФТИЛIFT», 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, оф. 224  
 Место производства:

1. ООО «СОФТИЛIFT», Россия, 123423, Москва, ул. Народного ополчения, д.34, стр.2, офис 224.
2. Арамянский филиал ОП ООО «СМД», Тбилисское шоссе 29/38 Каналер-Зейтун 0091, Ереван, Армения
3. ООО «СОФТИЛIFT», ДНР, г. Донецк, ул. Потийская, д. 89

Тел.: +7(499) 192-81-83, +7 (499) 197-32-71  
 E-mail: gskmed@bk.ru

|     |         |
|-----|---------|
| LOT | 164002  |
| 📅   | 02.2022 |
| 👤   | 02.2027 |



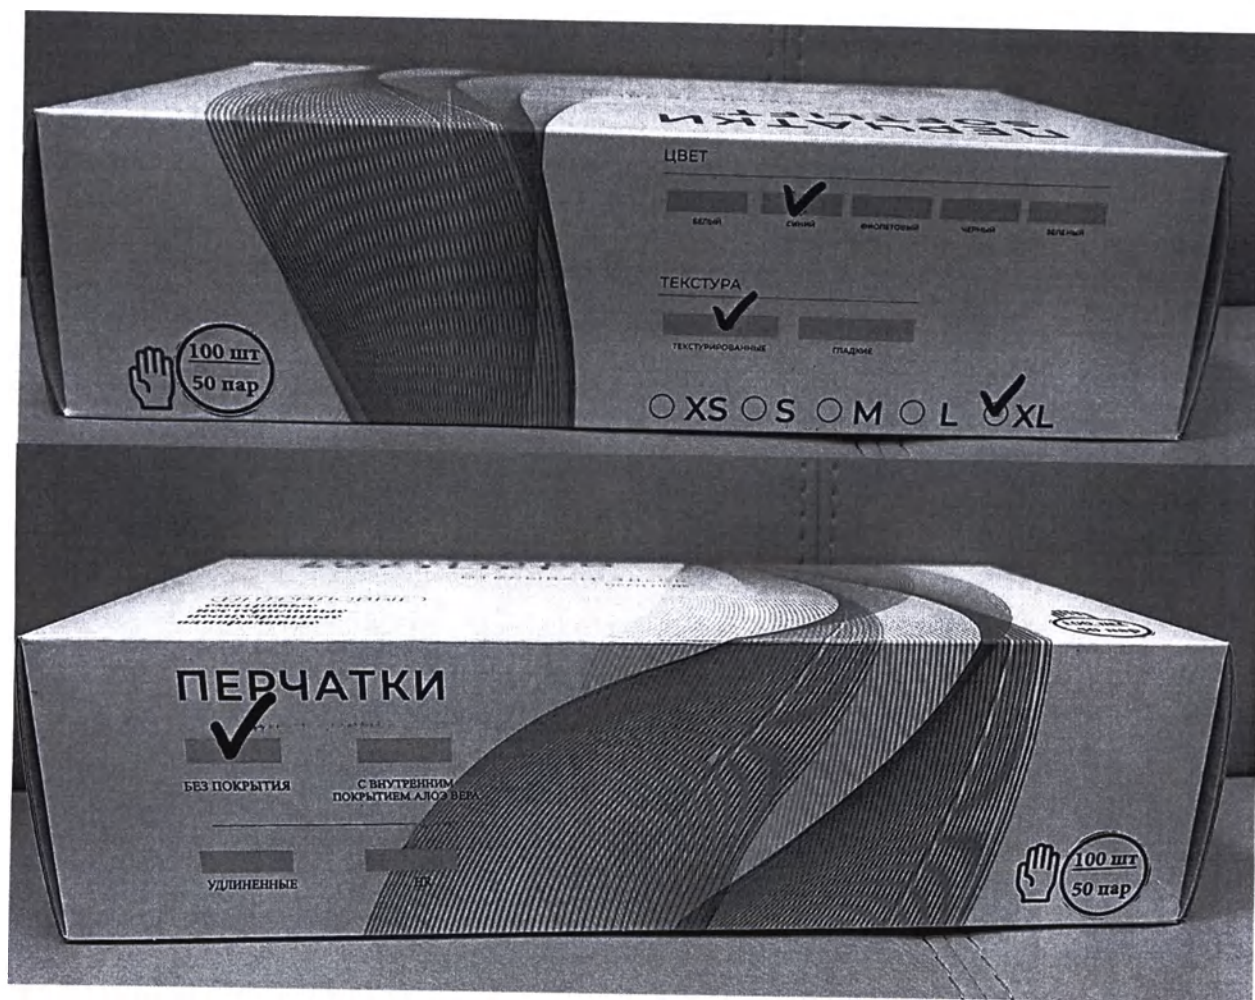

8. Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift<sup>®</sup> неопудренные текстурированные, цвет фиолетовый, размер: XS, S, M, L, XL



Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift<sup>®</sup>  
по ТУ 22.19.60-002-06663635-2022 в вариантах исполнения, партия 164001, 164002, 164003

Регистрационное удостоверение  
ГОСТ Р 52239

LOT 164002

Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85

Условия утилизации: Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). Нестерилизованные изделия (не имеющие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

02.2022

Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускаются привлеченные лица, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

02.2027

Производитель: ООО «СОФТИЛIFT», 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, оф. 224  
Места производства:

1. ООО «СОФТИЛIFT», Россия, 123423, Москва, ул. Народного ополчения, д.34, стр.2, офис 224.
2. Армянский филиал ОП ООО «СМД», Тбилиское шоссе /29/38 Канакер-Зейтун 0091, Ереван, Армения
3. ООО «СОФТИЛIFT», ДНР, г. Донецк, ул. Потийская, д. 89

Тел.: +7(499) 192-81-83, +7 (499) 197 32-71  
E-mail: gskmed@bk.ru





9. Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift<sup>®</sup> неопудренные текстурированные, цвет черный, размер: XS, S, M, L, XL



Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift<sup>®</sup>  
по ТУ 22.19.60-002-06663635-2022 в вариантах исполнения, партия 164001, 164002, 164003

Регистрационное удостоверение  
ГОСТ Р 52239

LOT

164003

Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85

Условия утилизации: Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). Непосредственные изделия (не имеющие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Сильными отходами различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к эпидемиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших респираторный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

02.2022

02.2022

02.2027

02.2027

Производитель: ООО «СОФТИЛIFT», 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, оф. 224  
Место производства:

1. ООО «СОФТИЛIFT», Россия, 123423, Москва, ул. Народного ополчения, д.34, стр.2, офис 224.  
2. Армянский филиал ОП ООО «СМД», Тбилиское шоссе /2938 Канавер-Зейтун 0091, Ереван, Армения  
3. ООО «СОФТИЛIFT», ДНР, г. Донецк, ул. Потийская, д. 89

Тел.: +7(499) 192-81-83, +7(499) 197-32-71  
E-mail: gskmed@bk.ru





10. Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift<sup>®</sup> неопудренные текстурированные, цвет зеленый, размер: XS, S, M, L, XL



Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift<sup>®</sup>  
по ТУ 22.19.60-002-06663635-2022 в вариантах исполнения, партия 164001, 164002, 164003

Регистрационное удостоверение  
ГОСТ Р 52239

LOT 164003

02.2022

02.2027

Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85

Условия утилизации: Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). Непосредственно после использования (не имеющие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).


Предупреждение: Смешивание отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к биологическим опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускаются привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Производитель: ООО «СОФТИЛIFT», 123423, г. Москва, ул. Народного ополчения, д. 34, стр. 2, оф. 224  
Место производства:

1. ООО «СОФТИЛIFT», Россия, 123423, Москва, ул. Народного ополчения, д. 34, стр. 2, офис 224.  
2. Армянский филиал ОП ООО «СМД», Тбилисское шоссе/2938 Каналер-Зейтун 0091, Ереван, Армения  
3. ООО «СОФТИЛIFT», ДНР, г. Донецк, ул. Петийская, д. 89

Тел.: +7(499) 192-81-83, +7 (499) 197-32-71  
E-mail: jpkmed@bk.ru



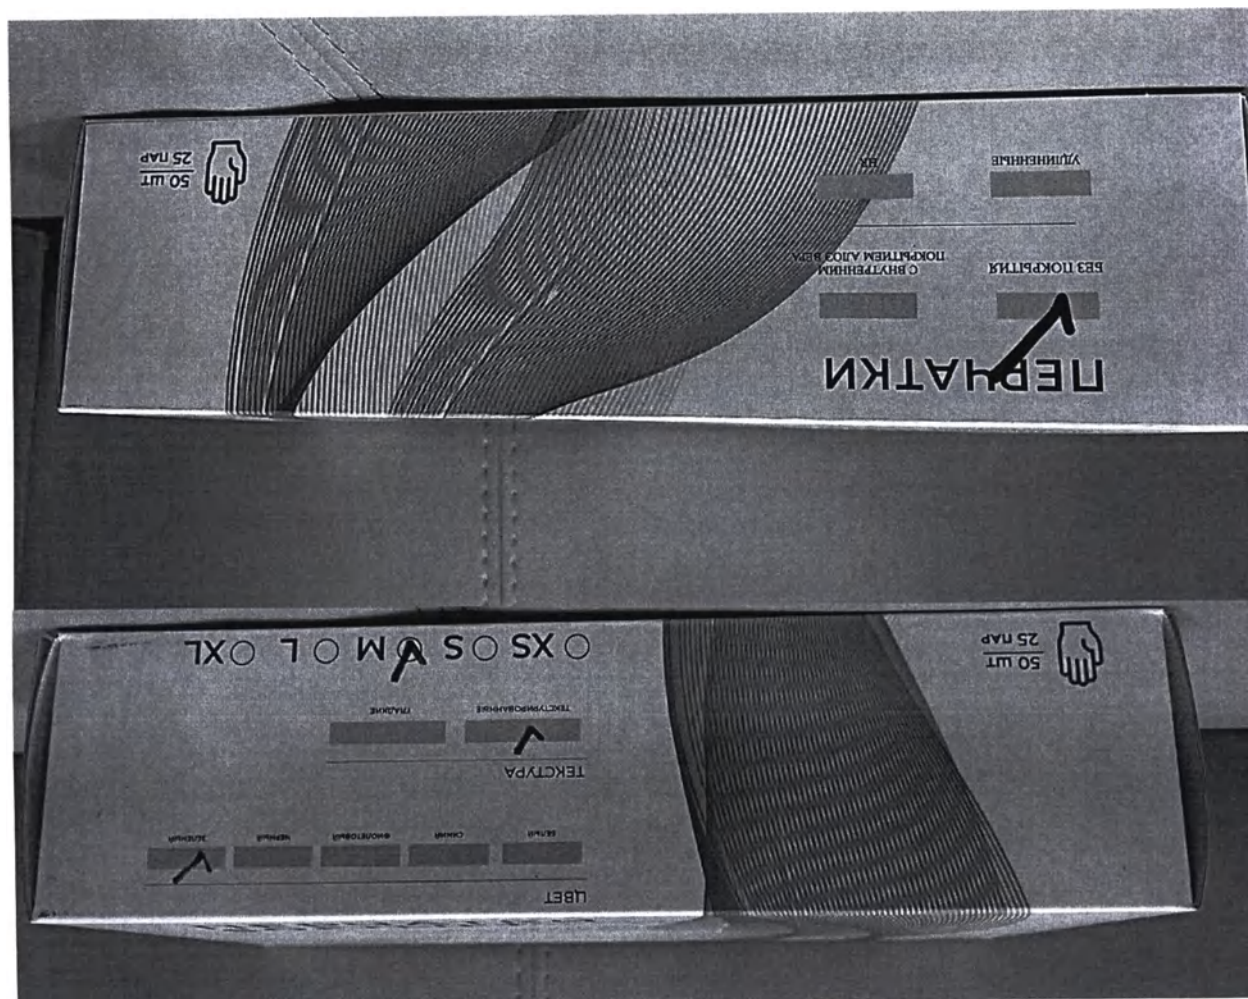

11. Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift  
 • неопудренные текстурированные High Risk, цвет синий, размер: XS, S, M, L, XL



Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift ®  
 по ТУ 22.19.60-002-06663635-2022 в вариантах исполнения, партии 164001, 164002, 164003

Регистрационное удостоверение  
 ГОСТ Р 52239

LOT 164003

02.2022

02.2027

Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85%  
 Условия утилизации: Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). Неполноценные изделия (не имеющие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).  
 Предупреждение: Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо. Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к экологобиологически опасным отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с экологобиологическими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших обязательный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Производитель: ООО «СОФТИЛФТ», 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, оф. 224  
 Место производства:  
 1. ООО «СОФТИЛФТ», Россия, 123423, Москва, ул. Народного ополчения, д.34, стр.2, офис 224.  
 2. Армзский филиал ОП ООО «СМД», Тбилисское шоссе /29/38 Калакер-Зейтун 0091, Ереван, Армения  
 3. ООО «СОФТИЛФТ», ДНР, г. Донецк, ул. Потайская, д. 89

Тел.: +7(499) 192-81-83, +7 (499) 197-32-71  
 E-mail: gskmed@bk.ru





12. Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift<sup>®</sup> неопудренные текстурированные удлиненные, цвет синий, размер: XS, S, M, L, XL





# ПЕРЧАТКИ SOFTLIFT®

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

OPEN HERE

НИТРИЛОВЫЕ

смотровые  
нестерильные  
неопудренные  
одноразовые  
перчатки диагностические



Перчатки смотровые медицинские одноразовые нитриловые нестерильные SoftLift® по ТУ 22.19.60-002-06663635-2022 в вариантах исполнения, партия 164001, 164002, 164003

Регистрационное удостоверение  
ГОСТ Р 52239

LOT 164003

02.2022

02.2027

Условия хранения: при температуре от 0°C до плюс 30°C, при влажности не более 85

Условия утилизации: Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс Б). Ненасыщенные изделия (не имеющие контакта с кровью и/или с биологическими жидкостями), в том числе с истекшим сроком годности, подлежат утилизации и/или уничтожению согласно СанПиН 2.1.3684-21 (класс А).

Предупреждение: Смешивание отходов различных классов и общей емкости недопустимо. Изделия, имеющие контакт с кровью и/или другими биологическими жидкостями, относятся к биологическим отходам и могут быть потенциально инфицированы. К работам по обращению с медицинскими отходами не допускаются привлеченные лица, не прошедшие специальное обучение по безопасному обращению с медицинскими отходами.

Производитель: ООО «СОФТЛИФТ», 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 2, оф. 224  
Место производства:

1. ООО «СОФТЛИФТ», Россия, 123423, Москва, ул. Народного ополчения, д.34, стр.2, оф. 224  
2. Армянская филиал ОП ООО «СМД», Тбилисское шоссе /39/38 Каналер-Зейтун 0091, Ереван, Армения  
3. ООО «СОФТЛИФТ», ДНР, г. Донецк, ул. Потайская, д. 89

Тел.: +7(499) 192-81-83, +7 (499) 197 32-71  
E-mail: gskmed@bk.ru



## ПЕРЧАТКИ

БЕЗ ПОКРЫТИЯ

С ВНУТРИШНИМ  
ПОКРЫТИЕМ ЛЮБОЙ ВЕРС

УДЛИНЕННЫЕ



ЦВЕТ

БЕЛЫЙ

СИНИЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ

ЧЕРНЫЙ

ЗЕЛЕНЫЙ


ТЕКСТУРА

ТЕКСТУРИРОВАННЫЕ

ПЛАДКЕ

XS S M L XL

## Транспортная упаковка

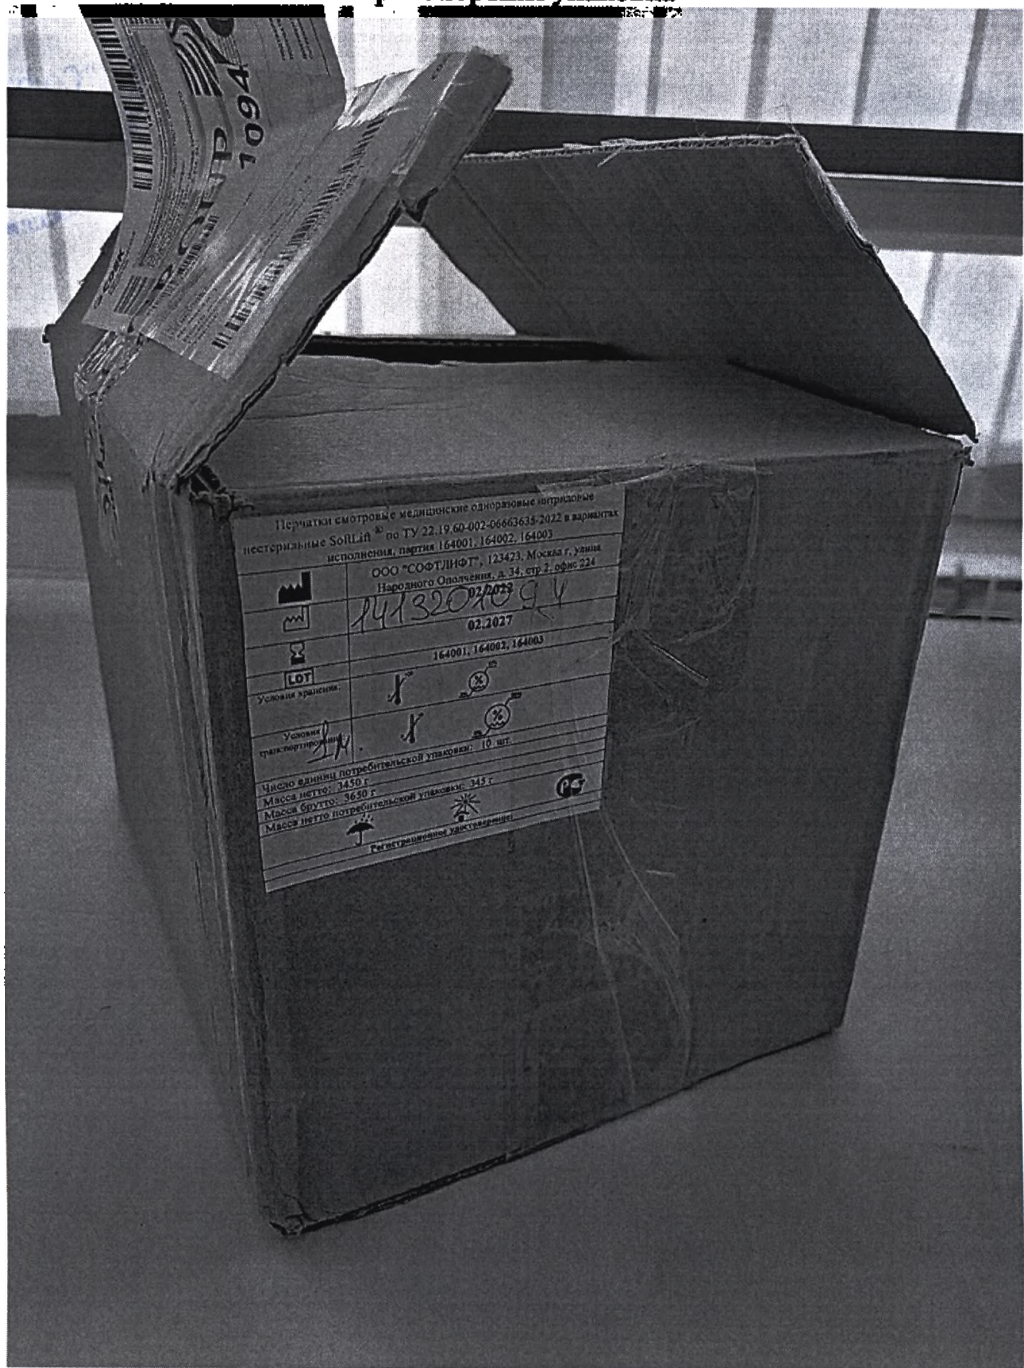

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 26 листа(ов)

Генеральный директор ООО «СОФТЛИФТ»

Т. А. Никифорова

