


Стенты мочеточниковые в вариантах исполнения

Маркировка индивидуальной упаковки Варианта исполнения 1
Стент мочеточниковый двухпетлевой с двумя открытыми концами,
длина 26 см, диаметр 4,7 Fr IVX-UT-01-472610



Стент мочеточниковый двухпетлевой с двумя открытыми концами, длина 26 см, диаметр 4,7 Fr IVX-UT-01-472610

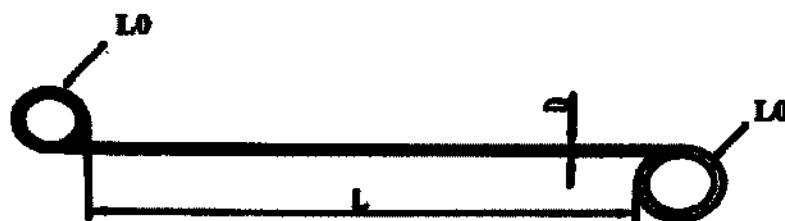

D – диаметр Ø1,56 мм (4,7 Fr), L – длина (260 мм), L0 – размер свернутой петли (19 мм)



ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД

Экспериментальная зона свободной торговли, дор. Цайлунь, №150, здание 7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай

Представитель производителя в РФ:

ООО «ЮМТЕКС СЕРВИС»:

644024, Омская обл., г. Омск, ул. Думская, д. 7, этаж 5, пом. 27,28

Тел. + 7 (495) 649-63-53, e-mail: info-service@umetex.com

Нетоксично

REF



РУ

LOT



Дата регистрации


STERILE



Маркировка потребительской упаковки Варианта исполнения 1
Стент мочеточниковый двухпетлевой с двумя открытыми концами,
длина 26 см, диаметр 4,7 Fr IVX-UT-01-472610



Стент мочеточниковый двухпетлевой с двумя открытыми концами, длина 26 см, диаметр 4,7 Fr IVX-UT-01-472610

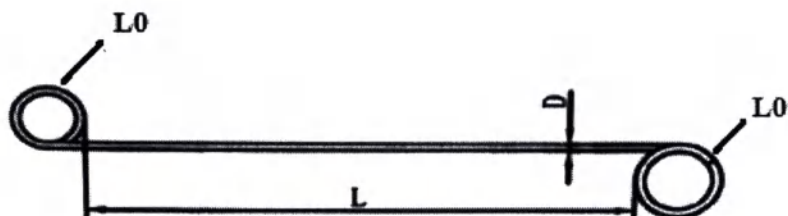

D – диаметр Ø1,56 мм (4,7 Fr), L – длина (260 мм), L0 – размер свернутой петли (19 мм)



ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД
(INNOVEX MEDICAL CO., LTD.)

Экспериментальная зона свободной торговли, дор. Цайлунь, №150, здание 7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай

Представитель производителя в РФ:

ООО «ЮМЕТЕКС СЕРВИС»:


644024, Омская обл., г. Омск, ул. Думская, д. 7, этаж 5, пом. 27,28

Тел. + 7 (495) 649-63-53, e-mail: info-service@umetex.com

В составе:

- 1) Стент мочеточниковый – 5 шт.,
- 2) Толкатель – 5 шт.,
- 3) Инструкция по применению – 1 шт.




Нетоксично



РУ



Дата регистрации




Маркировка транспортной упаковки Варианта исполнения 1

**Стент мочеточниковый двухпетлевой с двумя открытыми концами,
длина 26 см, диаметр 4,7 Fr IVX-UT-01-472610**



**Стент мочеточниковый двухпетлевой с двумя открытыми
концами, длина 26 см, диаметр 4,7 Fr IVX-UT-01-472610**

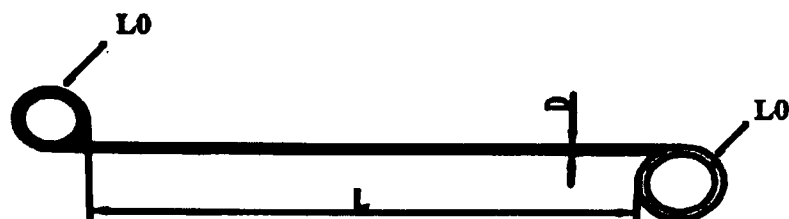

D – диаметр Ø1,56 мм (4,7 Fr), L – длина (260 мм), L0 – размер
свернутой петли (19 мм)



ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД
(INNOVEX MEDICAL CO., LTD.)

Экспериментальная зона свободной торговли, дор. Цайлунь, №150, здание
7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай

Представитель производителя в РФ:

ООО «ЮМЕТЕКС СЕРВИС»:

644024, Омская обл., г. Омск, ул. Думская, д. 7, этаж 5, пом. 27,28

Тел. + 7 (495) 649-63-53, e-mail: info-service@umetex.com

20 уп.

Нетоксично

REF




РУ

LOT




Дата регистрации



Маркировка индивидуальной упаковки Варианта исполнения 2
Стент мочеточниковый двухпетлевой с двумя открытыми концами,
длина 26 см, диаметр 6 Fr IVX-UT-01-602610



Стент мочеточниковый двухпетлевой с двумя открытыми концами, длина 26 см, диаметр 6 Fr IVX-UT-01-602610

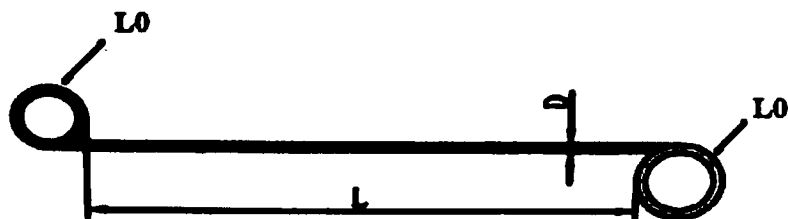

D – диаметр Ø2,00 (6 Fr), L – длина (260 мм), L0 – размер свернутой петли (19 мм)



ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД
(INNOVEX MEDICAL CO., LTD.)

Экспериментальная зона свободной торговли, дор. Цайлунь, №150, здание 7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай

Представитель производителя в РФ:

ООО «ЮМТЕКС СЕРВИС»:

644024, Омская обл., г. Омск, ул. Думская, д. 7, этаж 5, пом. 27,28

Тел. + 7 (495) 649-63-53, e-mail: info-service@umetex.com


Нетоксично



РУ




Дата регистрации



Маркировка потребительской упаковки Варианта исполнения 2
Стент мочеточниковый двухпетлевой с двумя открытыми концами,
длина 26 см, диаметр 6 Fr IVX-UT-01-602610



Стент мочеточниковый двухпетлевой с двумя открытыми концами, длина 26 см, диаметр 6 Fr IVX-UT-01-602610

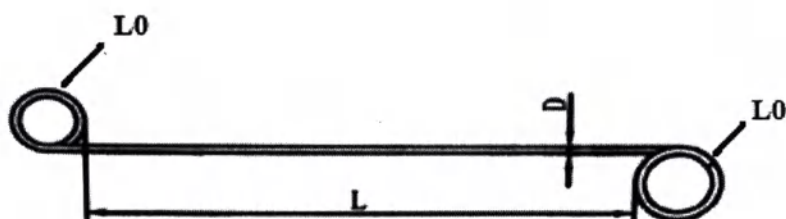

D – диаметр Ø2,00 (6 Fr), L – длина (260 мм), L0 – размер свернутой петли (19 мм)



ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД
(INNOVEX MEDICAL CO., LTD.)

Экспериментальная зона свободной торговли, дор. Цайлунь, №150, здание 7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай

Представитель производителя в РФ:

ООО «ЮМЕТЕКС СЕРВИС»:


644024, Омская обл., г. Омск, ул. Думская, д. 7, этаж 5, пом. 27,28

Тел. + 7 (495) 649-63-53, e-mail: info-service@umetex.com

В составе:

- 1) Стент мочеточниковый – 5 шт.,
- 2) Толкатель – 5 шт.,
- 3) Инструкция по применению – 1 шт.



Нетоксично



РУ



Дата регистрации



Маркировка транспортной упаковки Варианта исполнения 2
Стент мочеточниковый двухпетлевой с двумя открытыми концами,
длина 26 см, диаметр 6 Fr IVX-UT-01-602610



Стент мочеточниковый двухпетлевой с двумя открытыми концами, длина 26 см, диаметр 6 Fr IVX-UT-01-602610



D – диаметр Ø2,00 (6 Fr), L – длина (260 мм), L0 – размер свернутой петли (19 мм)



ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД
(INNOVEX MEDICAL CO., LTD.)

Экспериментальная зона свободной торговли, дор. Цайлунь, №150, здание 7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай

Представитель производителя в РФ:

ООО «ЮМТЕКС СЕРВИС»:

644024, Омская обл., г. Омск, ул. Думская, д. 7, этаж 5, пом. 27,28

Тел. + 7 (495) 649-63-53, e-mail: info-service@umetex.com

20 уп.


Нетоксично



РУ



Дата регистрации




**Итоговый вариант этикетки может быть изменен по усмотрению производителя.*

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6 листов.

Генеральный директор
ООО «Юметекс Сервис»
_____ Воронкин М.О.



Фотографические изображения медицинского изделия на примере Варианта исполнения 1
Стент мочеточниковый двухпетлевой с двумя открытыми концами,
длина 26 см, диаметр 4,7 Fr IVX-UT-01-472610

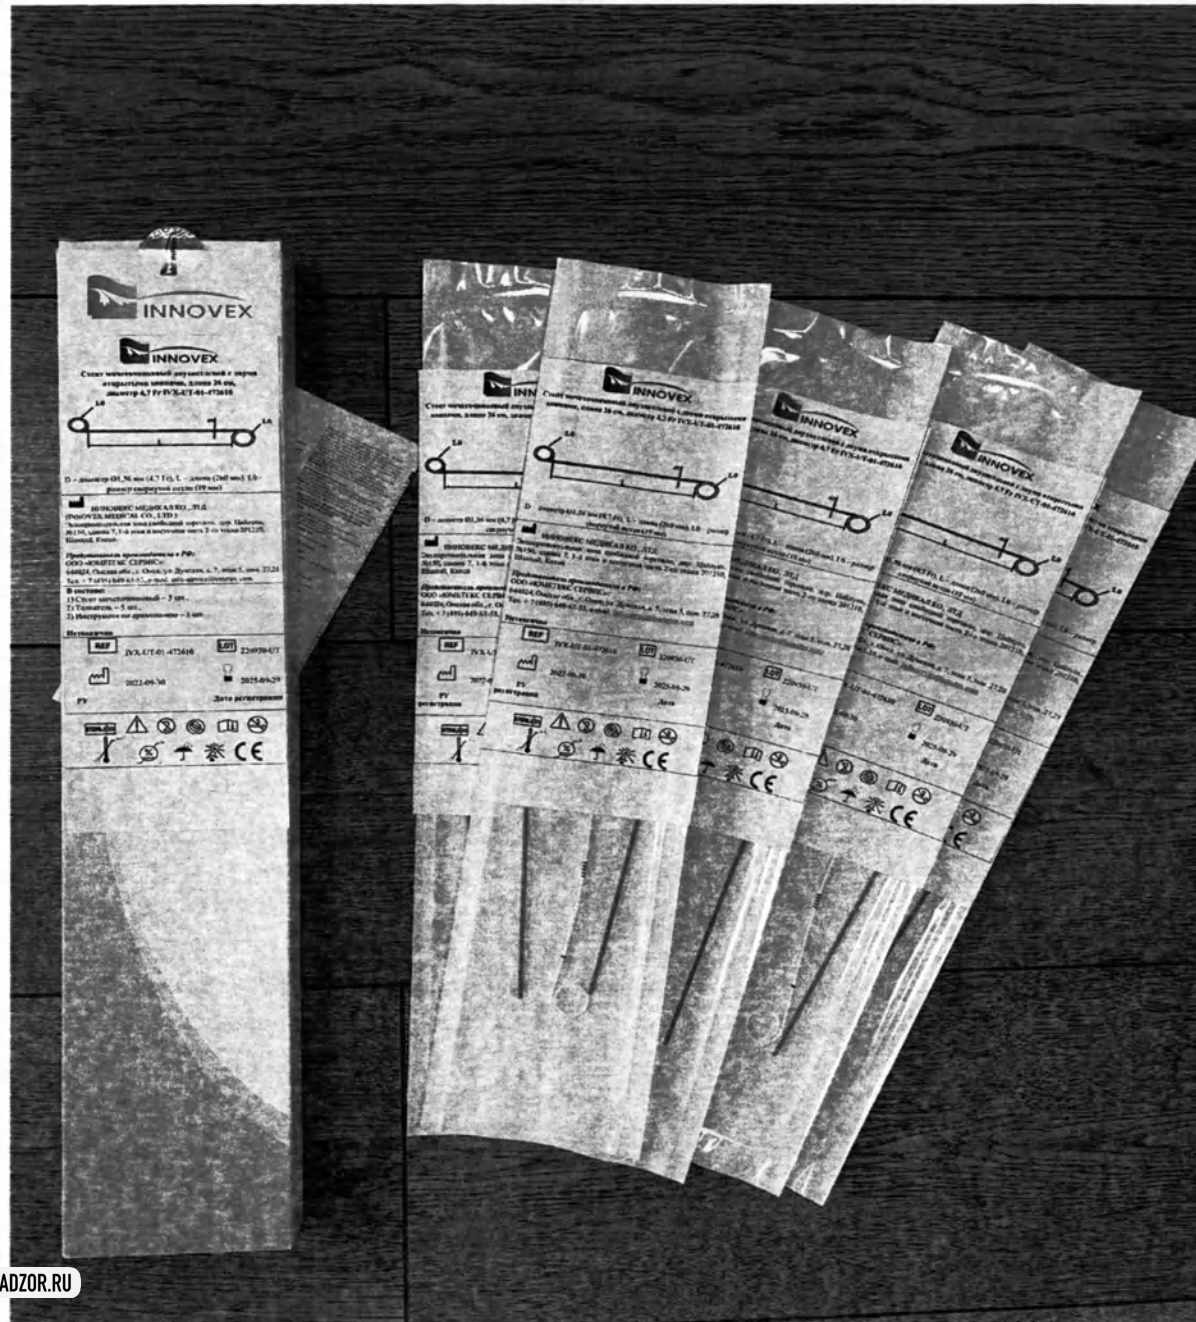

INNOVEX MEDICAL CO., LTD.



INNOVEX



INNOVEX

Стент мочеточниковый двухветлевой с двумя открытыми концами, длина 26 см, диаметр 4,7 Fr IVX-UT-01-472610



D – диаметр $\varnothing 1,56$ мм (4,7 Fr), L – длина (260 мм), L0 – размер свернутой петли (19 мм)

ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД
(INNOVEX MEDICAL CO., LTD.)
Защита интеллектуальной собственности: дор. Цайгуни,
№150, здание 7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201310,
Шанхай, Китай

Представитель производителя в РФ:
ООО «ЮМЕТРИКС СЕРВИС»:
644024, Омская обл., г. Омск, ул. Душманов, д. 7, этаж 5, пом. 27.28
Тел. +7 (495) 649-63-53, e-mail: info@yumetrix.ru

В составе:

- 1) Стент мочеточниковый – 5 шт.,
- 2) Толкатель – 5 шт.,
- 3) Инструкция по применению – 1 шт.

Идентификация

REF

IVX-UT-01-472610

LOT

220930-UT




2022-09-30



2023-09-29

РУ

Дата регистрации





Чистый инновационный индустриальный с антимикробными свойствами, длина 36 см, диаметр 4,7
Fr INX-UT-01-472418



D - диаметр Ø1,56 mm (4,7 Pt, L - длина (260 mm), L2 -
расстояние между отверстиями (19 mm)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ИРБИНСКИЙ КОД, АТЛ
Инновационная зона, производственная зона, ул. Удмуртская,
№158, здание 7, 1-й этаж в торгово-сервисном центре 3-го этажа 20118,
Ижевск, Киров

Организация, предоставляющая Р/Ф:
ООО «ОМЛЕТЕКС СЕРВИС»
644004, Омская обл., г. Омск, ул. Пушкина, д. 7, этаж 5, комната 2728
Тел. + 7 (493) 649-63-53, e-mail: info@omletex.com

Идентификация



INX-UT-01-472418

228703-01



2022-08-30

2025-08-29


Р/Ф

3078

сертификат







СЕРТИФИКАТ КОМПЕТЕНЦИИ
ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД.
ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД.
Заступник за качество: Лиана 26 см, диаметр 4,7 Фт. IVX-UT-01-472610



D - диаметр 01, 56 мм (4,7 Фт), L - длина (260 мм), L0 - диаметр
внутренний (19 мм)

ИННОВЕКС МЕДИКАЛ КО., ЛТД.
(INNOVEX MEDICAL CO., LTD.)

Заступник за качество: Лиана 26 см, диаметр 4,7 Фт. IVX-UT-01-472610
7, 1-й этаж и восточная часть 2-го этажа 201210, Шанхай, Китай

Присоединение к устройству в Род:

ООО «ИНОМЕТКС СЕРВИС»

644024, Омская обл., г. Омск, ул. Южная, д. 7, этаж 5, пом. 27, 28
Тел. +7 (495) 640-63-53, e-mail: info-service@innovex.com

20 лет

Нотариально

REF

IVX-UT-01-472610

LOT

220930-UT



2022-09-10

2025-09-29

PU

Дата регистрации

STERILE



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 6 листов.

Генеральный директор

ООО «Юметекс Сервис»

Воронкин М.О.

