УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

_____ Хусаинов М.Д.

«28» 07 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации 17-ОН-прогестерона в сыворотке (плазме) крови «17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ”
серия 1

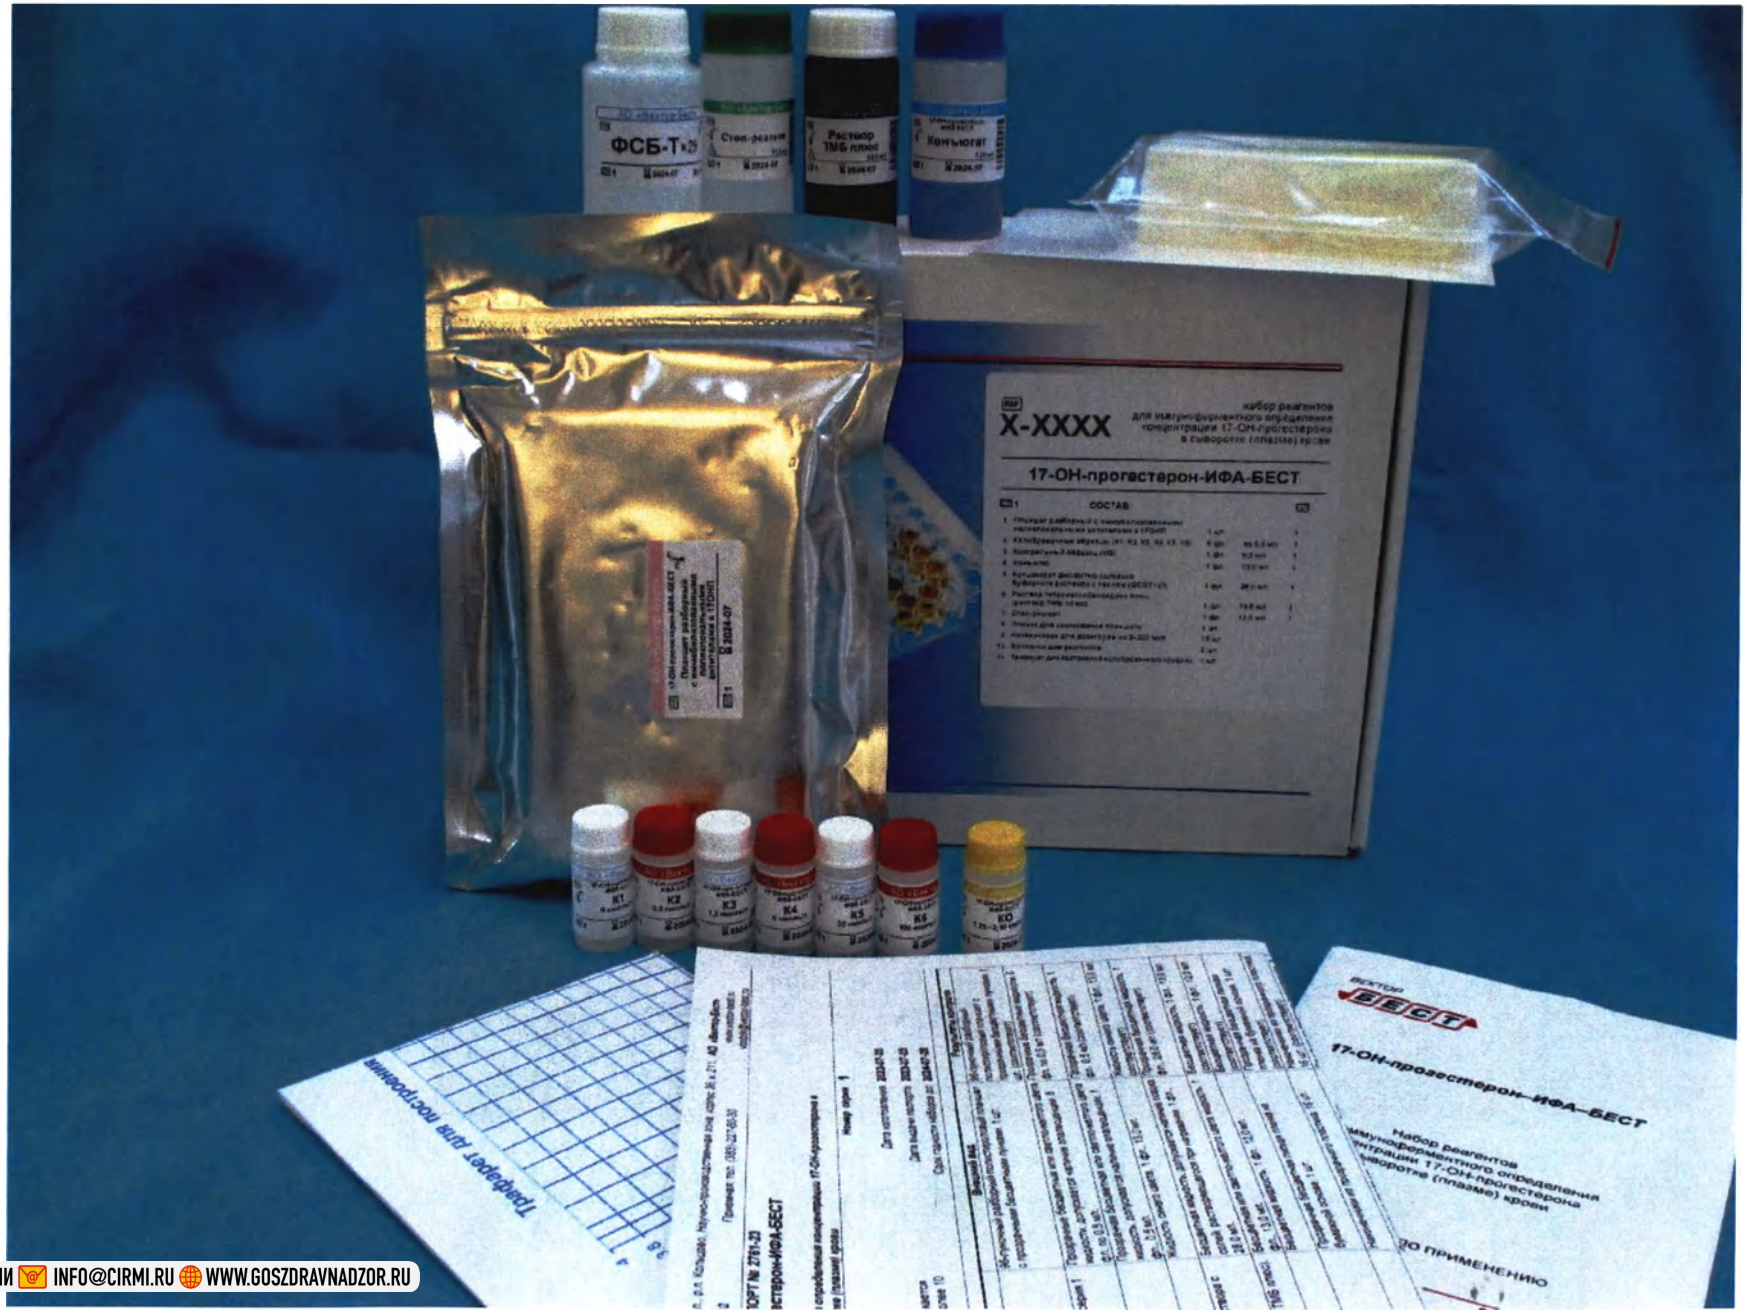

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 1
серия 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 2
серия 1

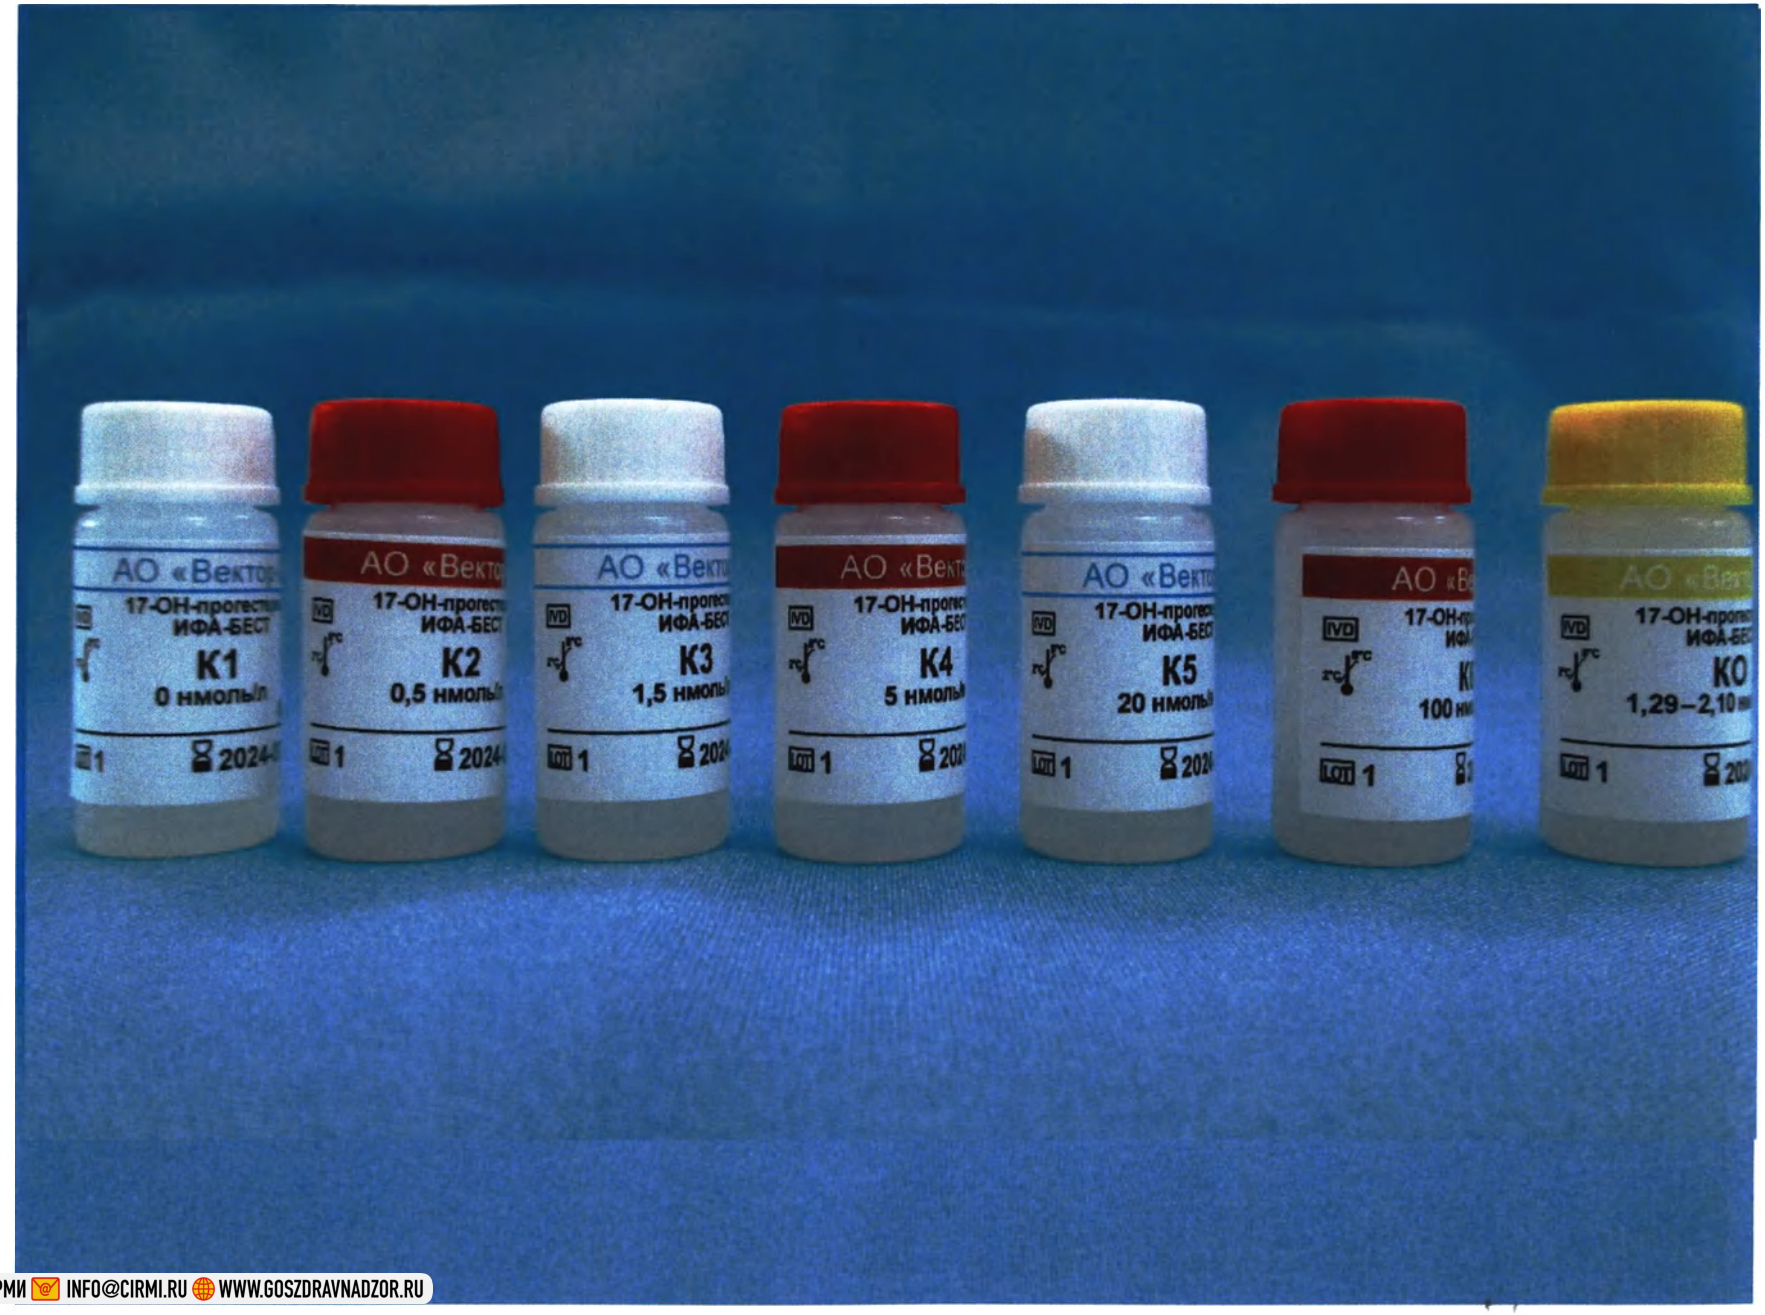

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 3
серия 1

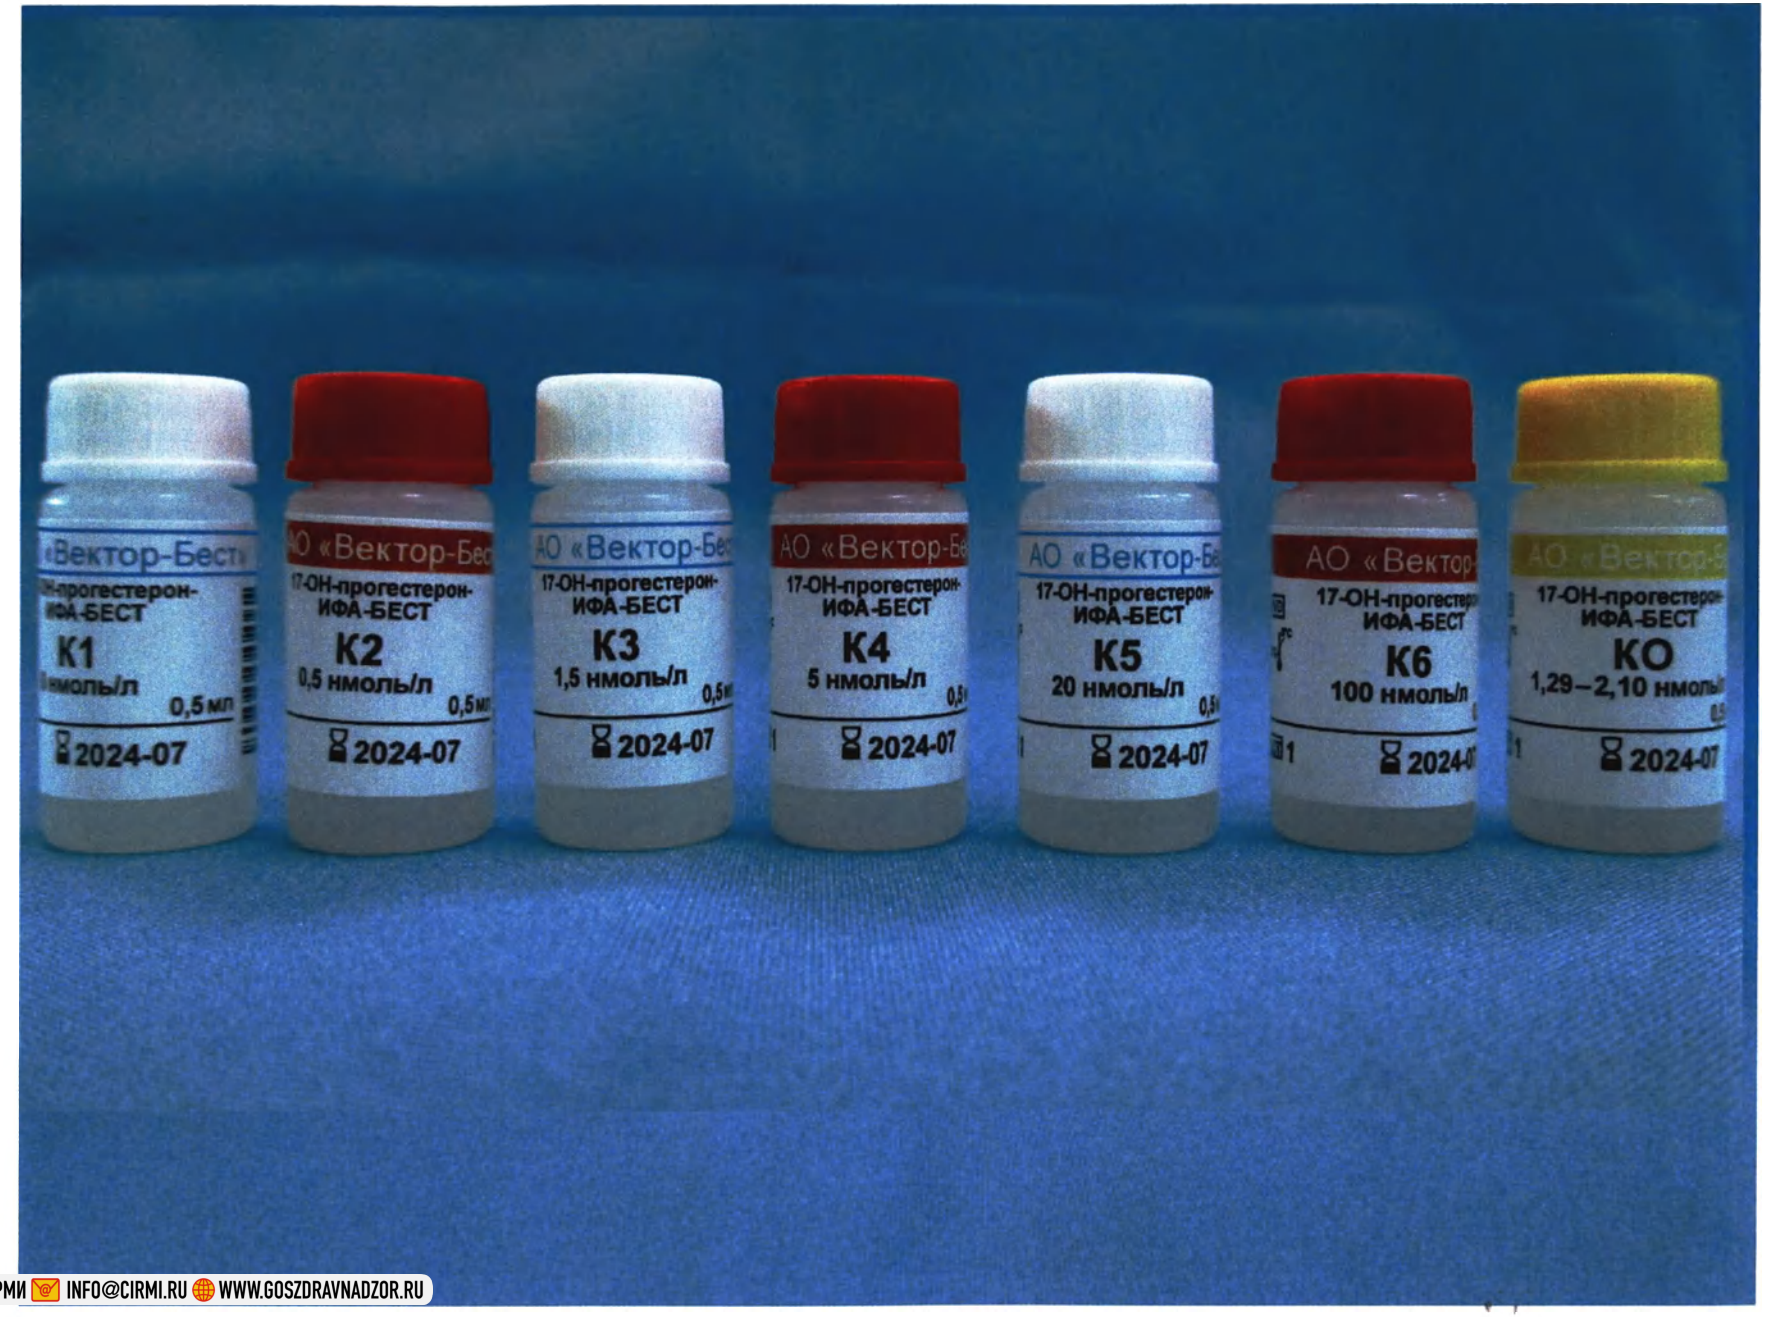

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 4
серия 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 5
серия 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 6
серия 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 7
серия 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 1
серия 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 2
серия 1

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 3
серия 1

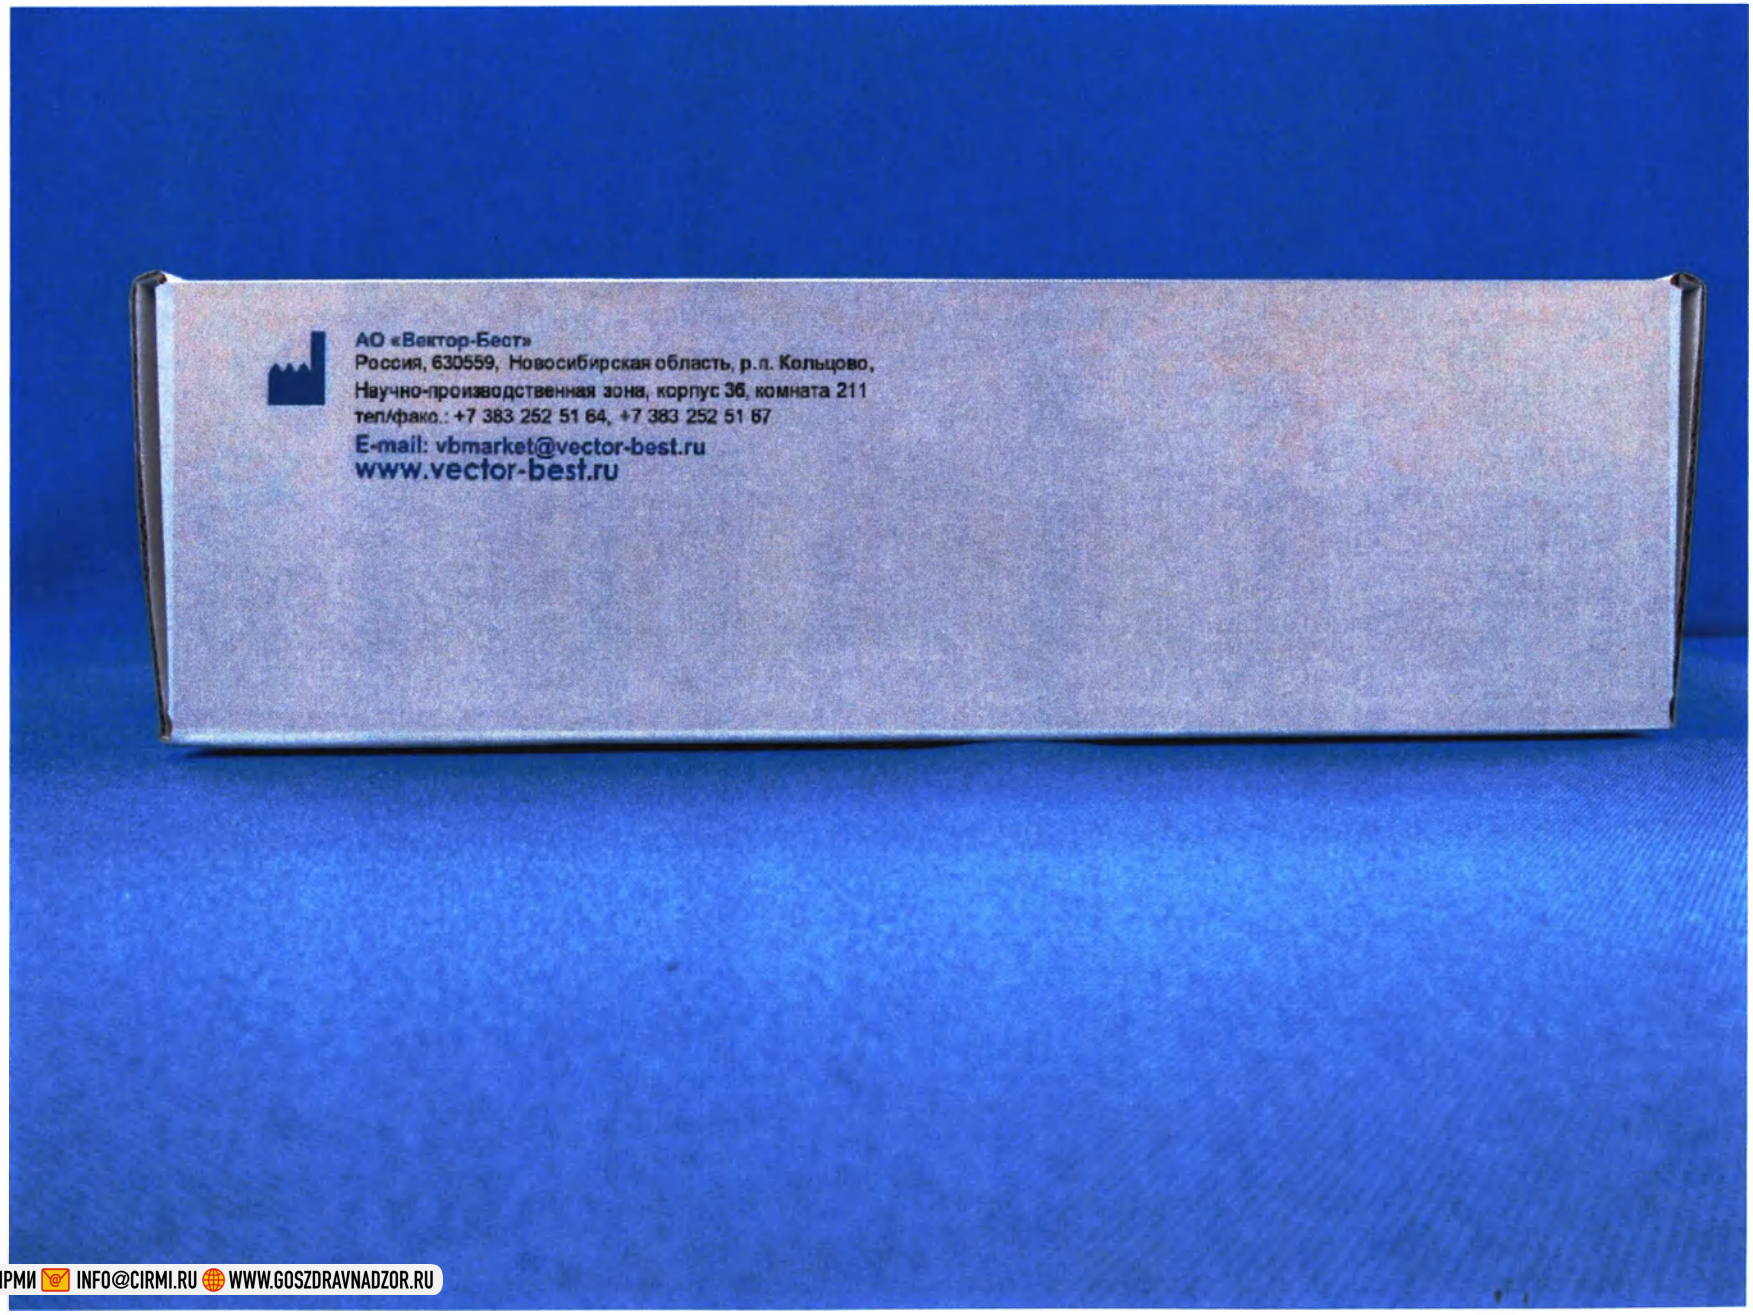

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ”
серия 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 1
серия 2

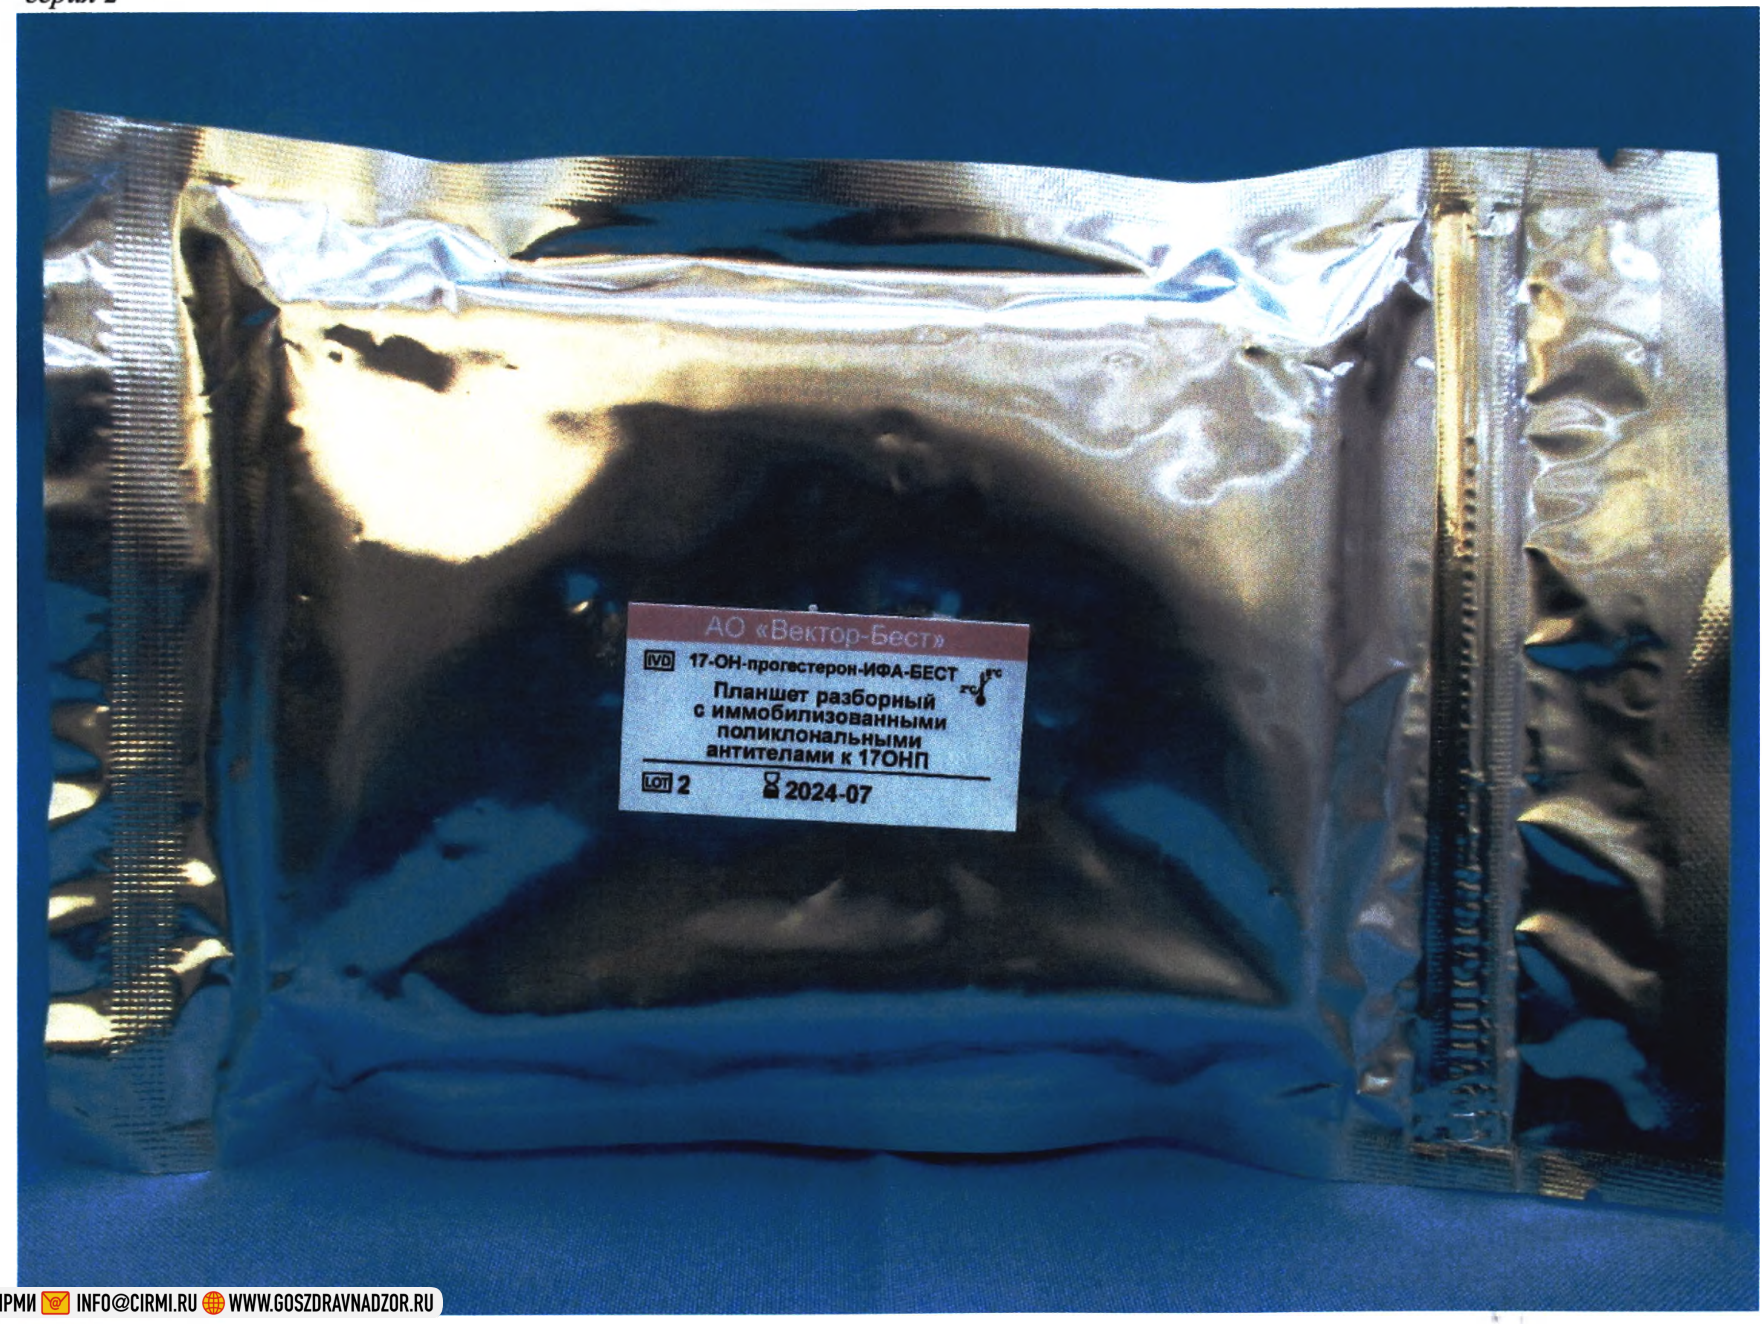

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 2
серия 2

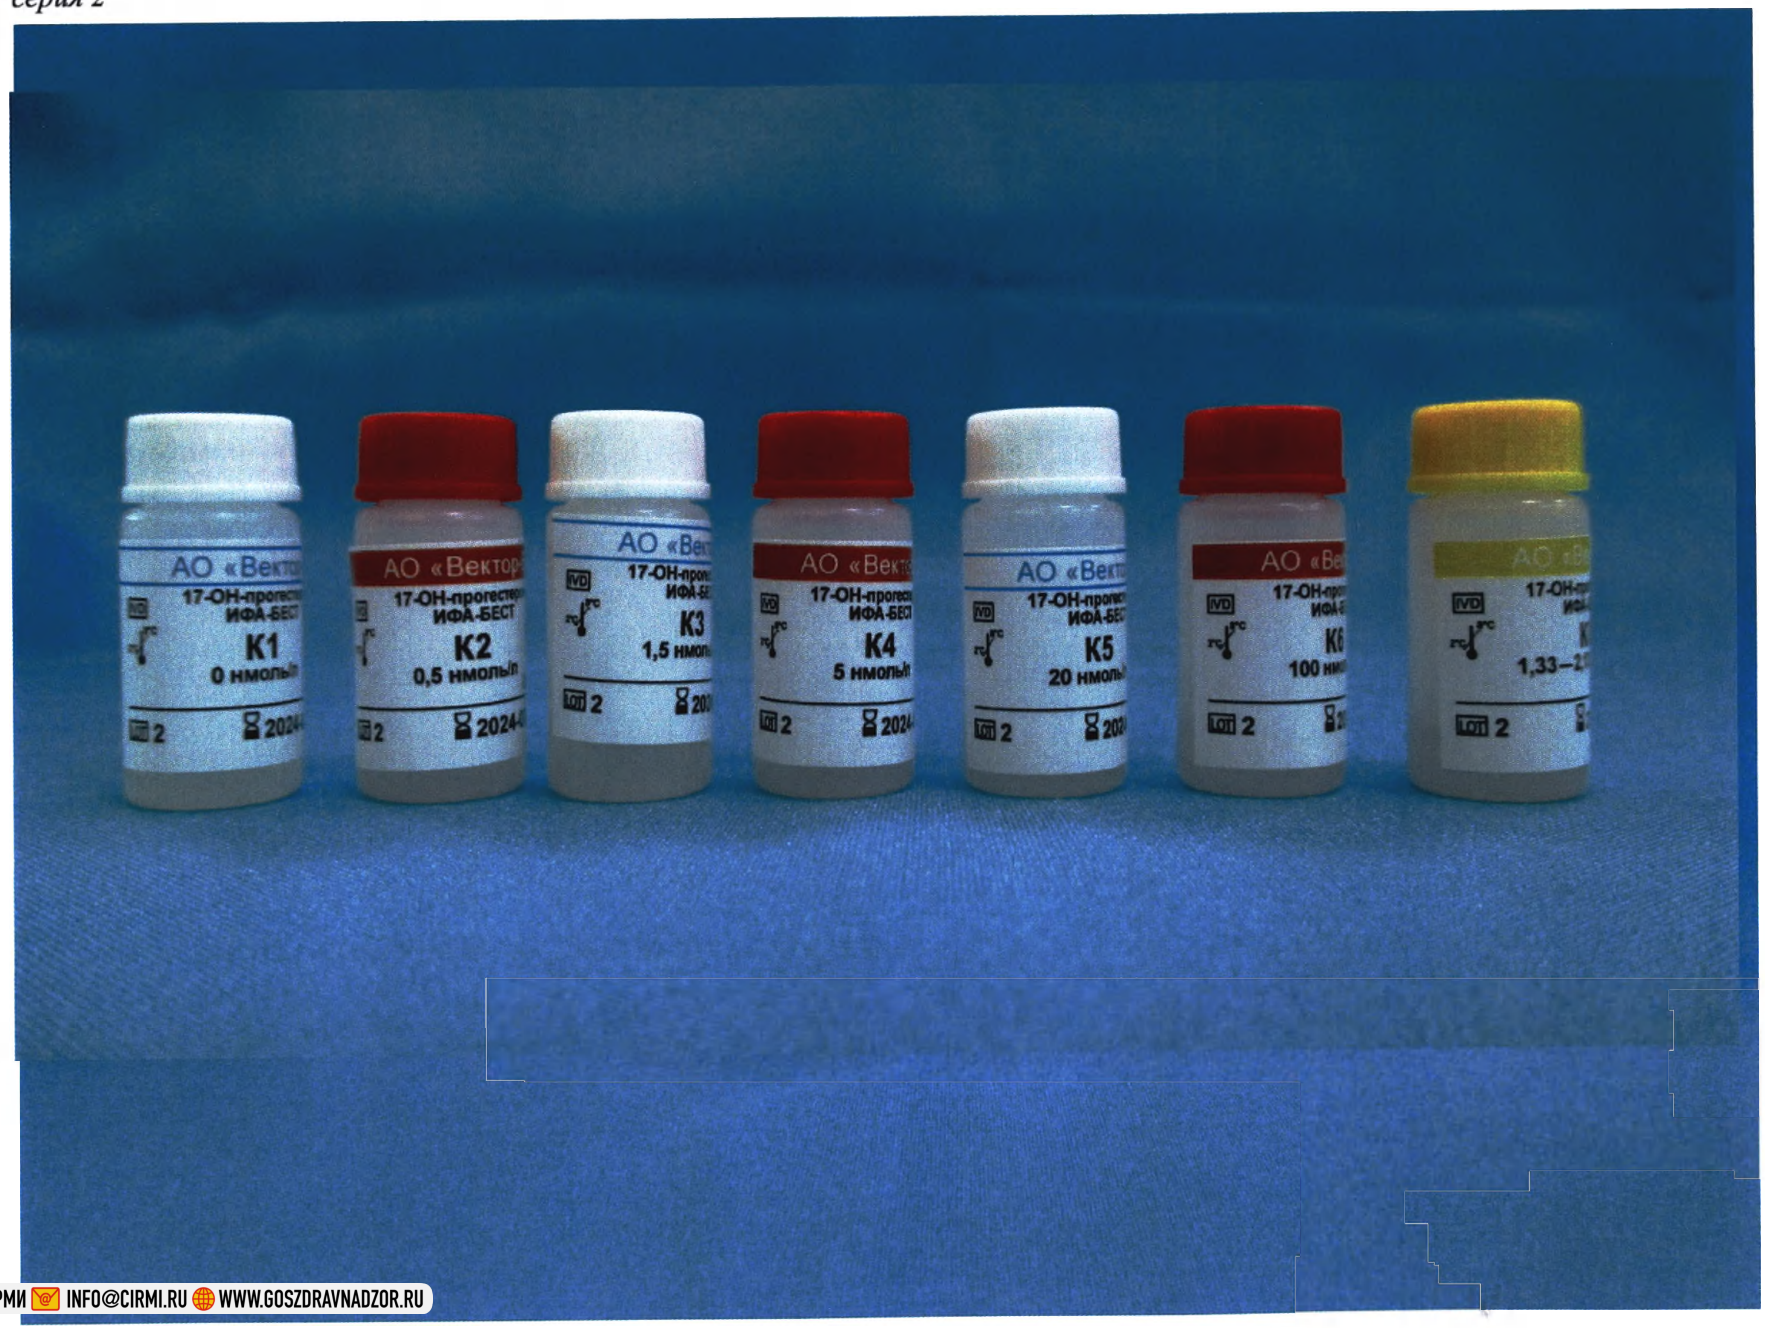

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 3
серия 2

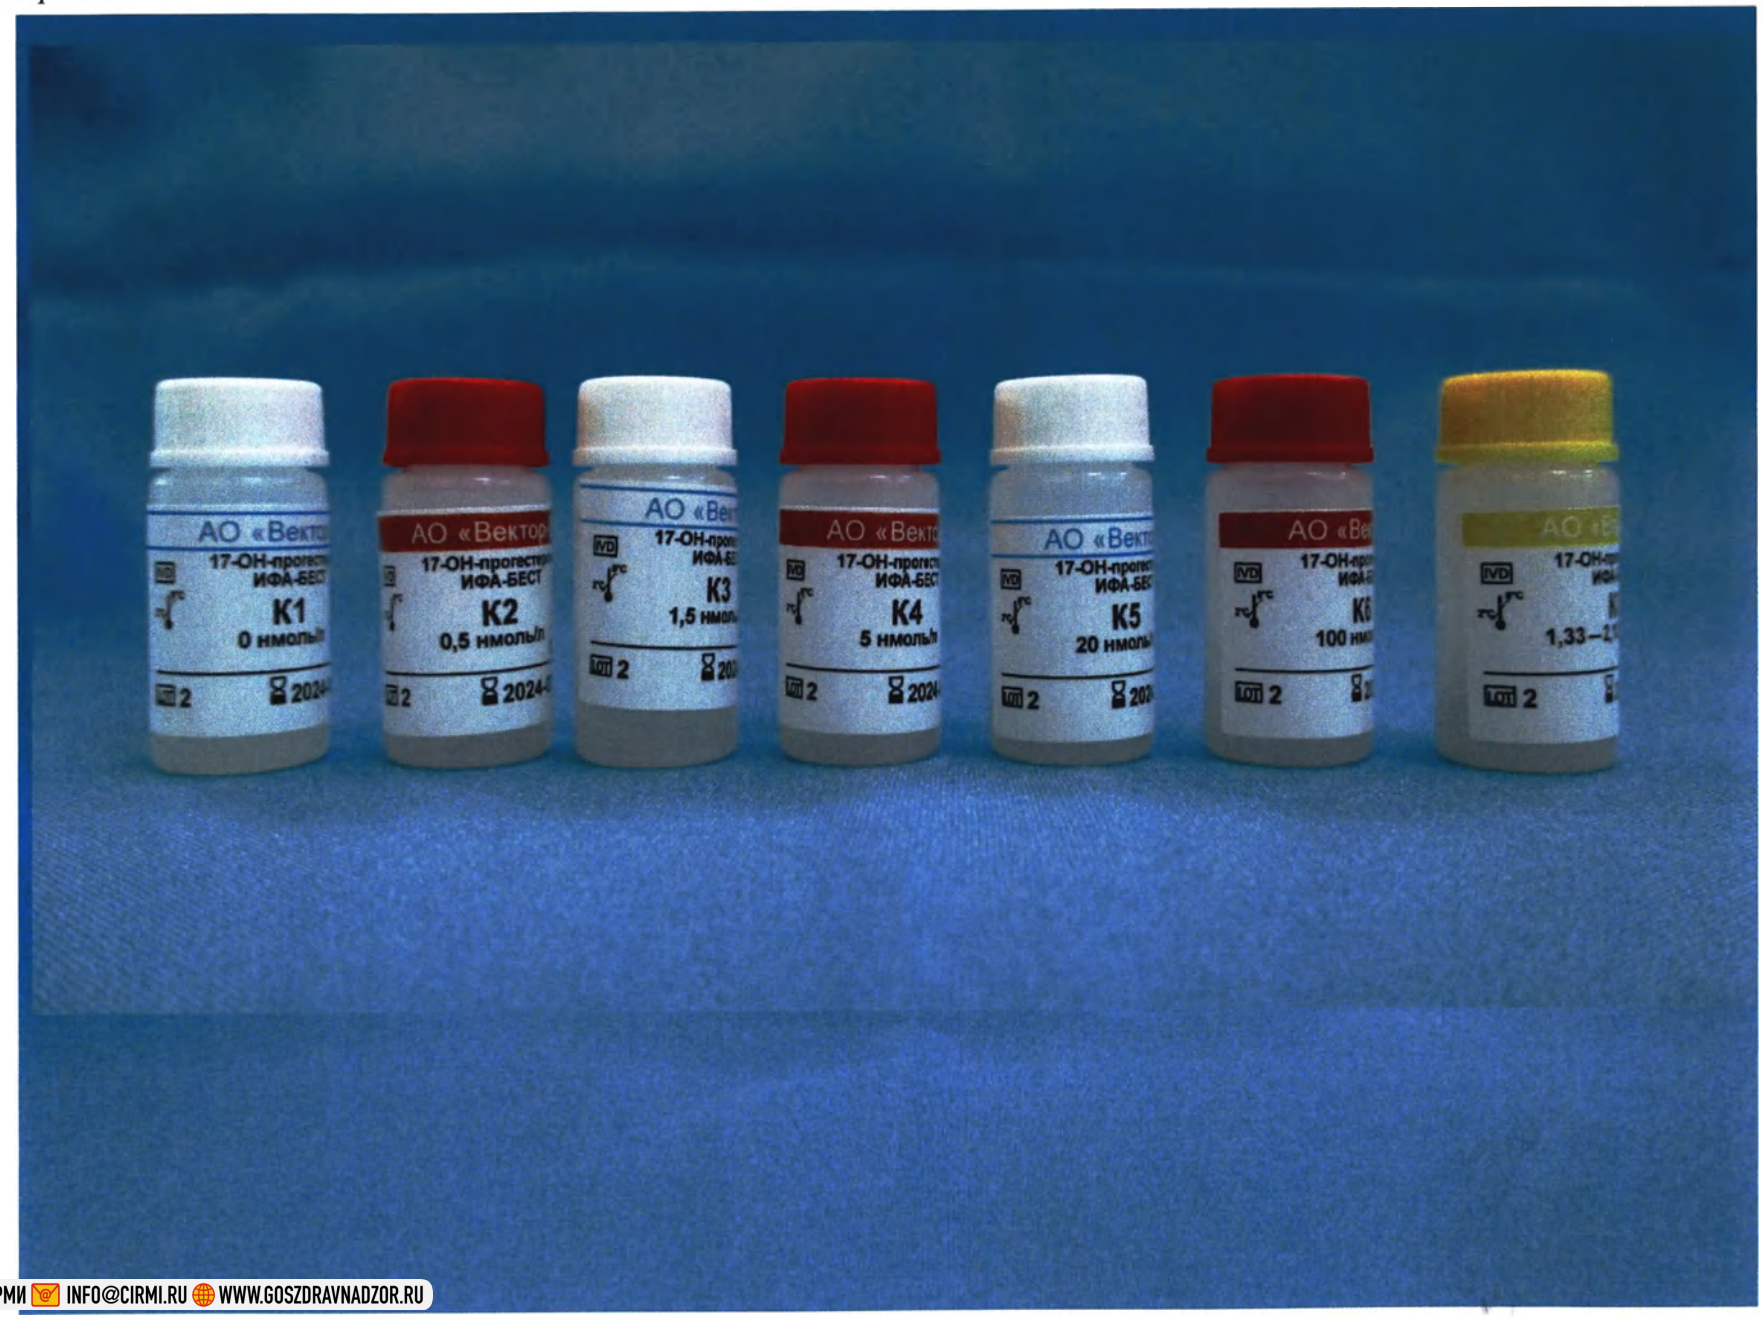

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 4
серия 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 5
серия 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 6
серия 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 7
серия 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 1
серия 2

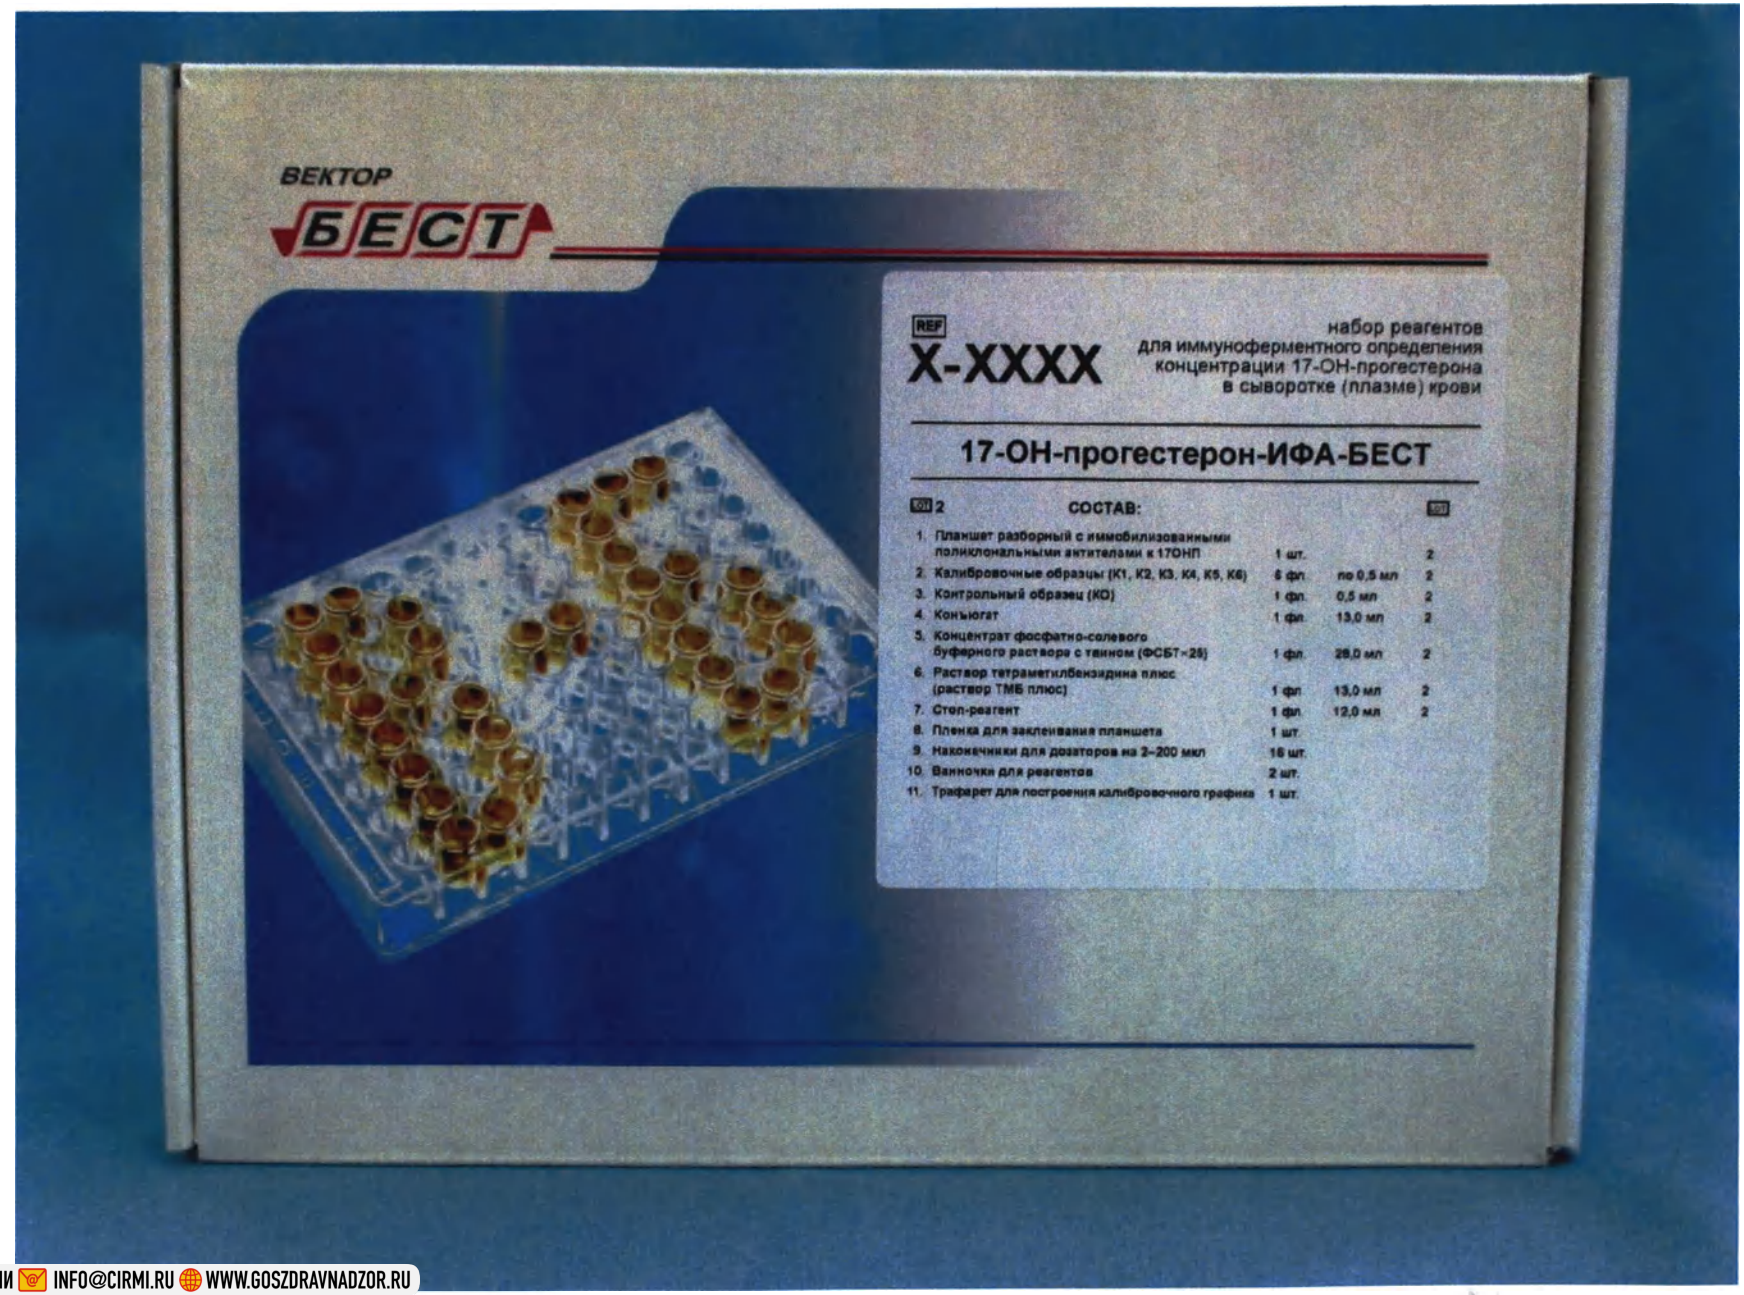

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 2
серия 2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“17-ОН-прогестерон–ИФА–БЕСТ” № 3
серия 2

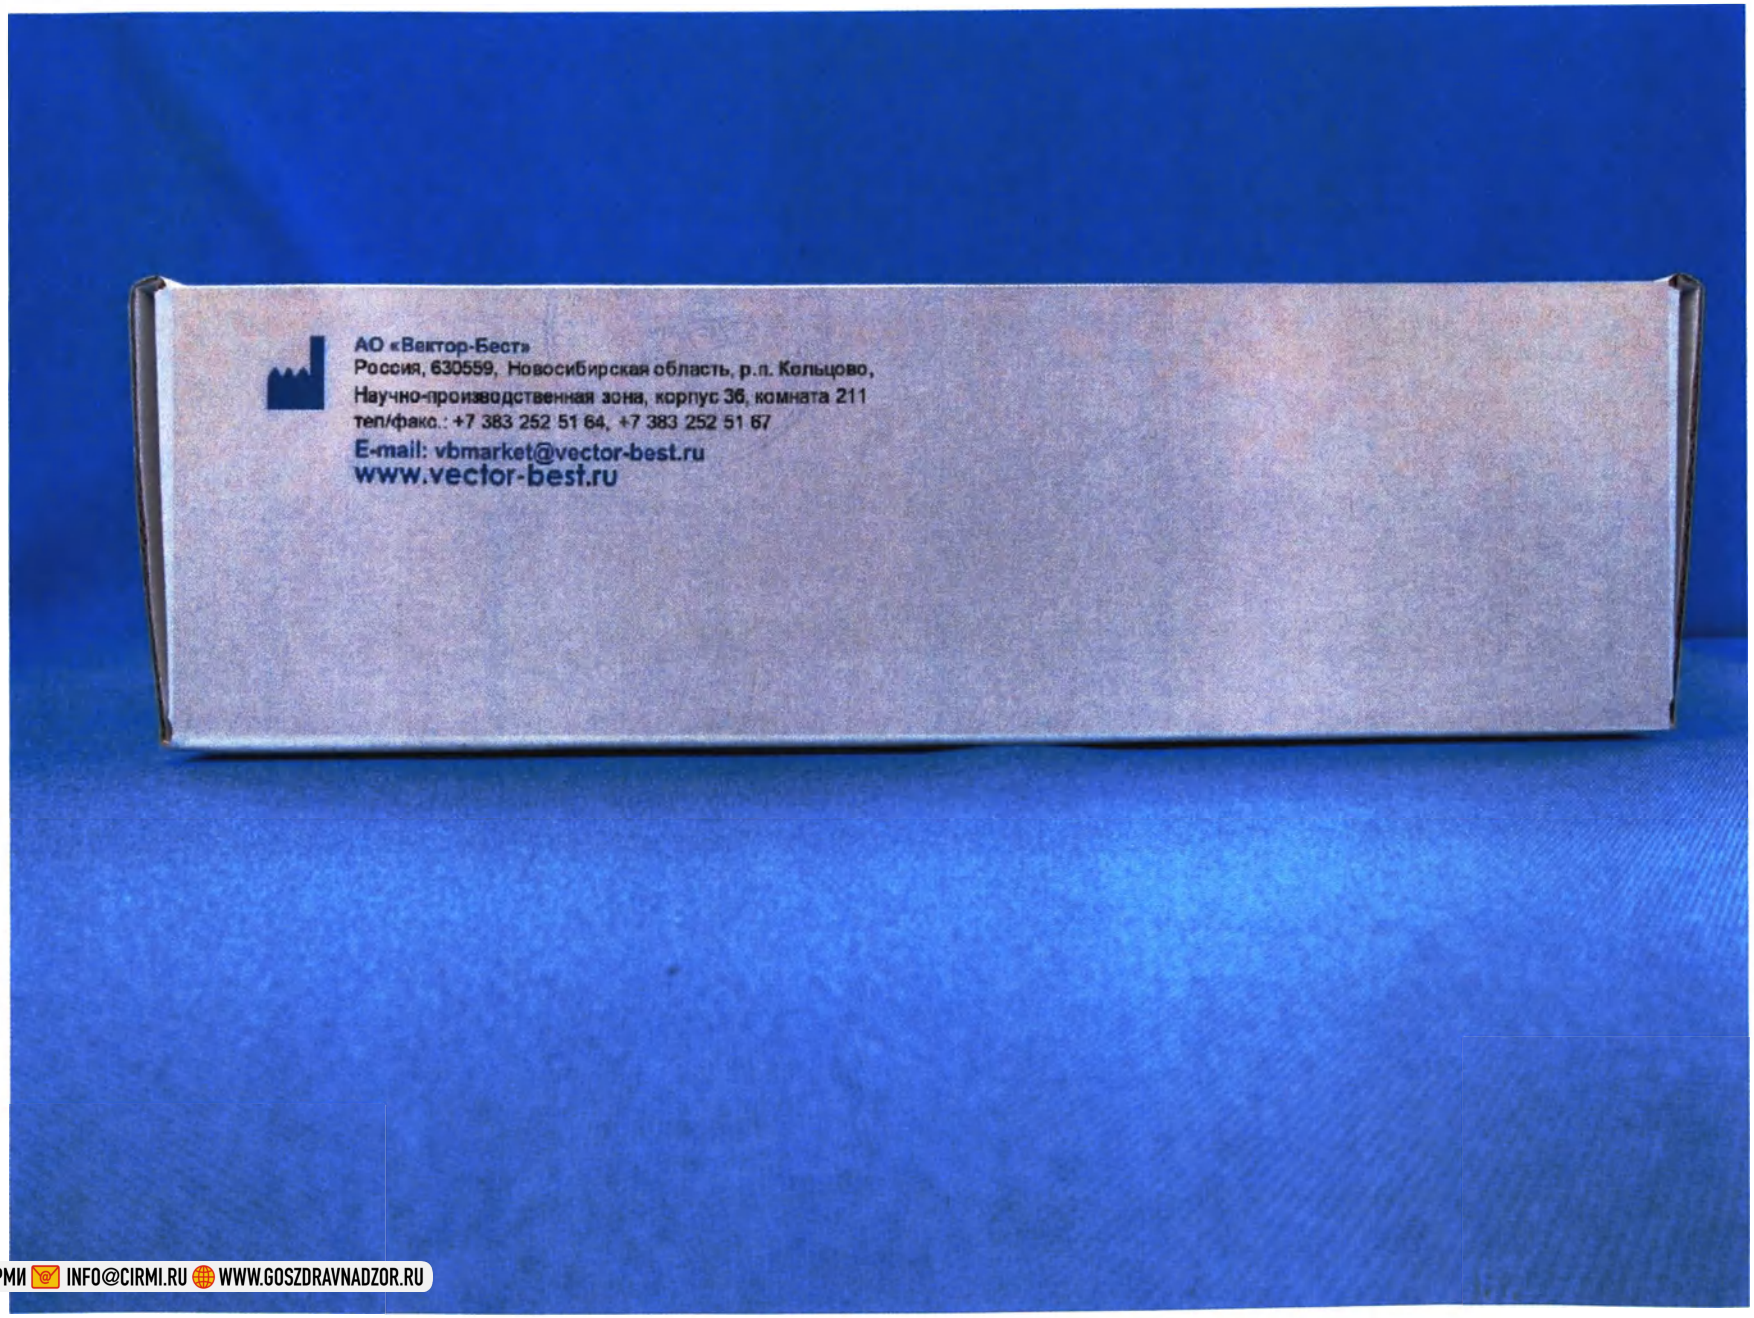

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 23 листов.
Директор по технологии и качеству
АО “Вектор-Бест”

_____ Масяго А.В.
“07” _____ 2023г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
_____ М.Д. Хусаинов
«17» ____07____ 2023 г.

Образцы маркировки на "Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации 17-ОН-прогестерона в сыворотке (плазме) крови (17-ОН-прогестерон-ИФА-БЕСТ)"

1. Образцы этикеток на компоненты набора "17-ОН-прогестерон-ИФА-БЕСТ"

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными поликлональными антителами к 17ОНП	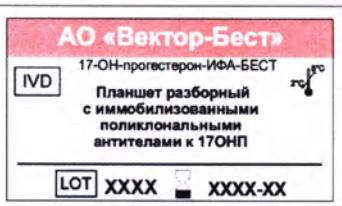
Калибровочный образец (К1)	
Калибровочный образец (К2)	
Калибровочный образец (К3)	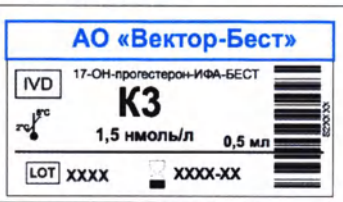
Калибровочный образец (К4)	
Калибровочный образец (К5)	
Калибровочный образец (К6)	

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наименование компонента	Этикетка
Контрольный образец (КО)	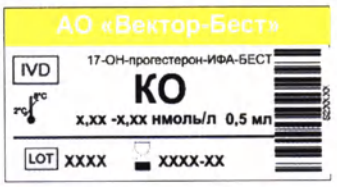
Конъюгат	
Раствор тетраметилбензидина плюс (раствор ТМБ плюс)	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)	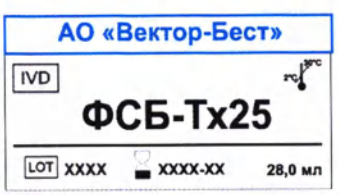
Стоп-реагент	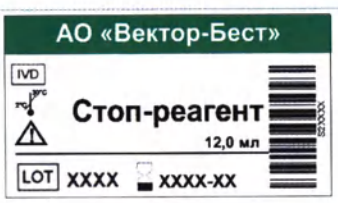

2. Образцы этикеток на коробке набора “17-ОН-прогестерон-ИФА-БЕСТ”

2.1. Верхняя этикетка

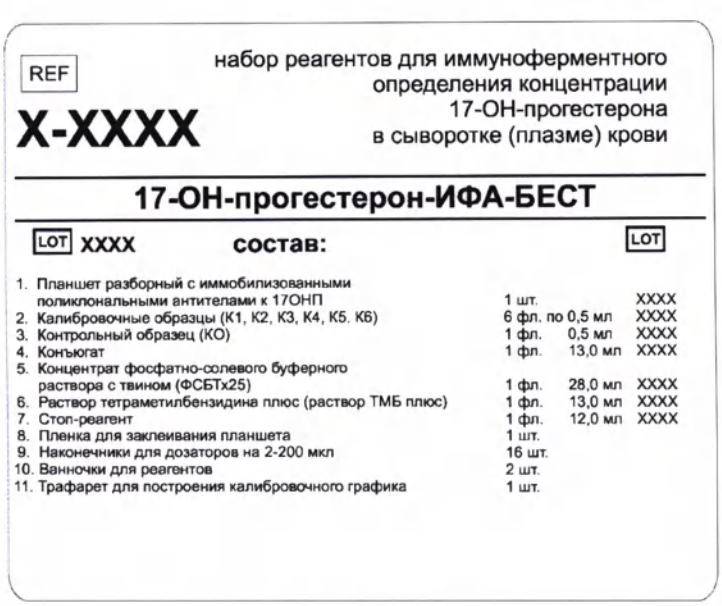

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2.2. Боковая этикетка №1.

2.3. Боковая этикетка №2.

АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www. vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИ СД
АО «Вектор-Бест» _____ М.Ю. Рукавишников
«27» 07 2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.
Директор по технологии и качеству
АО “Вектор-Бест”

Масяго А.В.

“24” 04 2023 г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU