



Фотографические изображения
медицинского изделия

***Системы офтальмологические лазерные, модели:
DIXION LPULSA SYL-9000, DIXION SeLecTor Deux с
принадлежностями***

Производства

«Лайтмед Корпорэйшн»/Lightmed Corporation


No. 1-1, Lane 1, Sec. 3, Pao An St., Shulin District,
New Taipei City 23861, Taiwan






1. Лампа щелевая с лазерным резонатором в сборе.



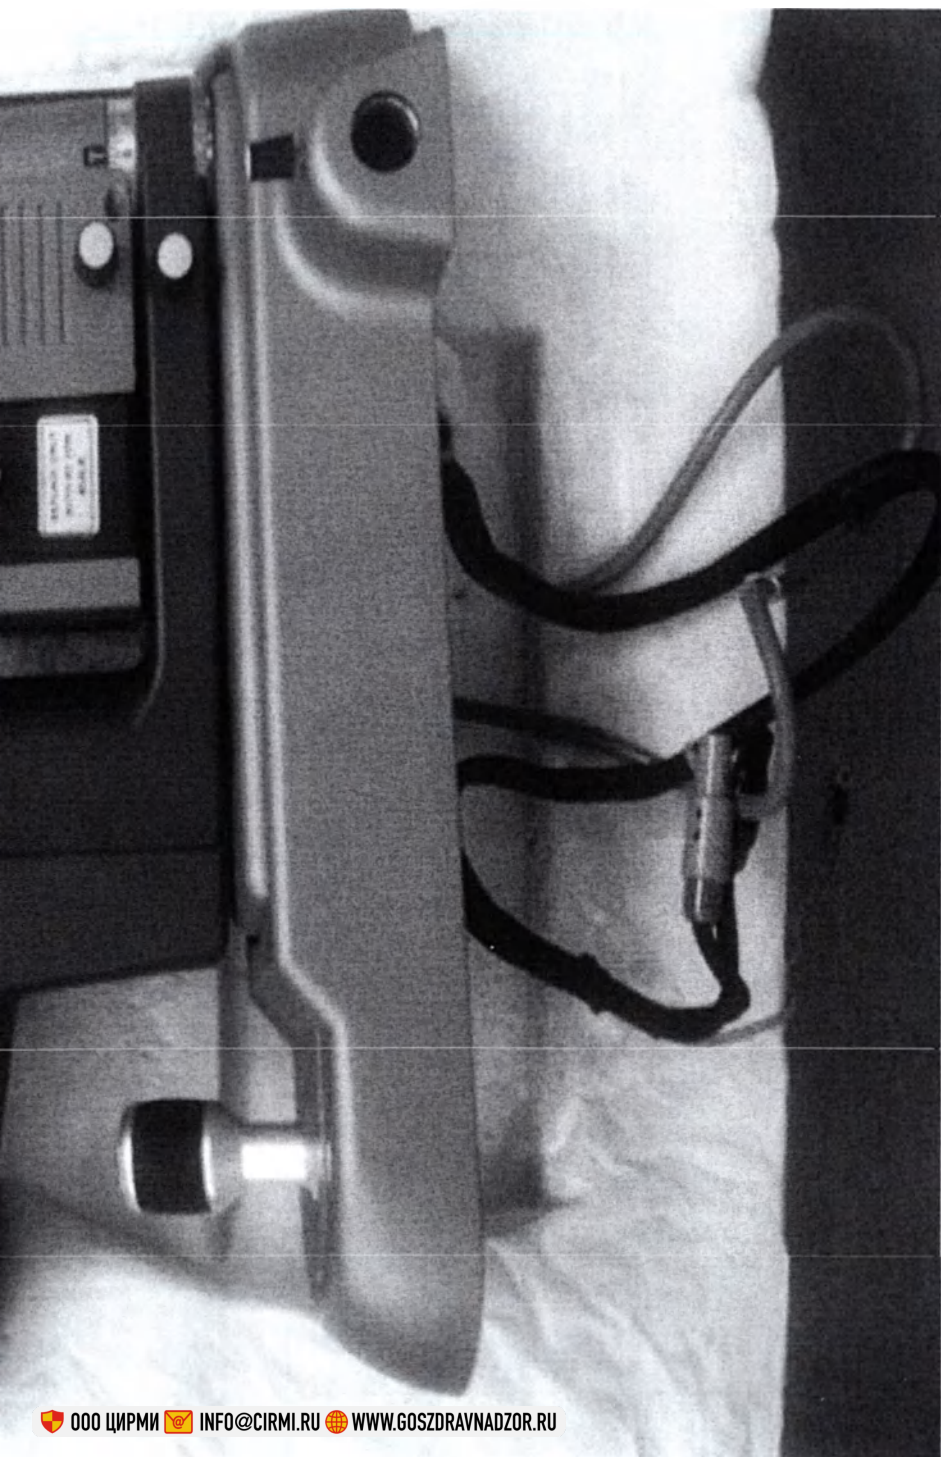



2. Бинокуляр микроскопа.



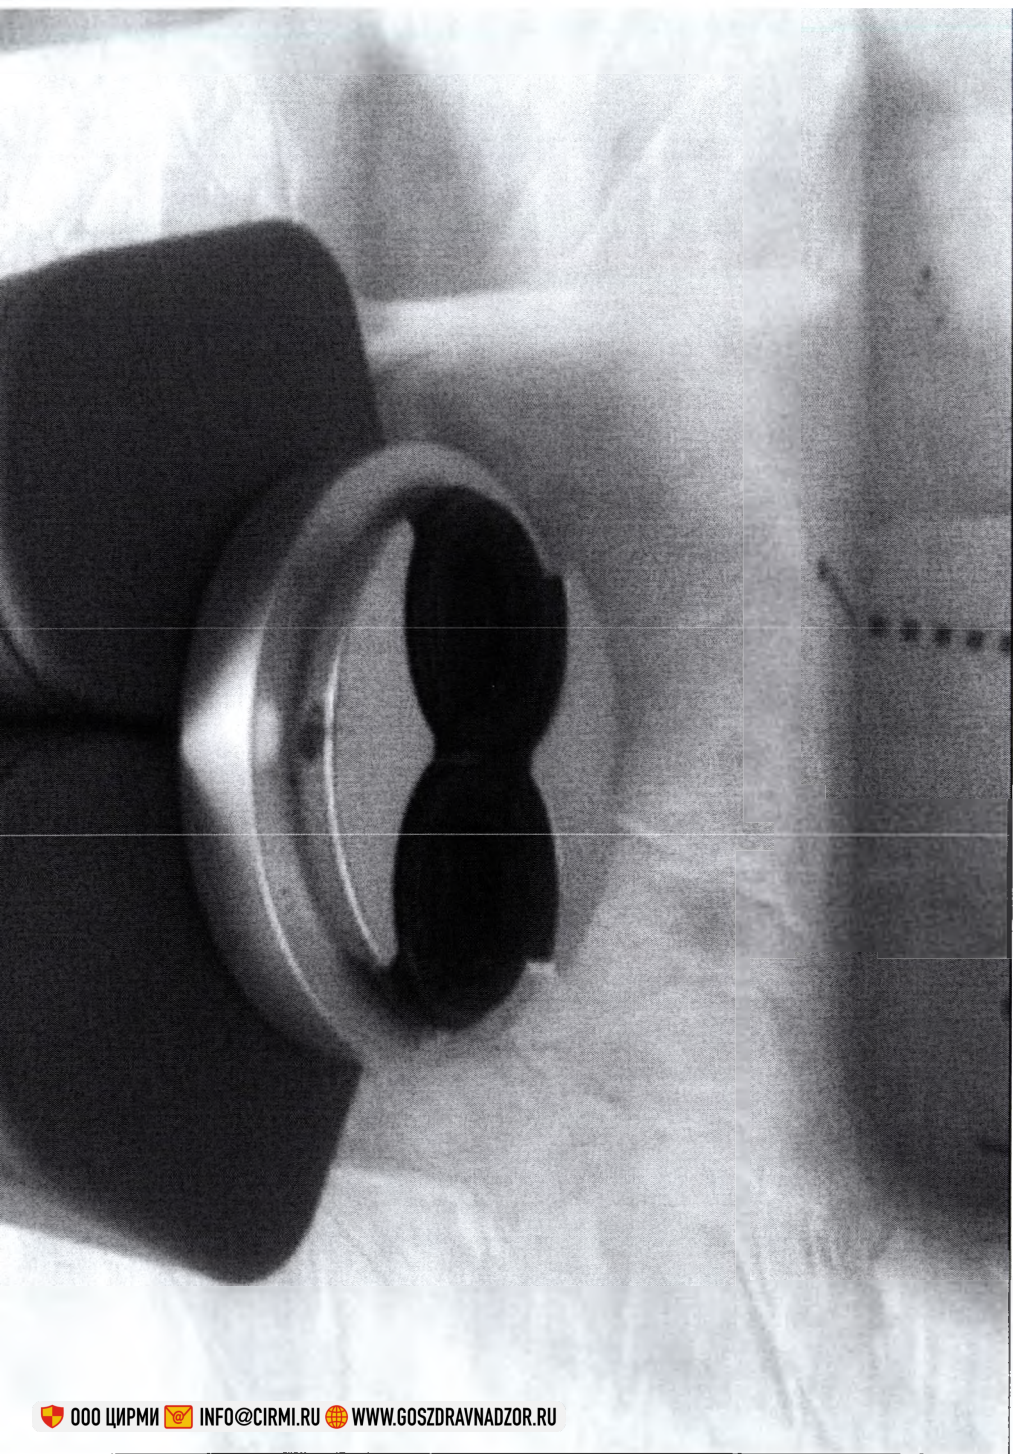



3. Накладка для проводов.

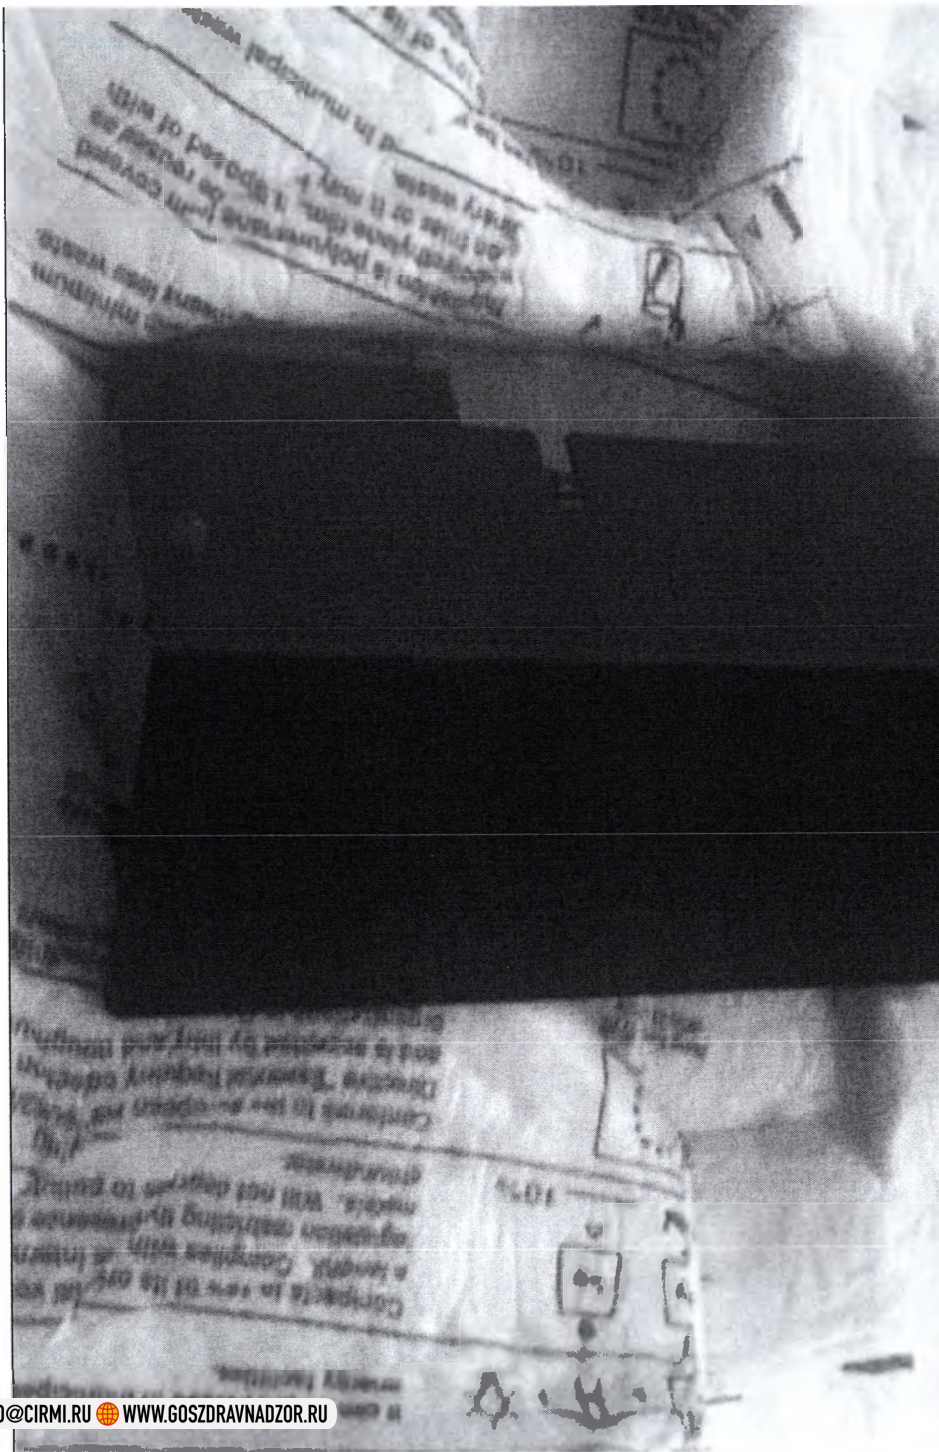

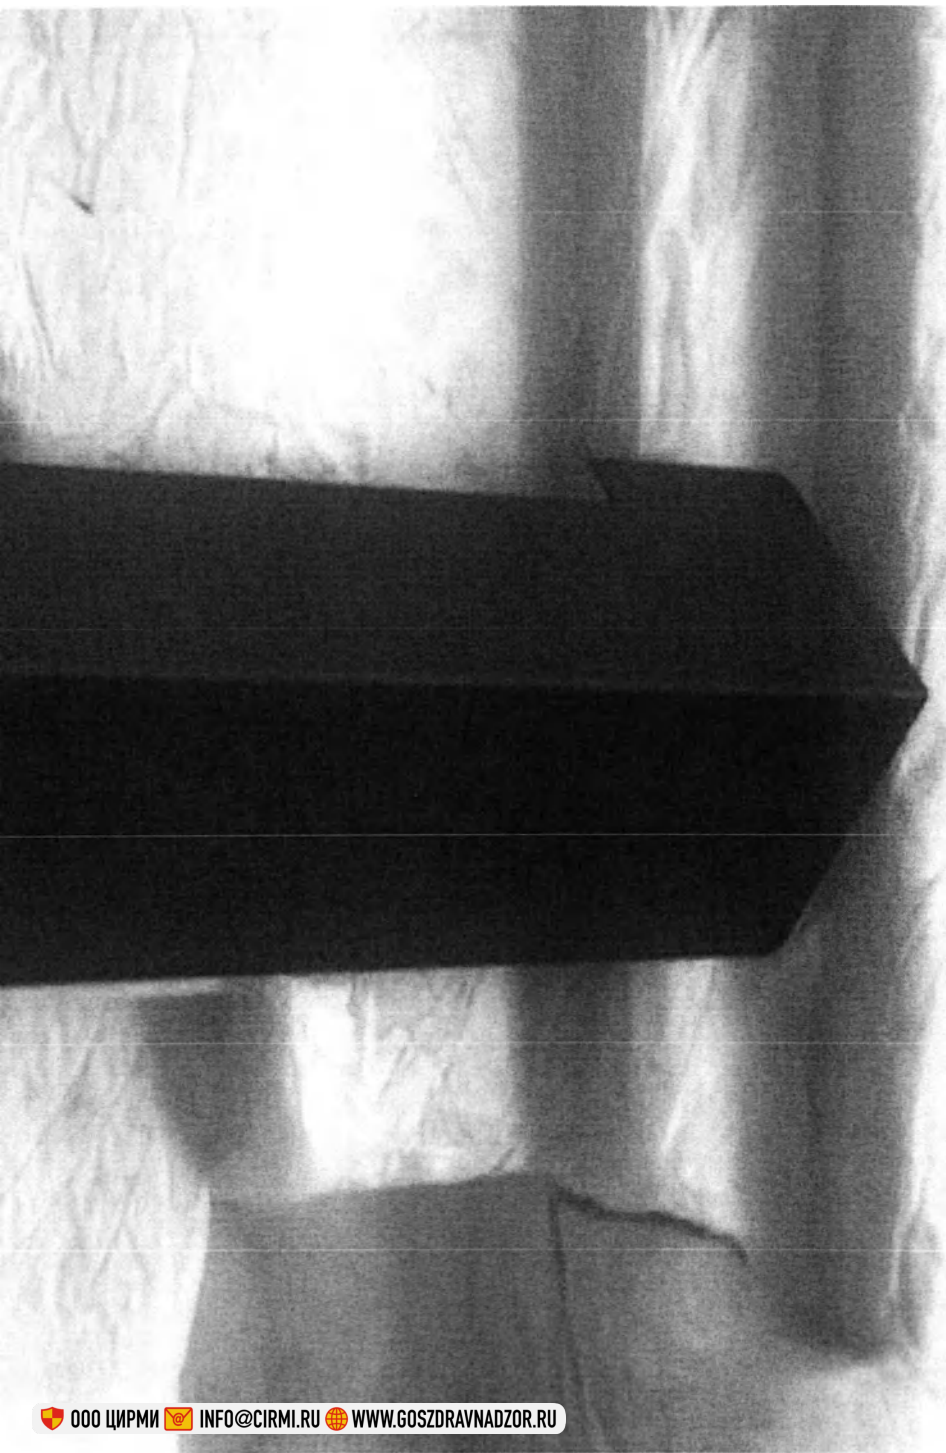


4. Вал с колесами зубчатыми в сборе.

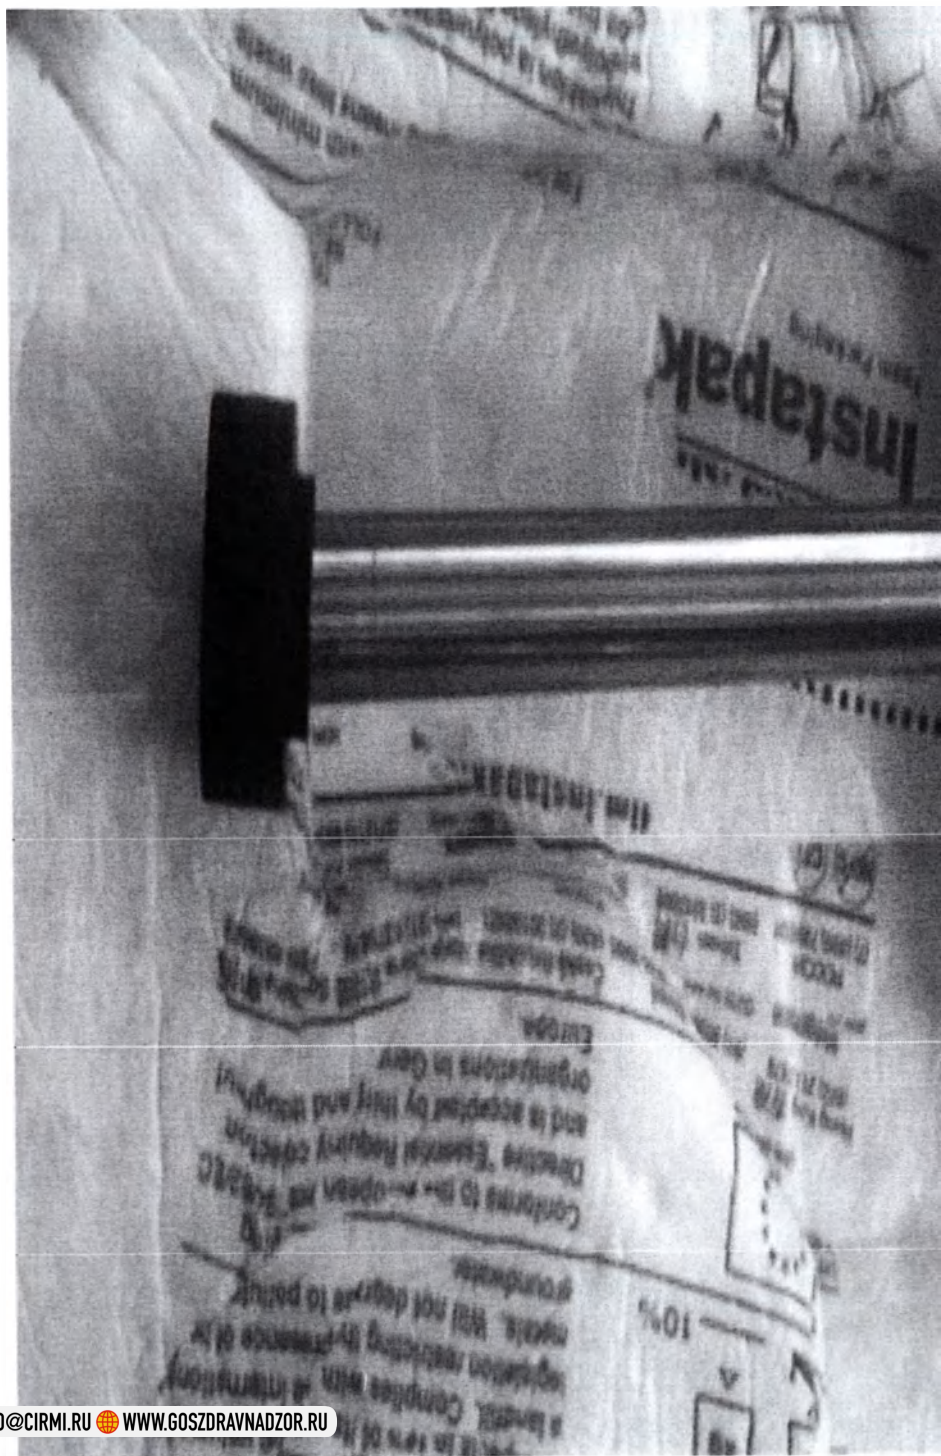

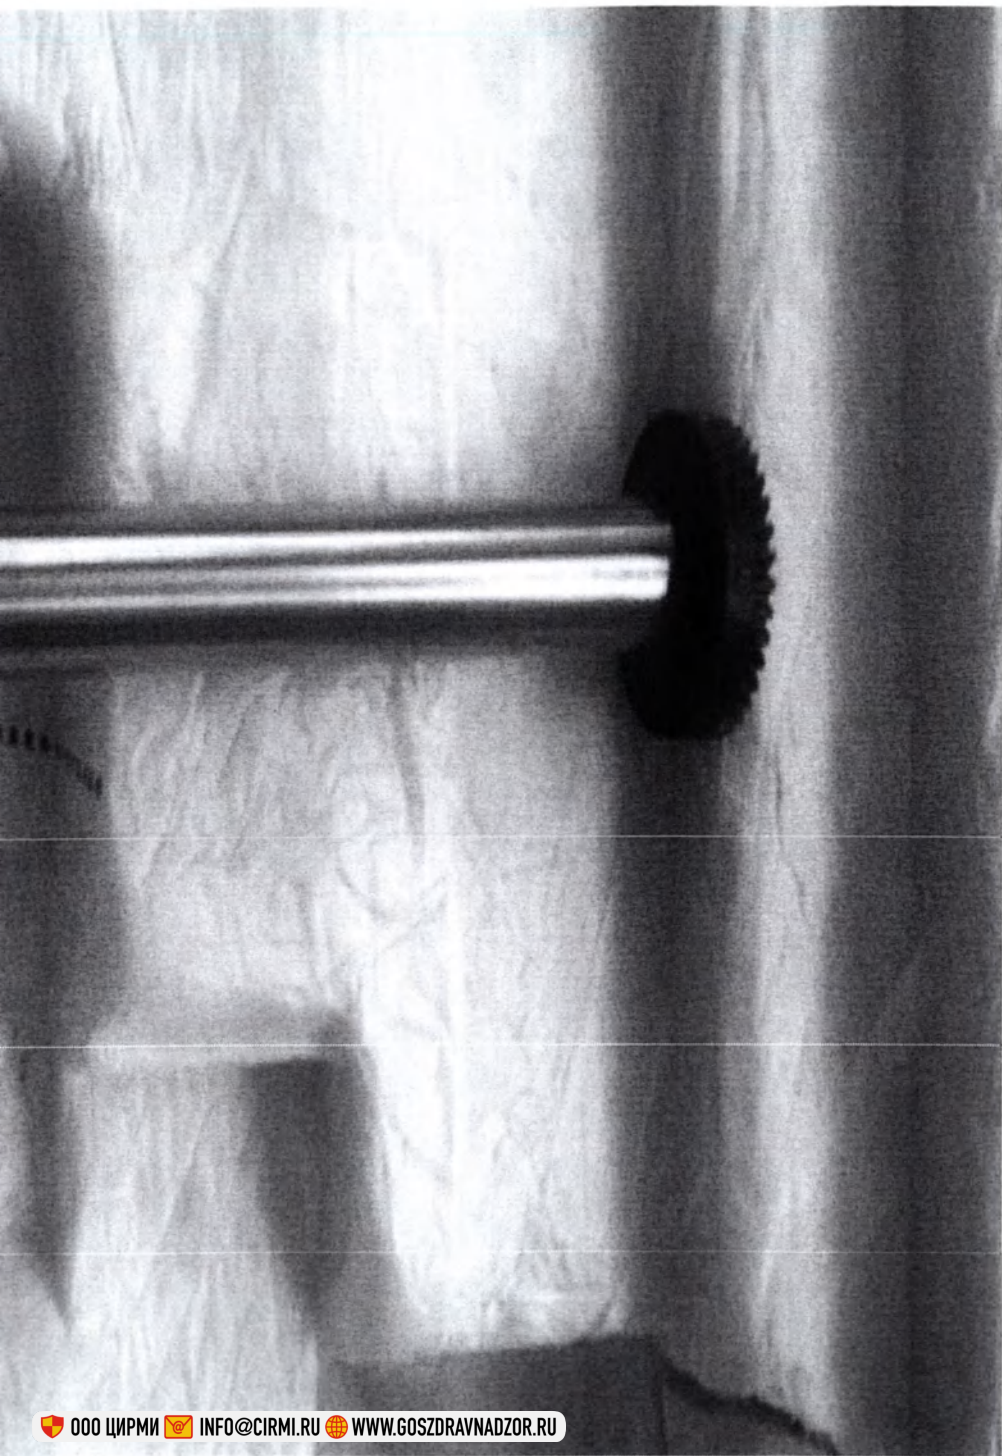

5. Упор для головы в сборе.

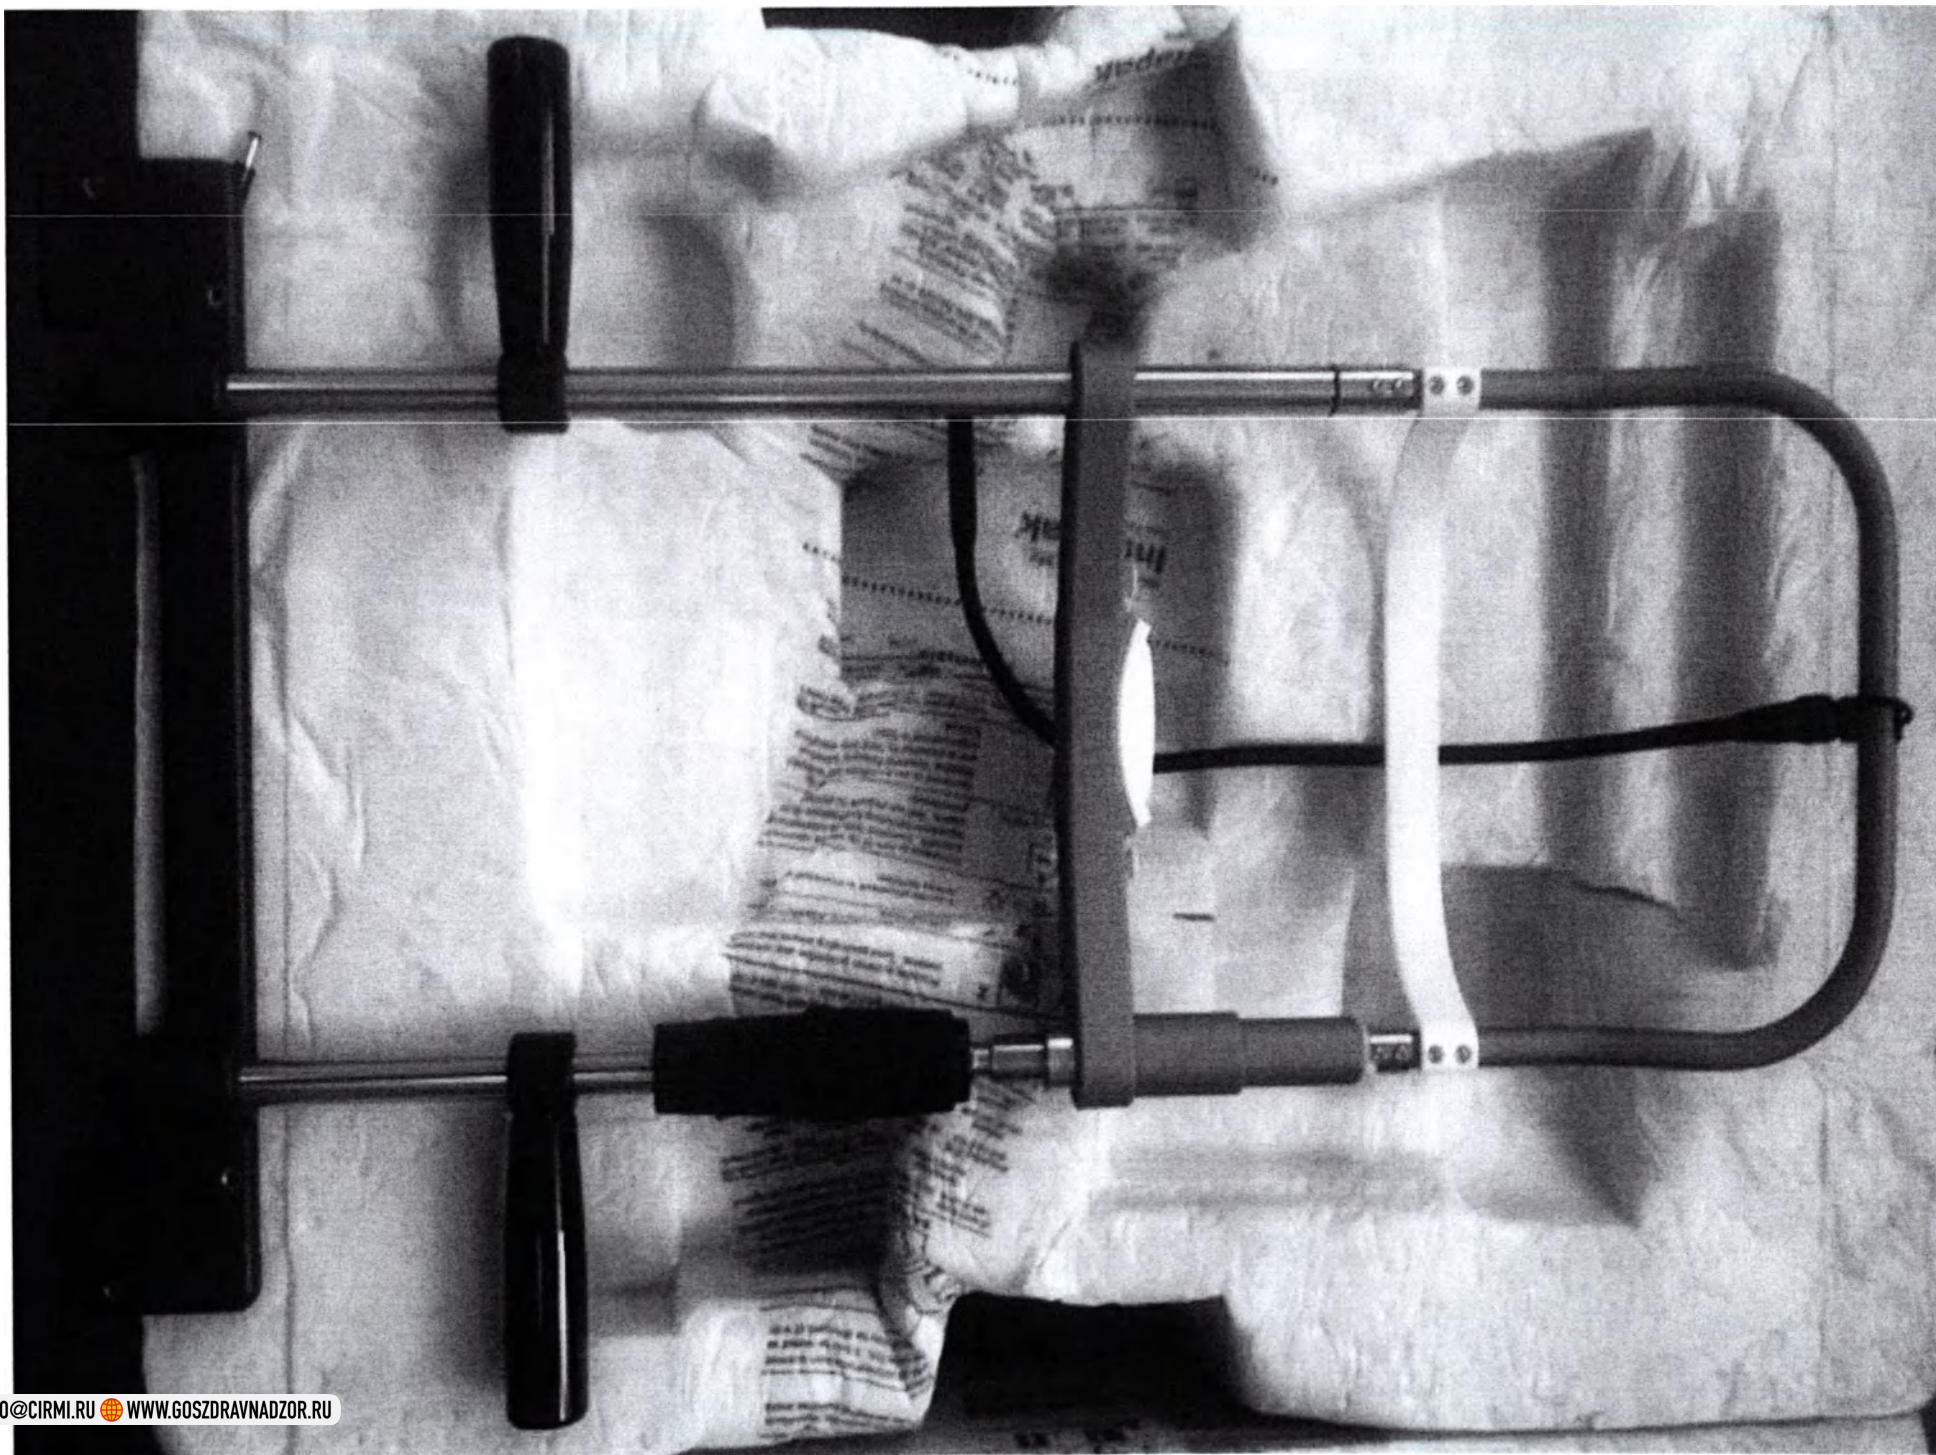


6. Ключ включения/выключения лазера.





7. Накладки для колес зубчатых.



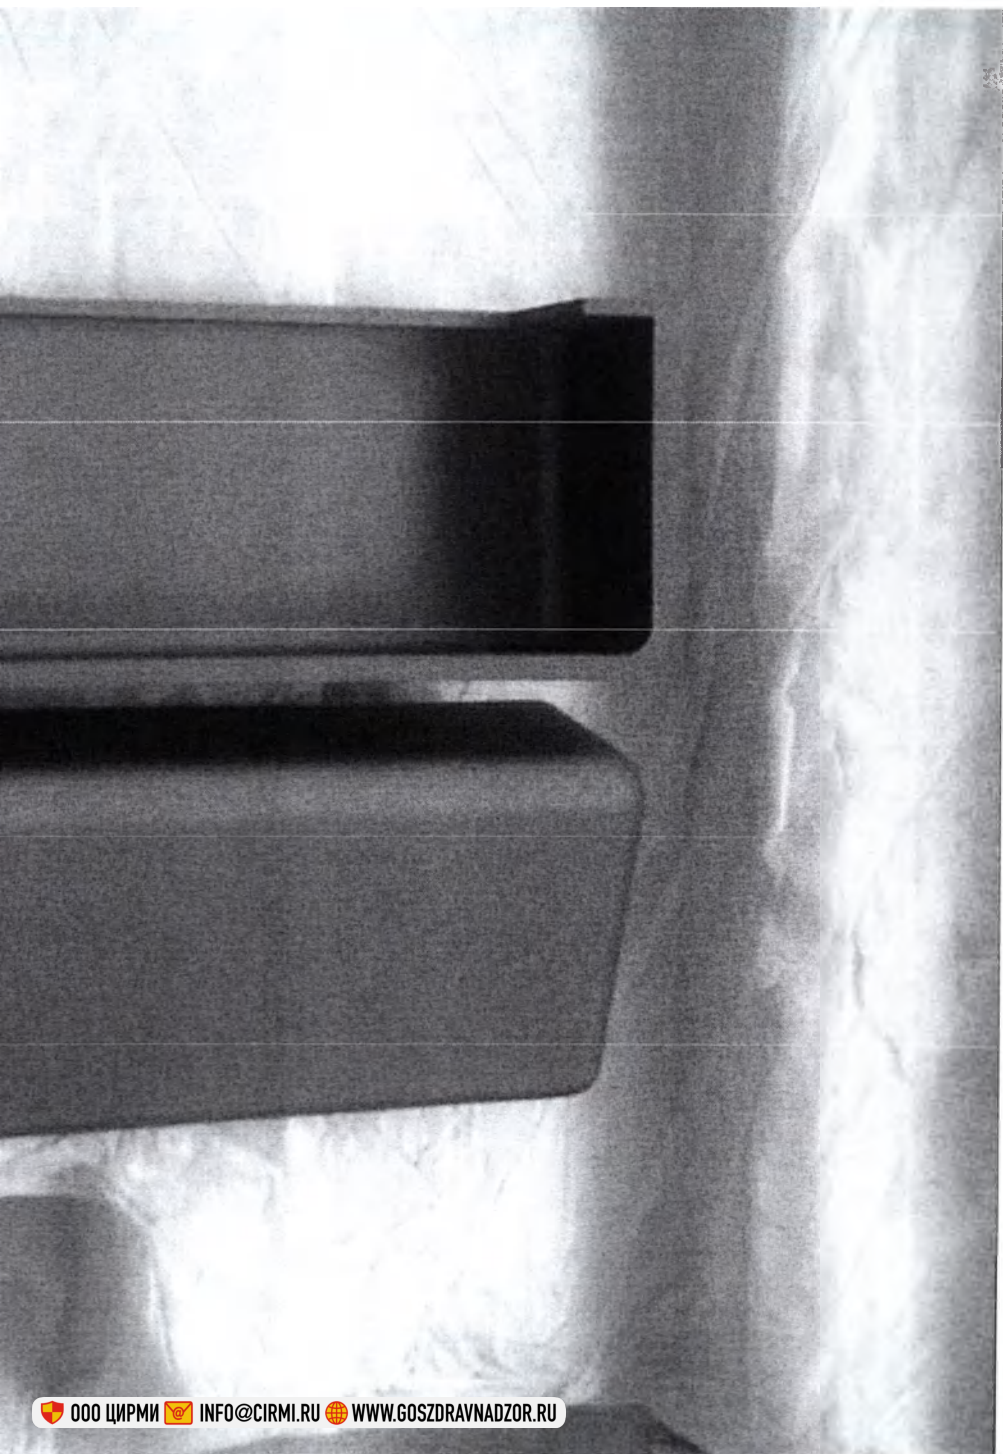


8. Чехол пылезащитный.

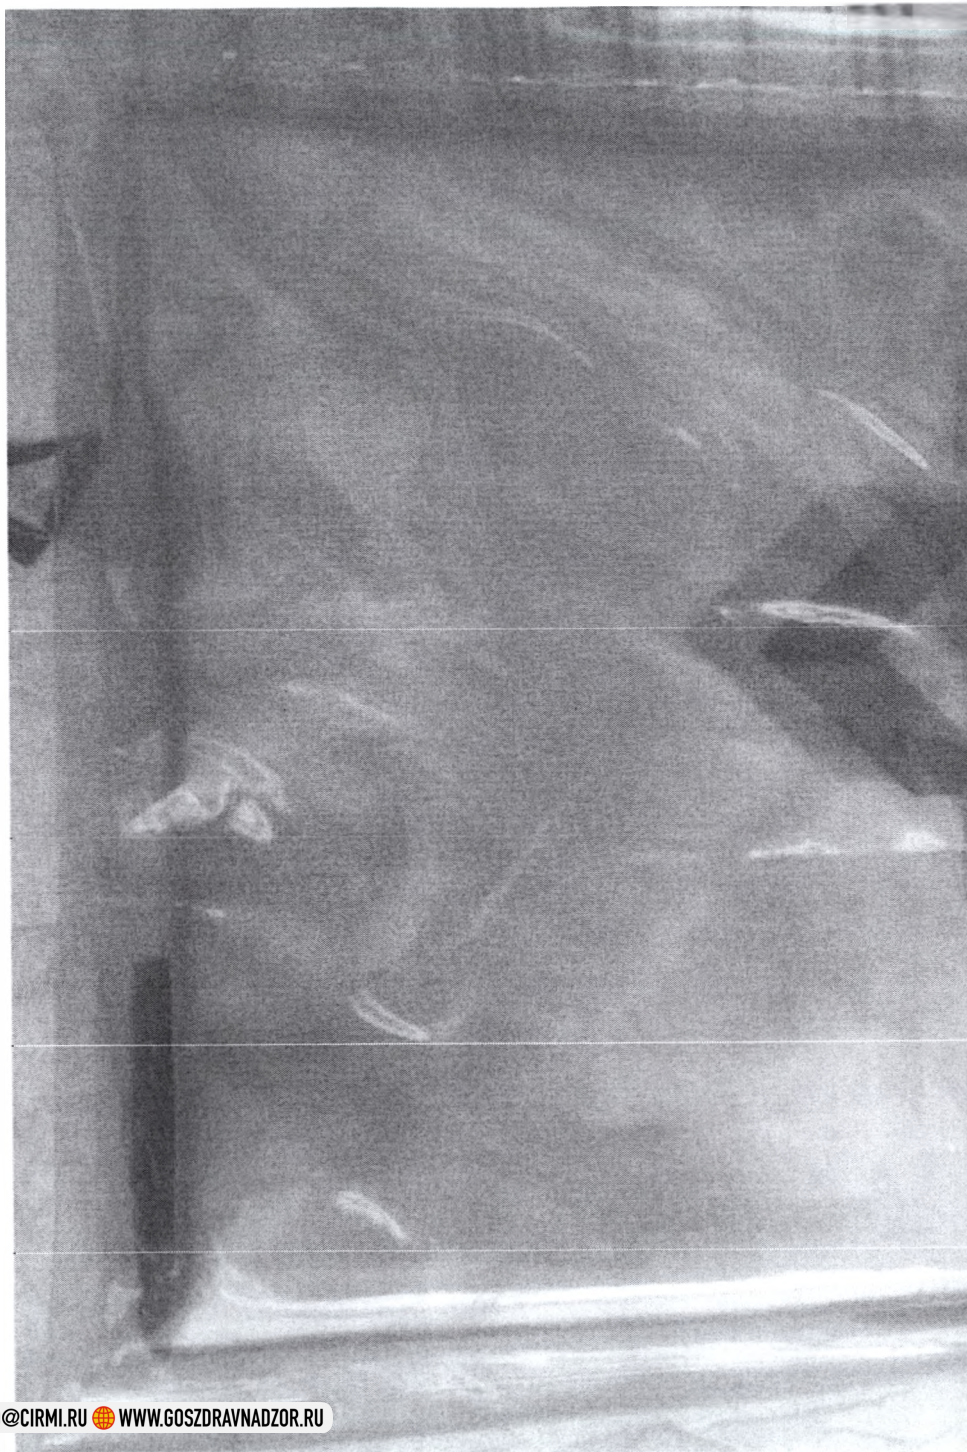

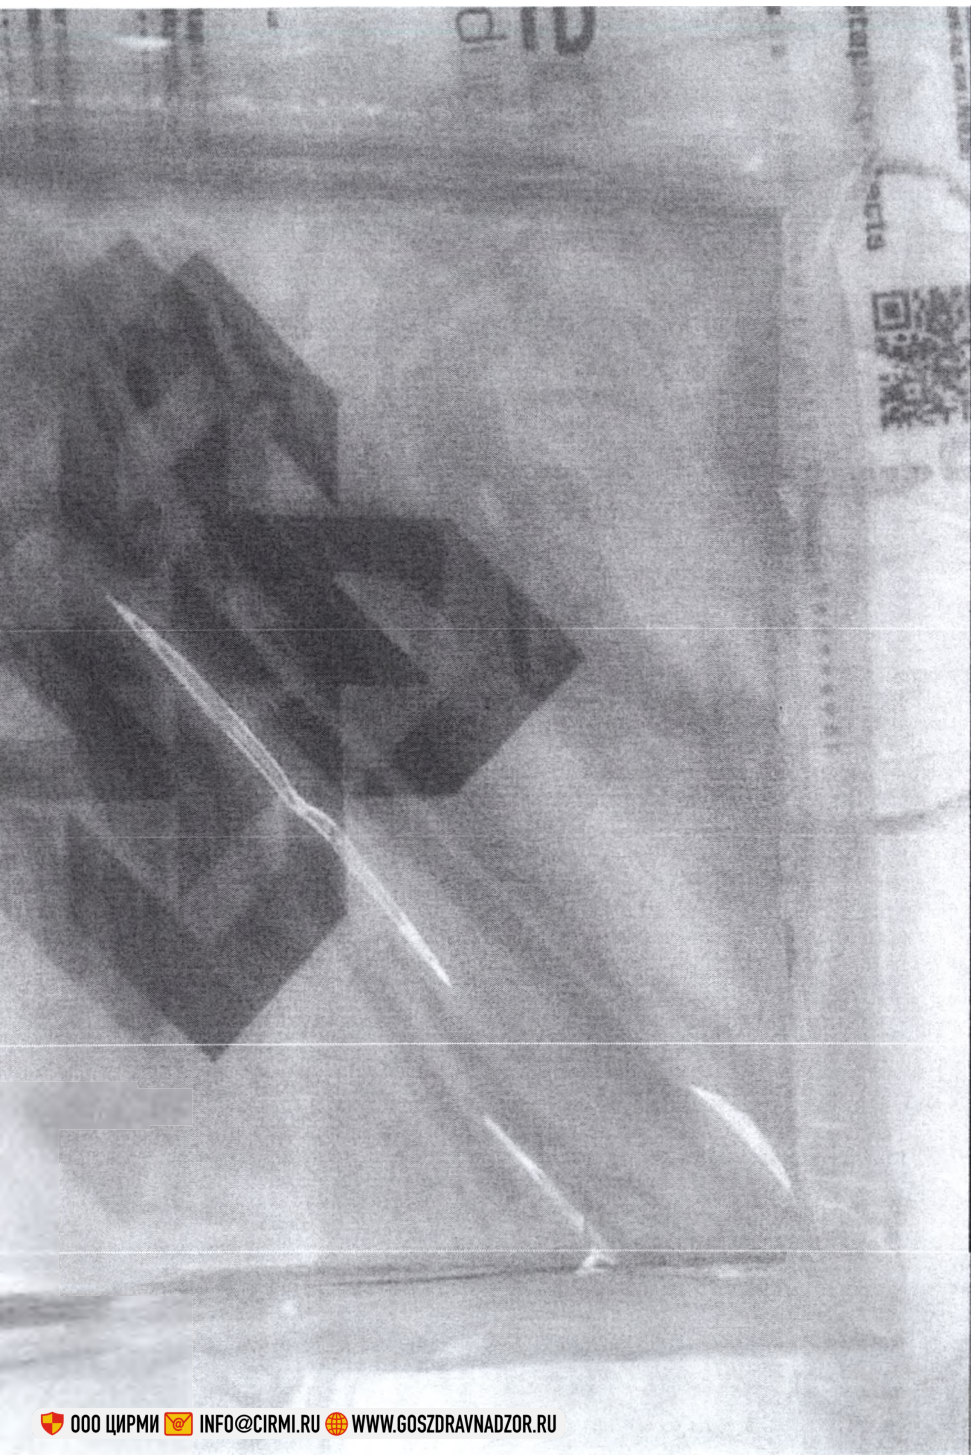

9. Ремень для фиксации головы.



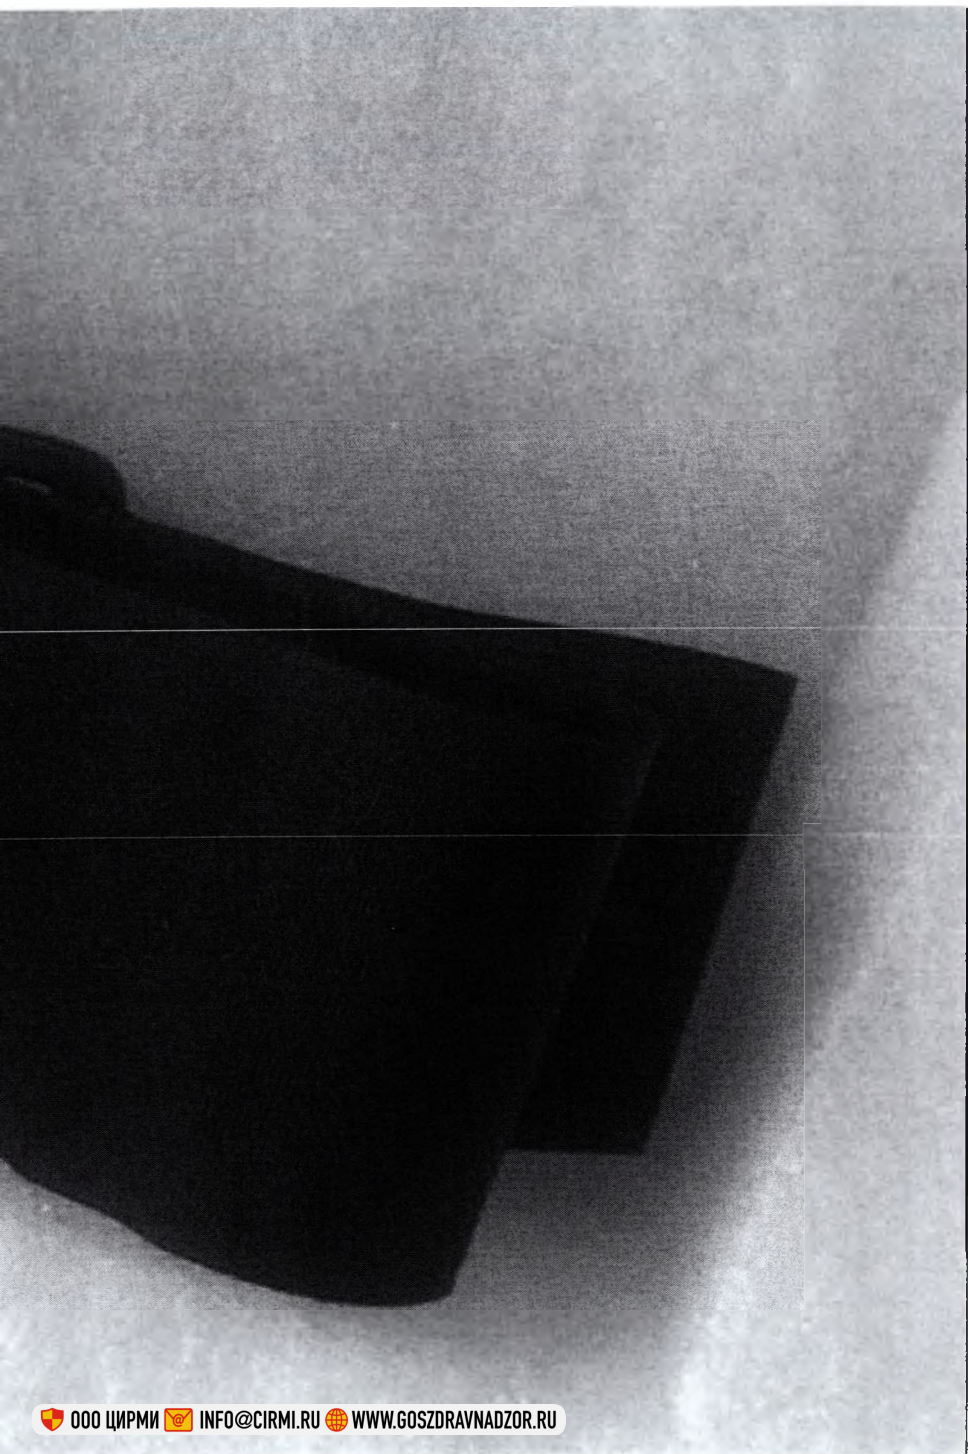

10. Винты крепежные для крепления упора для головы в сборе – 4 шт.




11. Предохранители – 2 шт.







12. Ключ шестигранный.



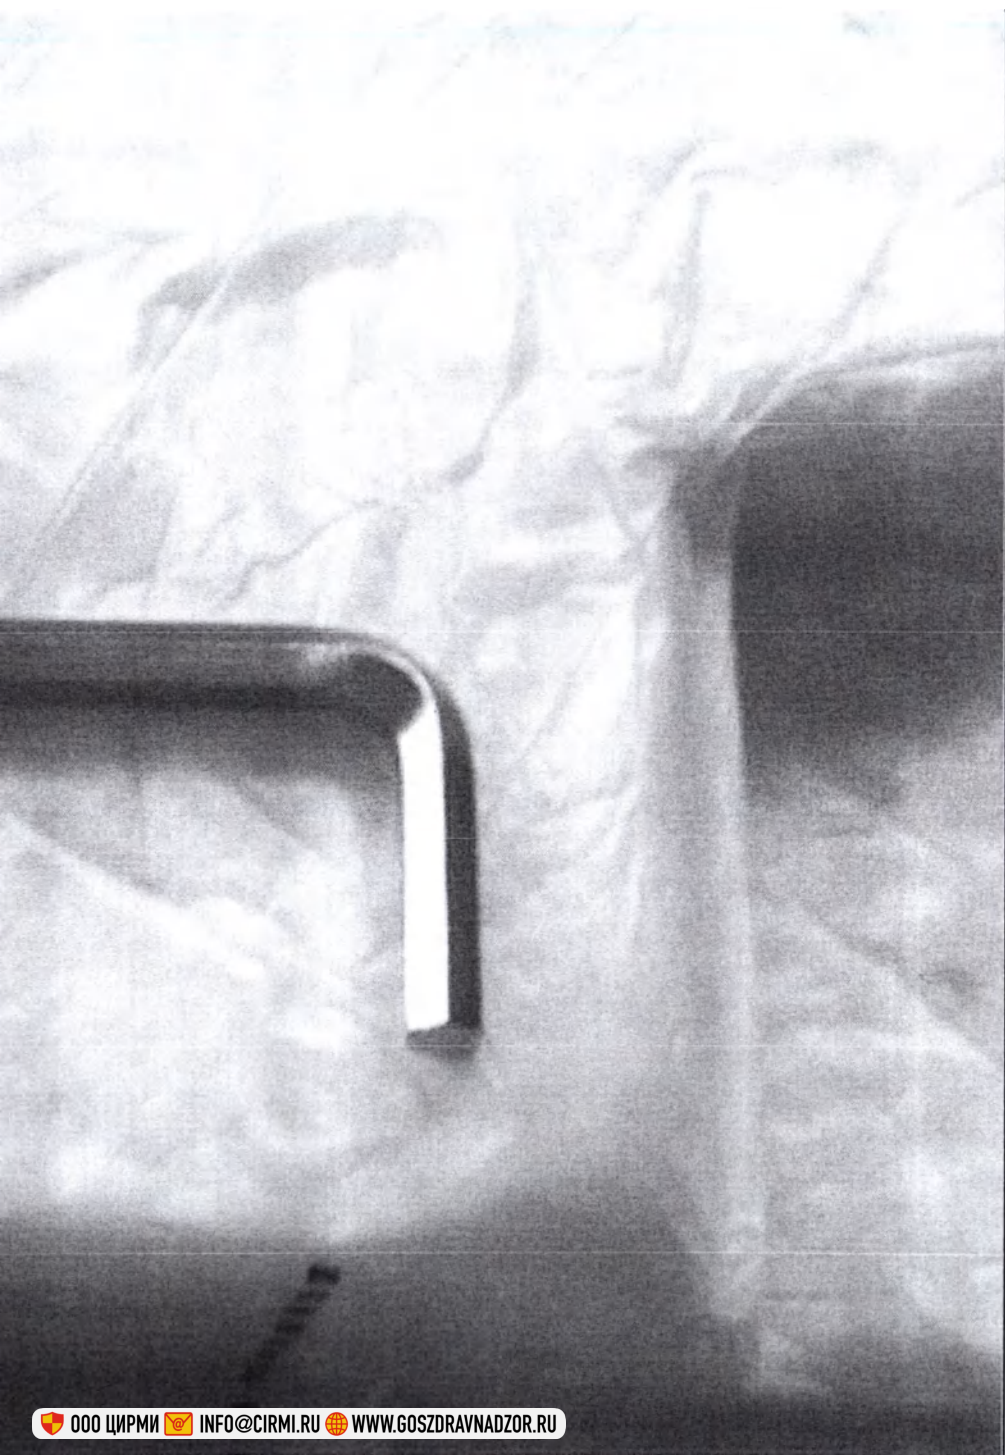

13. Стержень прицельный.

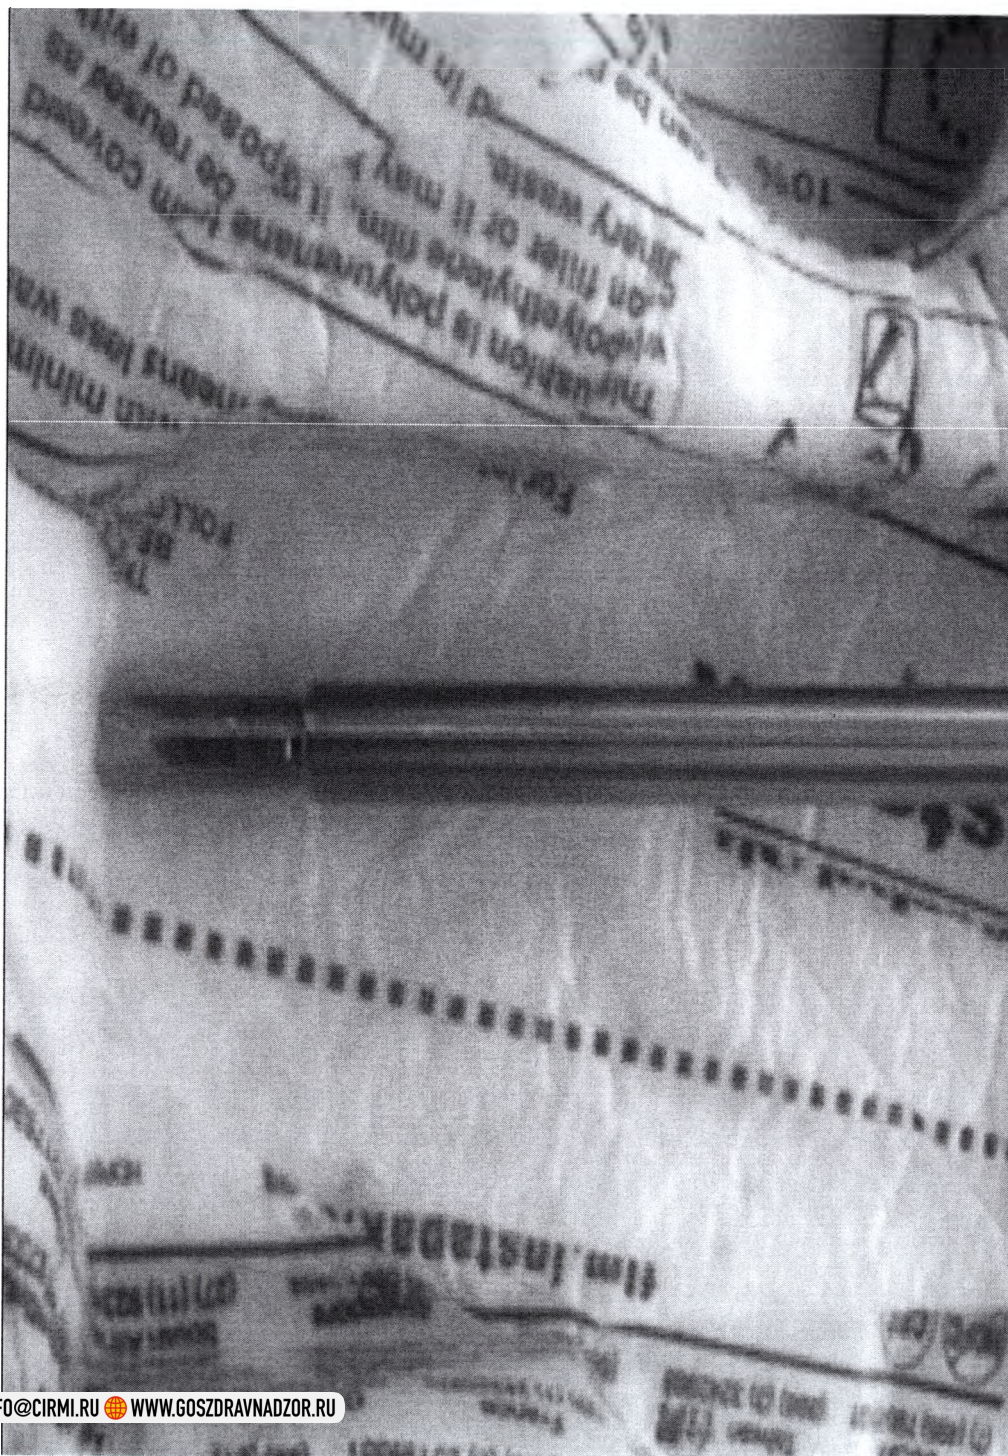


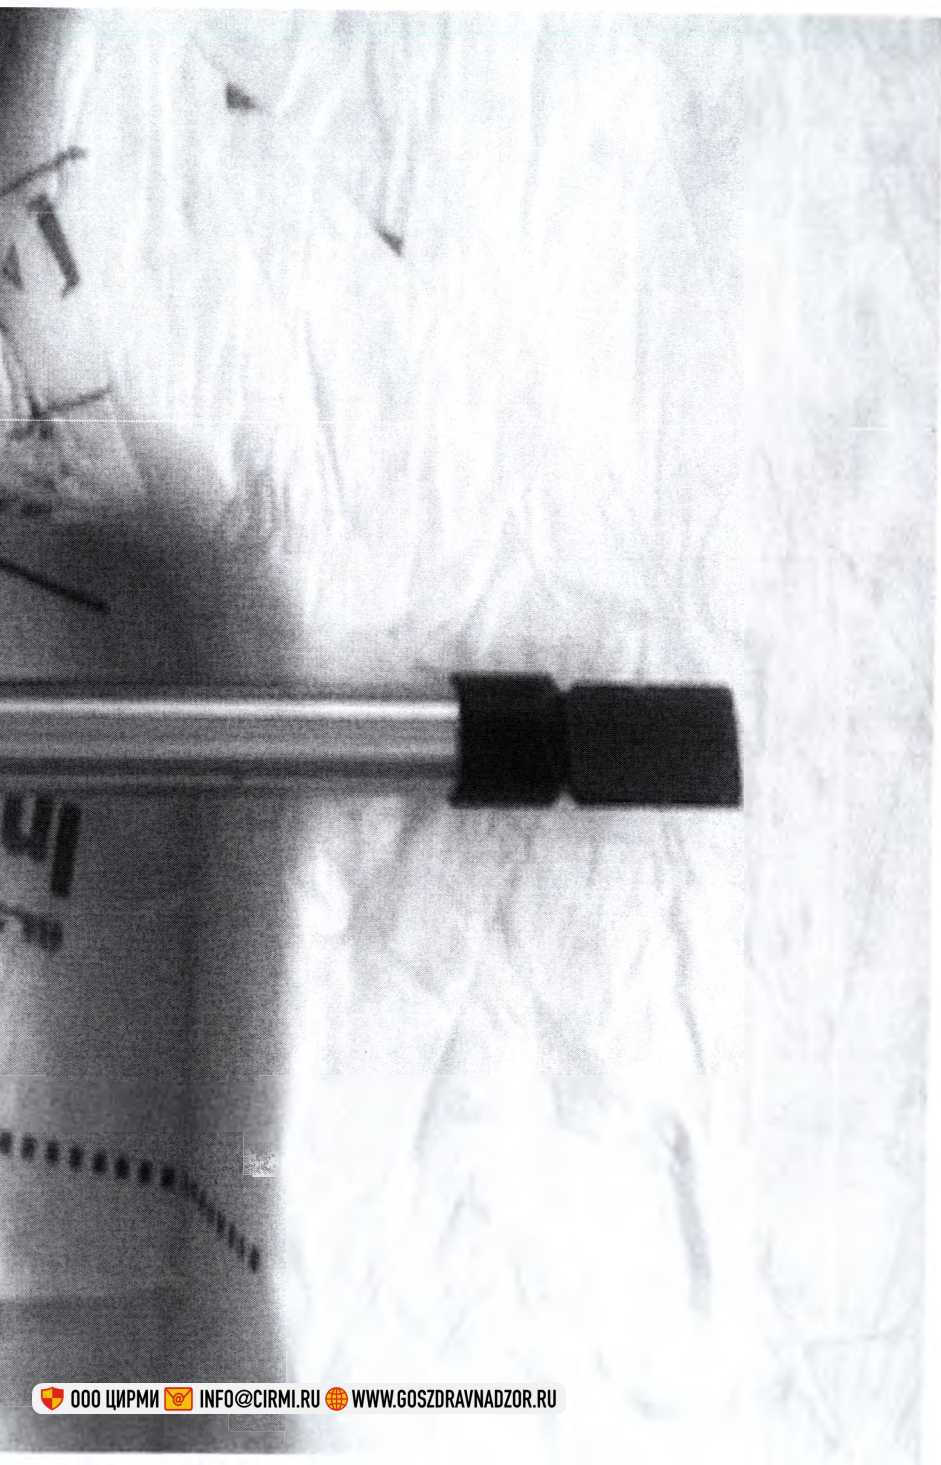


14. Бумага тестовая.



15. Мишень.

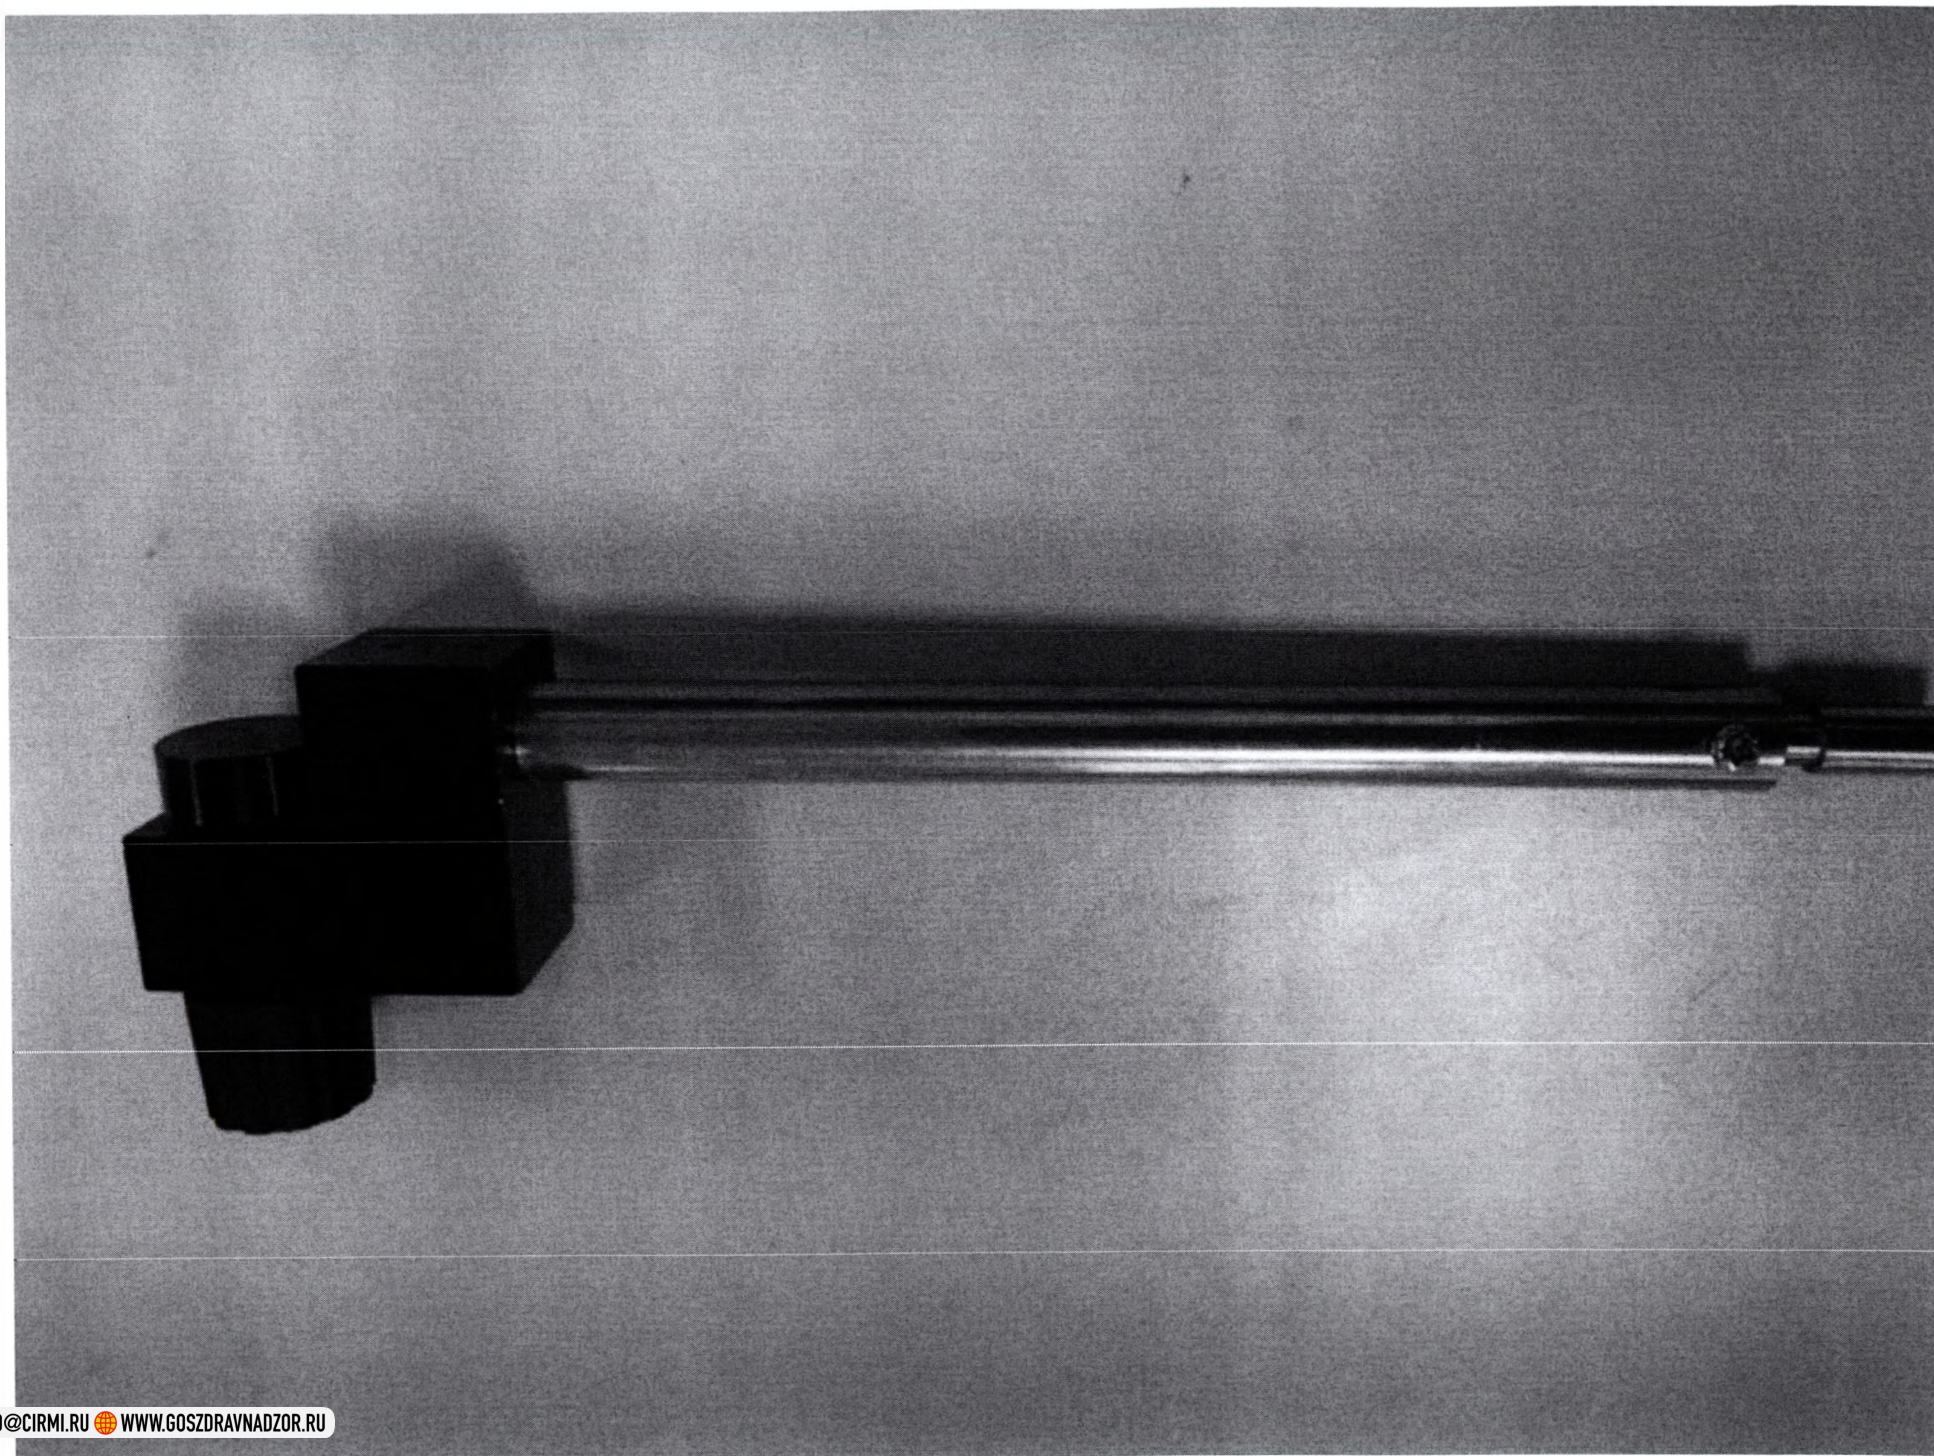


16. Блок управления.

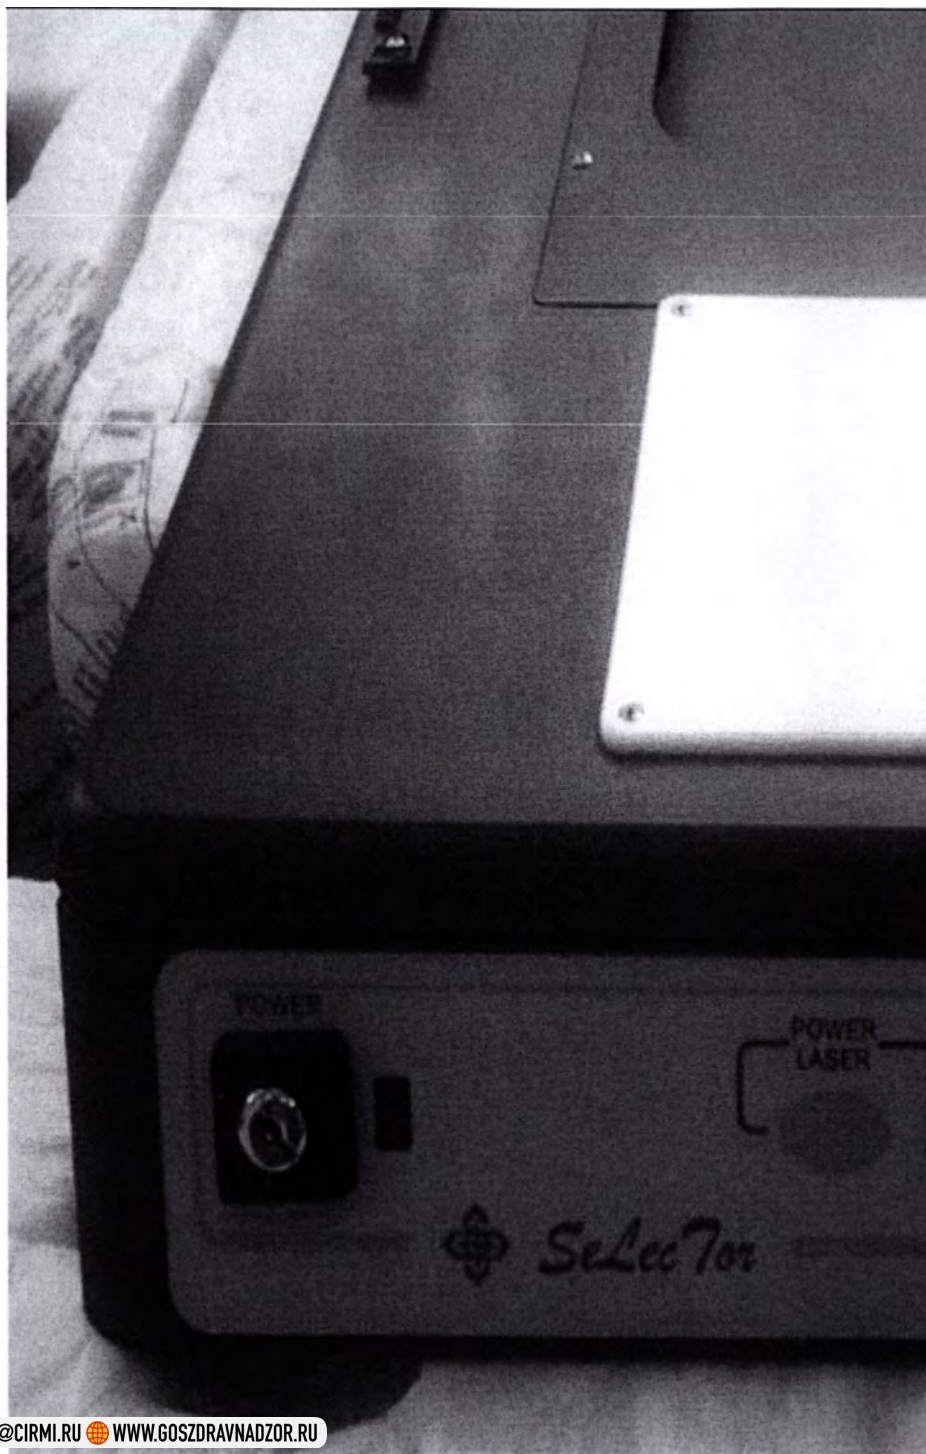





17.Кабель питания.

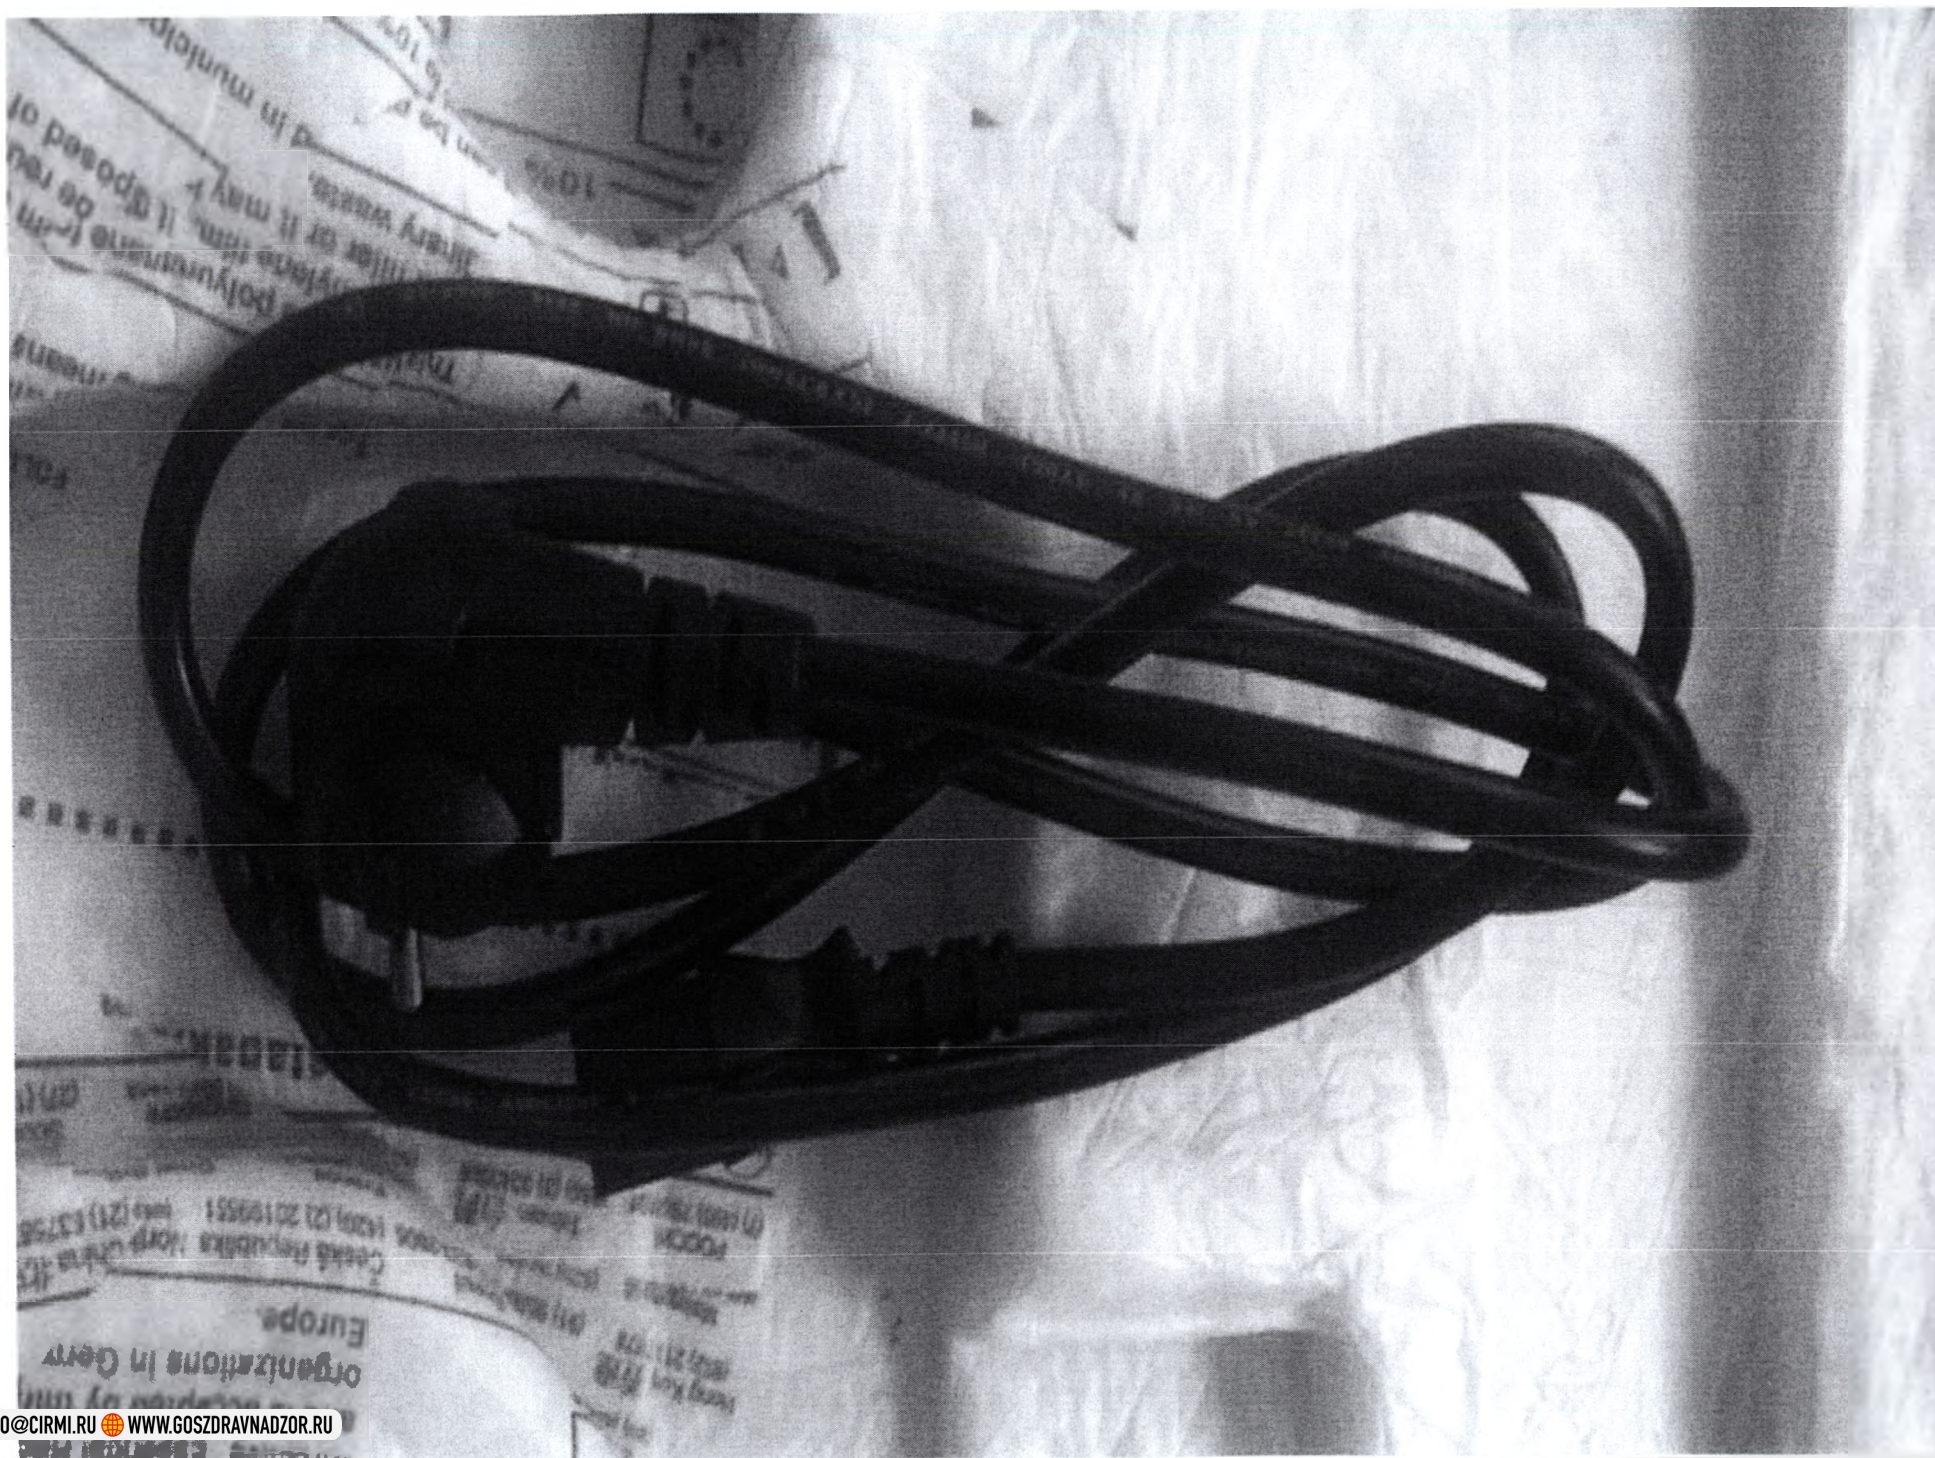

18. Устройство настройки прицельного луча.

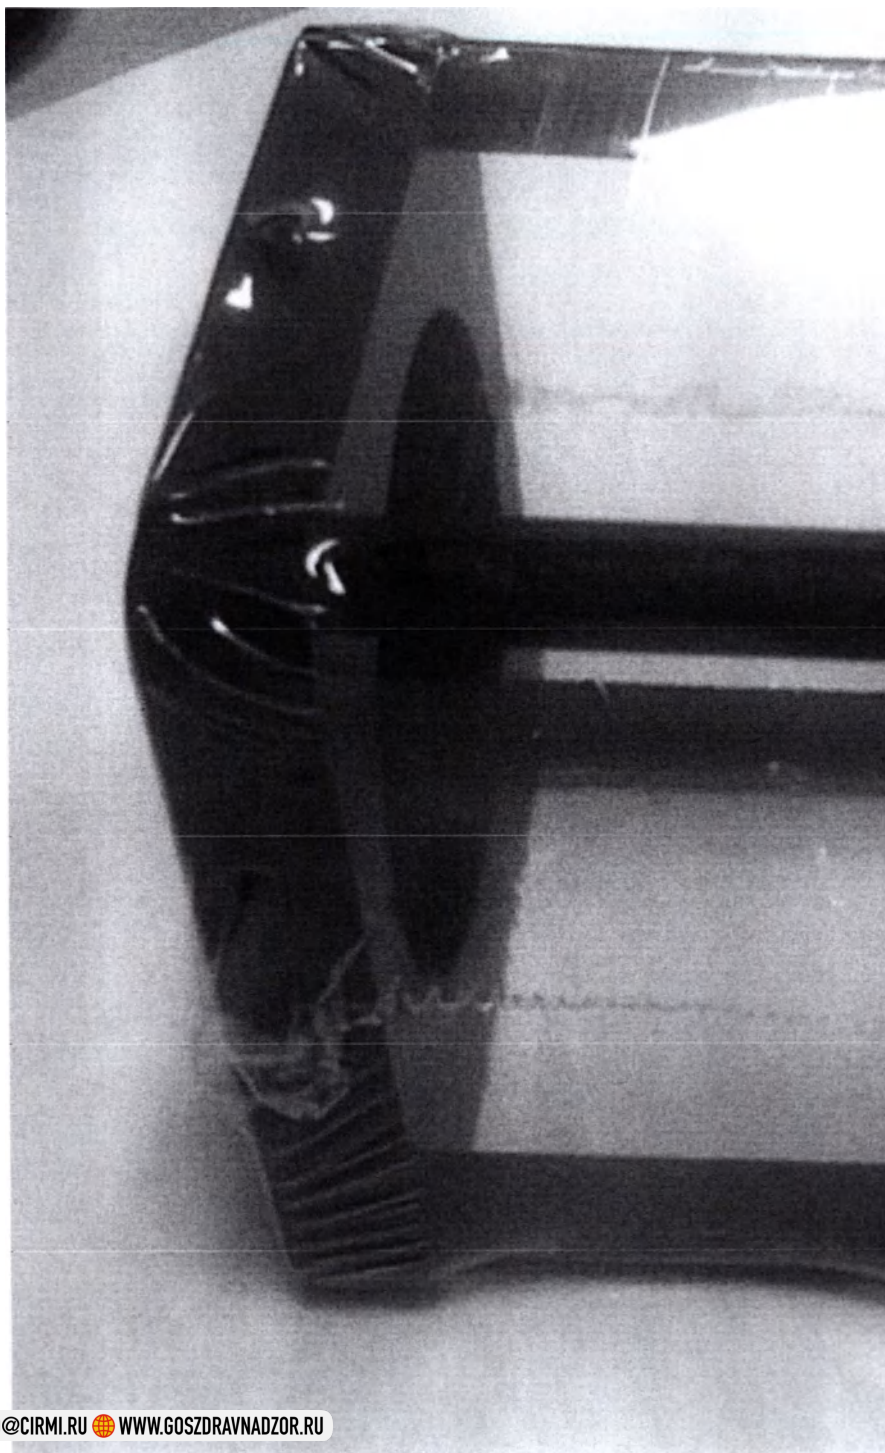

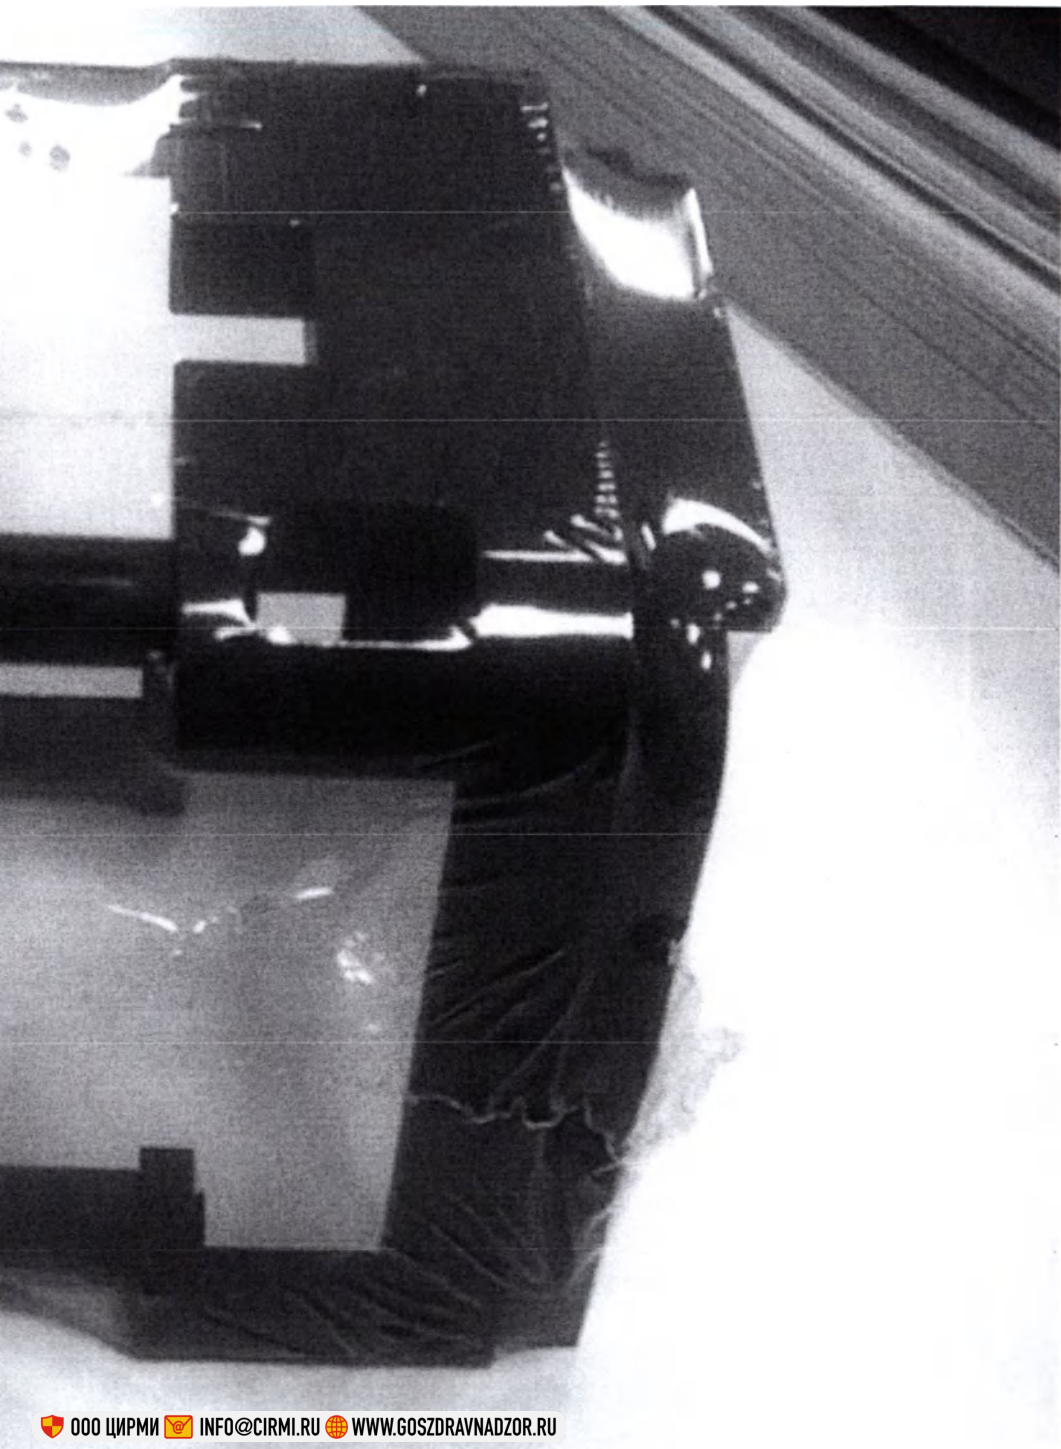

19. Лист упаковочный.

YAG Laser Packing List

Model: LF-USA SYL2000 Serial Number: YH12-0621

Customer name: _____

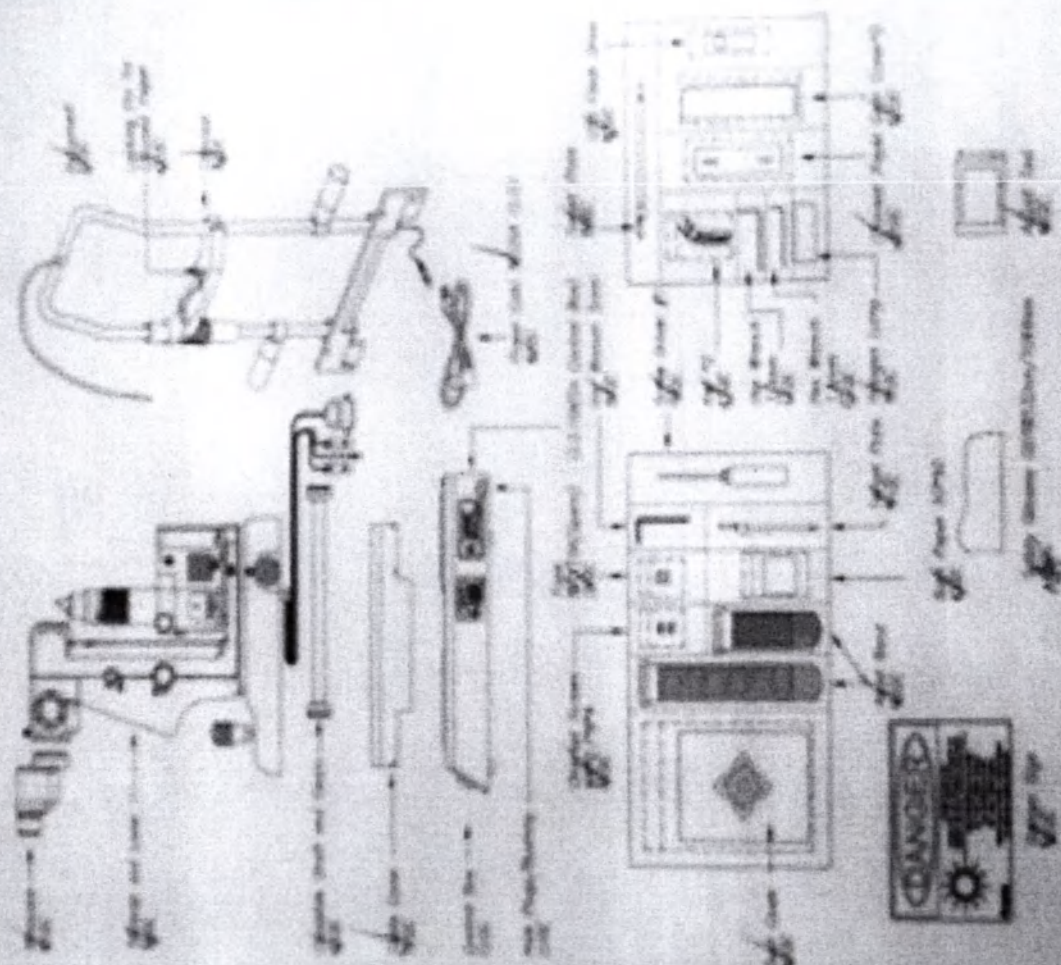


Diagram illustrating the components of the YAG Laser SYL2000, including the laser head, control console, foot pedal, and various cables and connectors.


Comments: _____

Customer Installation Personnel: _____

Lighted Inspector: William K. / 607

LF-1906-111 YAG Laser Packing List

20. Табличка лазерной безопасности.

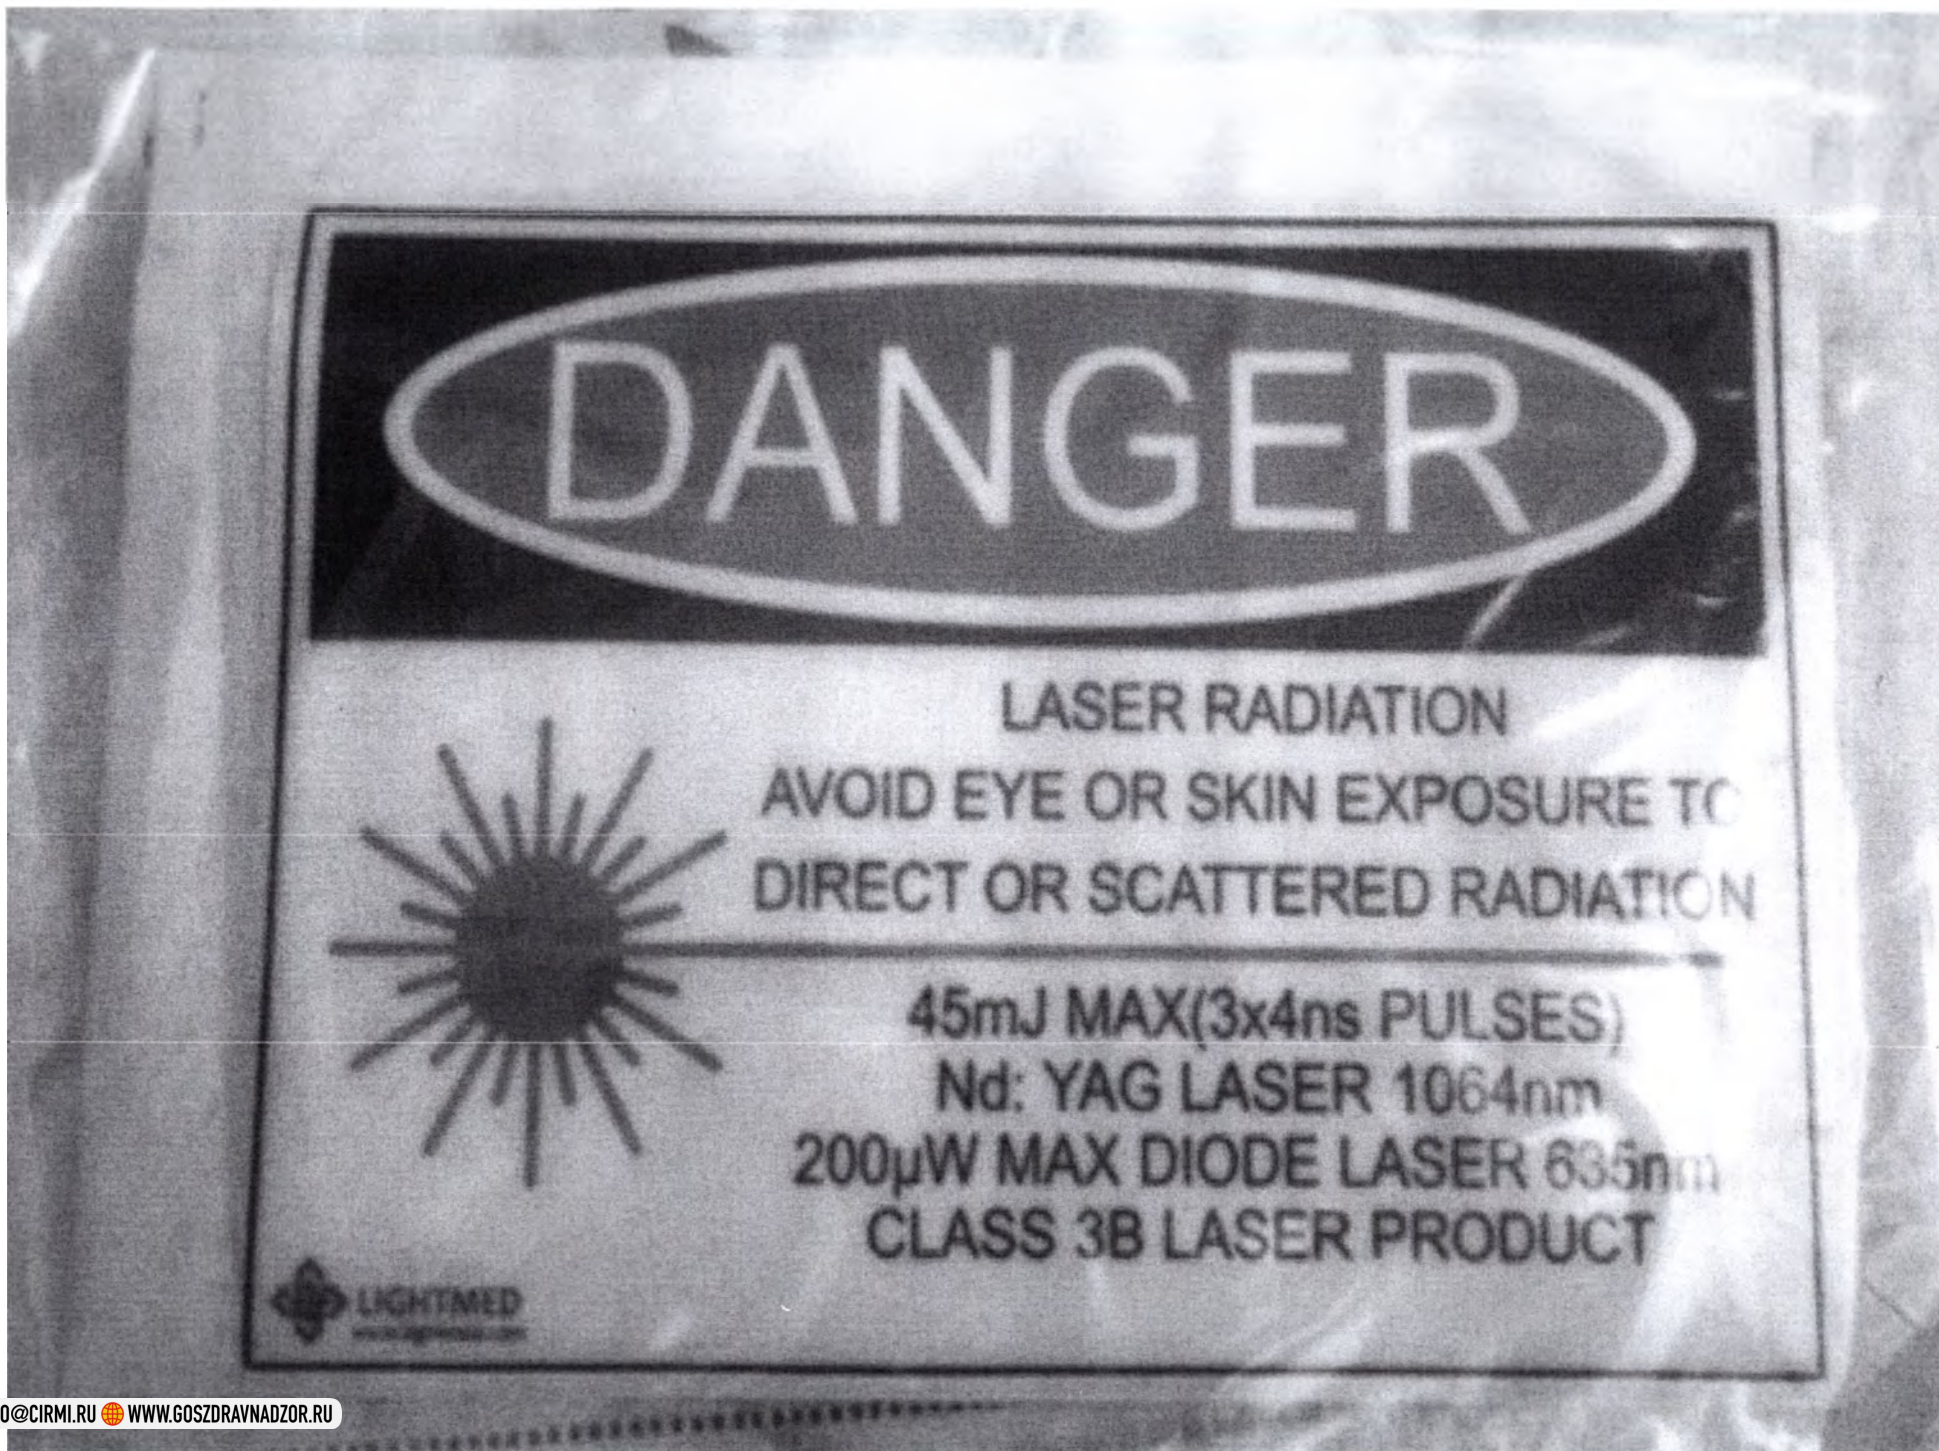

21. Фиксирующая лампочка для упора для подбородка.





22. Хирургическая линза для капсулотомии по Абрахаму.





23. Хирургическая линза для иридектомии по Абрахаму.





24. Разделитель луча для YAG лазера.






25. Микроскоп для ассистента (используется совместно с разделителем луча для YAG лазера).




26. Адаптер для видео камеры (используется совместно с разделителем луча для YAG лазера).




27. Адаптер для камеры (используется совместно с разделителем луча для YAG лазера).

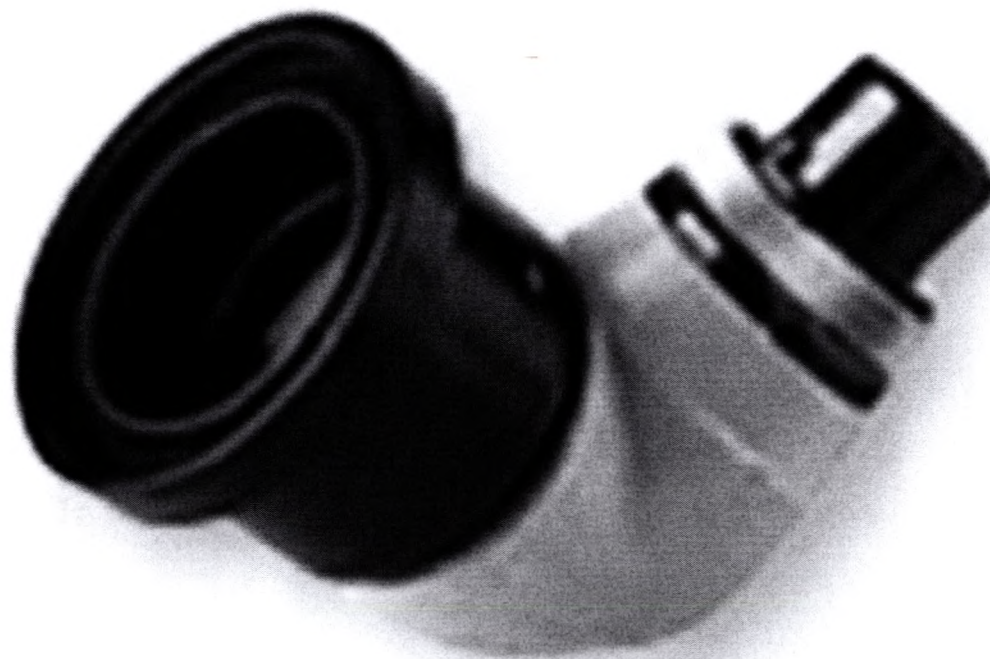

28. Моторизованный стол с крышкой с центральной подъемной колонной.

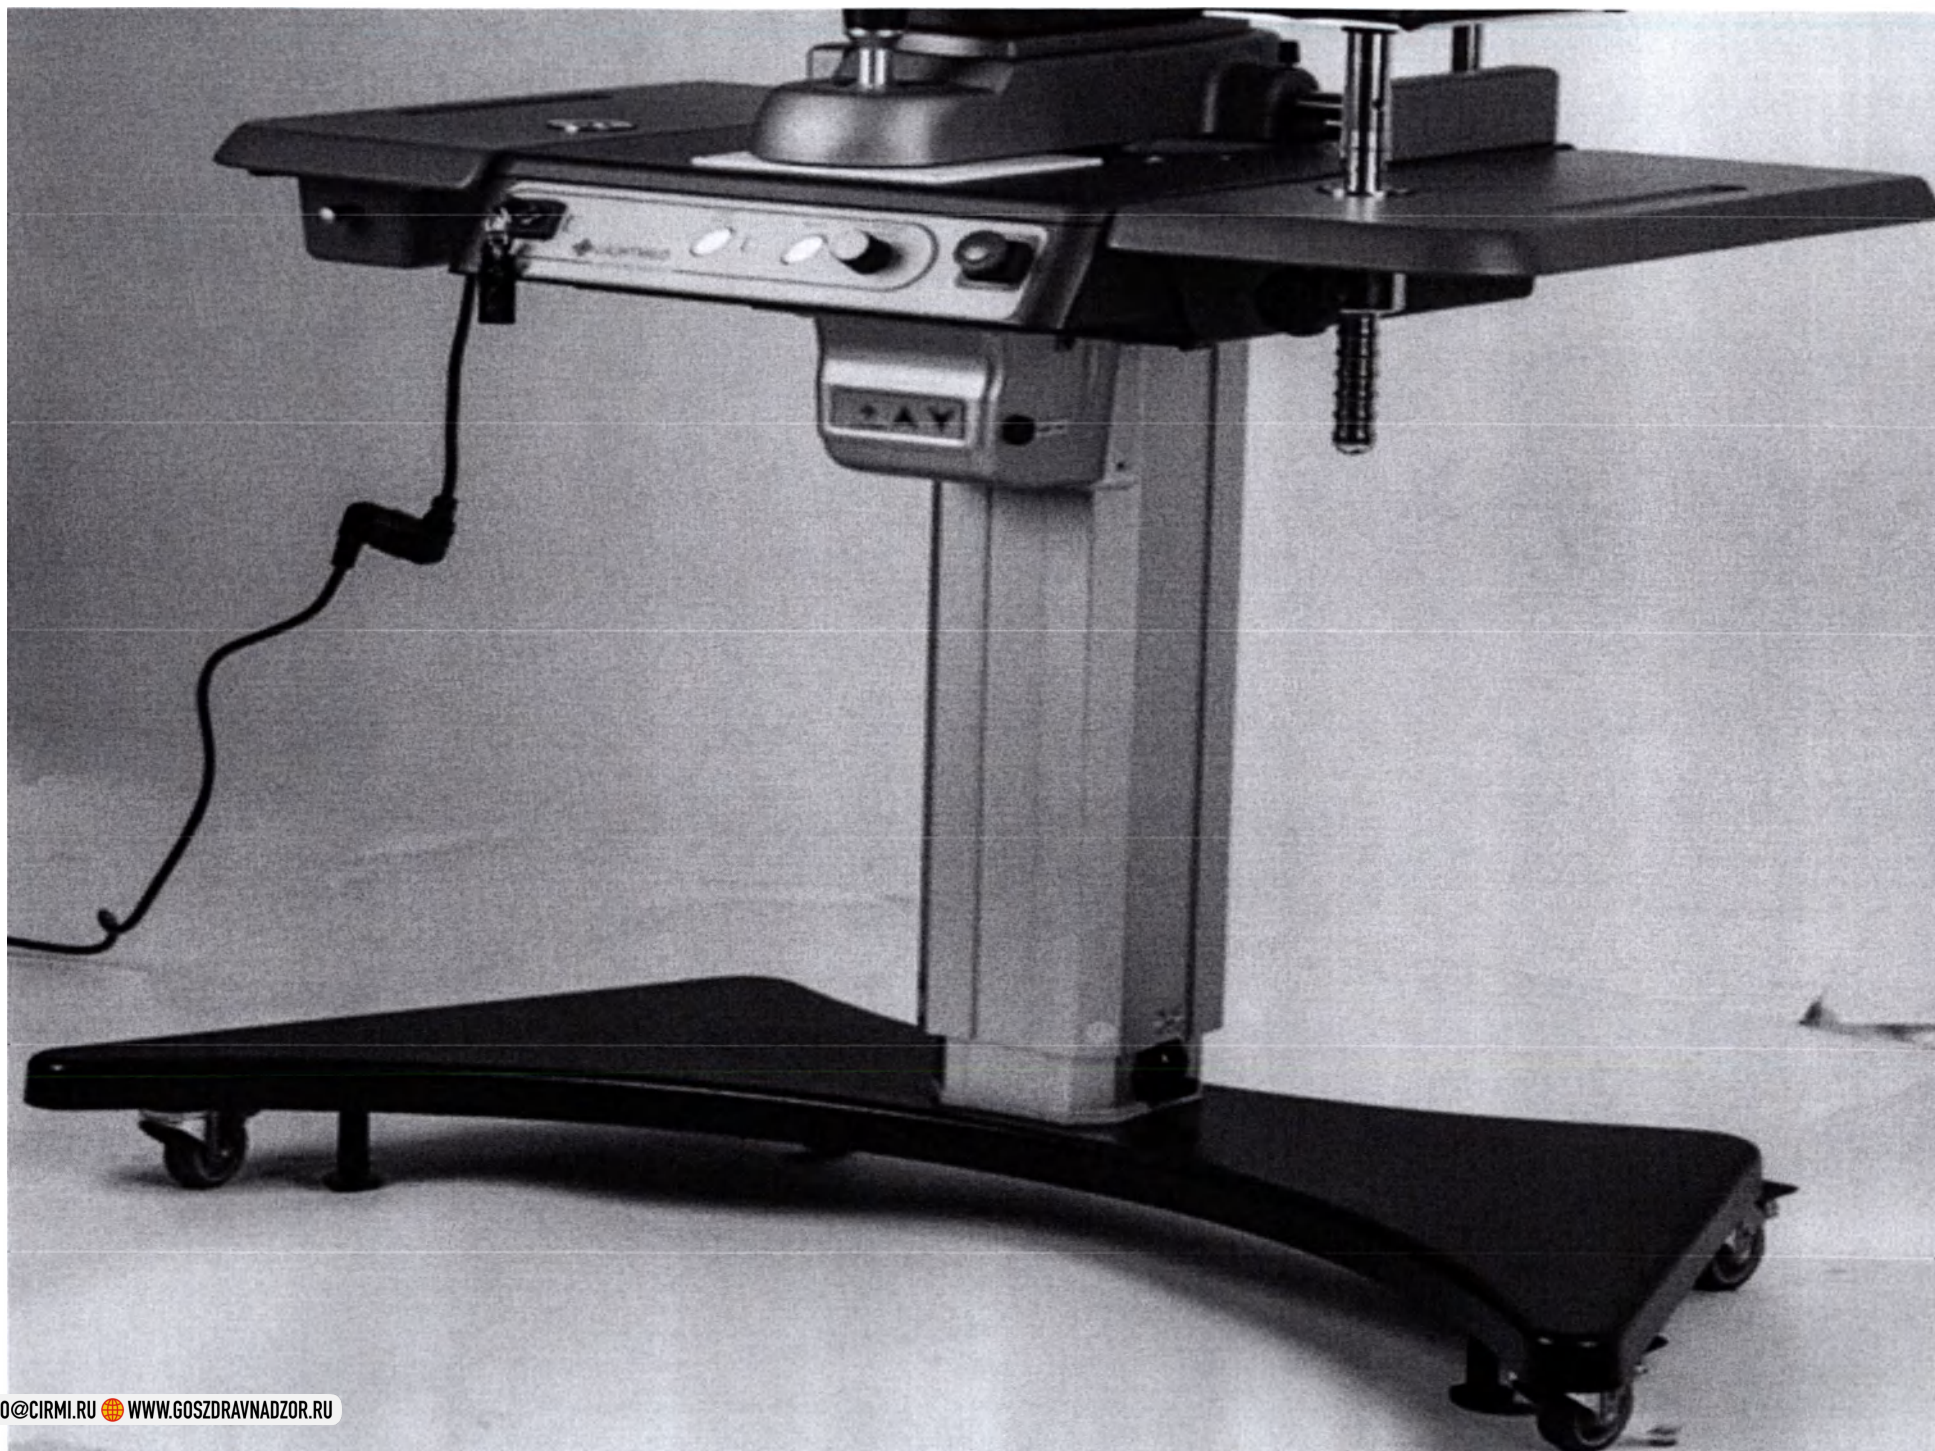

29. Моторизованный стол с крышкой с боковыми подъемными колоннами.

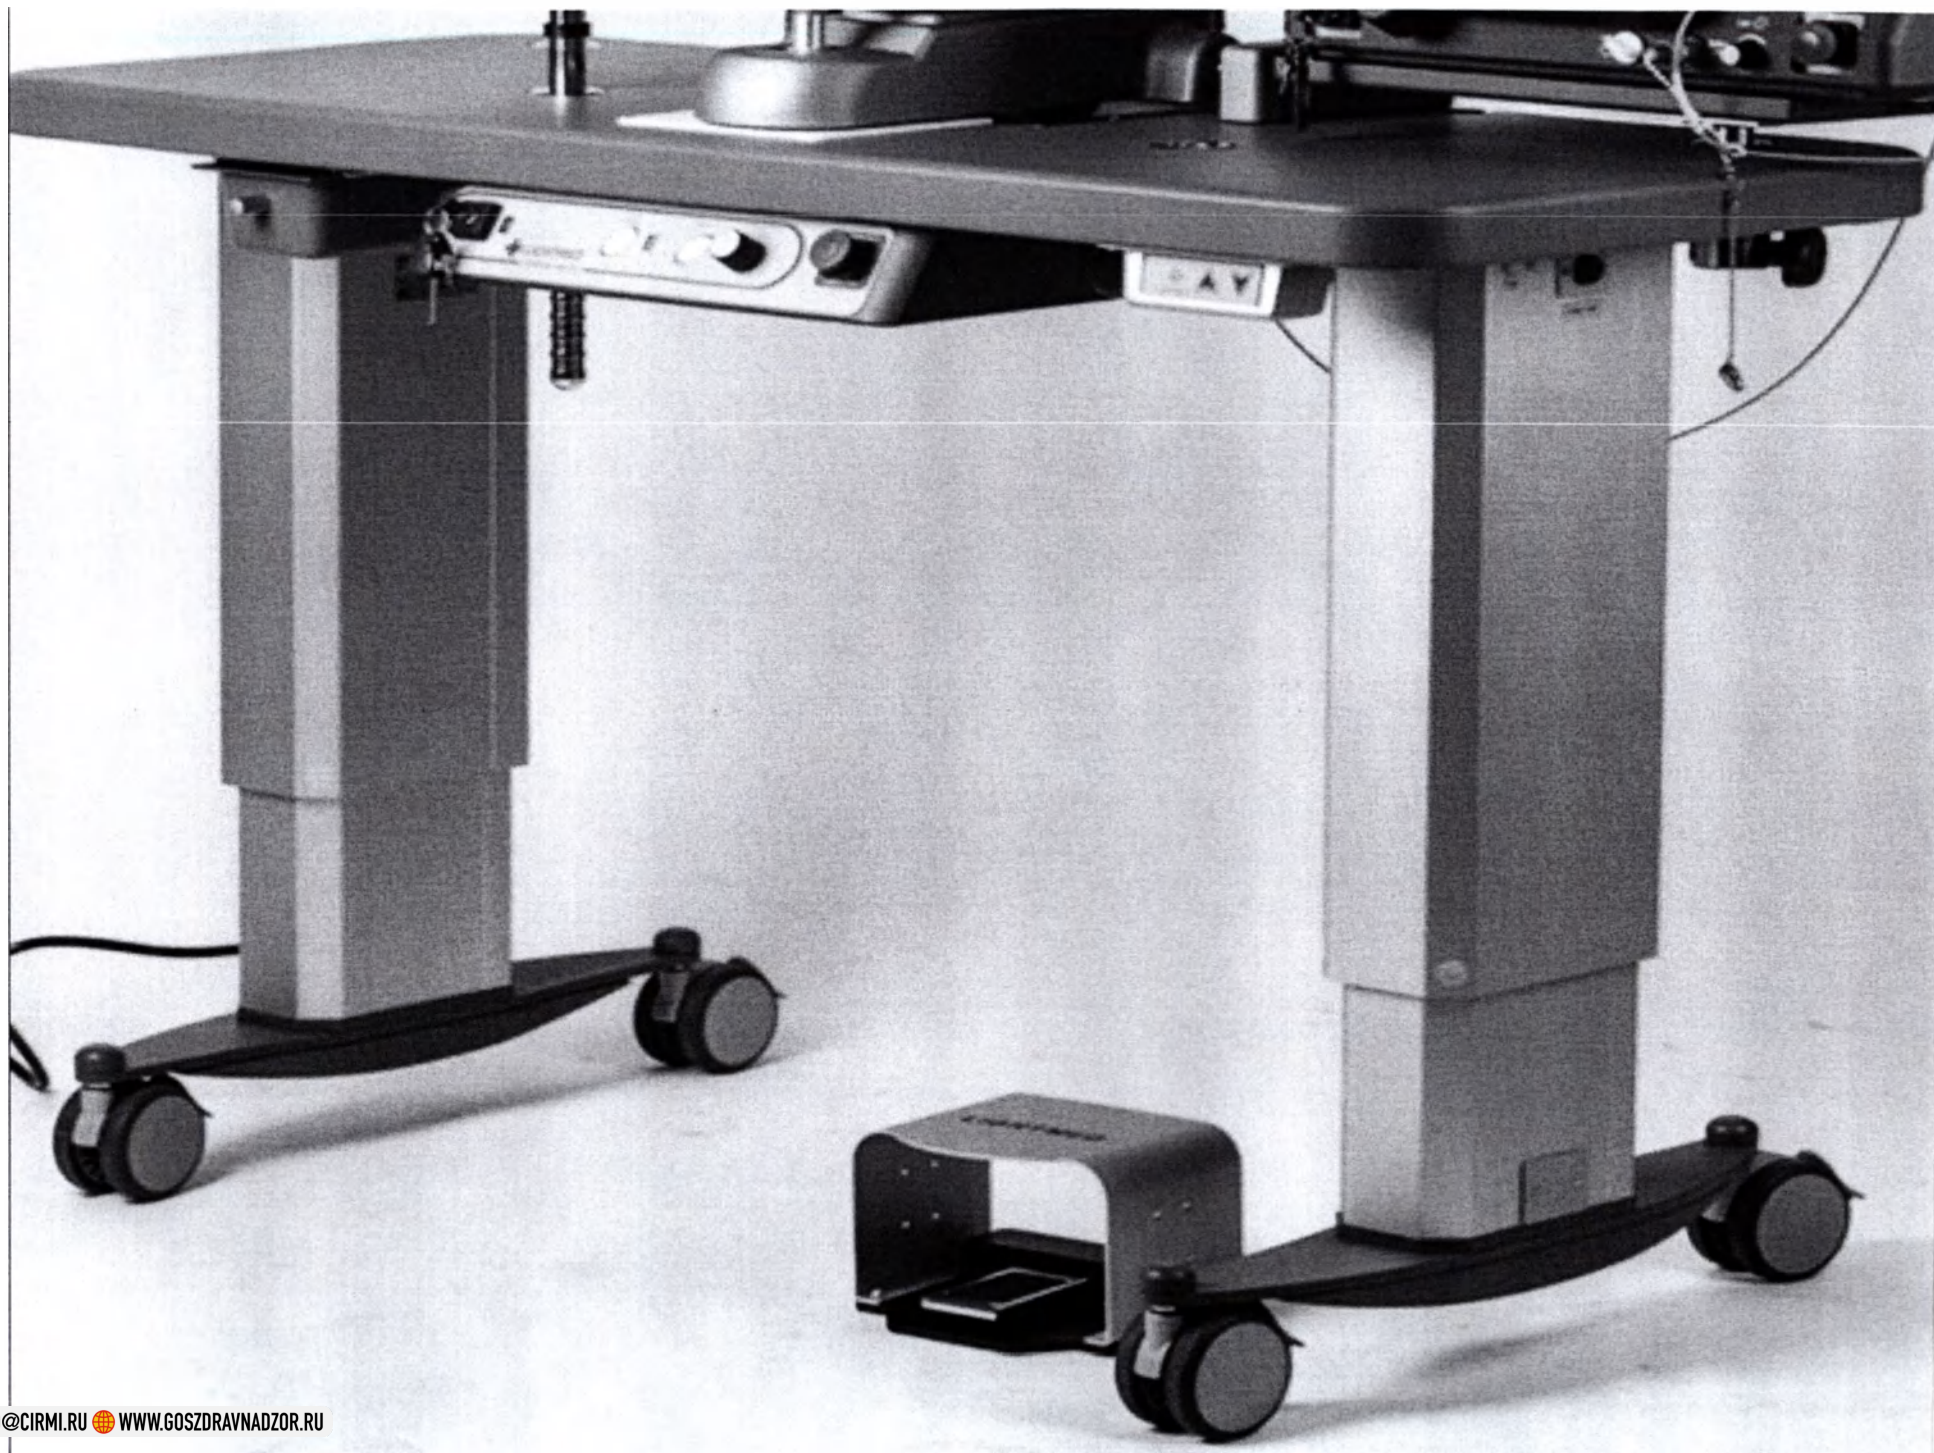


30. Защитные очки OD5 532 нм.



31. Защитные очки OD5 1064 нм.




32. Педаль.

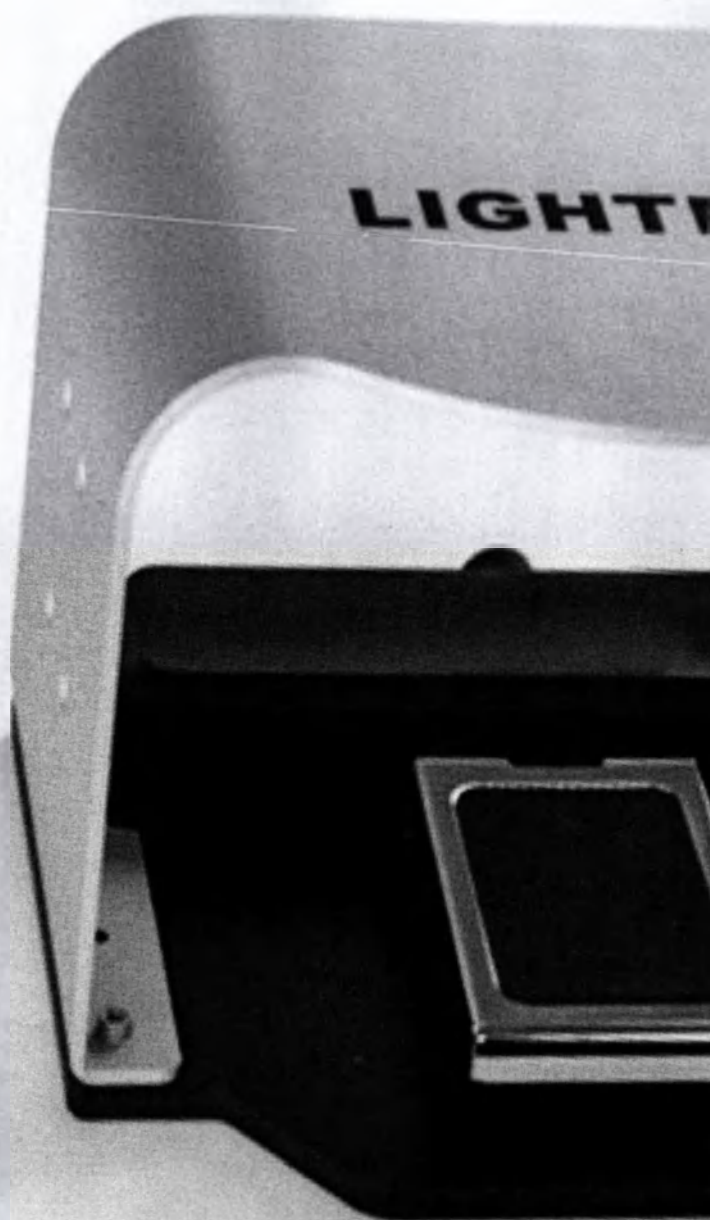





33. Монтажная пластина для крепления аппланационного тонометра (Тип Т900).

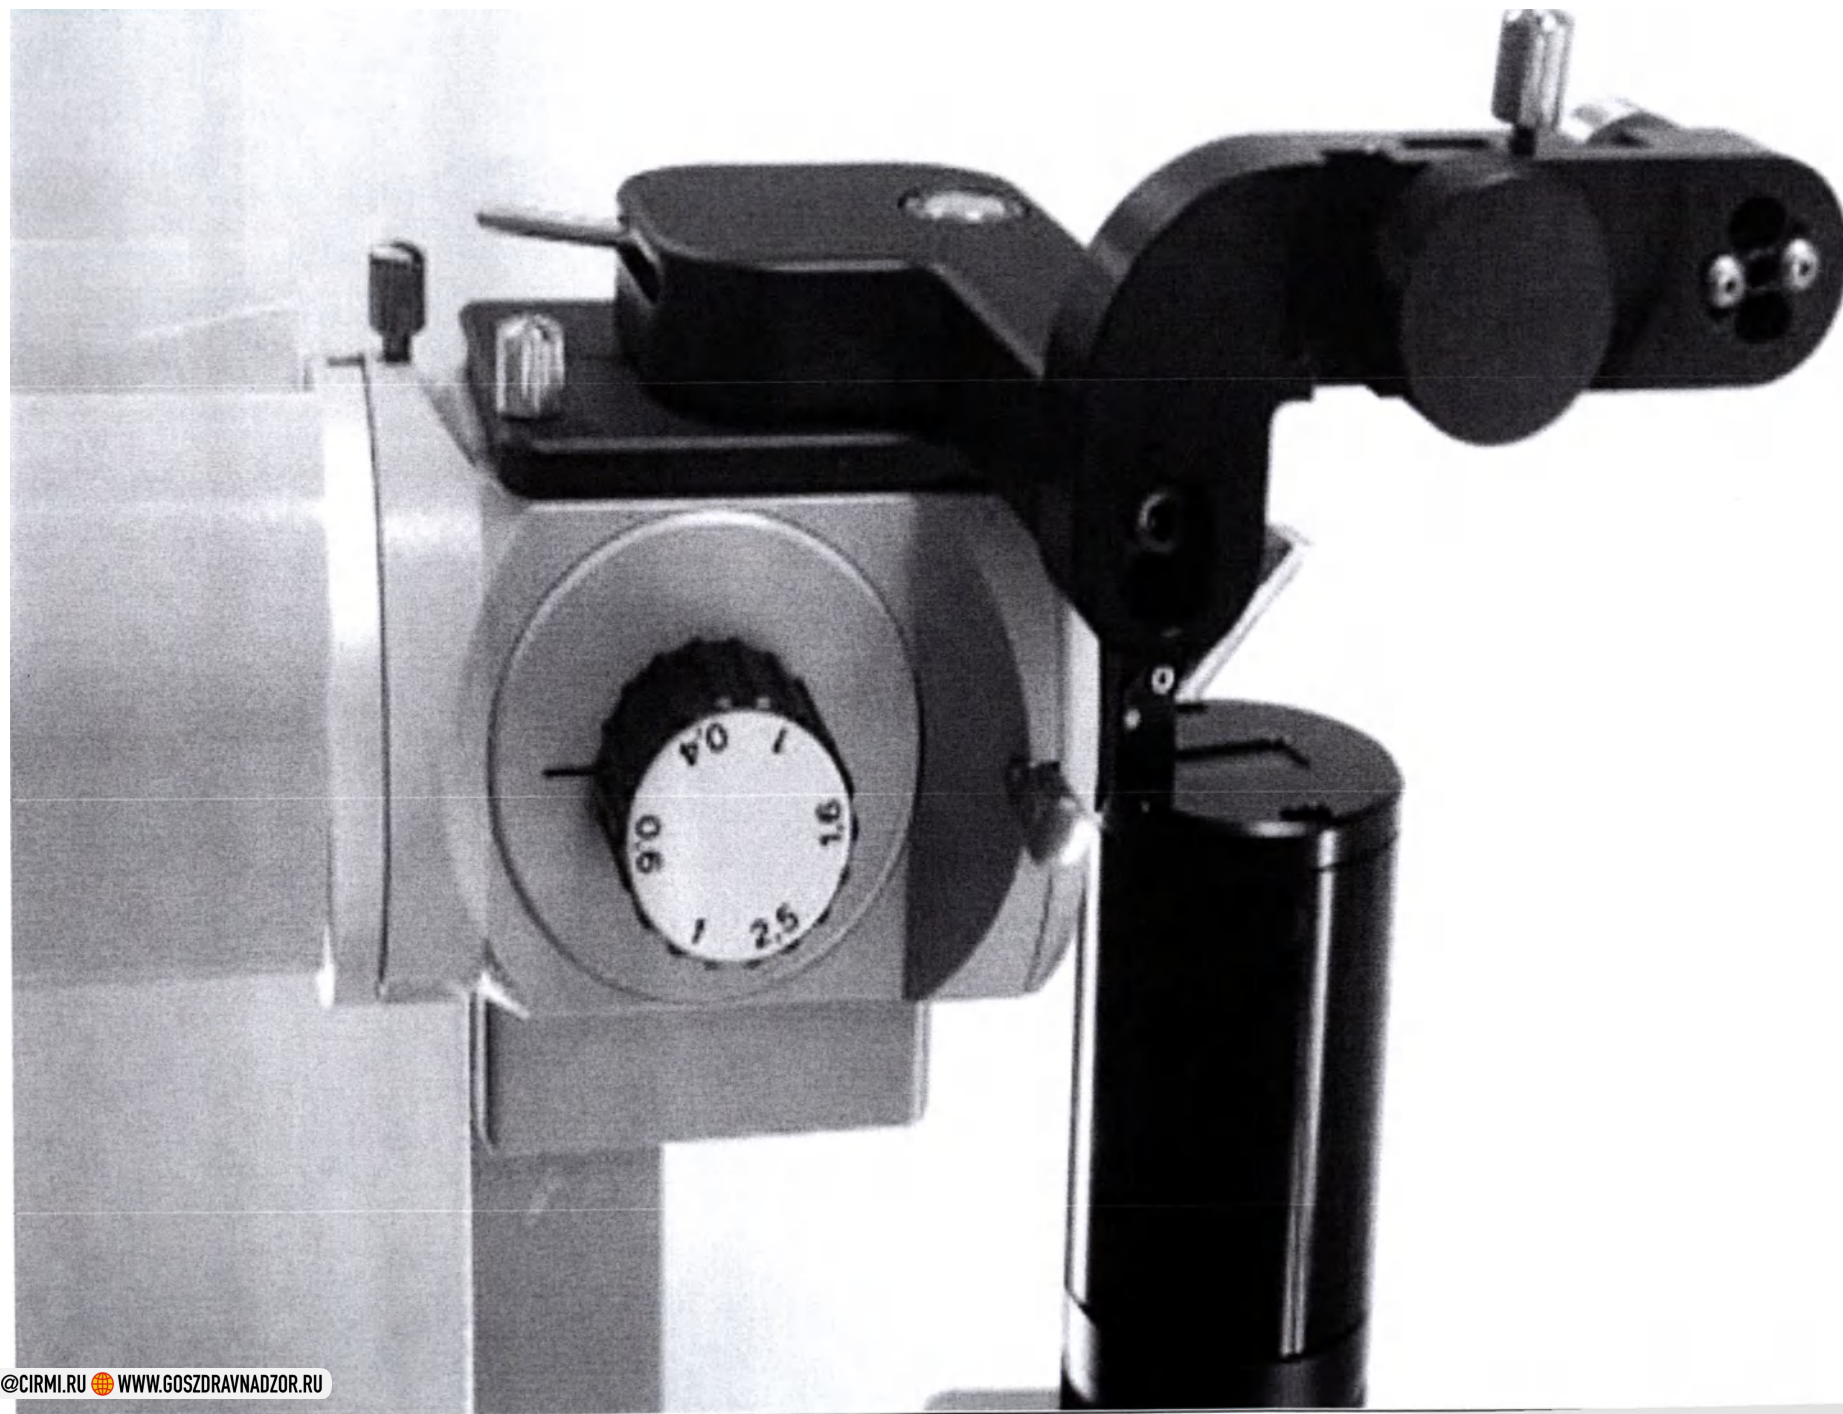


34. Крепление для аппланационного тонометр 870Z.

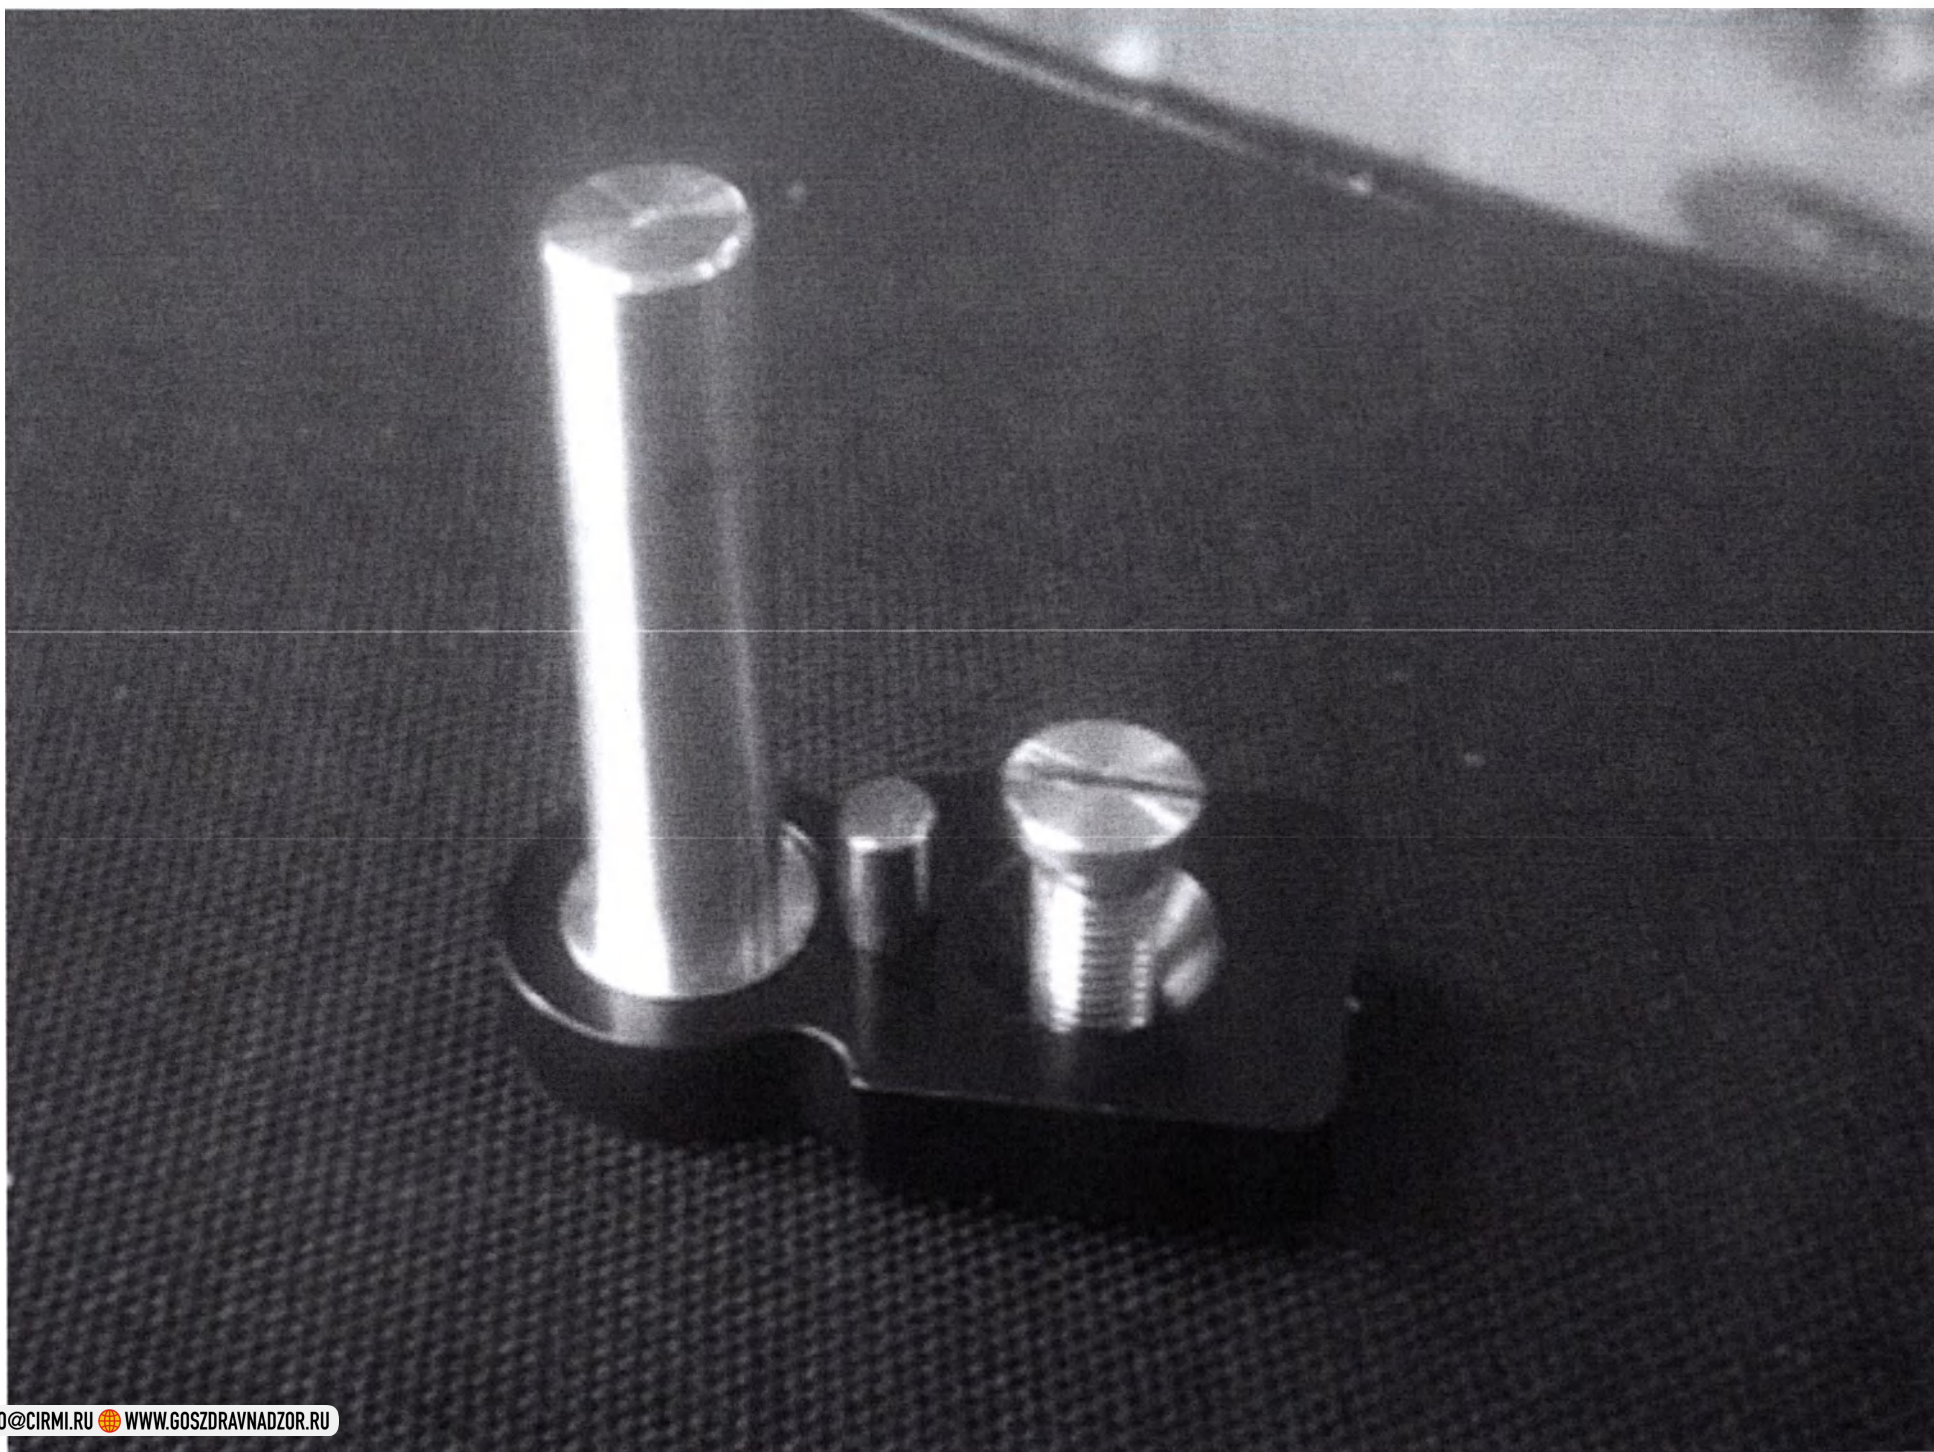


35. Набор тестовых глаз.

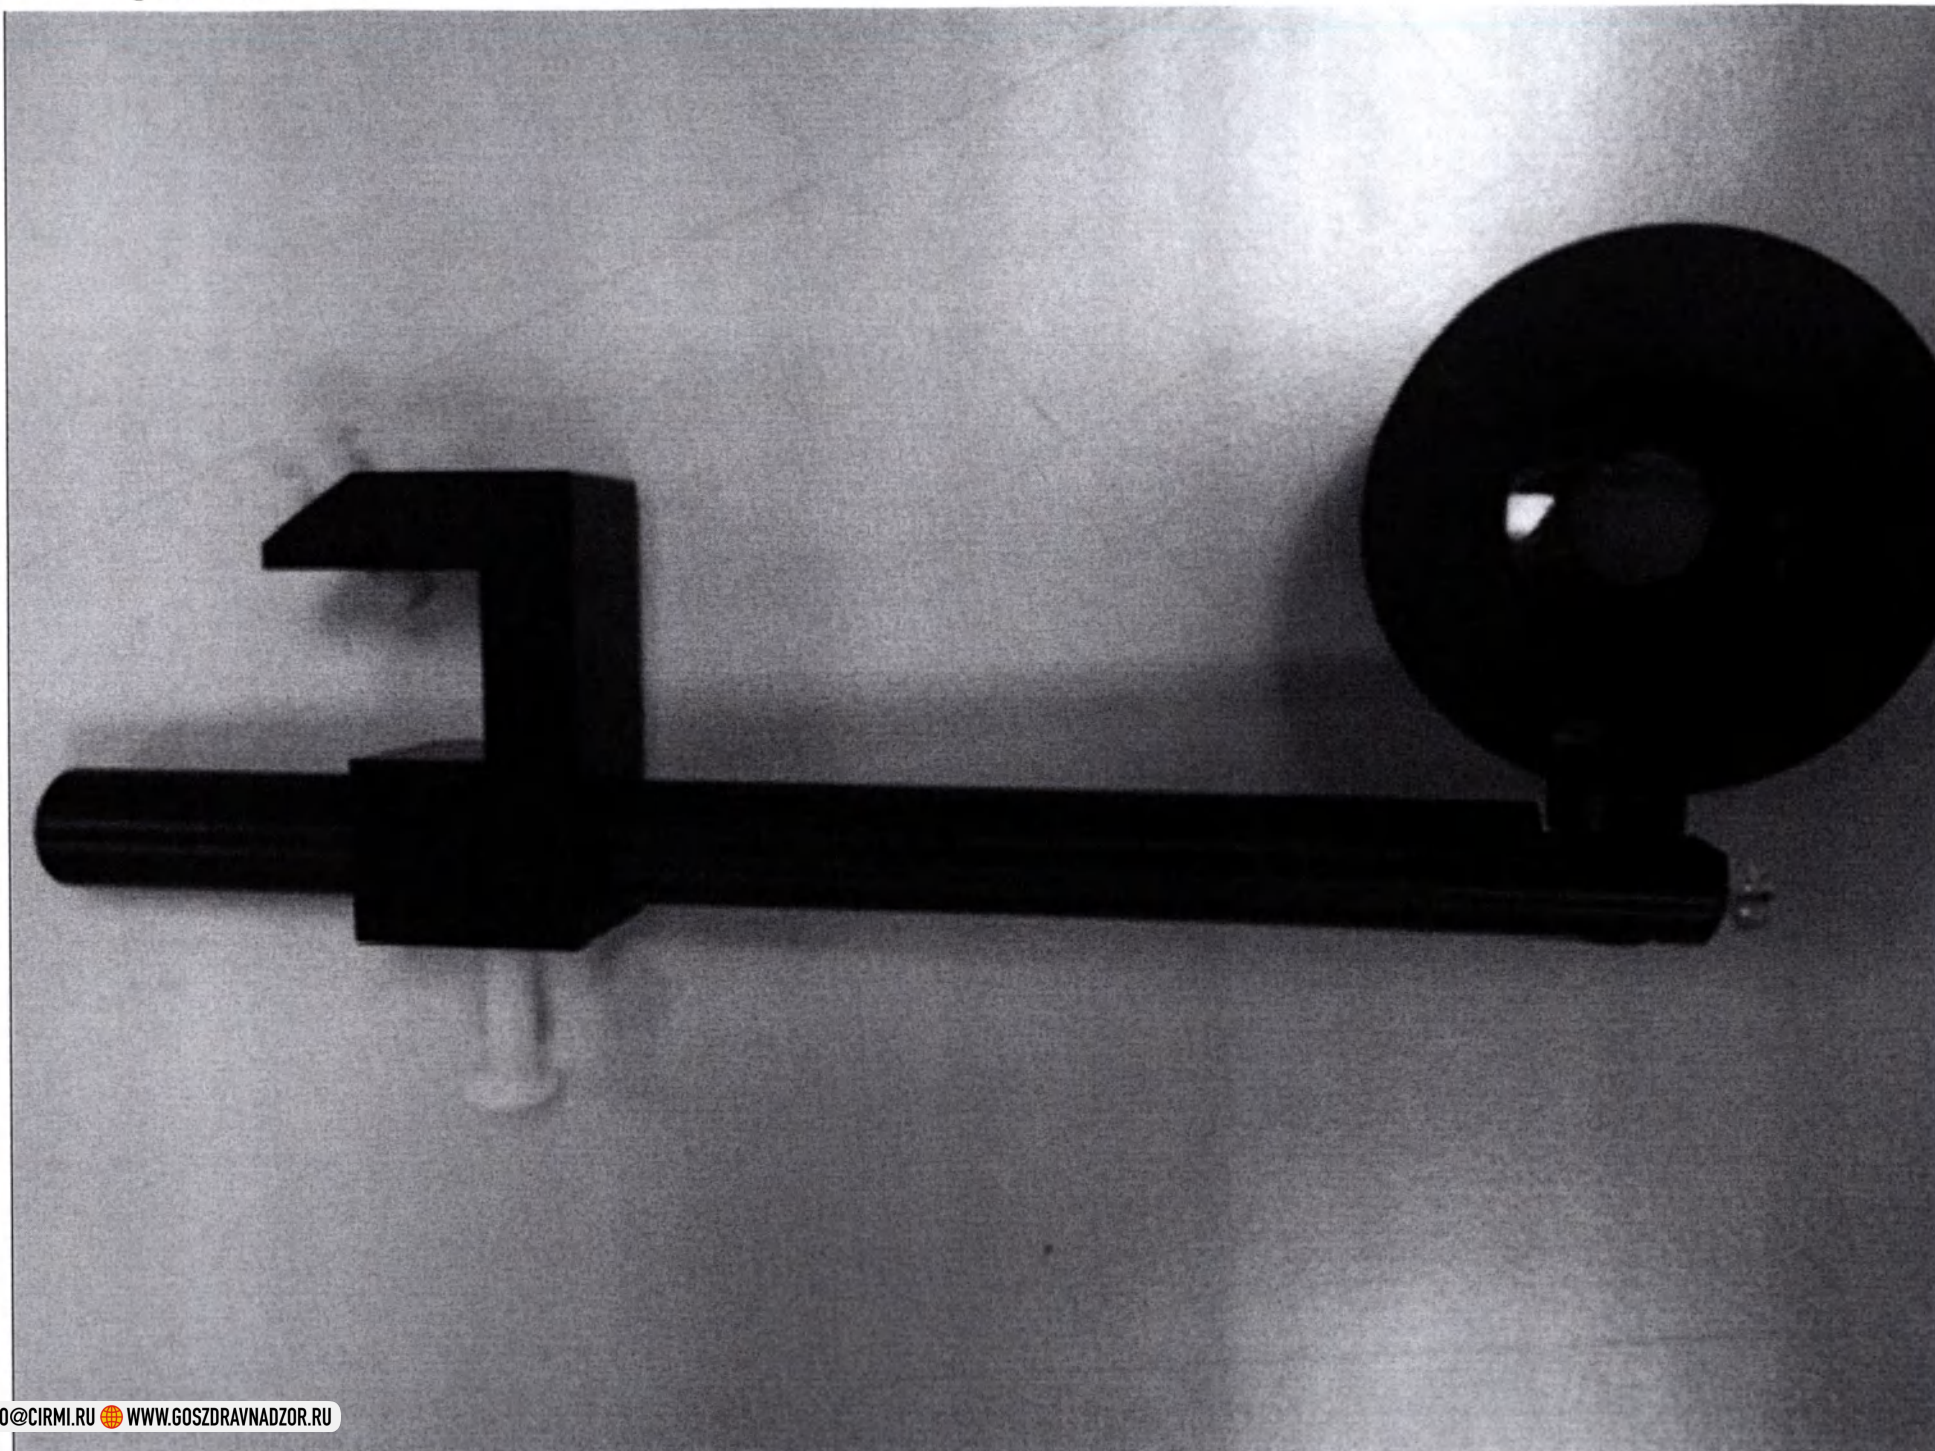



36. Мембраны для набора тестовых глаз.

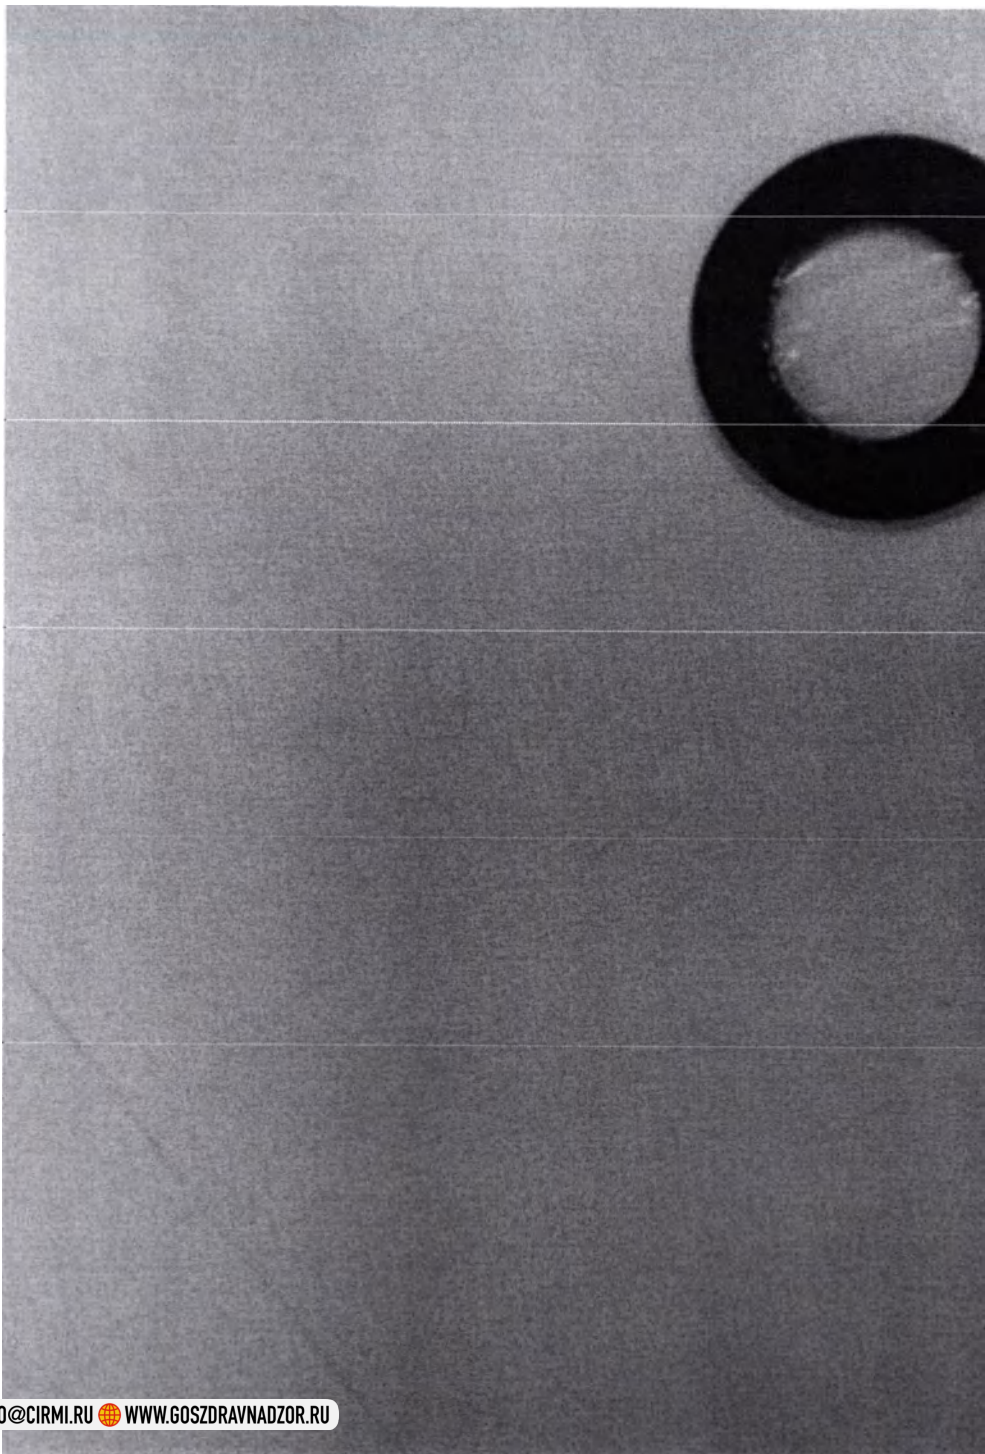

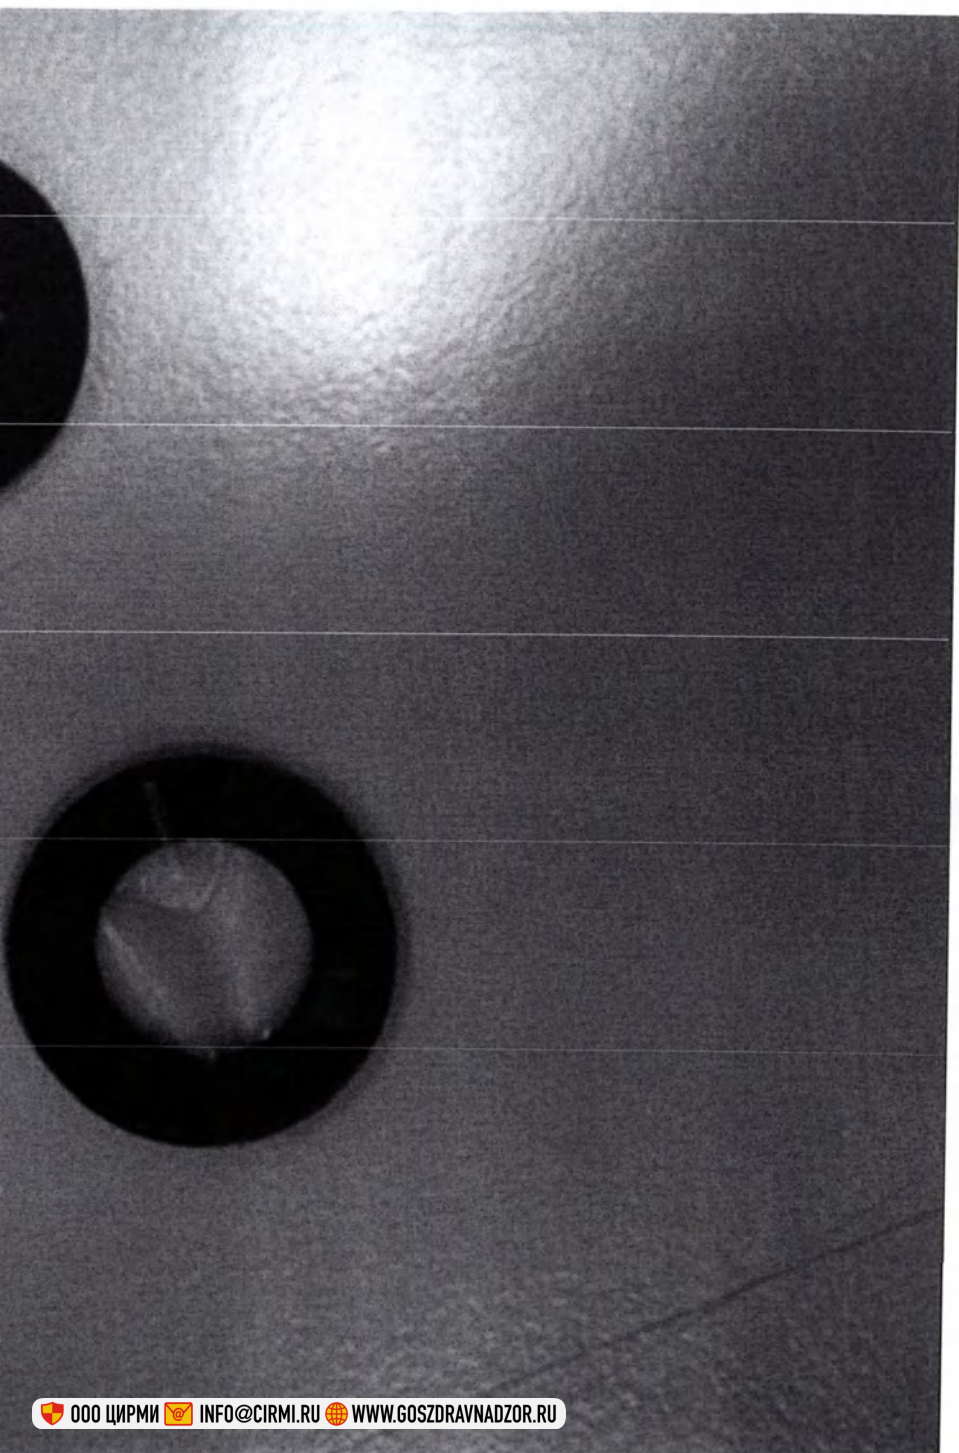


37. Бумага для упора для подбородка.

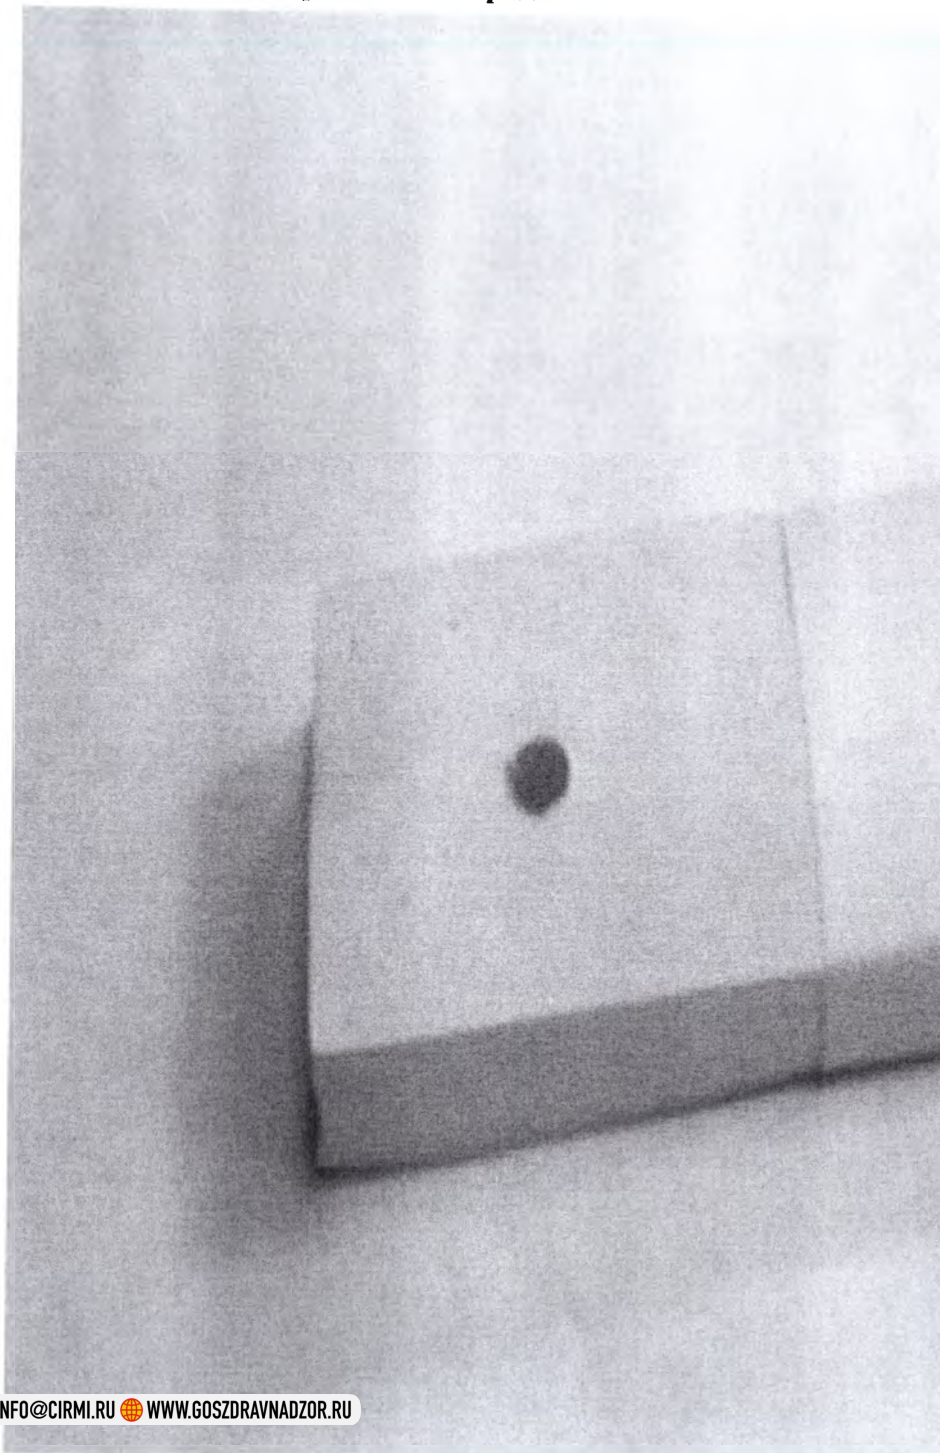

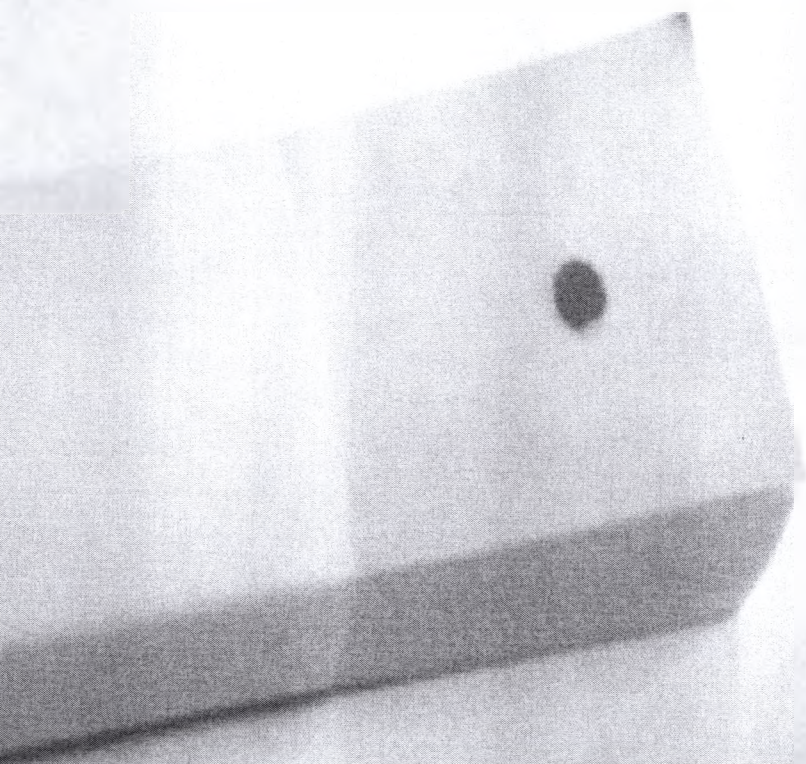

38. Лампочка щелевой лампы, галогеновая 6В 20Вт тип HLX 64251.

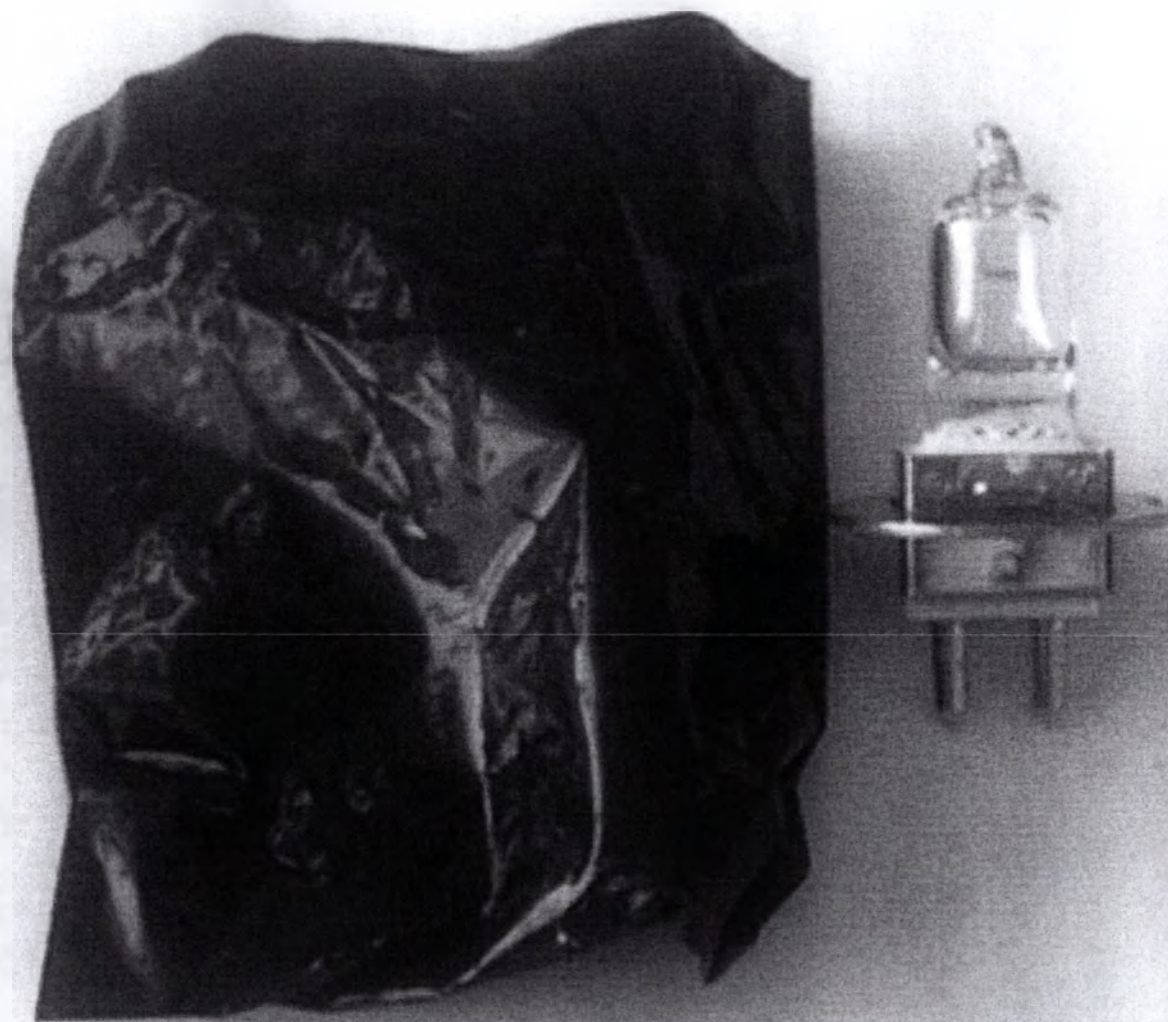

Руководство оператора

для

**Системы офтальмологические
лазерные, модели: DIXION
LPULSA SYL-9000.**

LIGHTMED

Руководство оператора

для

Системы офтальмологические
лазерные, модели:

DIXION SeLecTor Deux.

LIGHTMED

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО

45 ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «ДИКСИОН»
Яковлев А.А.

