



Сделано в России

Аппарат для функциональной многоканальной
электромиостимуляции «Орторент ФЭС»

ТУ 26.60.13-023-11363852-2020

РУ № _____ от _____

Запрещено применять при наличии кардиостимулятора
и других имплантированных электронных устройств

Напряжение питания:  3,7 В

Макс.рабочий цикл: 30 мин-работа,20мин-пауза

 01

 03.2023

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б
Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru

 ООО "Орторент"



IP 30



Внешний вид нанесения маркировки
Аппарат для функциональной многоканальной электростимуляции
«Орторент ФЭС»



КОПИЯ ВЕРНА


ПОДПИСЬ

Друшечко Д. С.
17.10.2023


Аппарат для функциональной многоканальной электростимуляции «Орторент ФЭС» по ТУ 26.60.13-023-11363852-2020




Блок электростимуляции

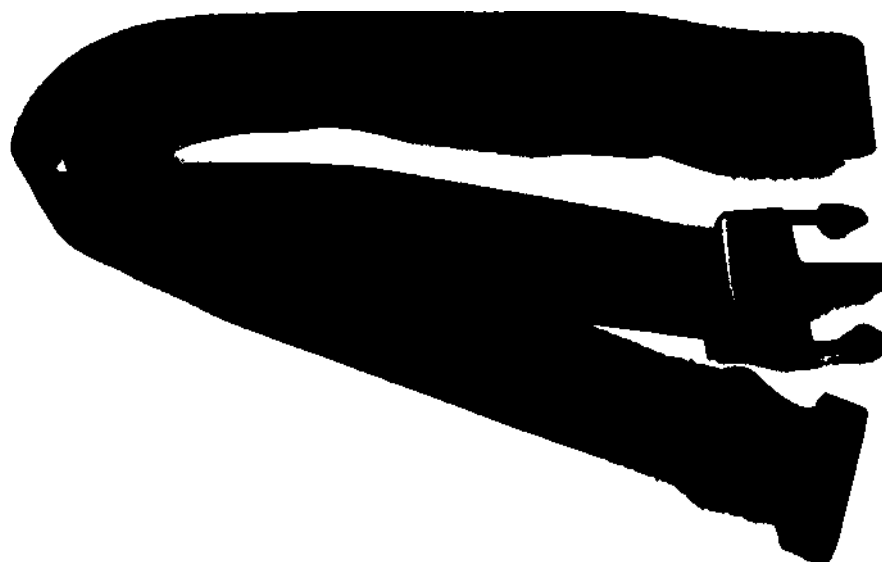


Ремень для ношения блока электростимуляции

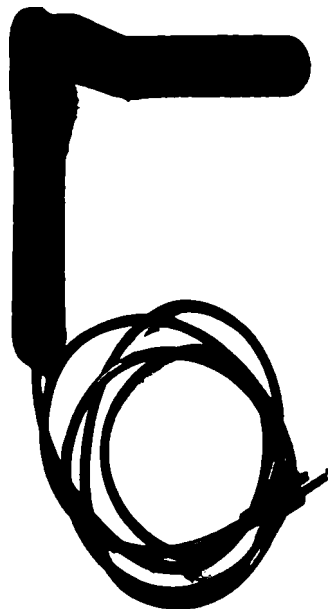



**Комплект датчиков измерения суставных углов
1) левый; 2) правый**

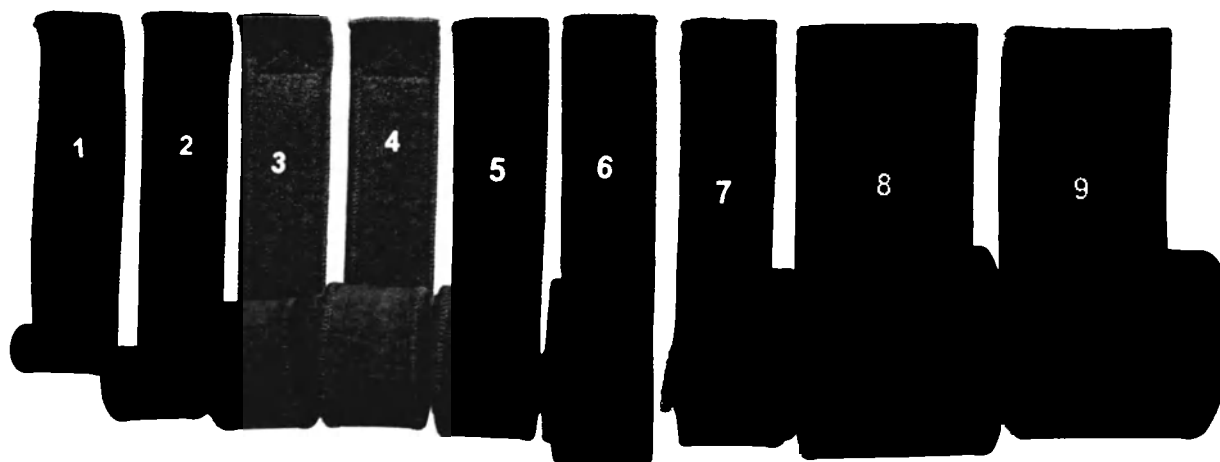


Комплект фиксирующих ремней

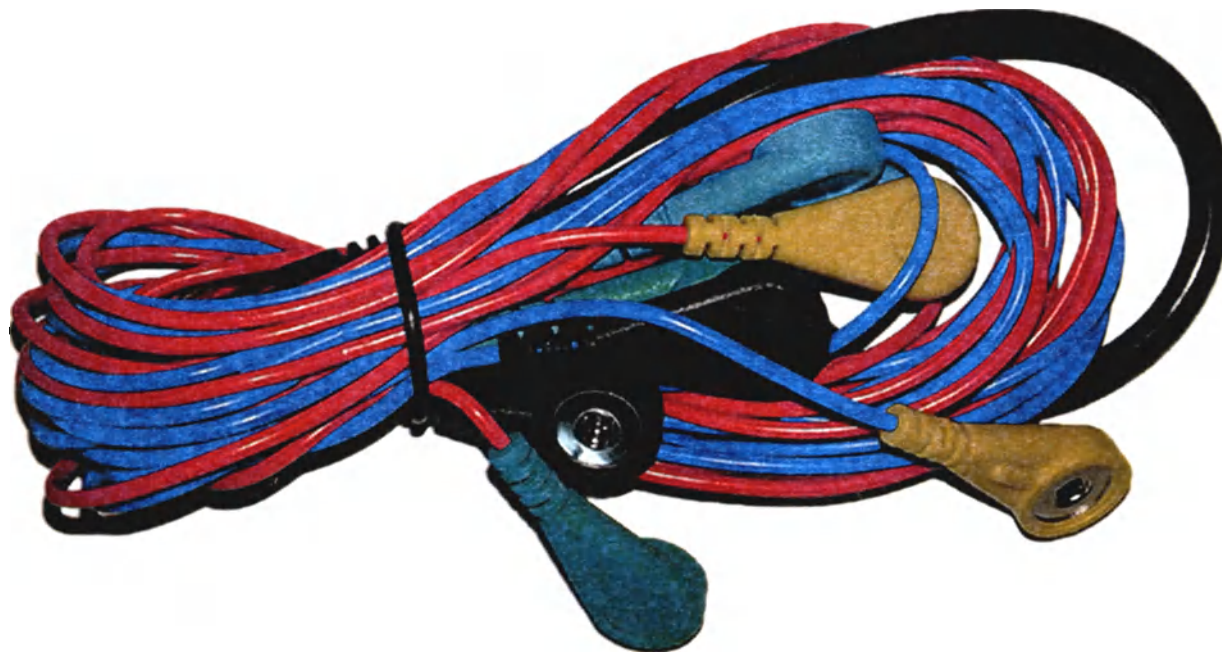


Кабель для подключения электродов

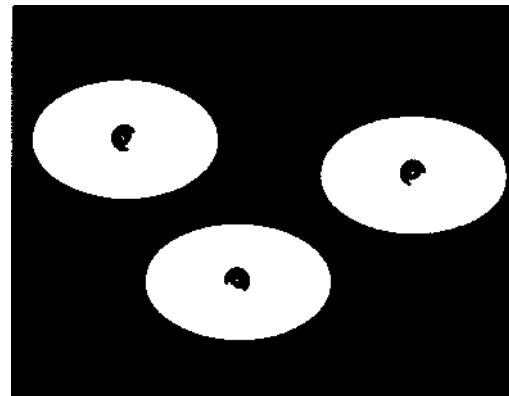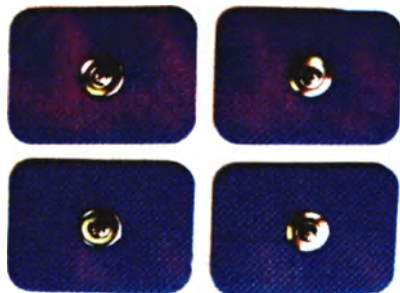

Электроды

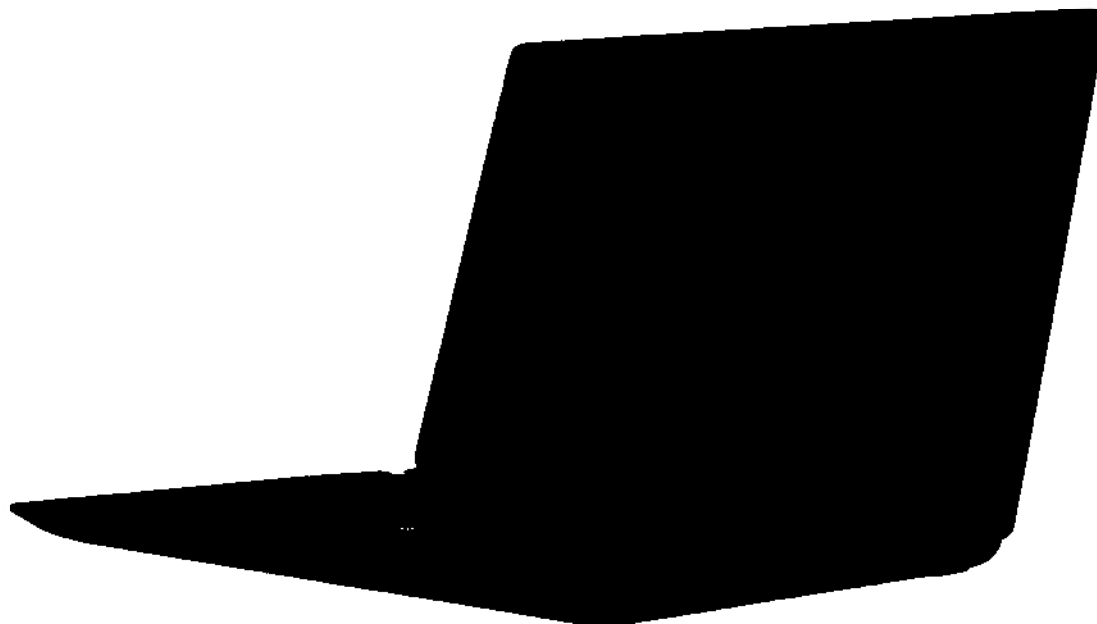


Портативный компьютер (ноутбук)

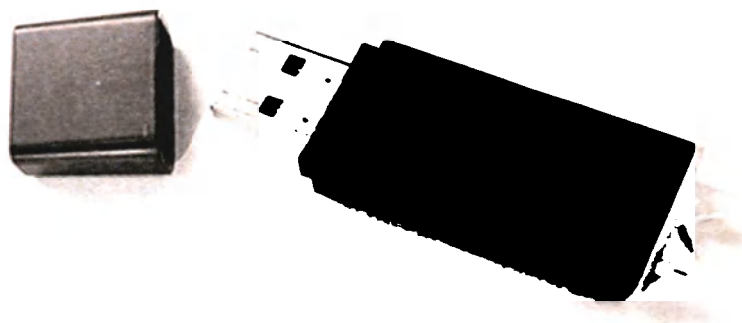


**USB-флеш-накопитель с программным
обеспечением «Орторент ФЭС»**



Зарядное устройство

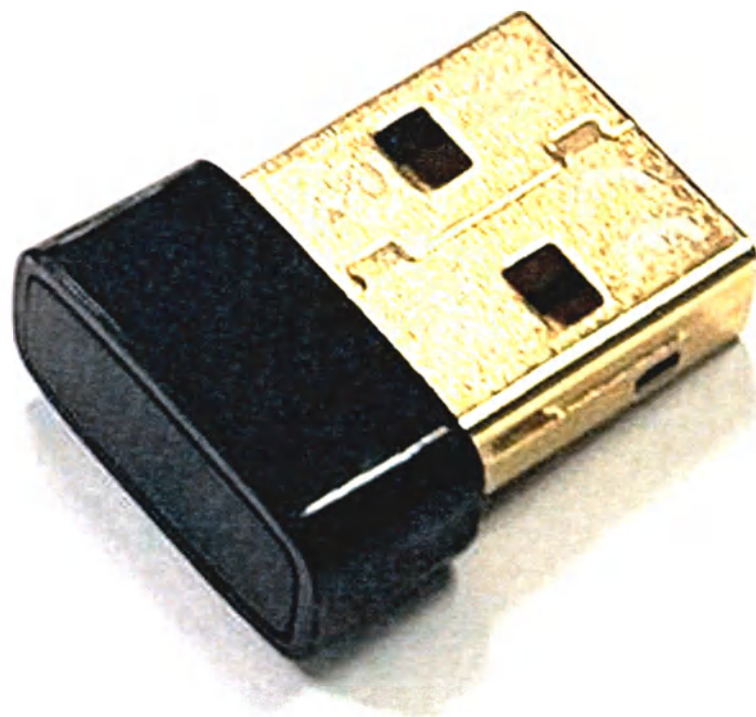

Адаптер USB Bluetooth

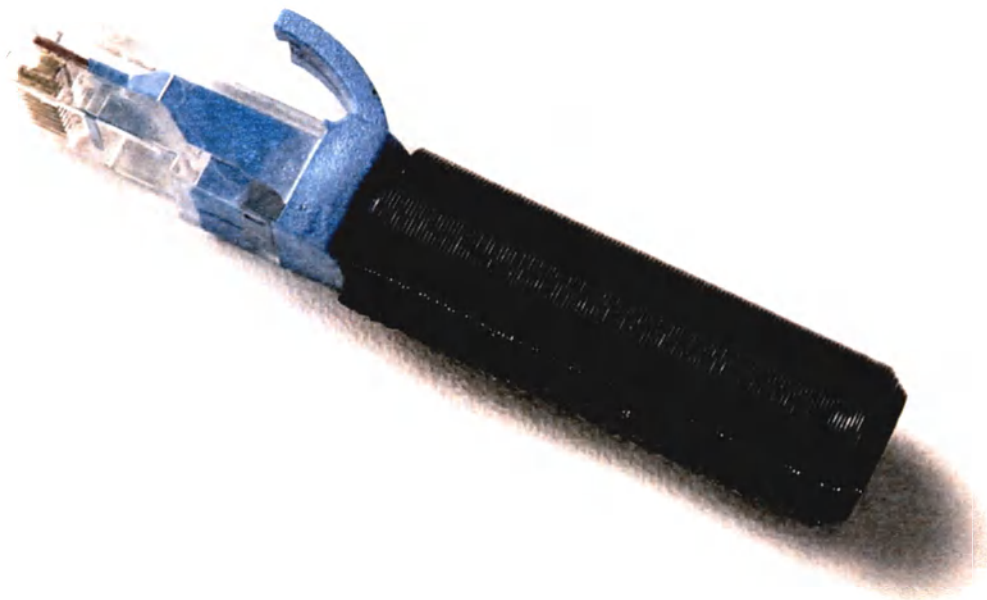

Ключ безопасности



Чемодан (кейс) для хранения и транспортировки



Упаковка

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ № 13 листов
Генеральный директор
ООО «Орторент» _____ Великов О. А.

