



УТВЕРЖДАЮ

Директор


ООО ИПФ «Литех»

А.Ю. Наумов

11 2022 г.

Фотографические изображения медицинского изделия


Автоматическая система для экспресс-идентификации микроорганизмов
методом масс-спектрометрии Smart MS 5020

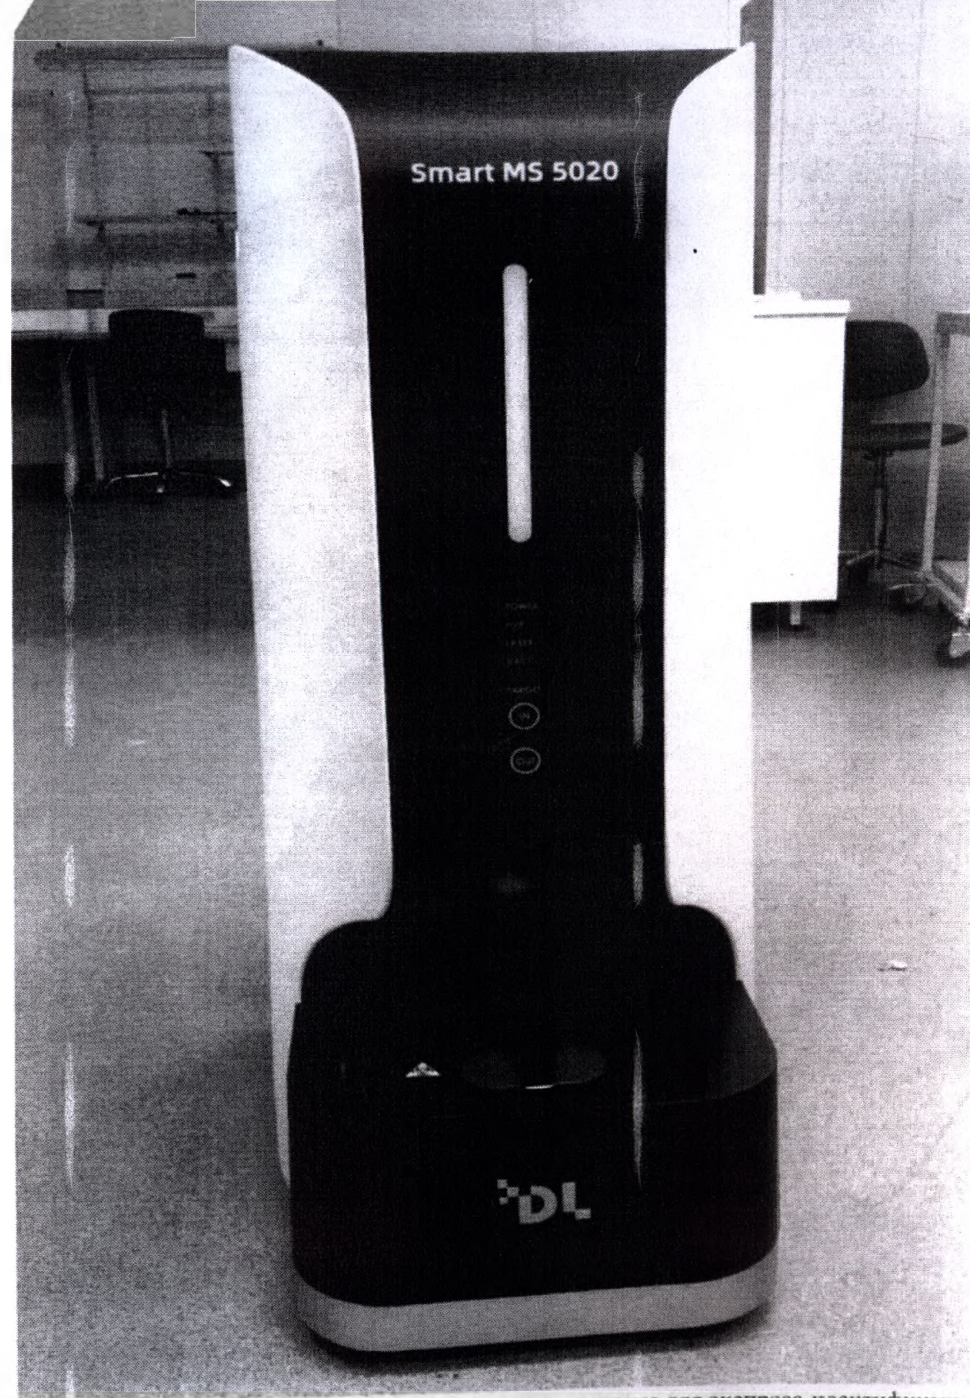


Фотографическое изображение 1 – Автоматическая система для экспресс-идентификации
микроорганизмов методом масс-спектрометрии Smart MS 5020




Фотографическое изображение 2 – Кабель питания

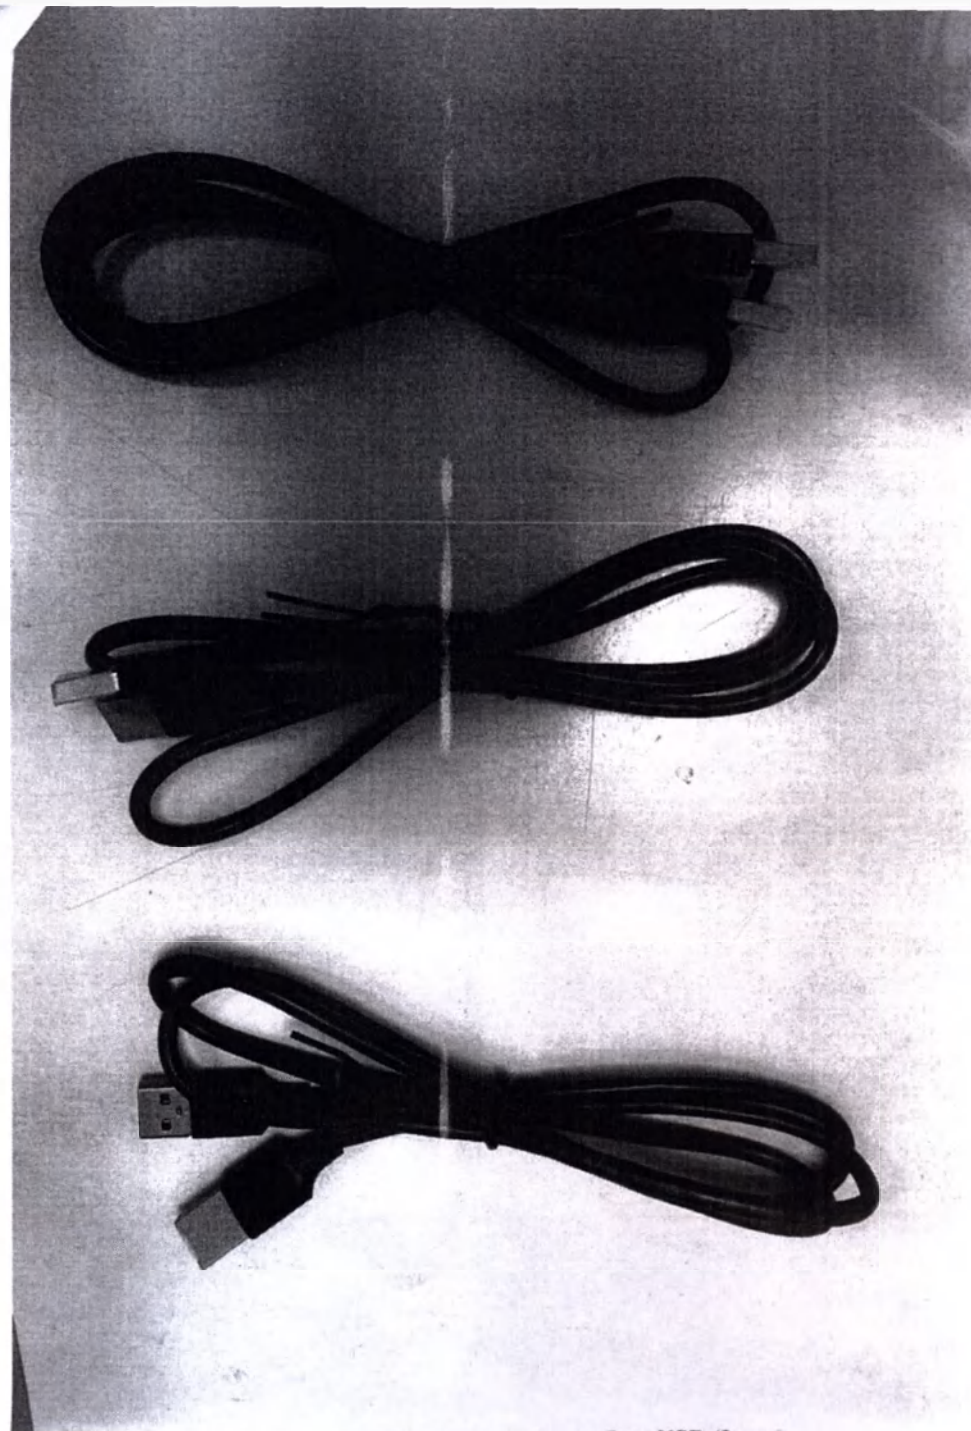

Фотографическое изображение 3 – Кабель USB (3 шт.)

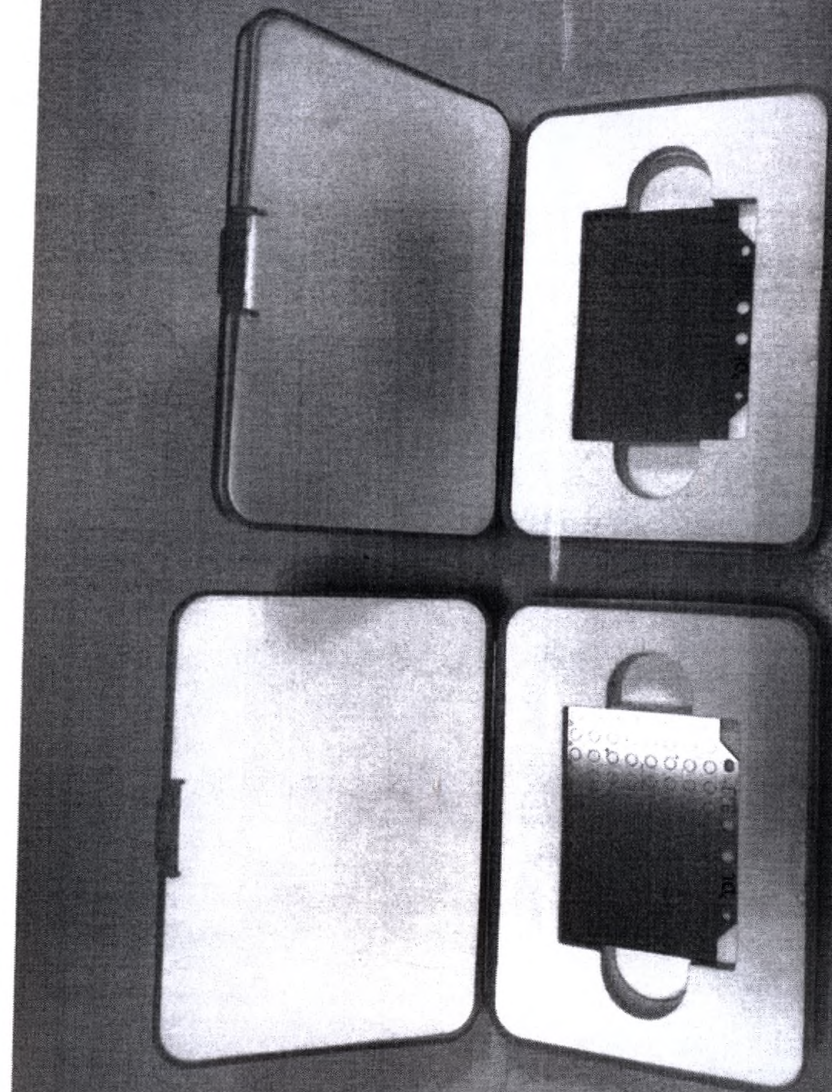

Фотографическое изображение 4 – Многоразовая металлическая мишень (2 шт)

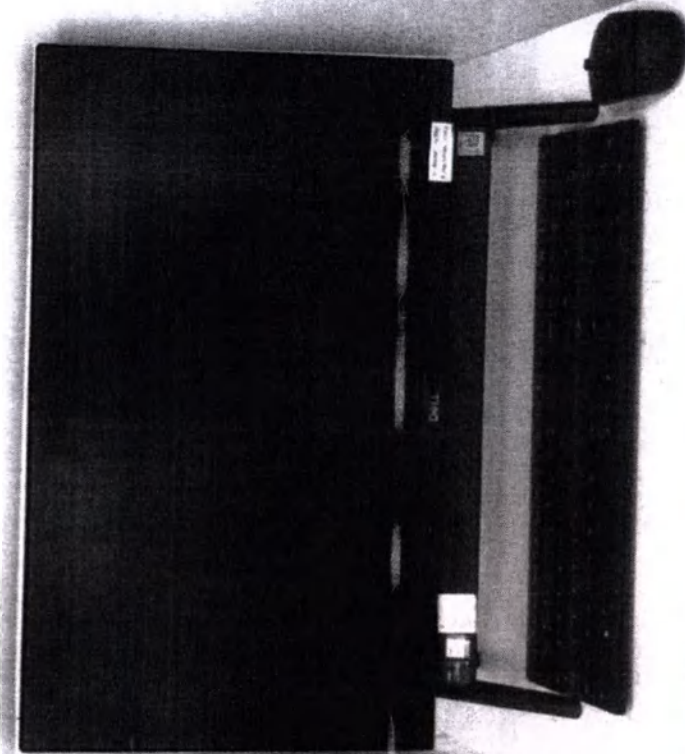

Фотографическое изображение 5 – Рабочая станция с интегрированным монитором, в составе (рабочая станция с интегрированным монитором, клавиатура, мышь)



Фотографическое изображение 6 – Рабочая станция с интегрированным монитором, в составе (Блок питания)





Фотографическое изображение 7 – Рабочая станция с интегрированным монитором, в составе (Кабель питания)