


Фотографические изображения

«Дилуэнт для разведения пробы при выполнении тестов на модулях биохимических cobas c (ISE Diluent Gen.2 Roche/Hitachi), бутыл, объем 2 л, 2 шт.»

Дилуент для разведения пробы при выполнении тестов на модулях биохимических cobas c (ISE Diluent Gen.2 Roche/Hitachi), бутыль, объем 2 л, 2 шт. (общий вид)




Дилуэнт для разведения пробы при выполнении тестов на модулях биохимических cobas с (ISE Diluent Gen.2 Roche/Hitachi), бутыль, объем 2 л, 2 шт. (маркировка лицевой стороны коробки)

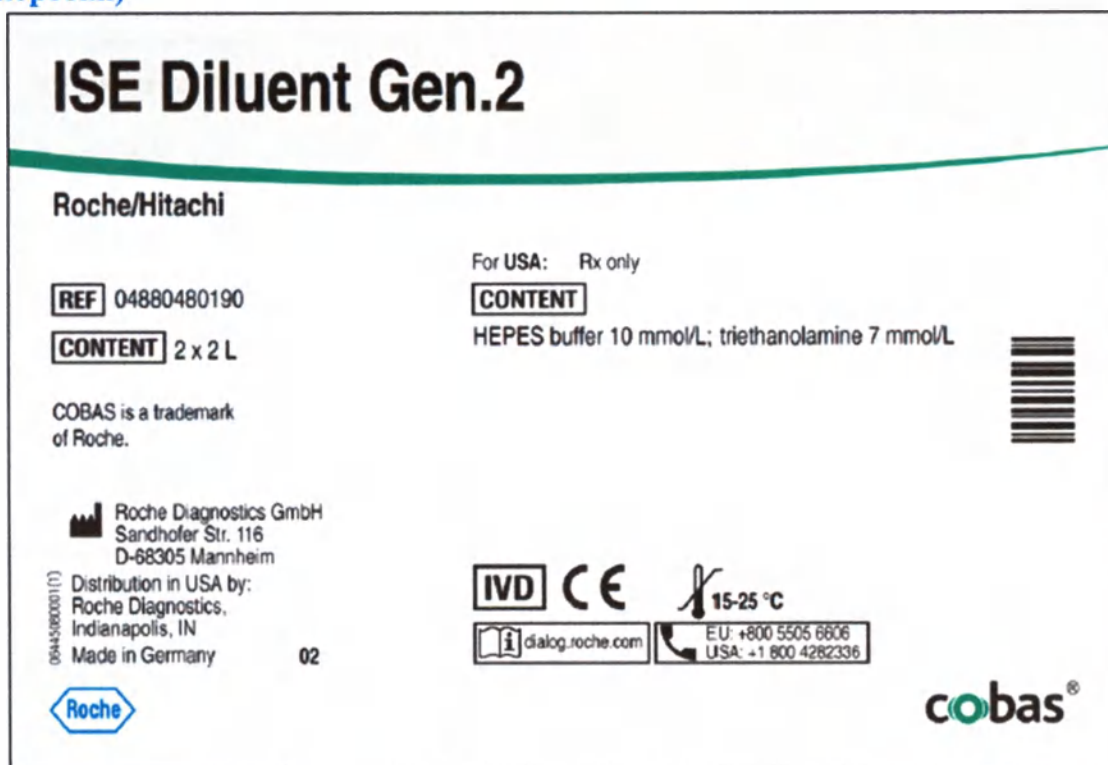

Дилуэнт для разведения пробы при выполнении тестов на модулях биохимических cobas с (ISE Diluent Gen.2 Roche/Hitachi), бутыль, объем 2 л, 2 шт. (маркировка боковой стороны коробки)



Дилуэнт для разведения пробы при выполнении тестов на модулях биохимических cobas c (ISE Diluent Gen.2 Roche/Hitachi), бутылка, объем 2 л, 2 шт. (маркировка бутылок)

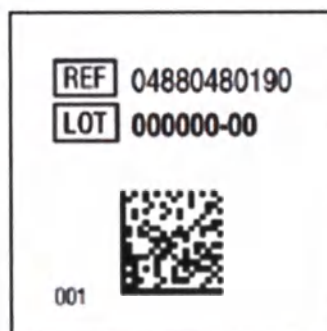

Дилуэнт для разведения пробы при выполнении тестов на модулях биохимических cobas c (ISE Diluent Gen.2 Roche/Hitachi), бутылка, объем 2 л, 2 шт. (макет маркировки на русском языке)

Дилуэнт для разведения пробы при выполнении тестов на модулях биохимических cobas c (ISE Diluent Gen.2 Roche/Hitachi), бутылка, объем 2 л, 2 шт.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18183 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 04880480190

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
4 листа (ов)



по доверенности
от 30.01.2020 г.

Александров
Е. А.