

## **Фотографические изображения**


**Набор калибраторов для количественного определения  
дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С)  
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови  
человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e  
(DHEA-S CalSet Elecsys and cobas e analyzers)**

Набор калибраторов для количественного определения дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (DHEA-S CalSet Elecsys and cobas e analyzers)



Набор калибраторов для количественного определения дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (DHEA-S CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Калибратор 1 (DHEA-S Cal1) – 2 шт

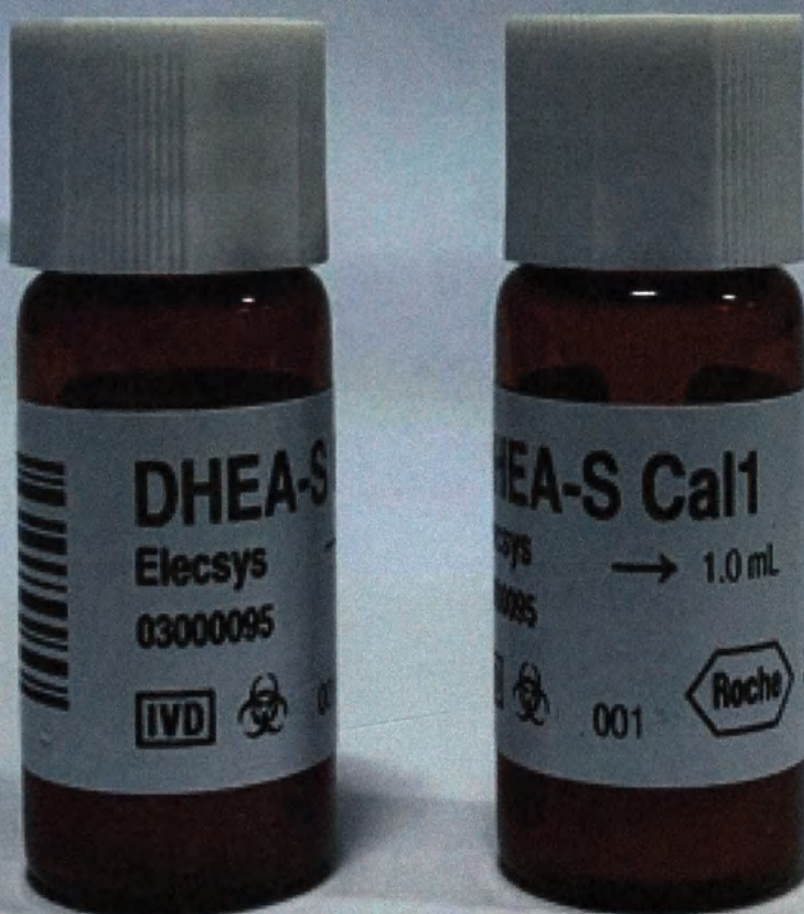

Набор калибраторов для количественного определения дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (DHEA-S CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Калибратор 2 (DHEA-S Cal2) – 2 шт.




Набор калибраторов для количественного определения дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (DHEA-S CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Флакон пустой – 4 шт. (2 шт. с белой крышкой)



Набор калибраторов для количественного определения дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (DHEA-S CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Флакон пустой – 4 шт. (2 шт. с черной крышкой)

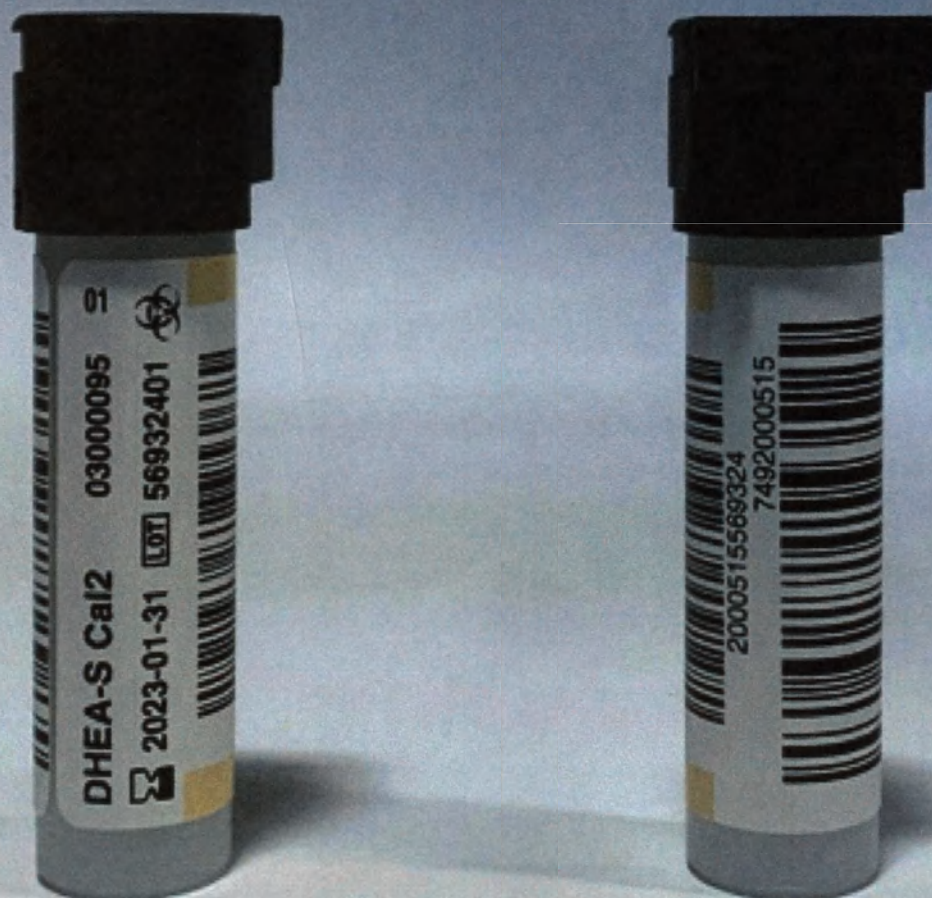

Набор калибраторов для количественного определения дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (DHEA-S CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Карта с штрих-кодом

**DHEA-S  
CalSet**

Elecsys  
and cobas e analyzers


03000095

740

**LOT** 569324



01

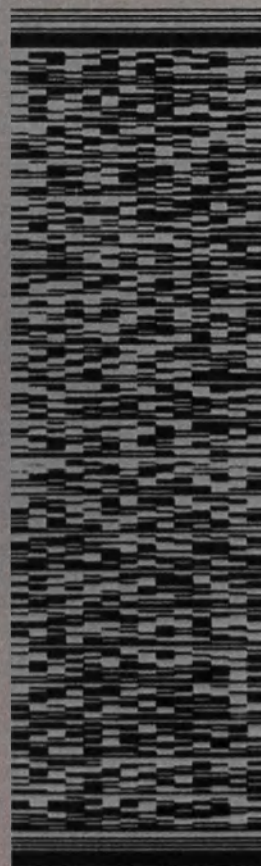

Набор калибраторов для количественного определения дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (DHEA-S CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Этикетка со штрих-кодом для флакона

DHEA-S Cal1 03000095  
2023-01-31 56932401



DHEA-S Cal1 03000095  
2023-01-31 56932401



DHEA-S Cal1 03000095  
2023-01-31 56932401



DHEA-S Cal1 03000095  
2023-01-31 56932401



DHEA-S Cal1 03000095  
2023-01-31 56932401




DHEA-S Cal1 03000095  
2023-01-31 56932401



DHEA-S Cal2 03000095  
2023-01-31 56932401



DHEA-S Cal2 03000095  
2023-01-31 56932401

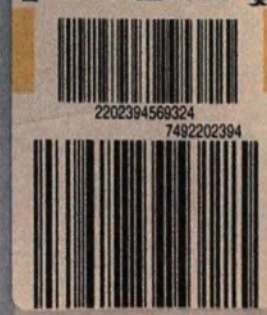

DHEA-S Cal2 03000095  
2023-01-31 56932401



DHEA-S Cal2 03000095  
2023-01-31 56932401



DHEA-S Cal2 03000095  
2023-01-31 56932401



DHEA-S Cal2 03000095  
2023-01-31 56932401



## Макет маркировки на русском языке

Набор калибраторов для количественного определения дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (DHEA-S CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

Состав:

1. Калибратор 1 (DHEA-S Cal1), флакон, объем 1 мл, 2 шт.
2. Калибратор 2 (DHEA-S Cal2), флакон, объем 1 мл, 2 шт.
3. Флакон пустой – 4 шт.
4. Карта с штрих-кодом
5. Этикетка со штрих-кодом для флакона – 12 шт.
6. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9550 от \_\_\_\_\_

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики *in vitro*

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: [moscow.reception\\_dia@roche.com](mailto:moscow.reception_dia@roche.com)

Кат. номер 03000095122

## Маркировка картонной упаковки

Набор калибраторов для количественного определения дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (DHEA-S CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

# DHEA-S CalSet

Elecsys and  
cobas e analyzers

**REF** 03000095122

### CONTENT

Cal1 → 2 x 1.0 mL

Cal2 → 2 x 1.0 mL



COBAS, COBAS E  
and ELECSYS are trademarks of  
Roche.



Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Str. 116  
D-68305 Mannheim

06444857001 (1)

Distribution in USA by:  
Roche Diagnostics,  
Indianapolis, IN  
Made in Germany



0123



dialog.roche.com

02



cobas®

Верхняя сторона картонной упаковки

## DHEA-S CalSet

For USA: **CONTENT**

Cal1 DHEA-S (synthetic) in a depleted human serum matrix

Cal2 DHEA-S (synthetic) in a depleted human serum matrix

**REF** (240)03000095122

**LOT** (10)00000000

 2000-01-31

 2000-01-01

**GTIN** (01)04015630917389

Rx only

04




**UDI**




Боковая сторона картонной упаковки

## Маркировка флаконов набора калибраторов

Набор калибраторов для количественного определения дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА-С) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (DHEA-S CalSet Elecsys and cobas e analyzers)

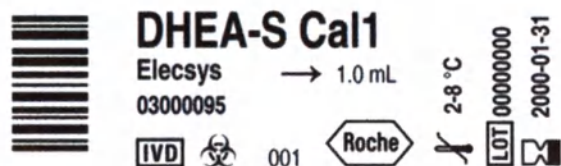

Калибратор 1 (DHEA-S Cal1), флакон, объем 1 мл, 2 шт.

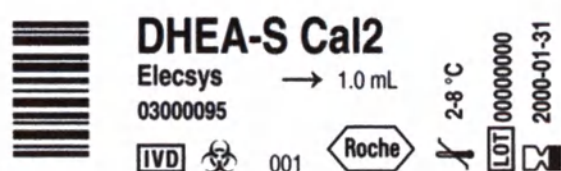

Калибратор 2 (DHEA-S Cal2), флакон, объем 1 мл, 2 шт.



Флакон пустой – 4 шт.

Всего пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью  
12 листа (ов)



по доверенности  
от 30.01.2023 г.

Светлова Н. Г.