

ООО «Эксперт Медикал»

ИНН 7722737935 КПП 772001001

111524, город Москва, улица Электродная, дом 11 строение 19, помещение 26,
тел: 8-800-201-15-74, факс 8 (495) 641-04-68

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Эксперт Медикал»

Ильякина Ж.А.

«28»

апреля

2020

МП




**Установка для мойки гибких эндоскопов,
модели: MT- 5000L, MT- 5000S**

Фотографические изображения


I. Установка для мойки гибких эндоскопов, модель МТ - 5000L

Базовый комплект поставки:


1.1. Установка для мойки гибких эндоскопов МТ - 5000L – 1 шт.;

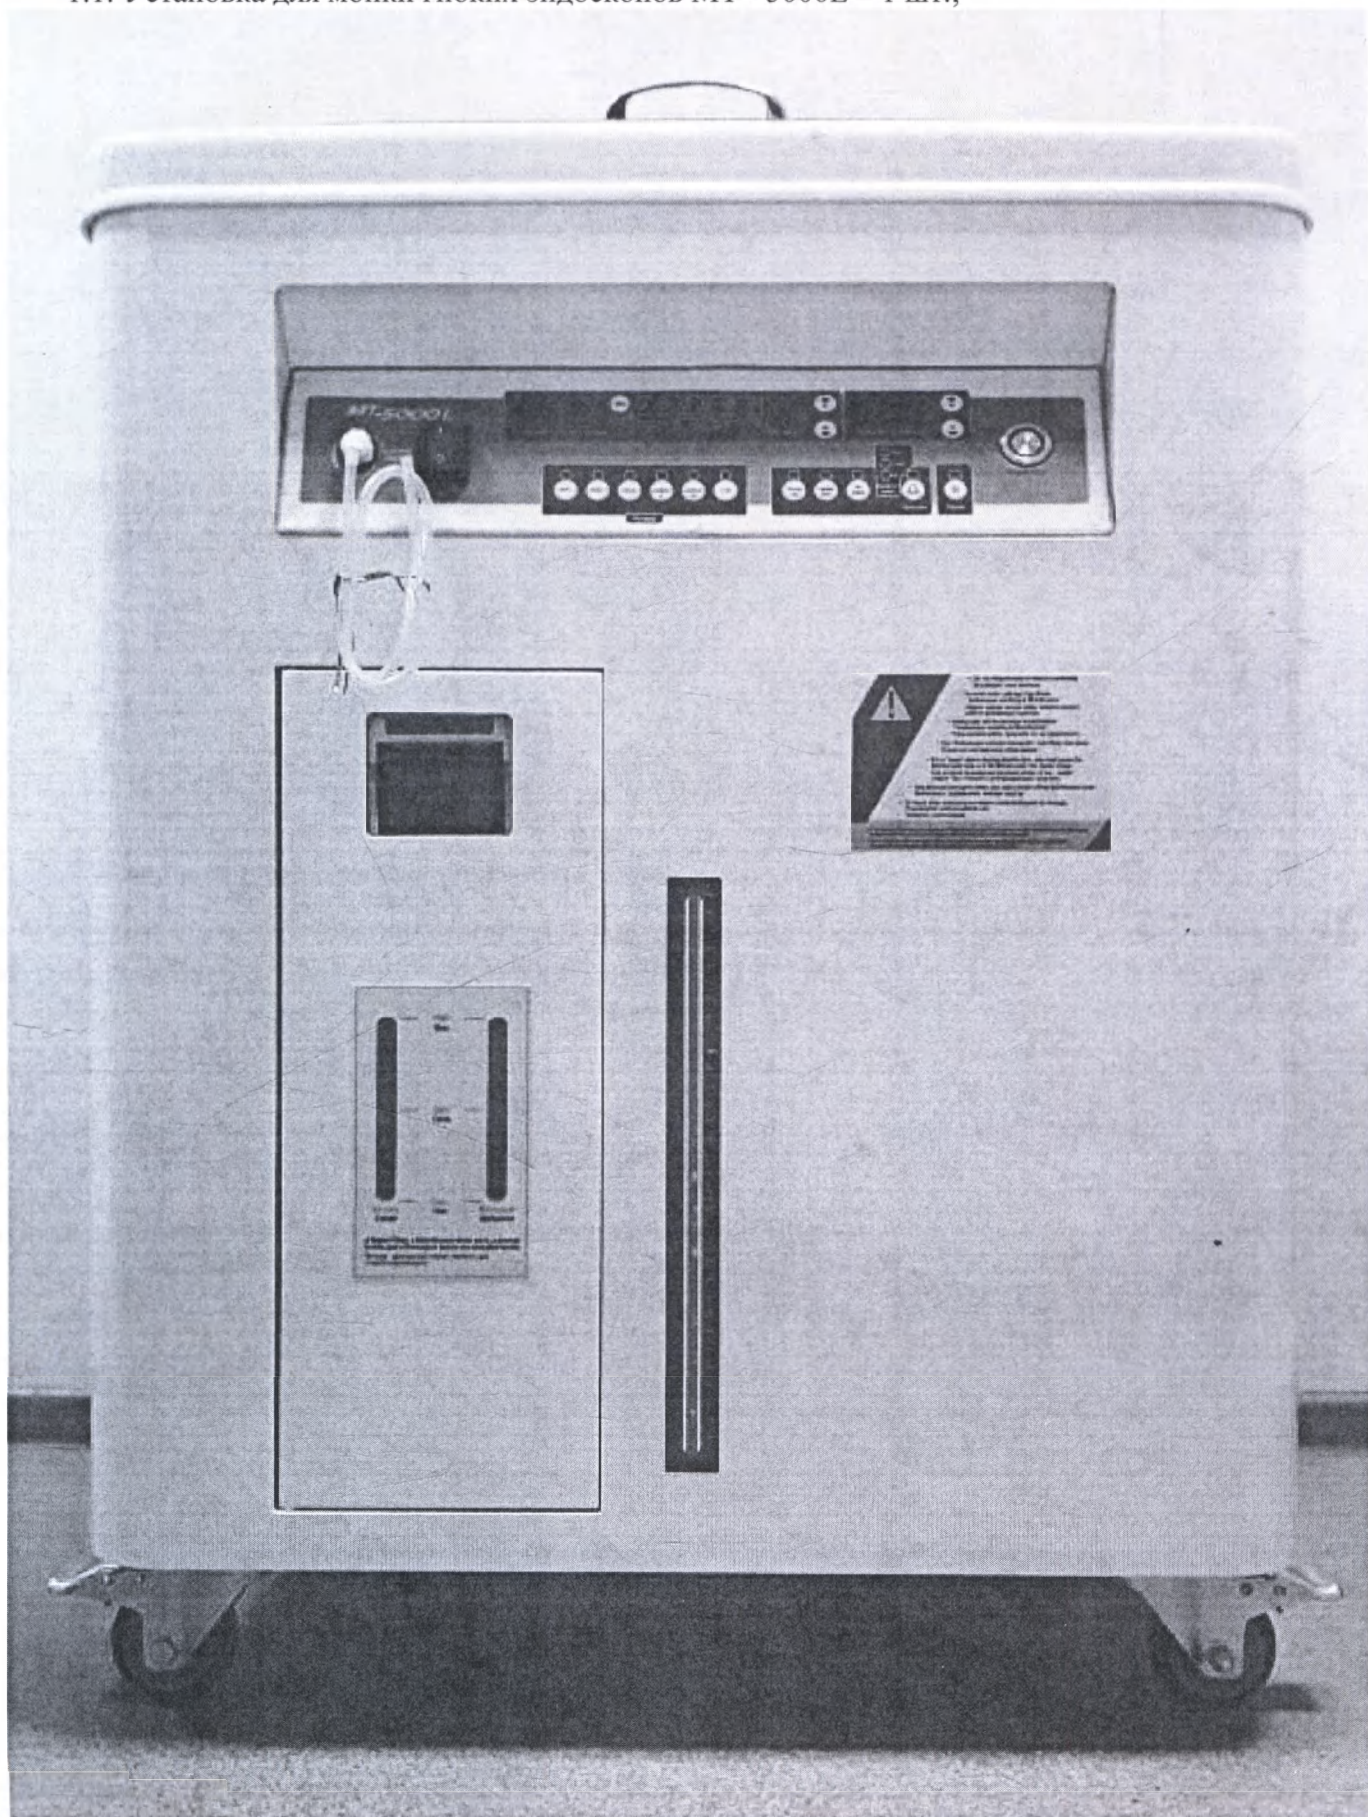


1.2. Адаптер проверки на герметичность гибкого эндоскопа Р – 2 шт.; (при необходимости)

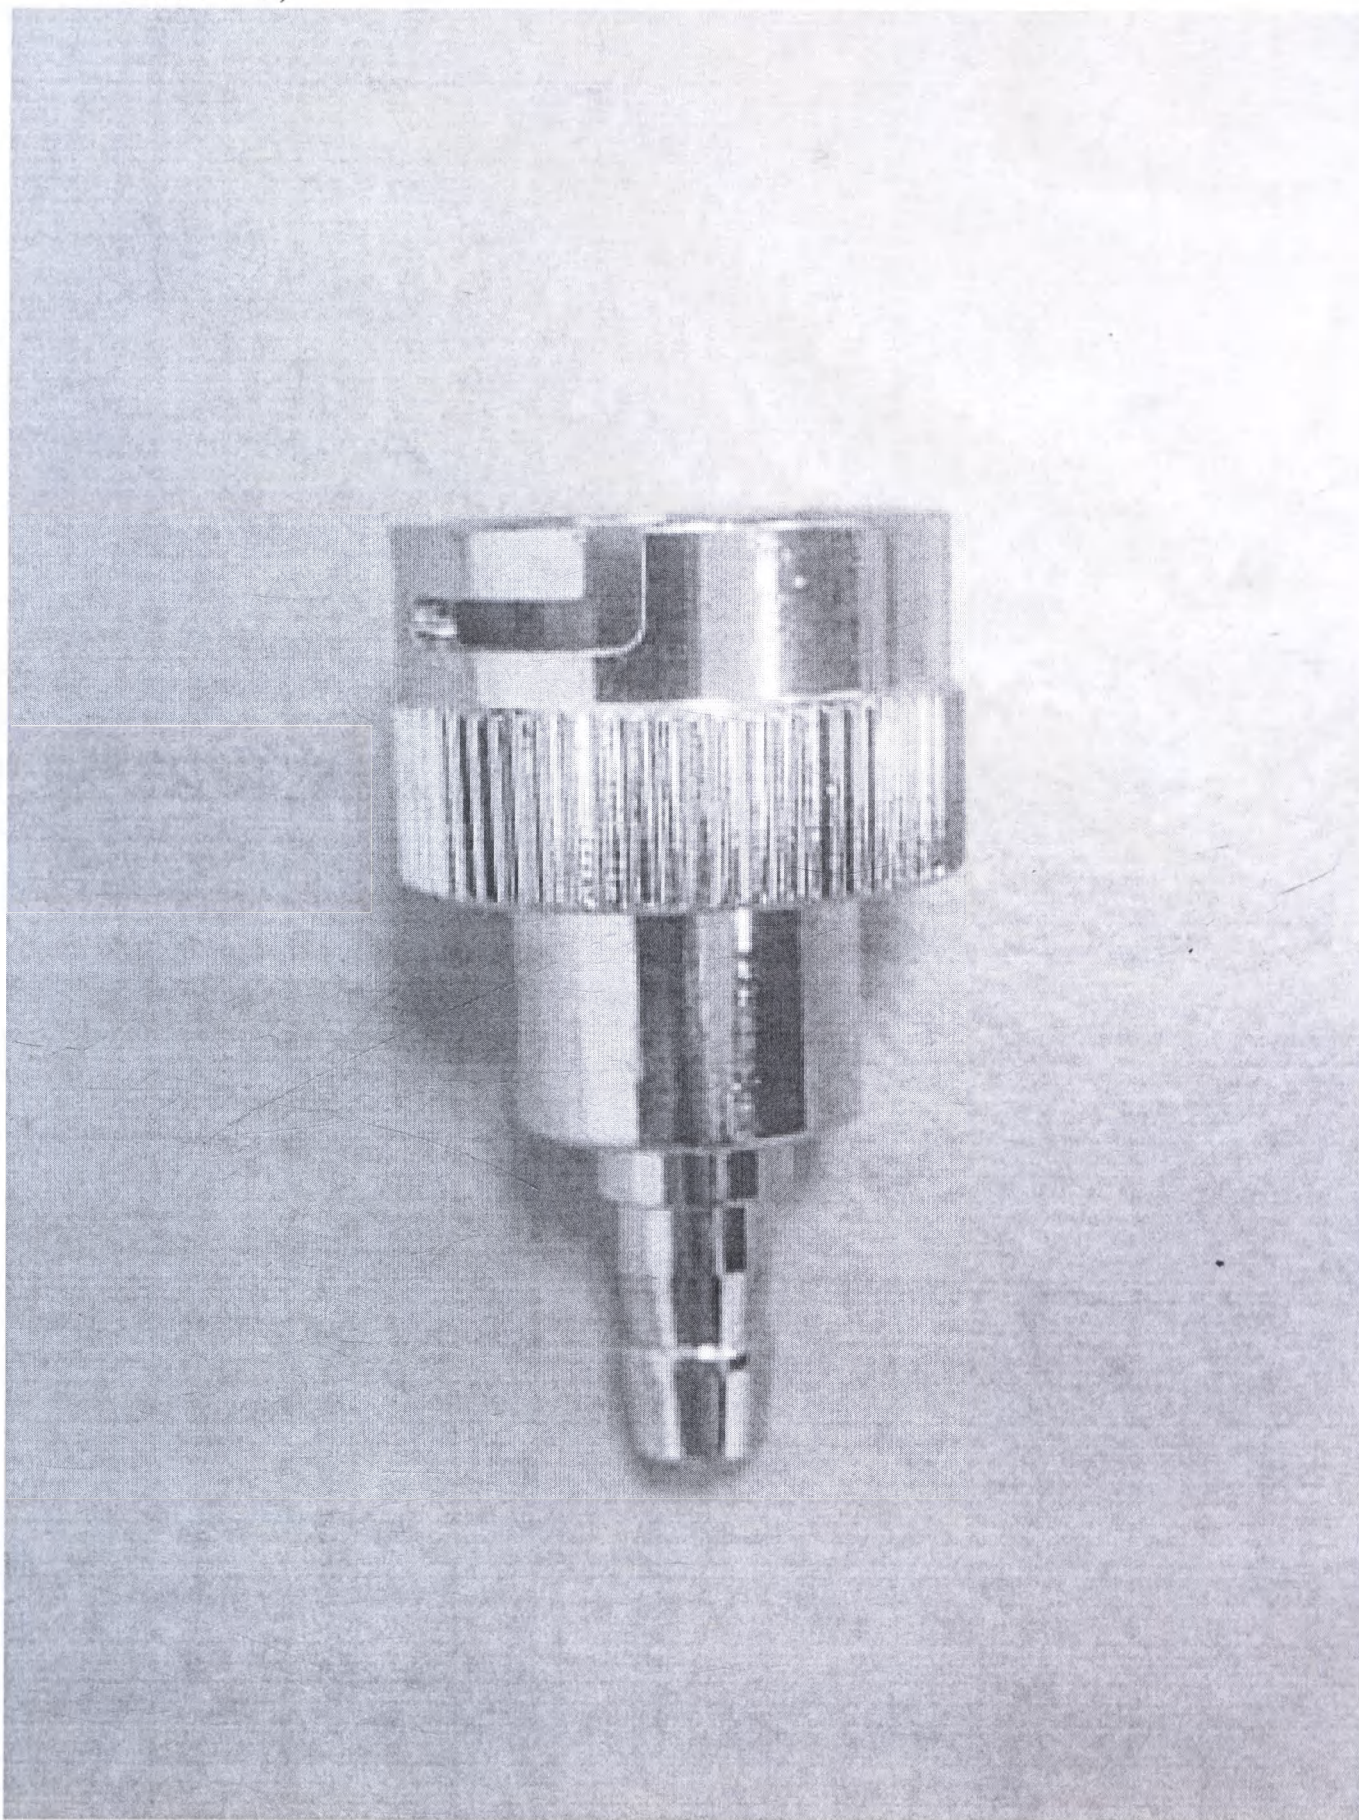


1.3. Адаптер проверки на герметичность гибкого эндоскопа О – 2 шт.; (при необходимости)

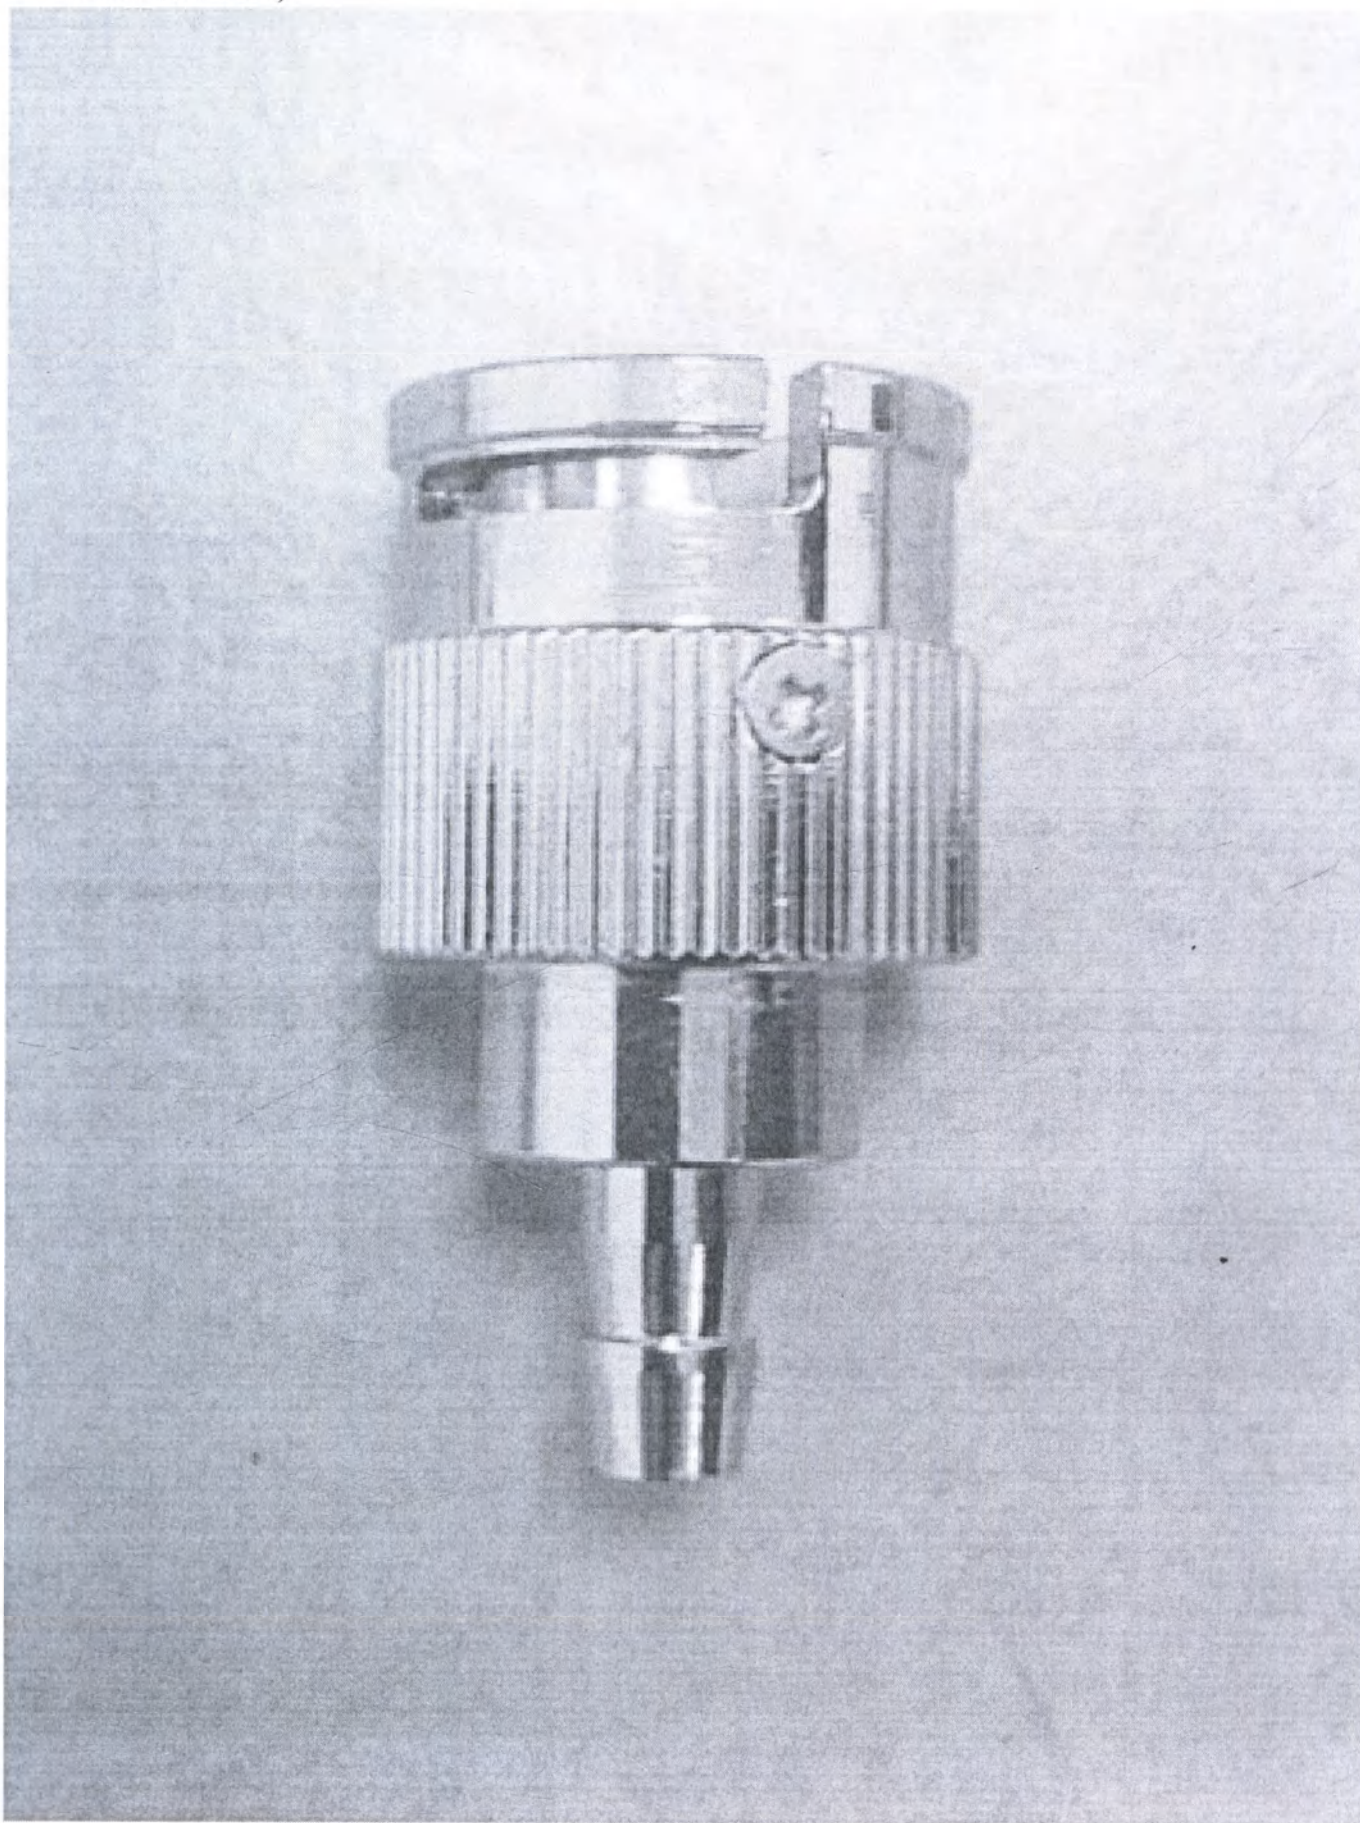


1.4. Шланг отводящий— 1 шт.;

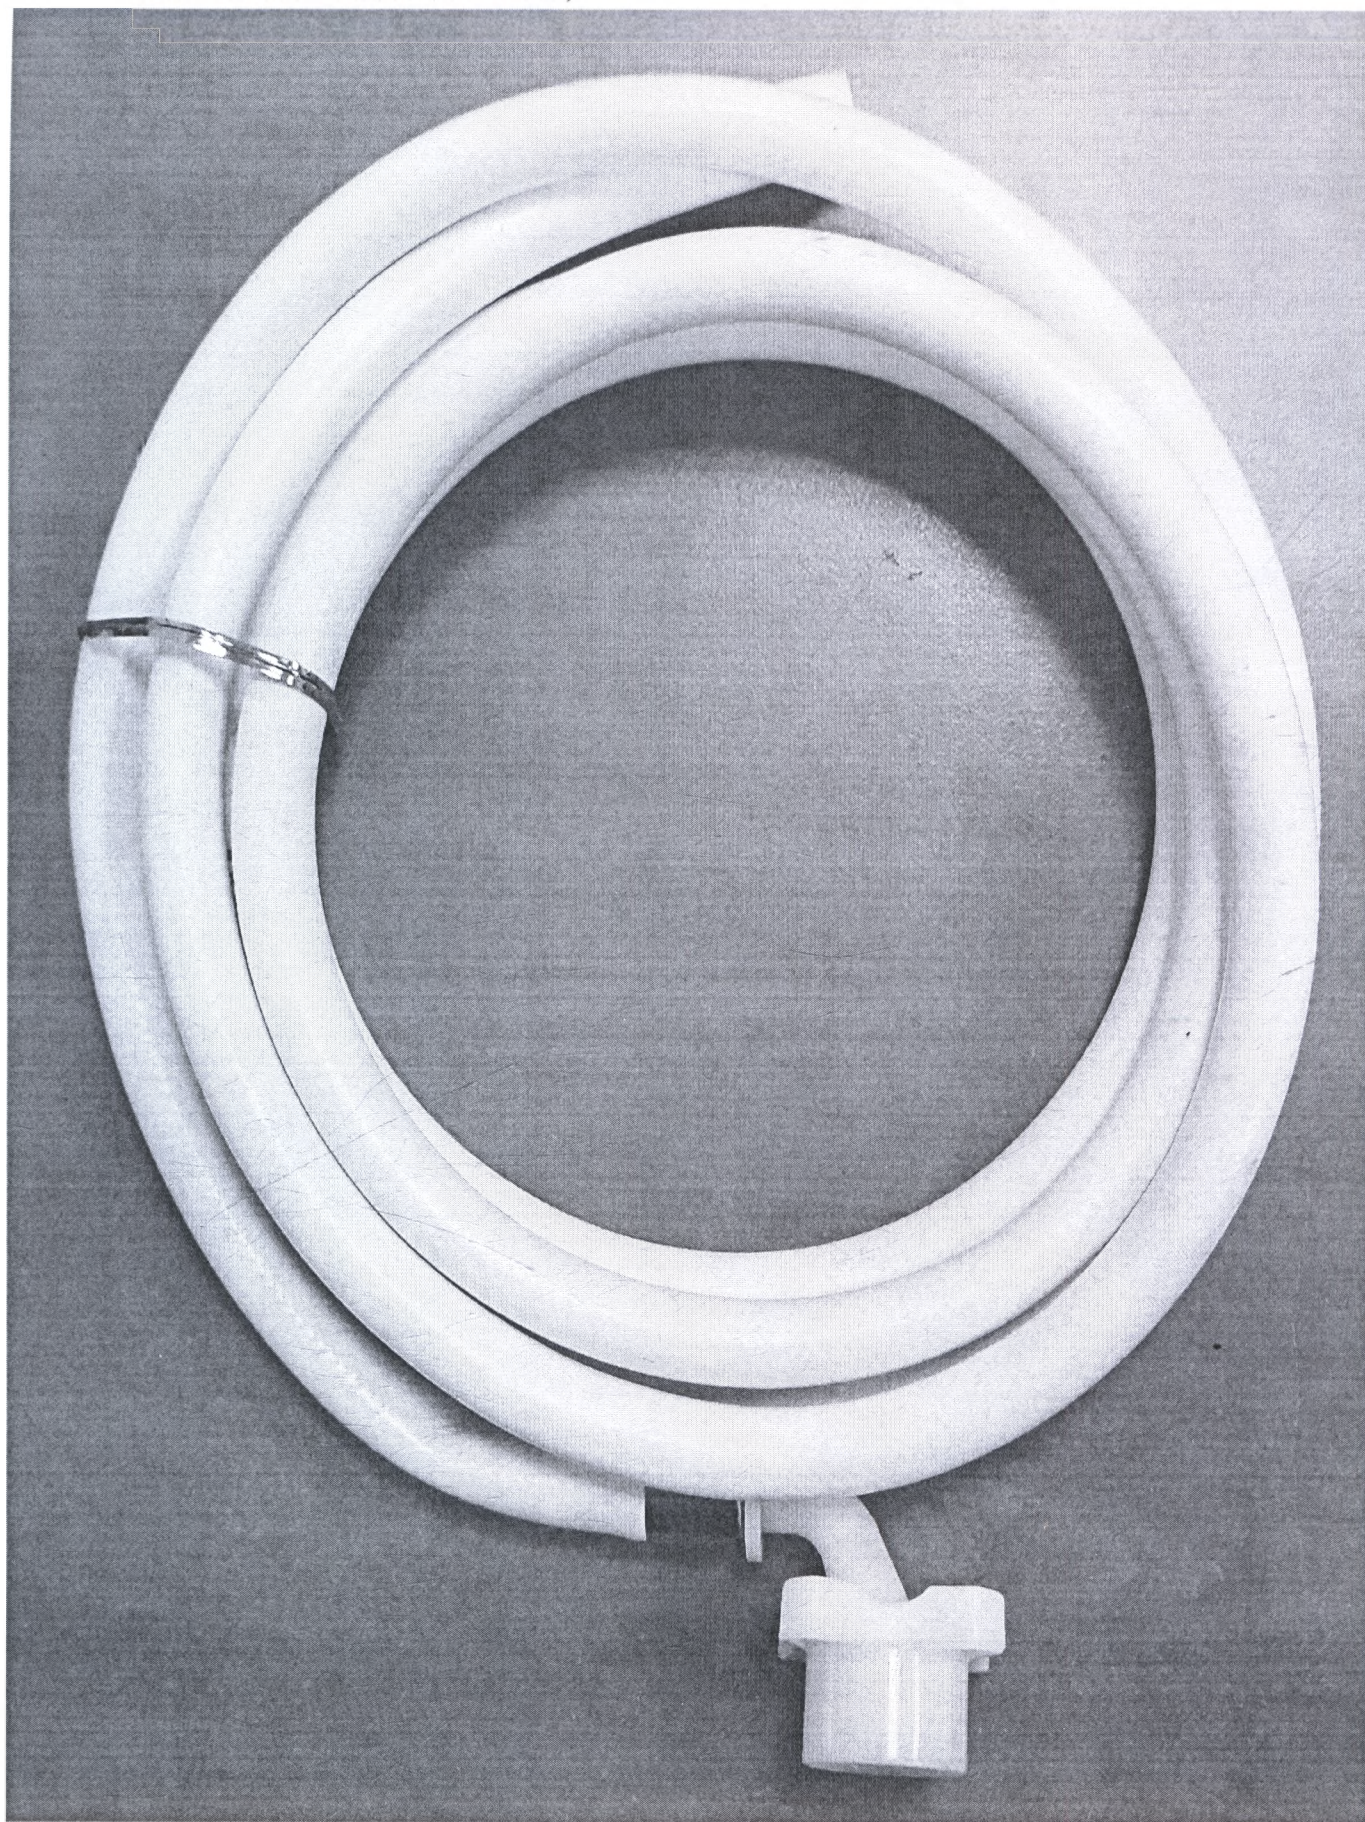


1.5. Шланг для подвода воды – 2 шт.;

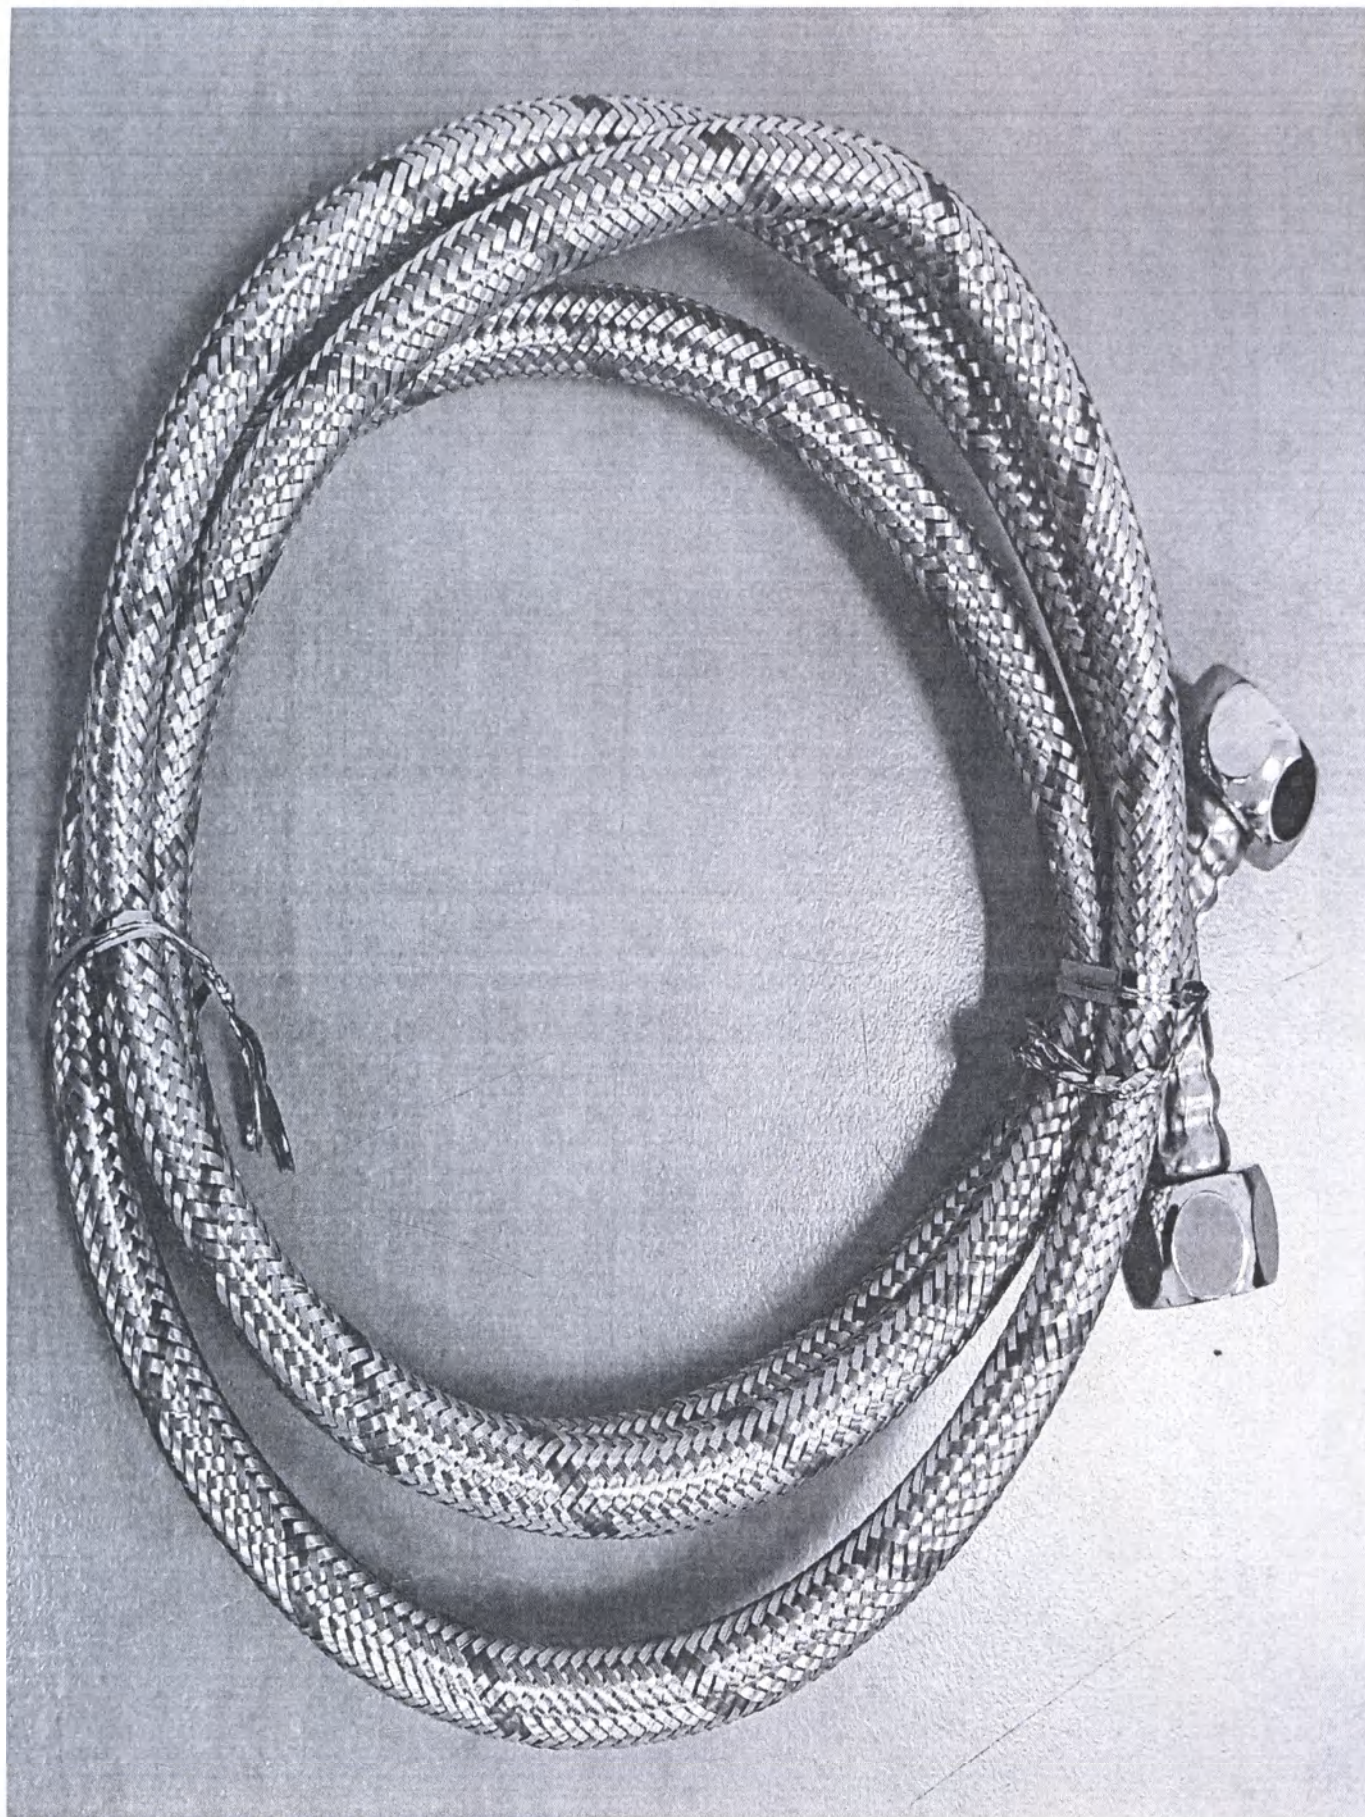


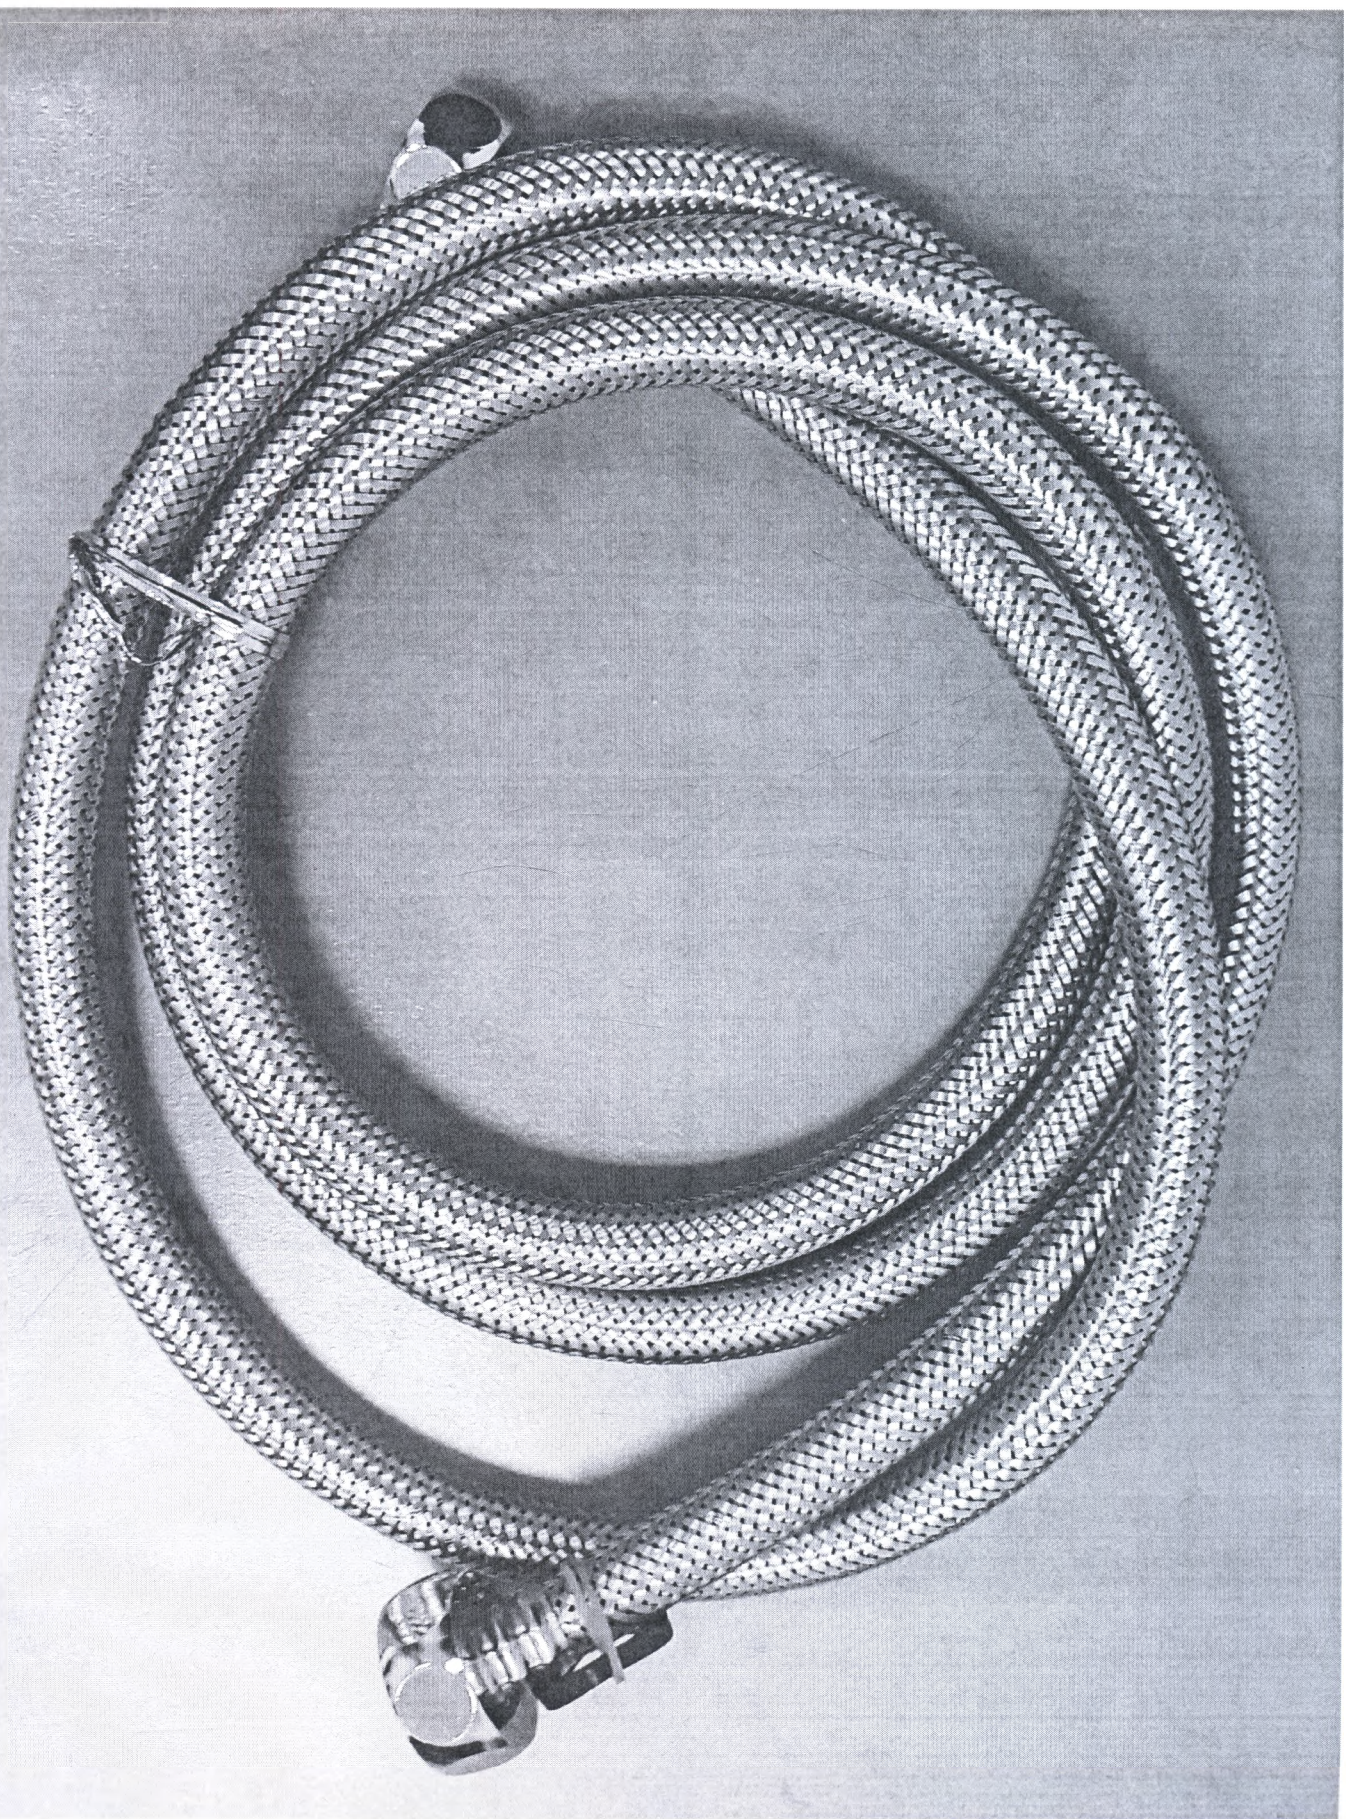


1.6. Шнур сетевой – 1 шт.;

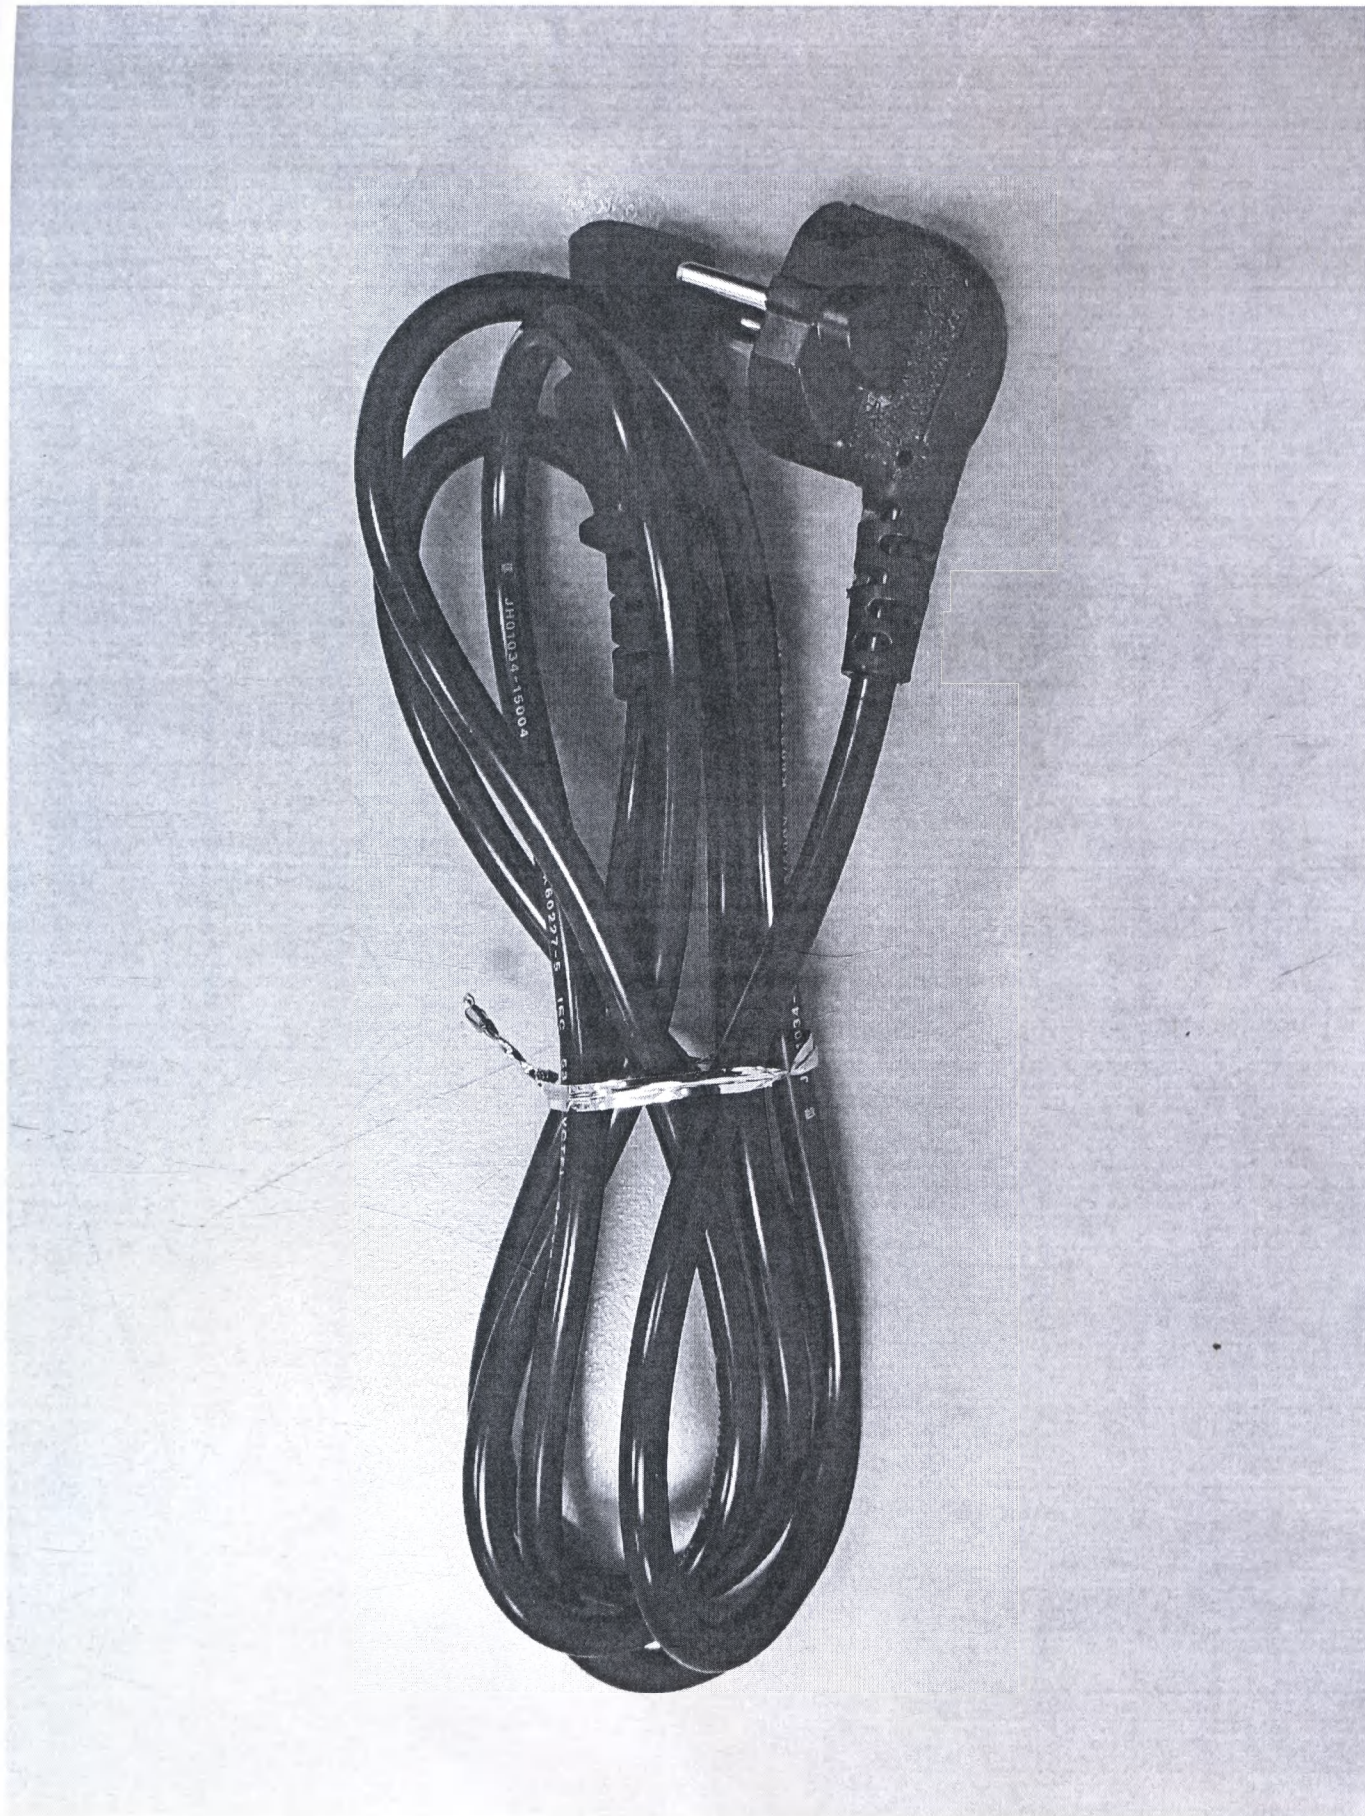


1.7. Крышка вентиляционного отверстия – 1 шт.;

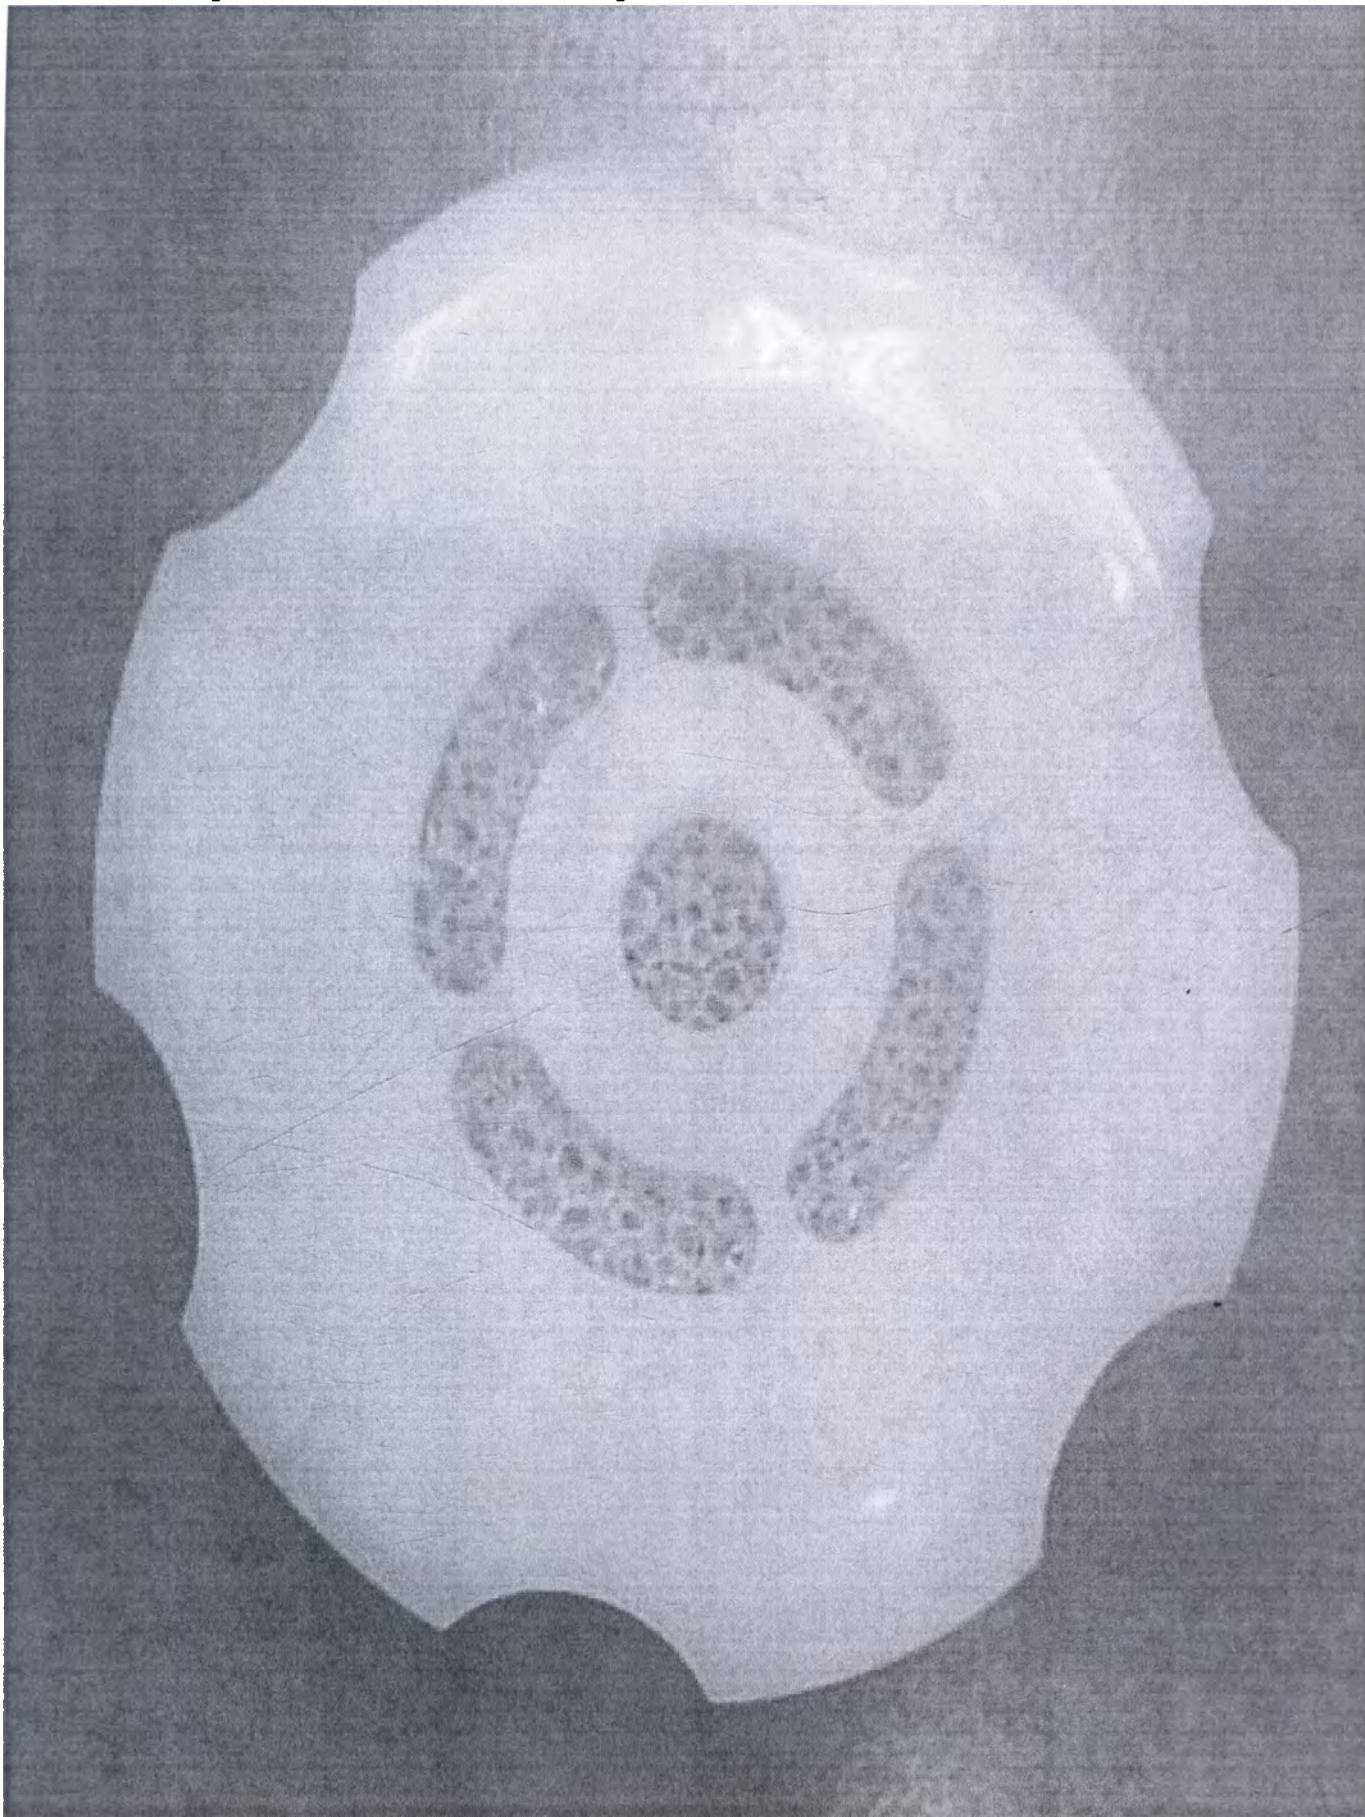


1.8. Корзинка для мелких деталей гибкого эндоскопа – 1 шт.;

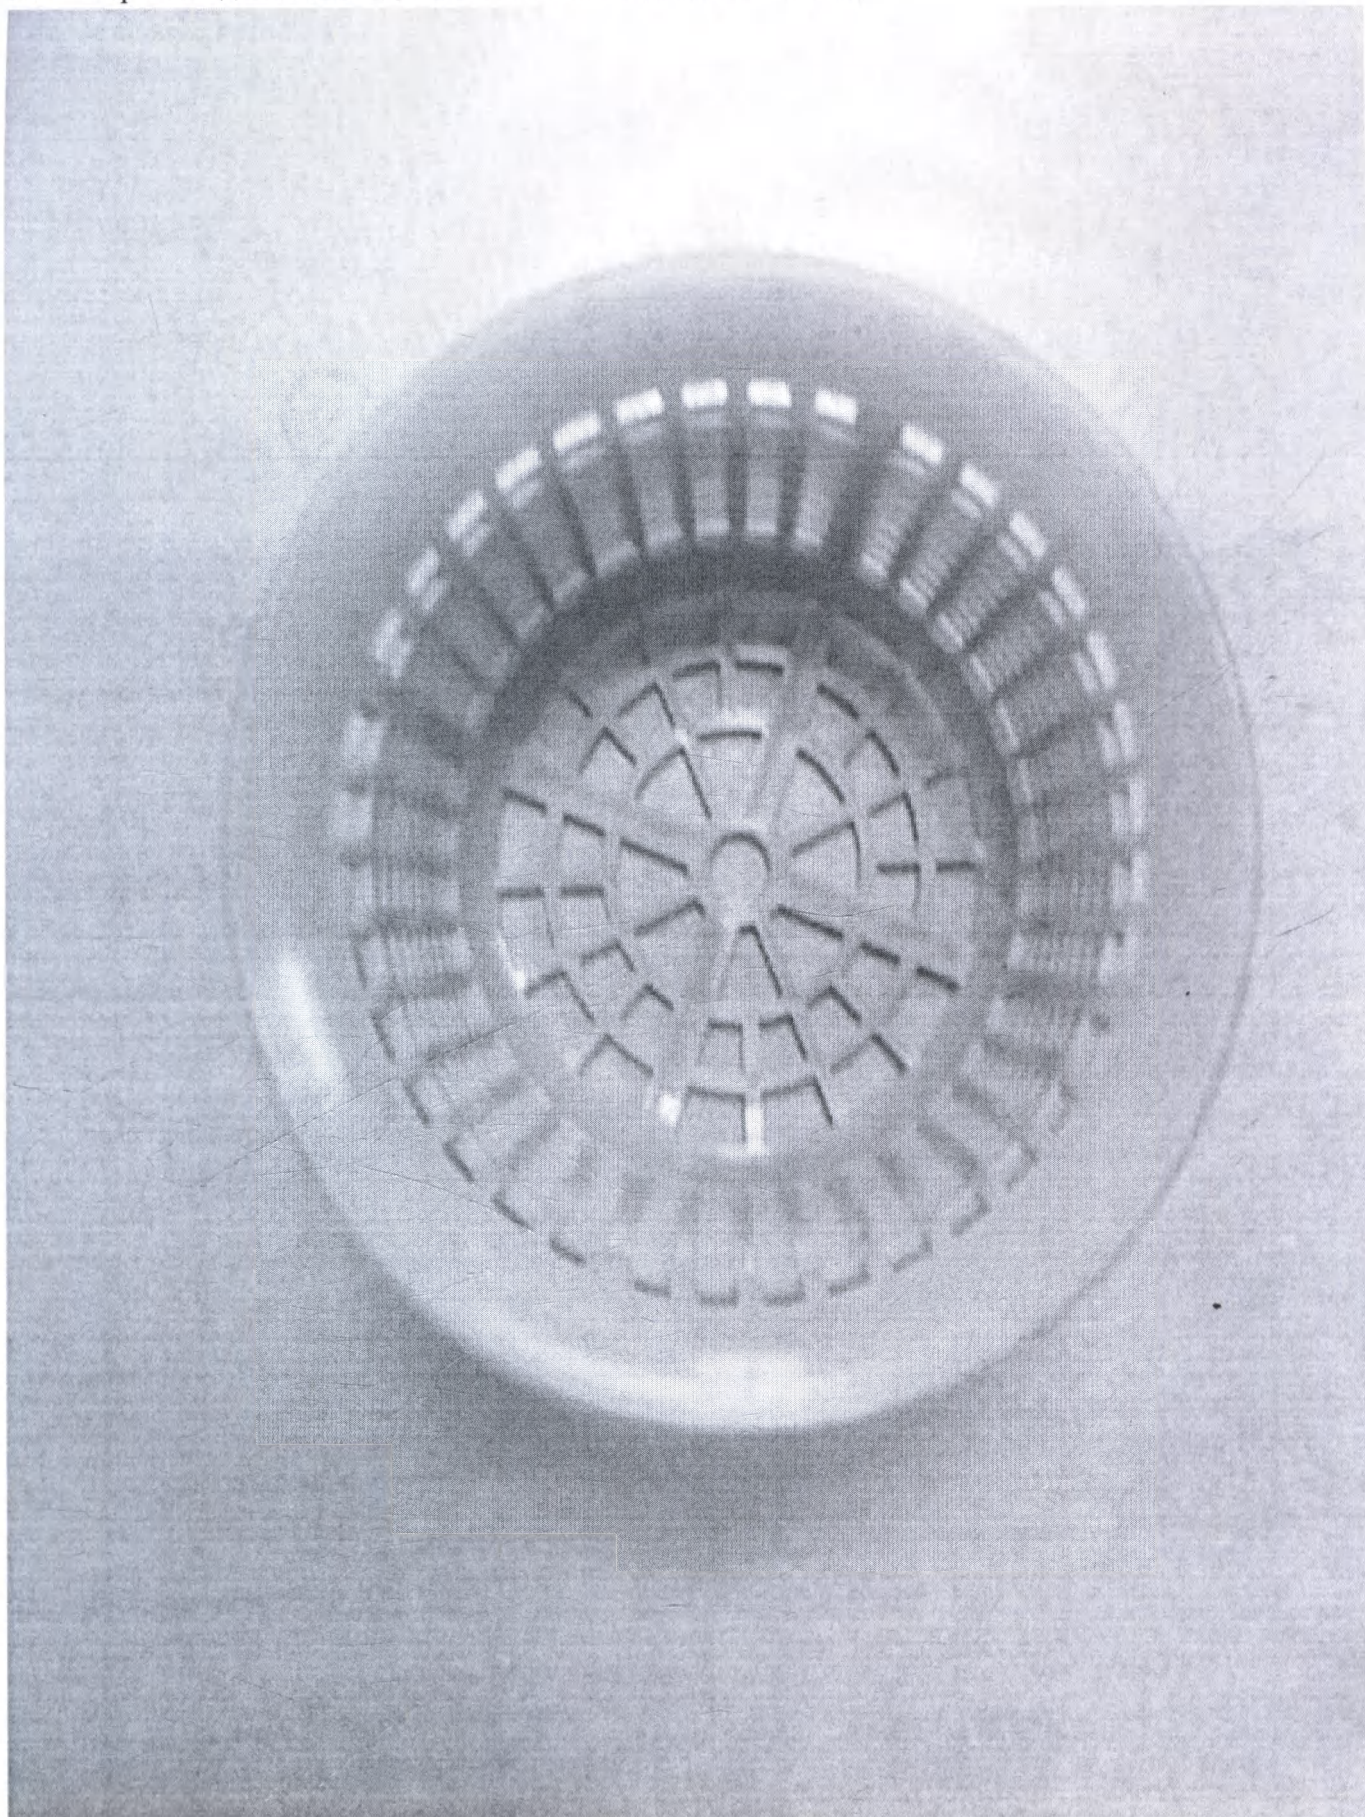


1.9. Адаптер для биопсийного (инструментального) канала О, F – 2 шт.; (при необходимости)

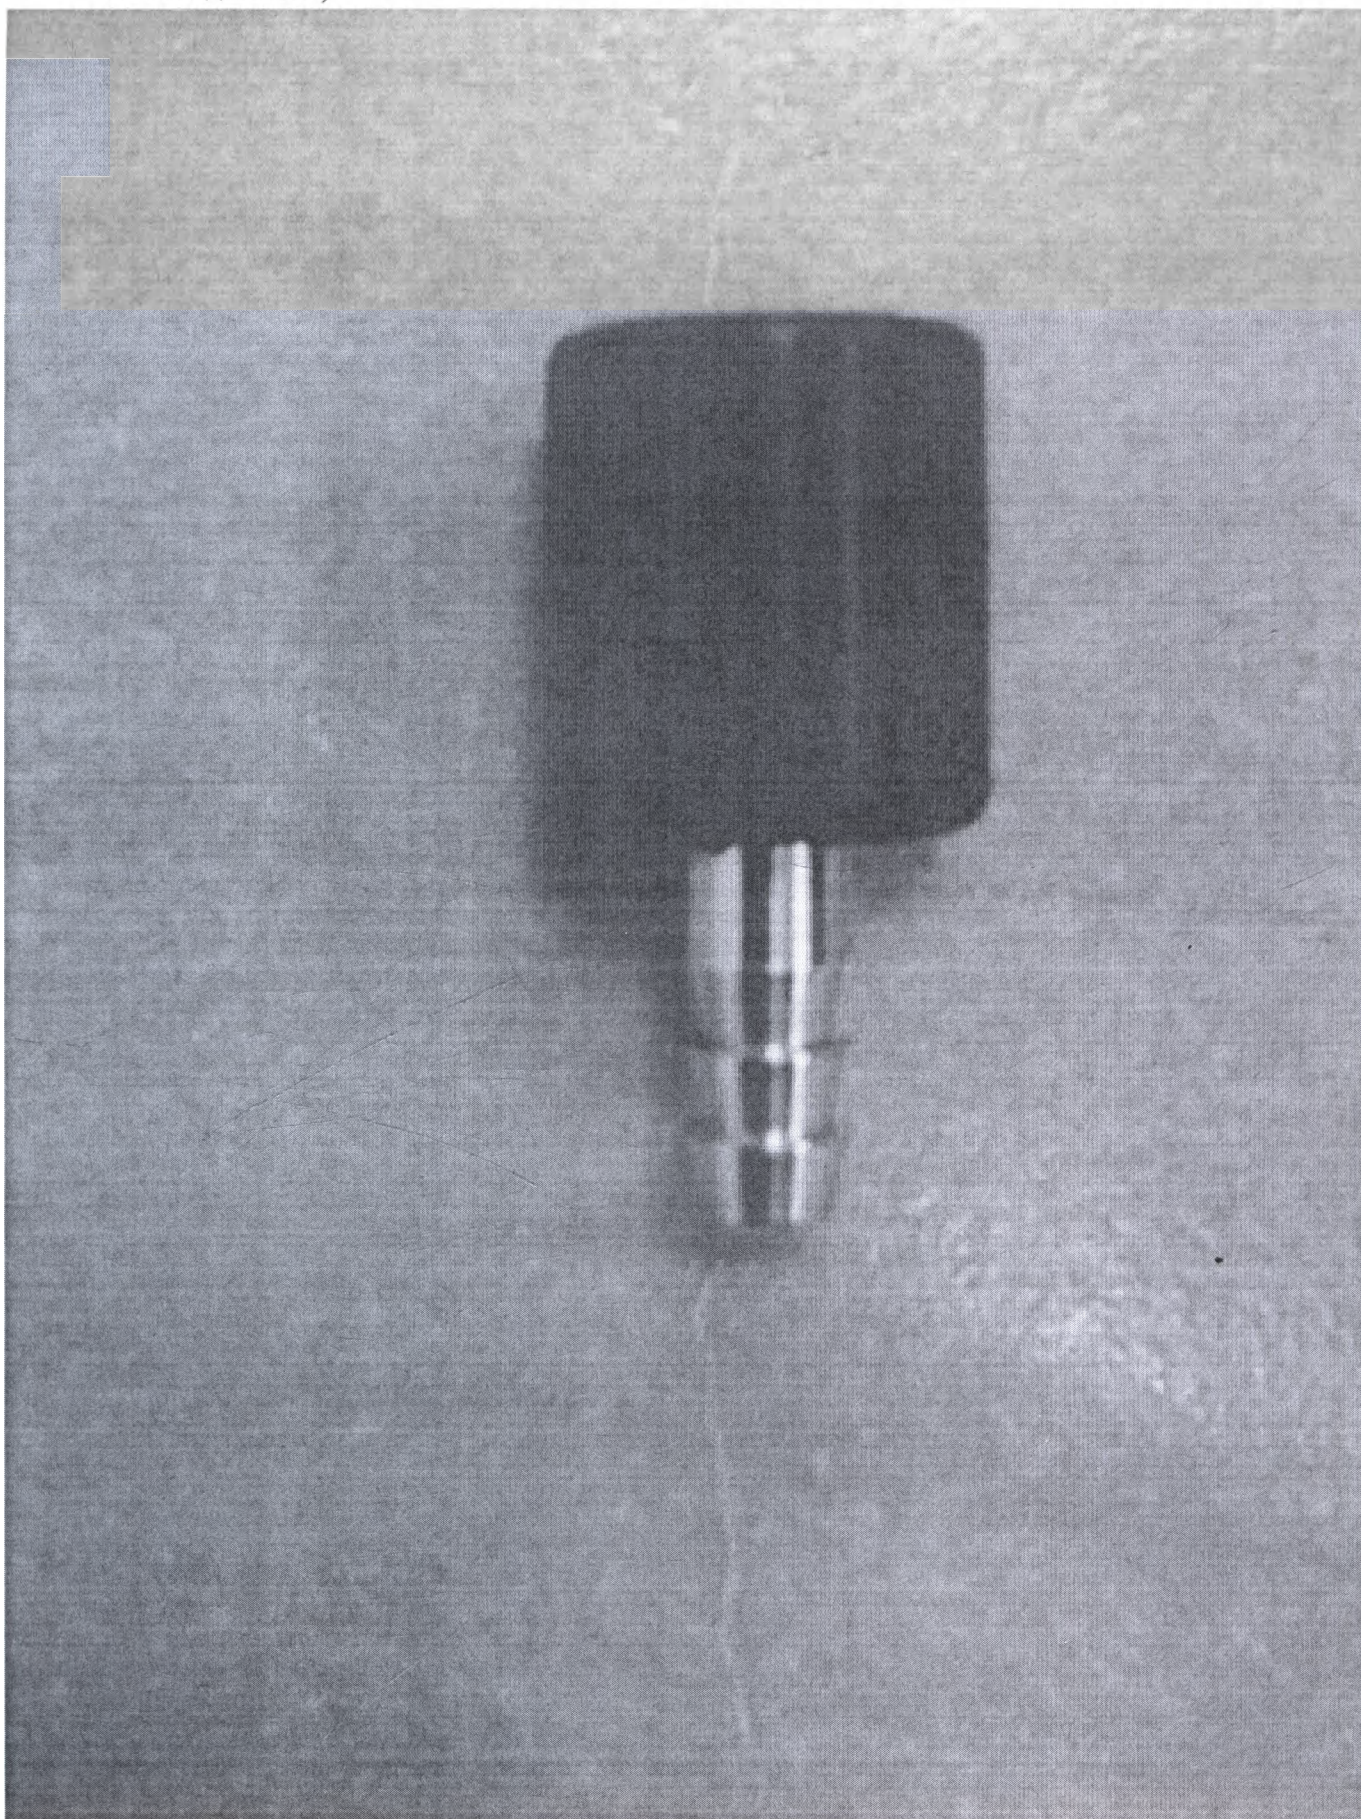

1.10. Адаптер для биопсийного (инструментального) канала Р – 2 шт.; (при необходимости)

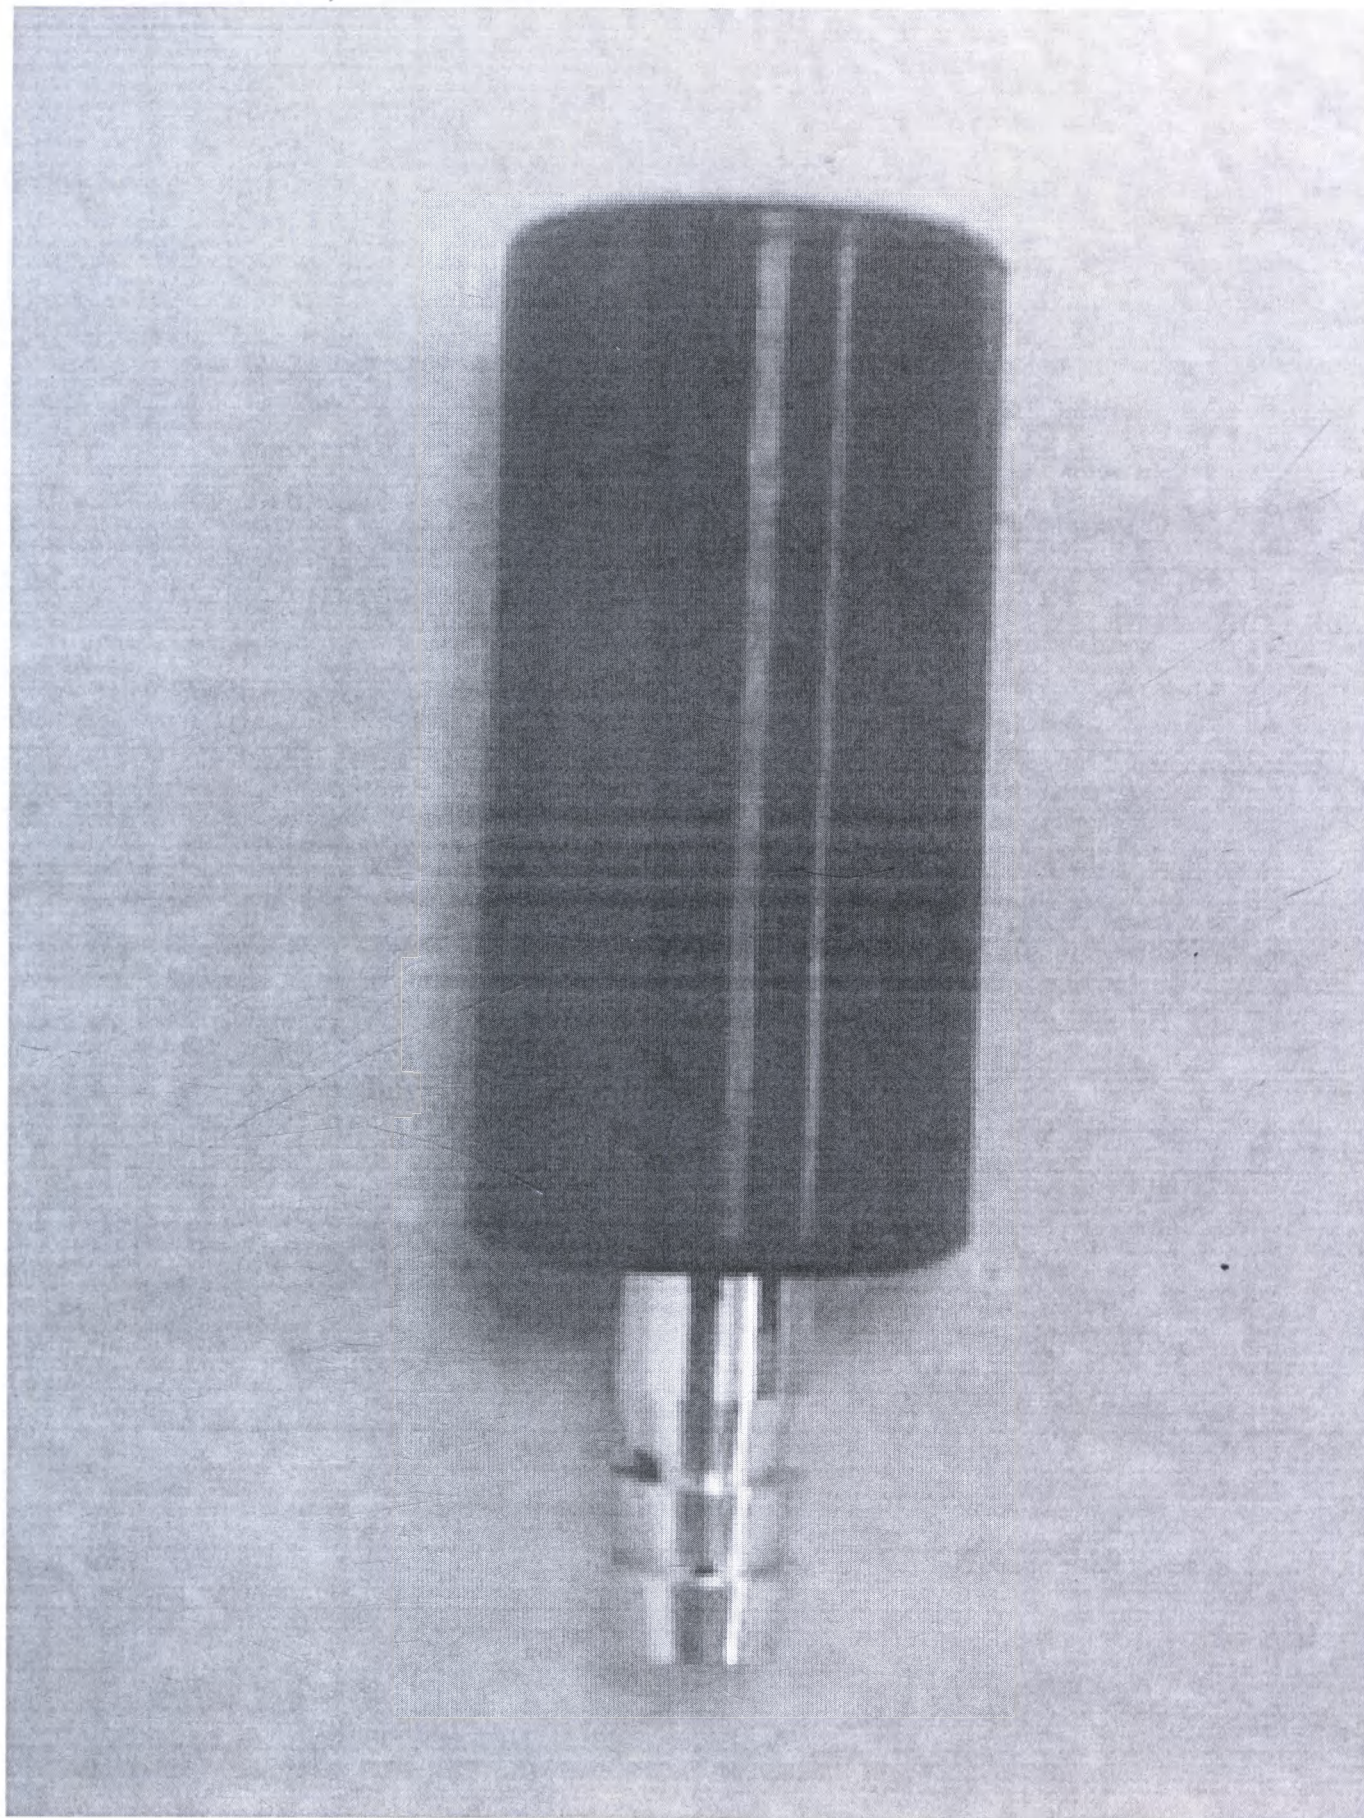

1.11. Набор адаптеров – 1 комплект (6 шт.); (при необходимости)

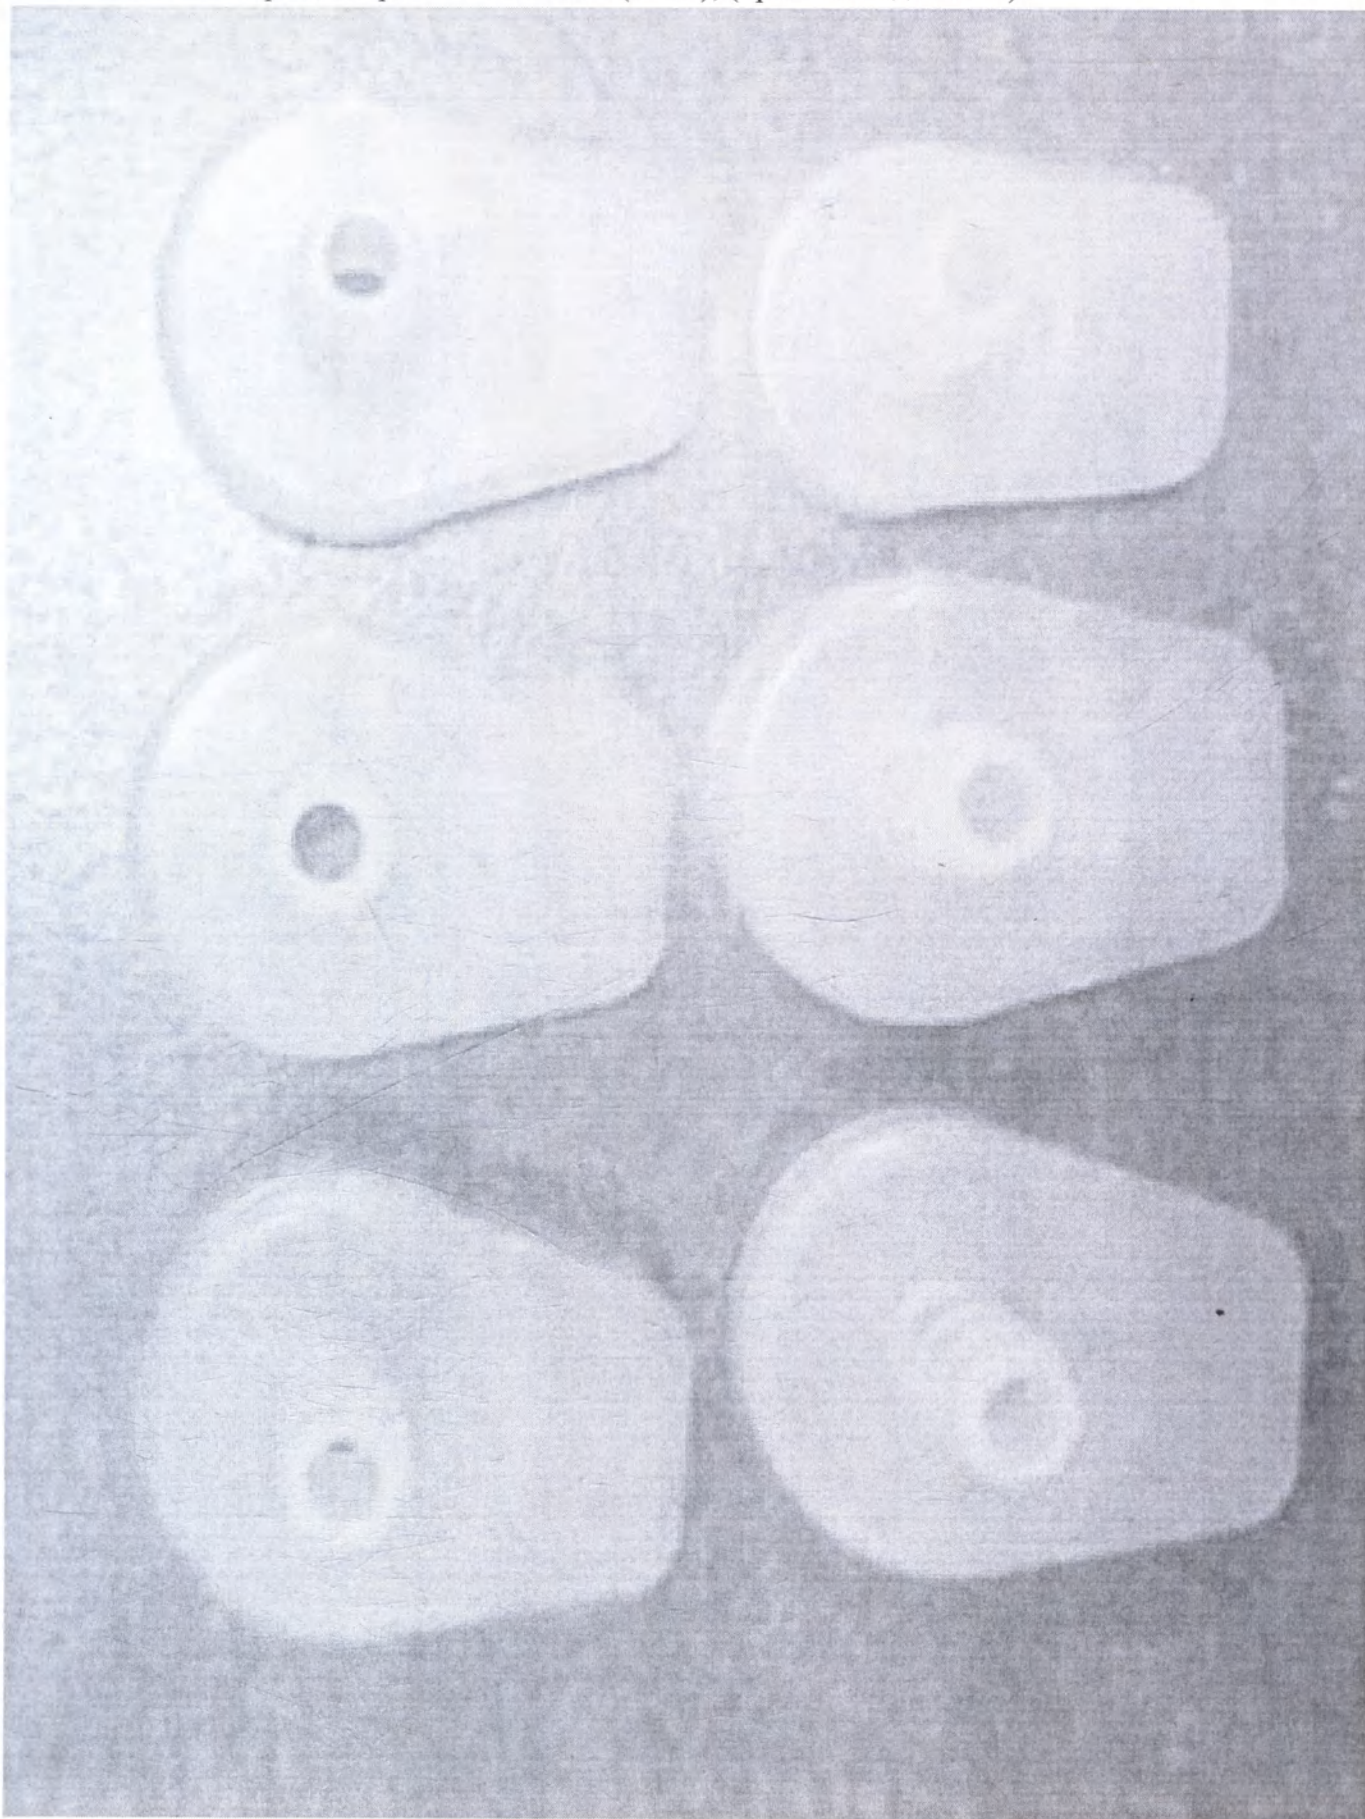

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Установка для мойки гибких эндоскопов,
модель- MT-5000L

2019г.

Версия -1

 Huons Medicare


Макет маркировки (шильдик) на Установке для мойки гибких эндоскопов MT-5000L.

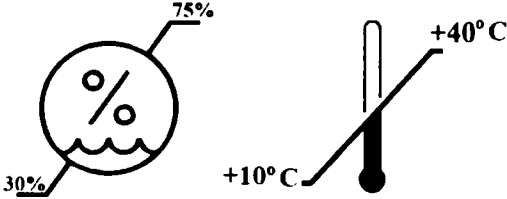 Производитель	Хуонс Медика Ко., ЛТД. 22, Ноксансдан 165-ро, Гангseo-гу, Пусан, Республика Корея Тел.:82-51-831-1030; 82-70-7410-8992 contact@huonsmedicare.com info@huonsmedicare.com
Адрес места производства	С-401, 27, Аннам-ро 418беон-гил, Бупусонг-гу, Инчeon, Республика Корея
Регистрационное удостоверение	ФСЗ xxxx/xxxxx от xx ____ xxxx года
Наименование	Установка для мойки гибких эндоскопов
Модель	MT-5000L
 Серийный номер	xxxx-xx-xx-xxx
 Дата изготовления	xx.xx.xxxx
Вес	81 кг
Источник питания, потребляемая мощность	220В, 50/60Гц, 500Вт
Класс электробезопасности	Класс 1
Условия эксплуатации	 Пожалуйста, используйте в указанном диапазоне влажности и температуры
  Сделано в Республике Корея	


II. Установка для мойки гибких эндоскопов, модель MT – 5000S

Базовый комплект поставки:


2.1. Установка для мойки гибких эндоскопов MT - 5000S – 1 шт.;

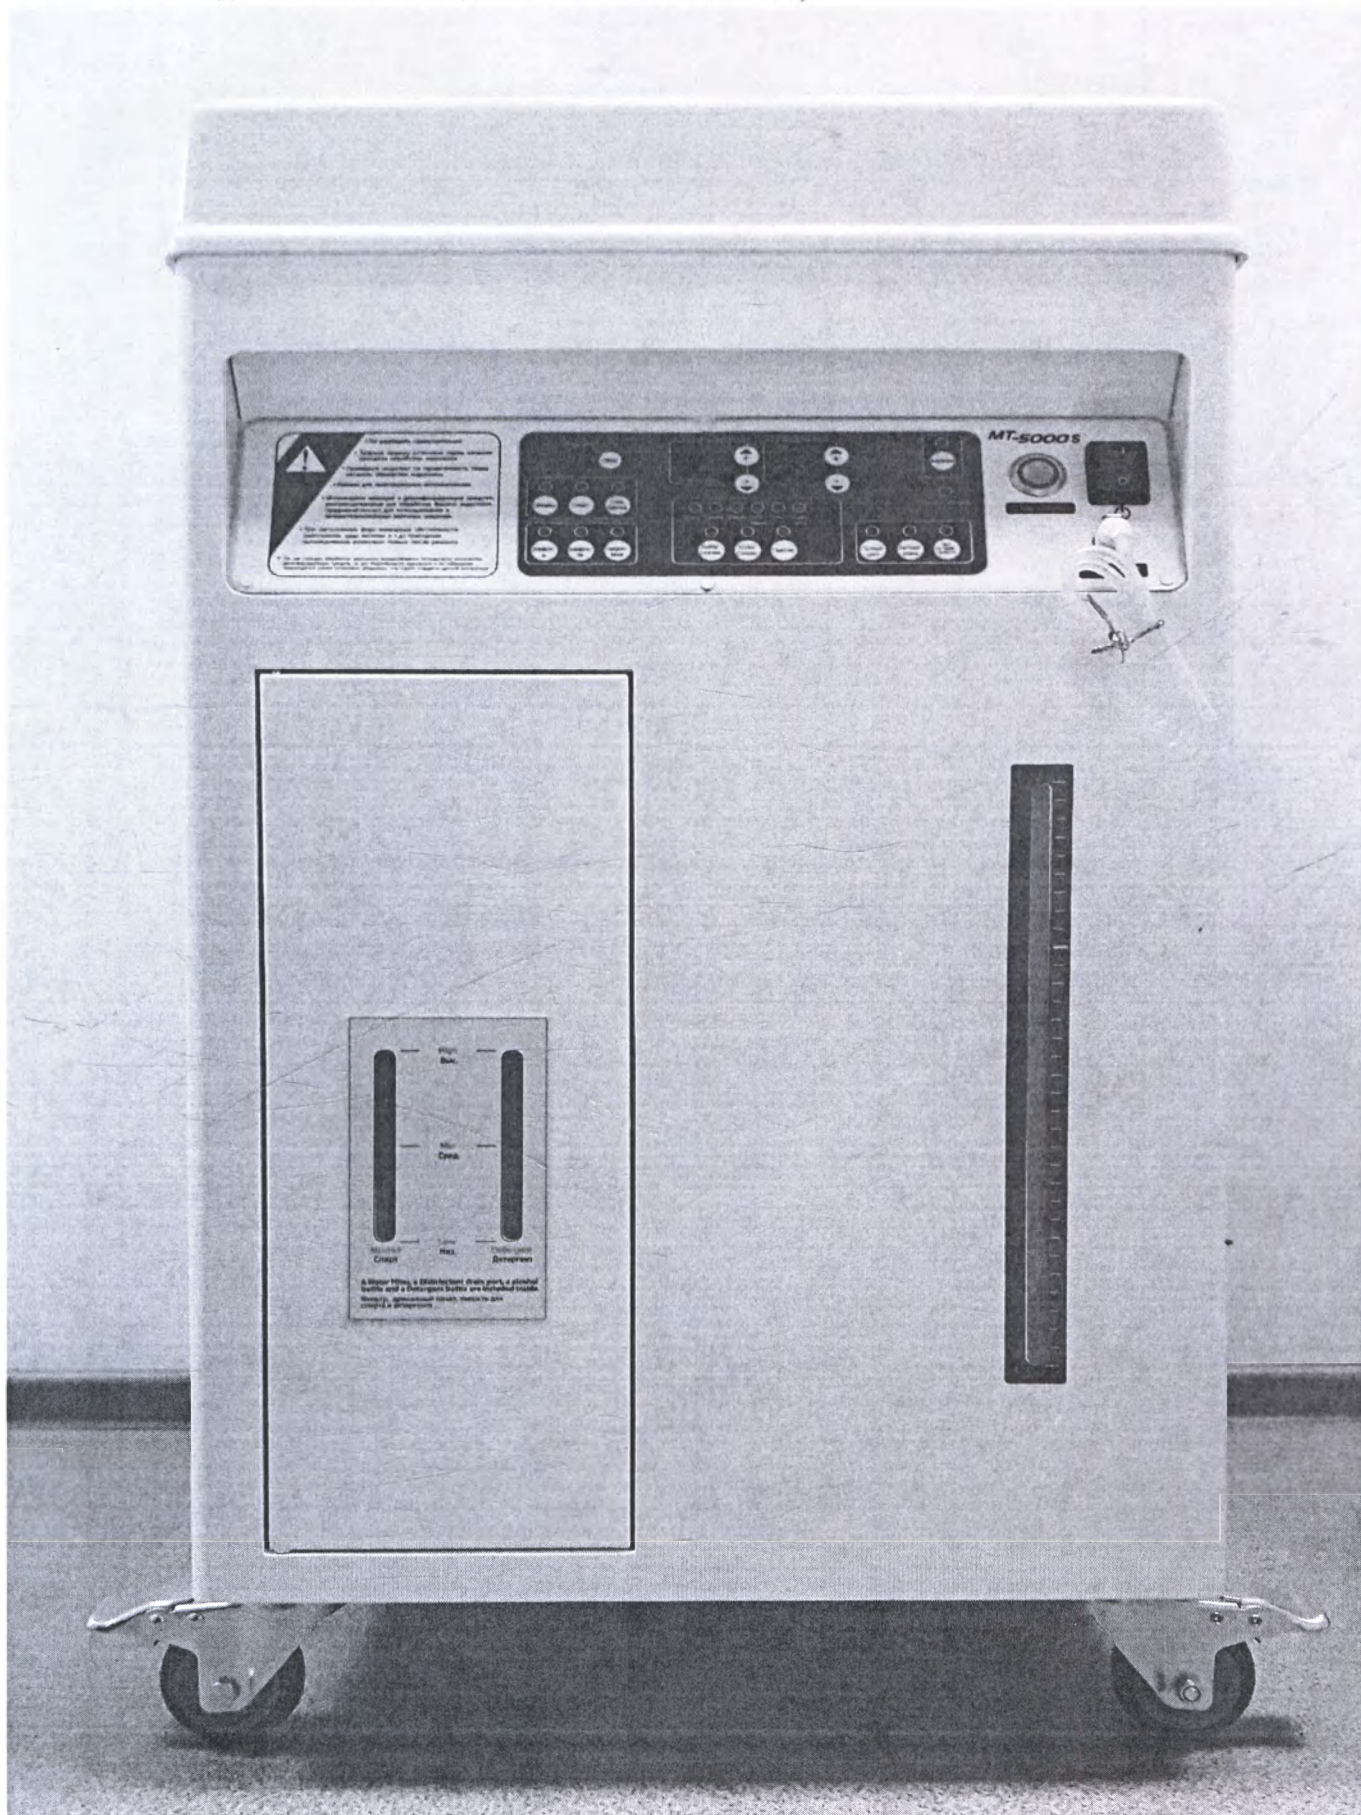


2.2. Адаптер проверки на герметичность гибкого эндоскопа Р – 1 шт.; (при необходимости)

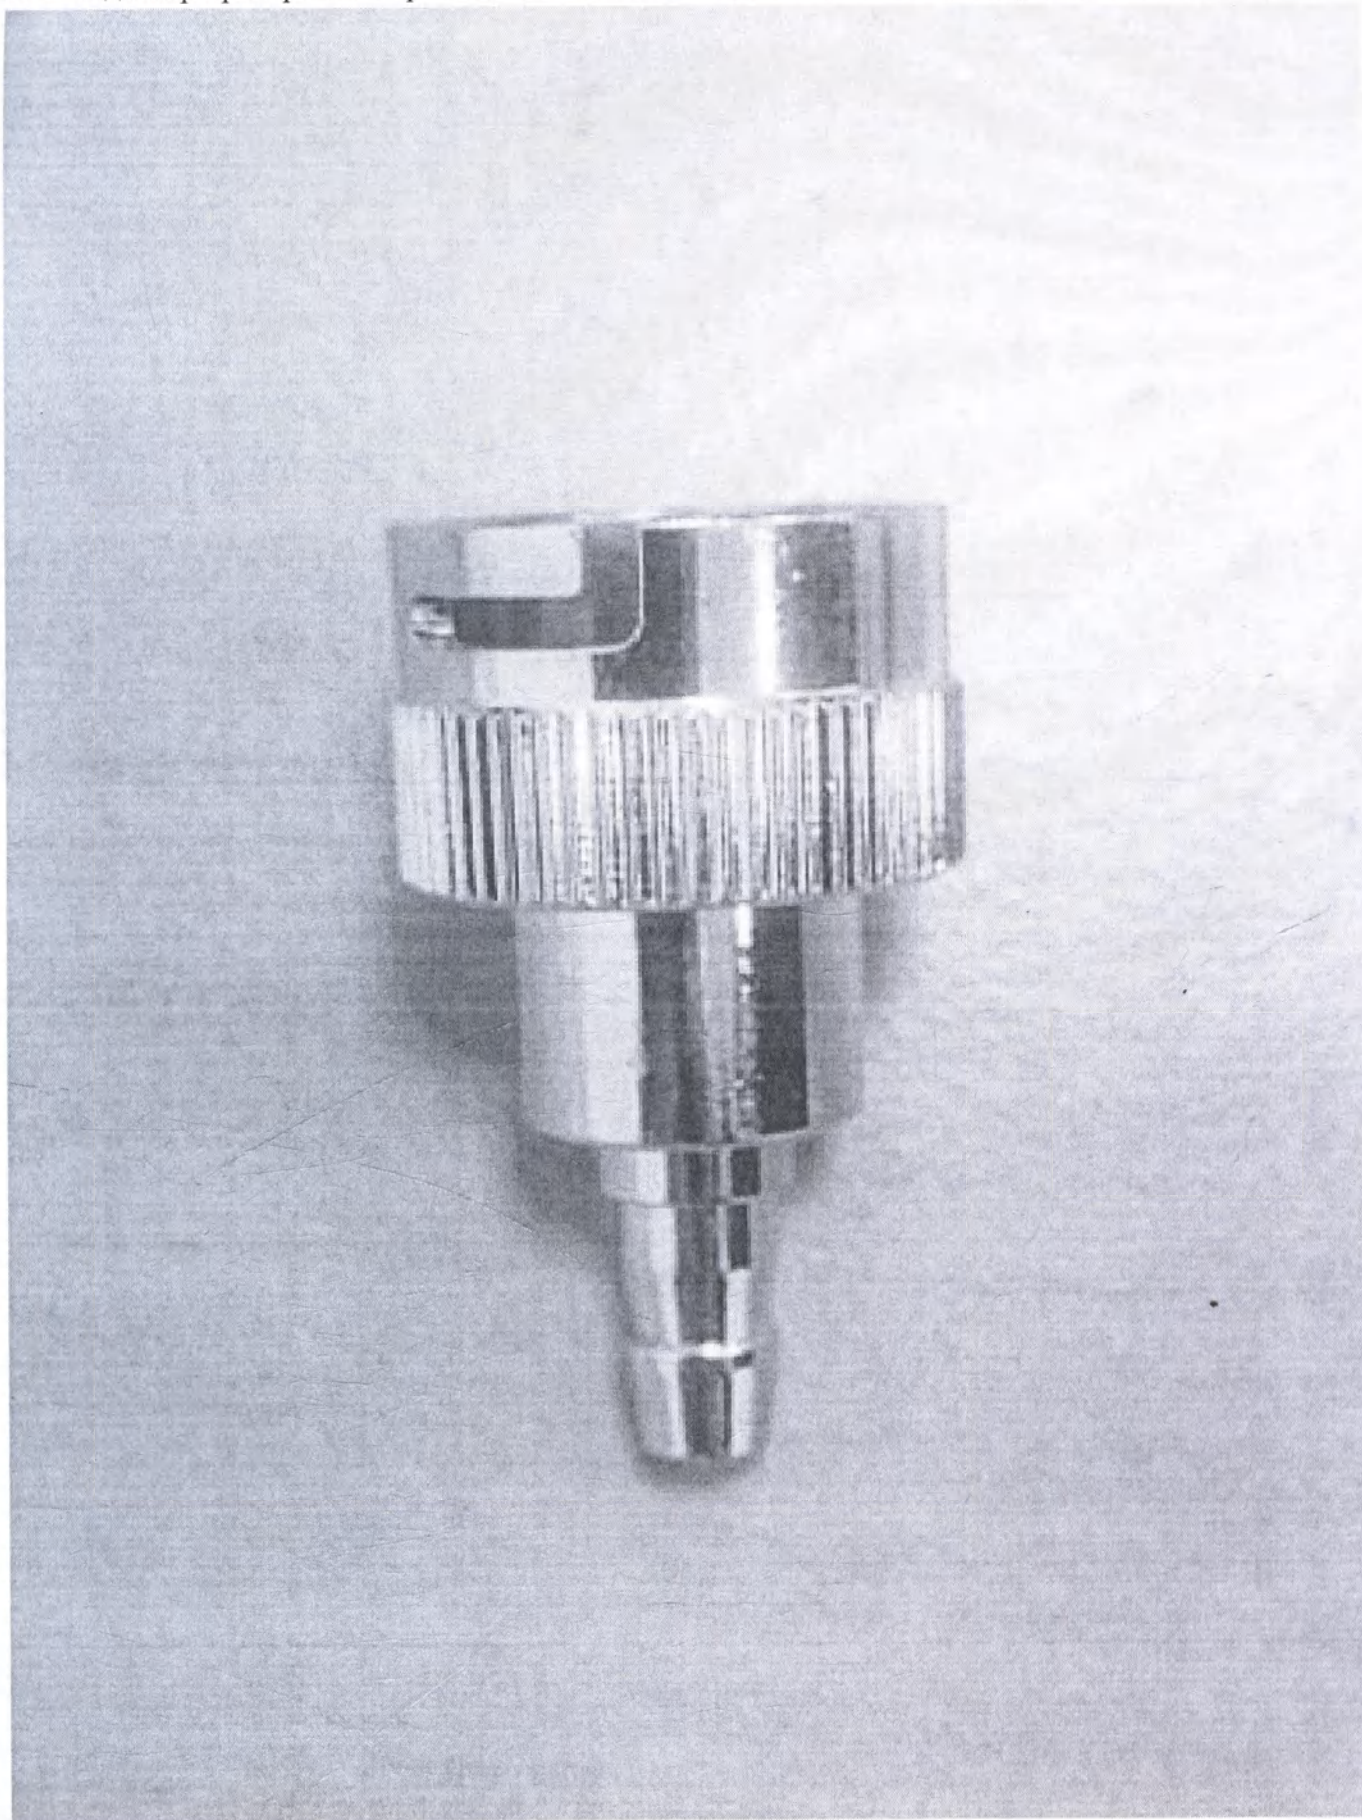


2.3. Адаптер проверки на герметичность гибкого эндоскопа О – 1 шт.; (при необходимости)

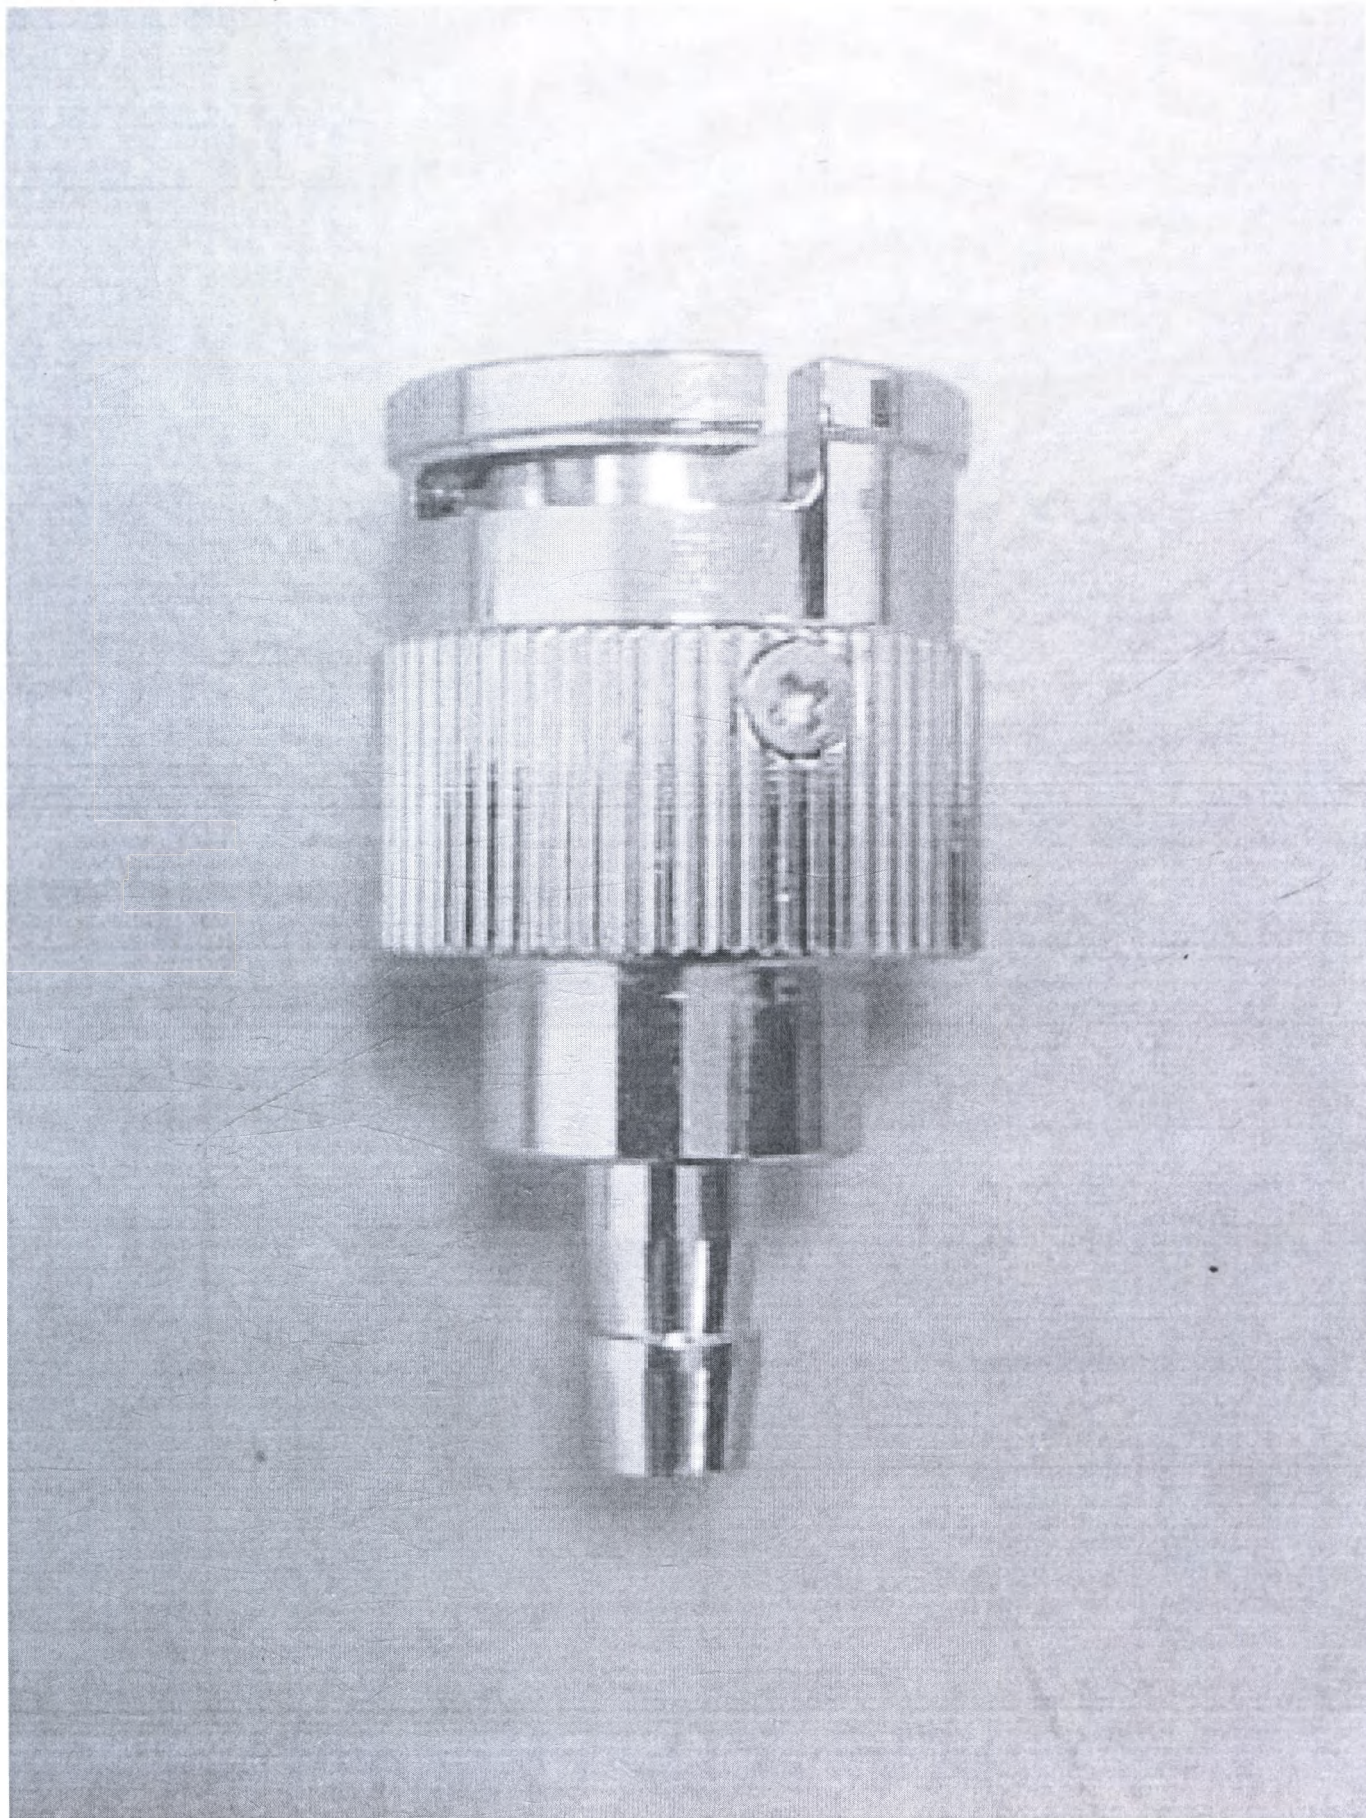


2.4. Шланг отводящий – 1 шт.;

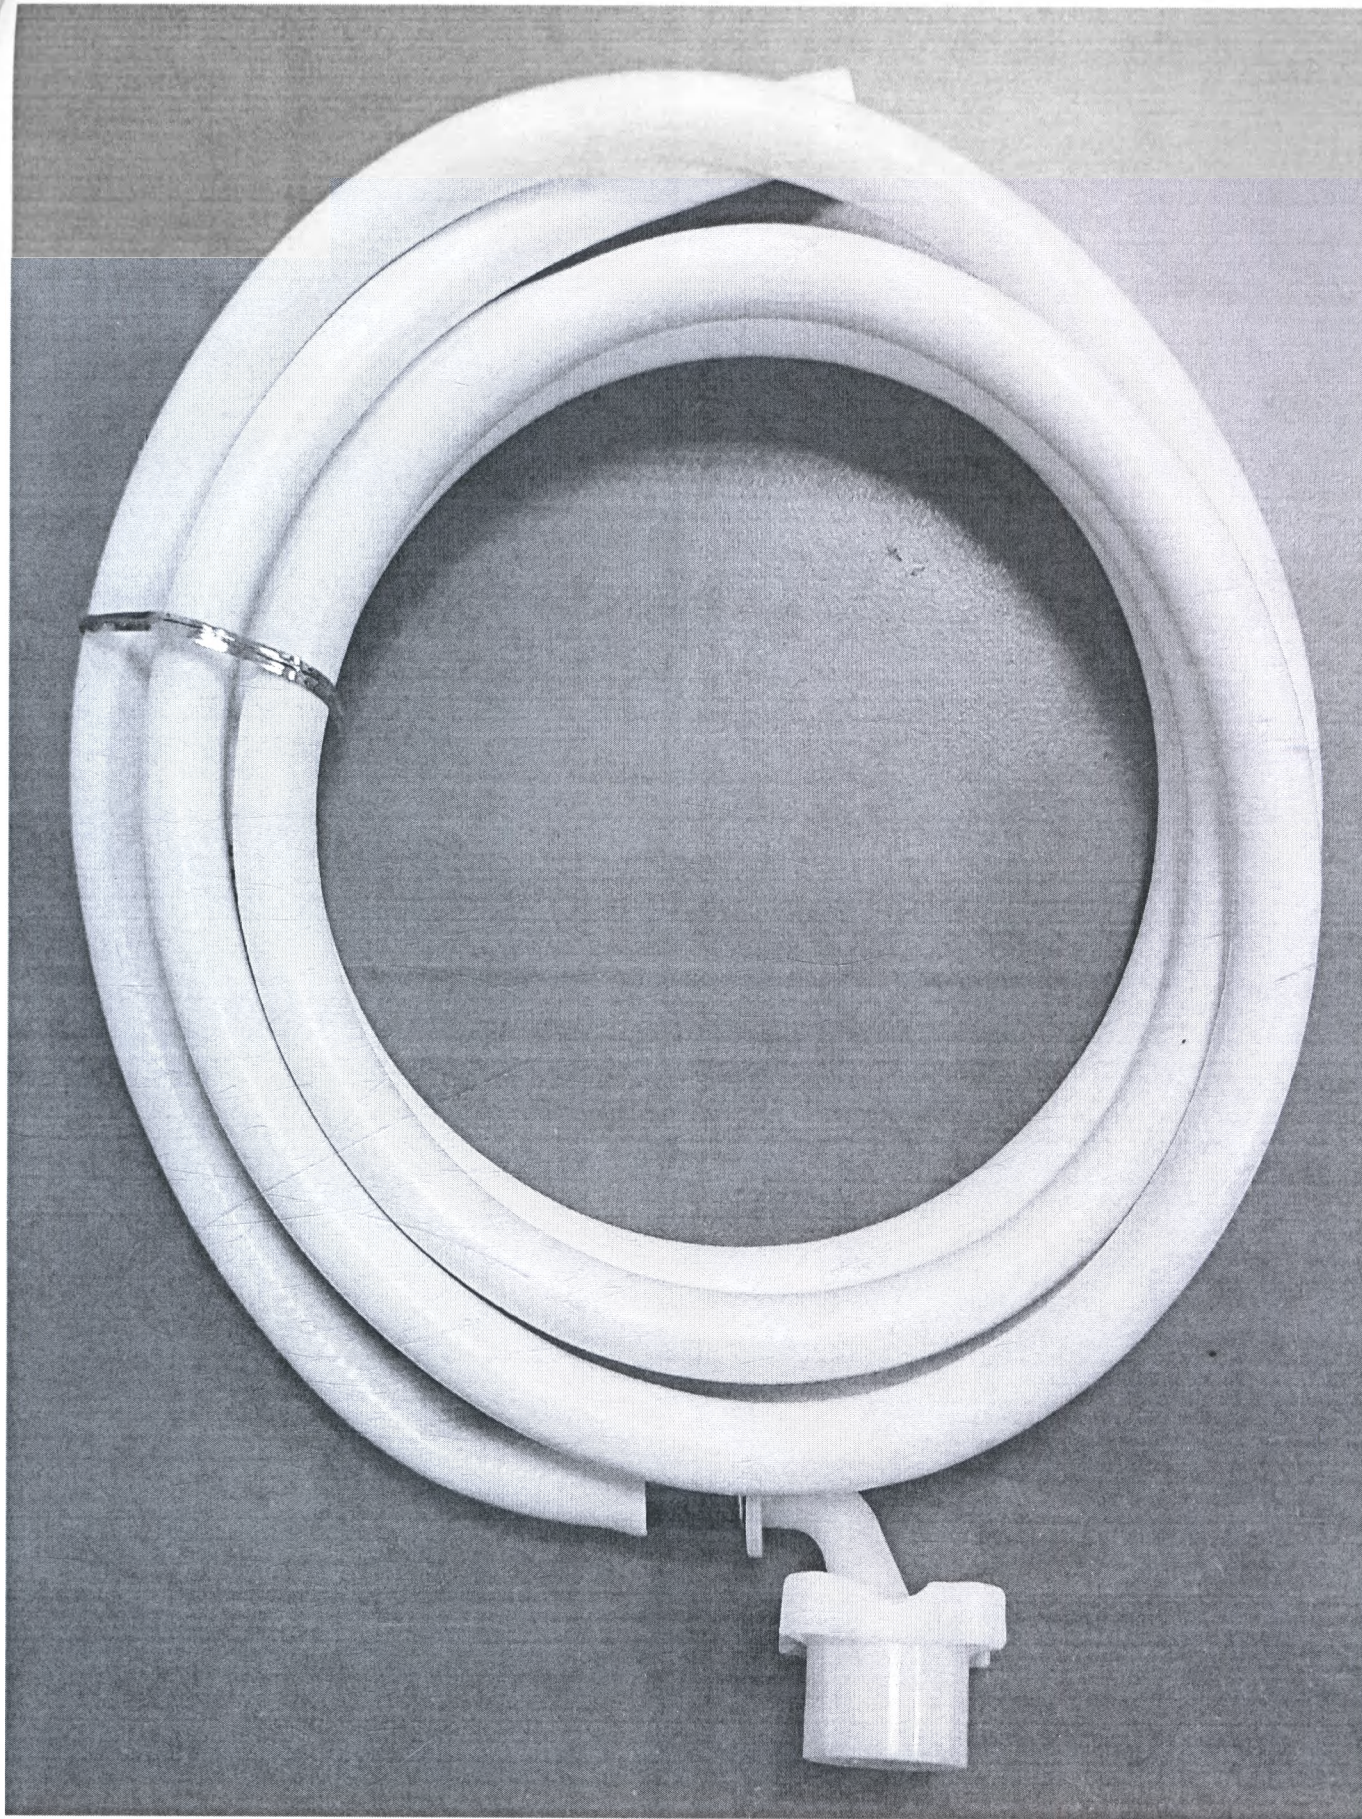


2.5. Шланг для подвода воды – 2 шт.;

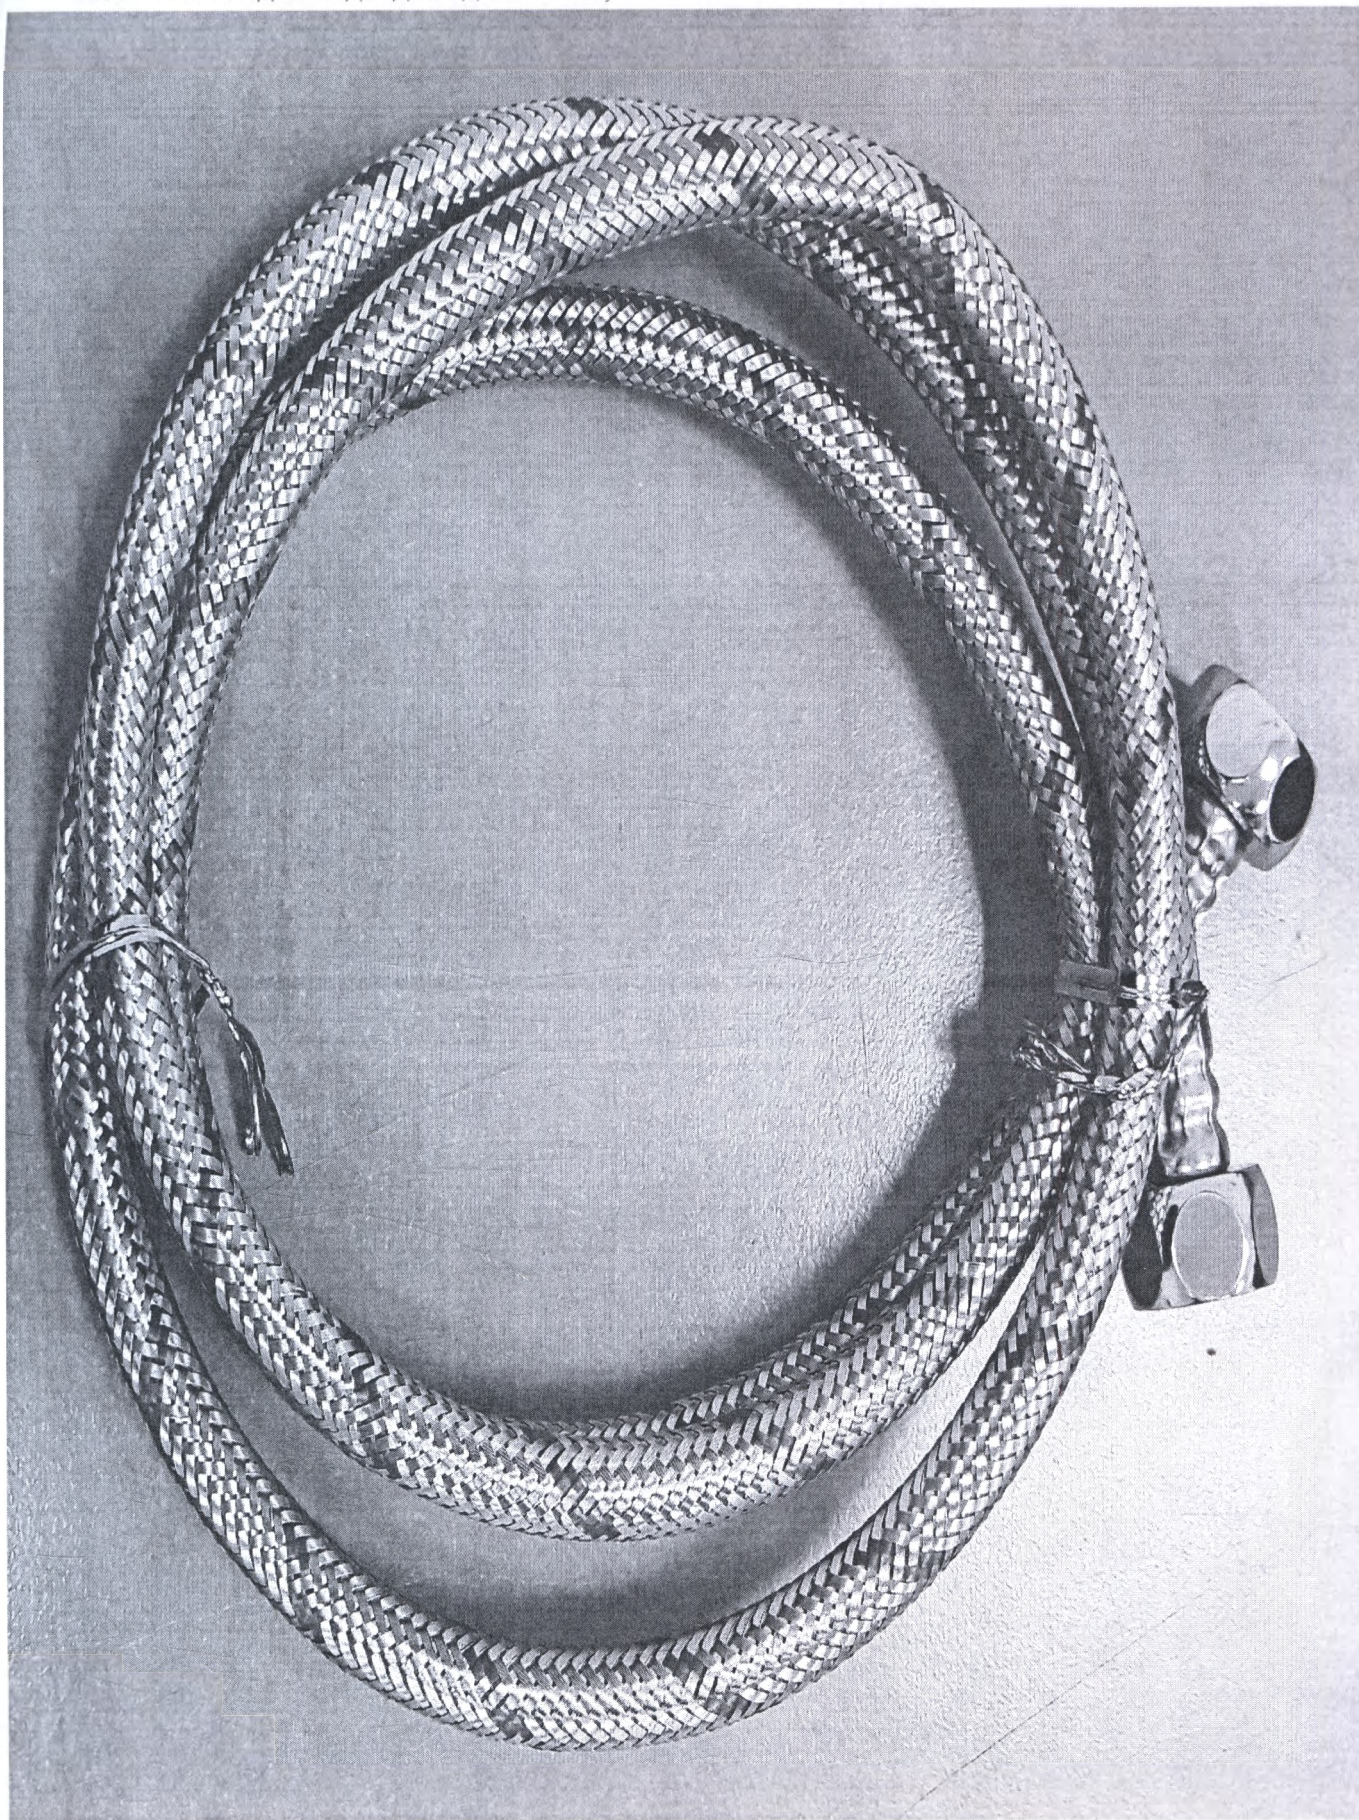


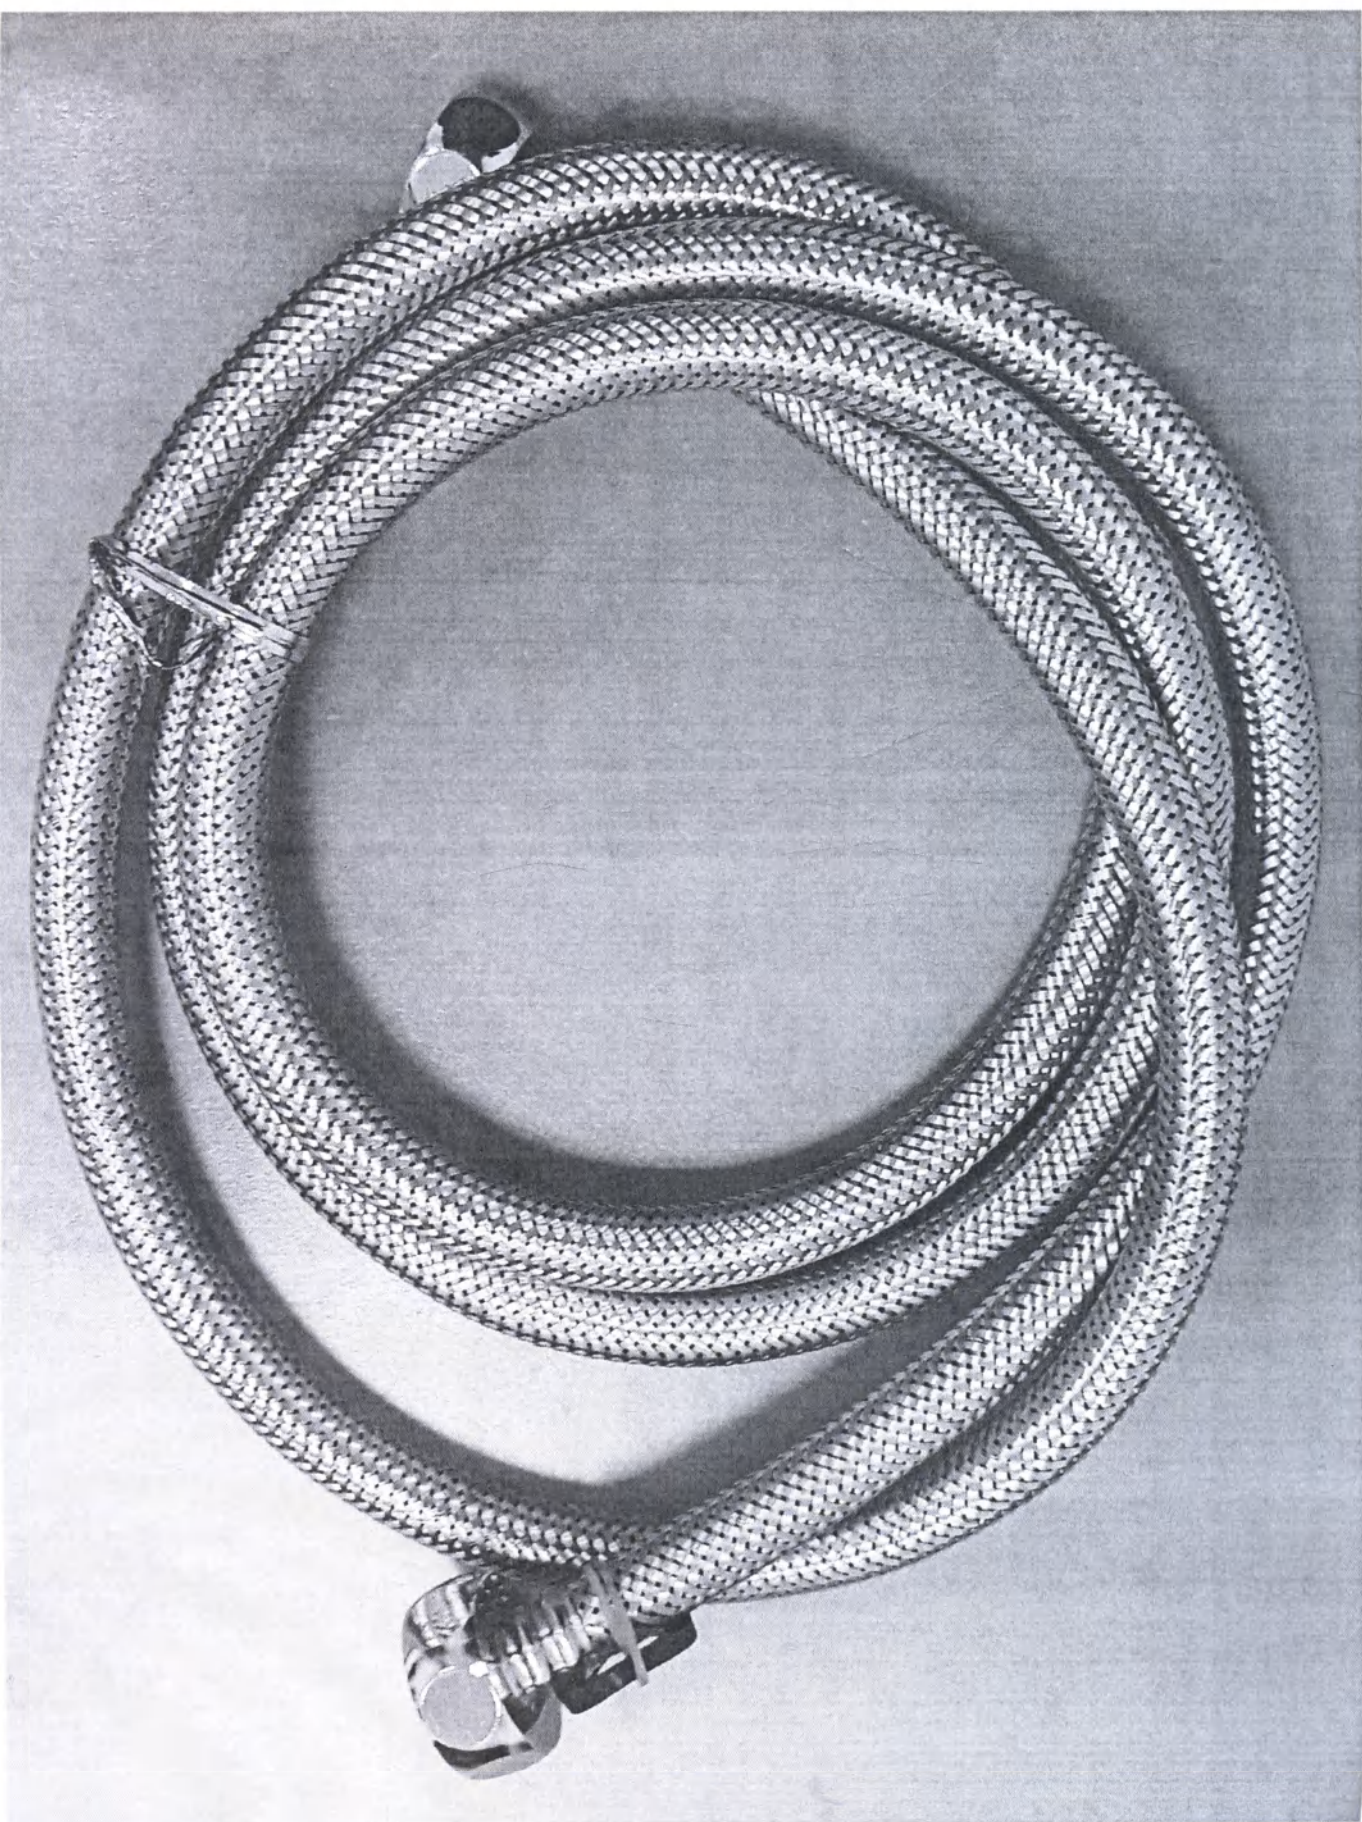


2.6. Шнур сетевой – 1 шт.;

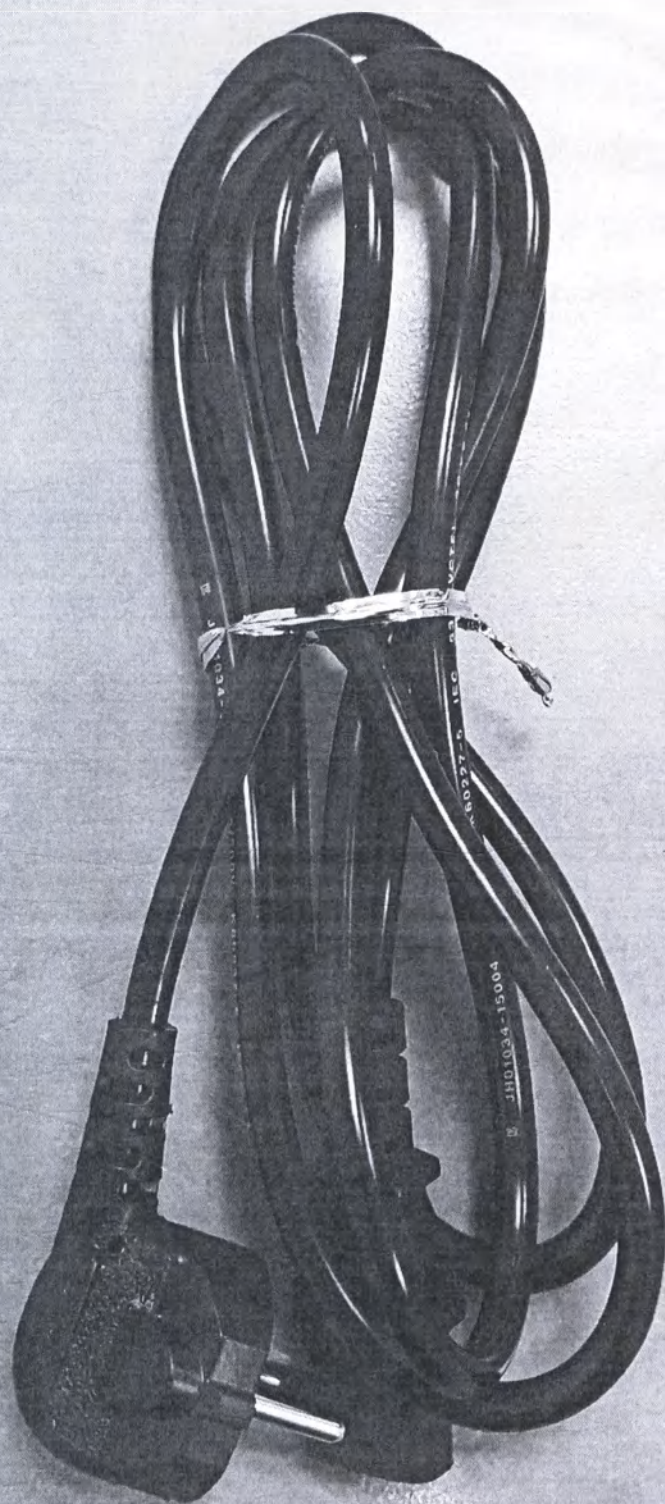


2.7. Крышка вентиляционного отверстия – 1 шт.;

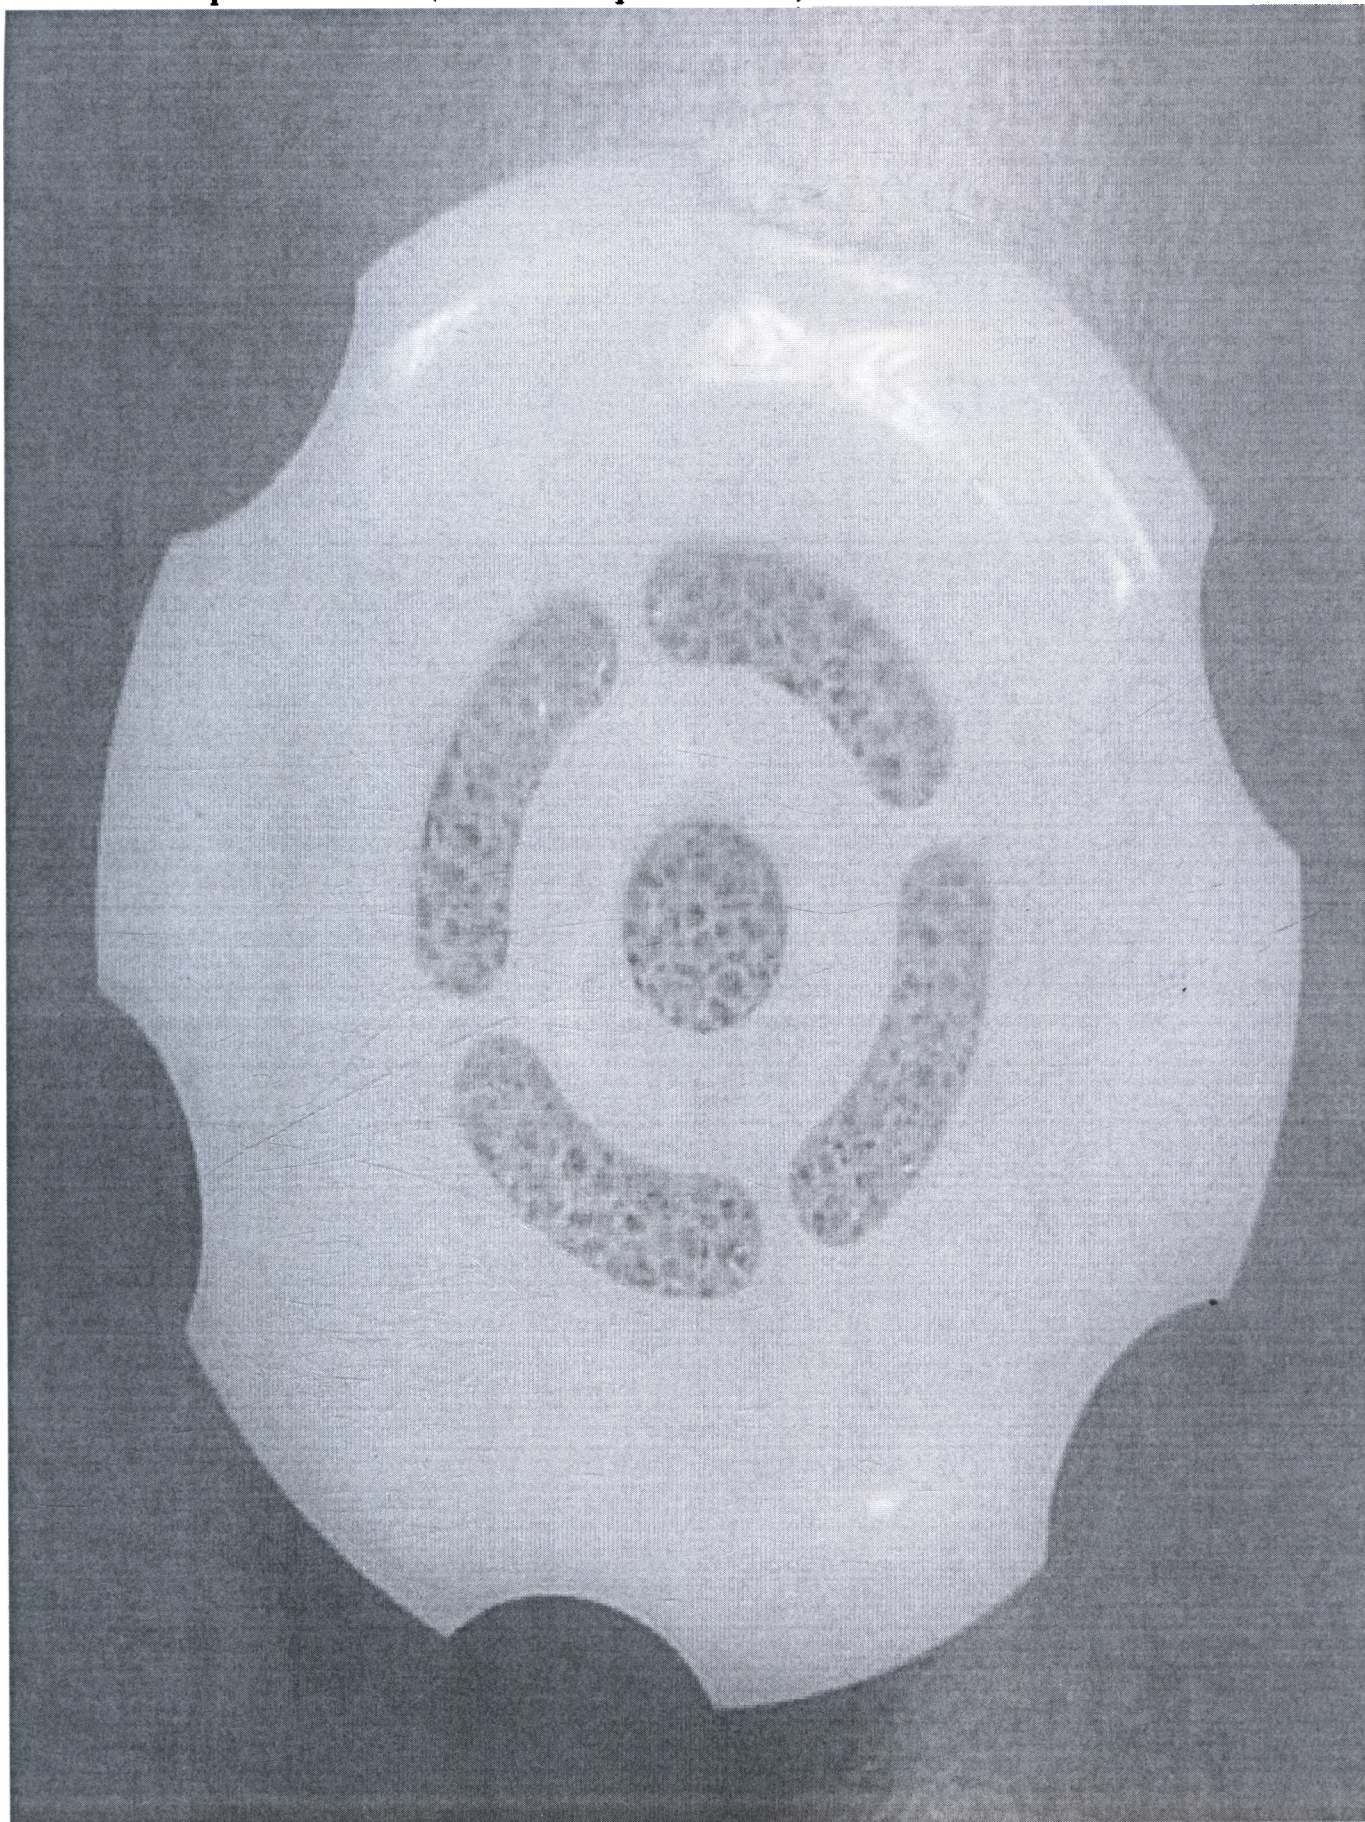


2.8. Корзинка для мелких деталей гибкого эндоскопа – 1 шт.;

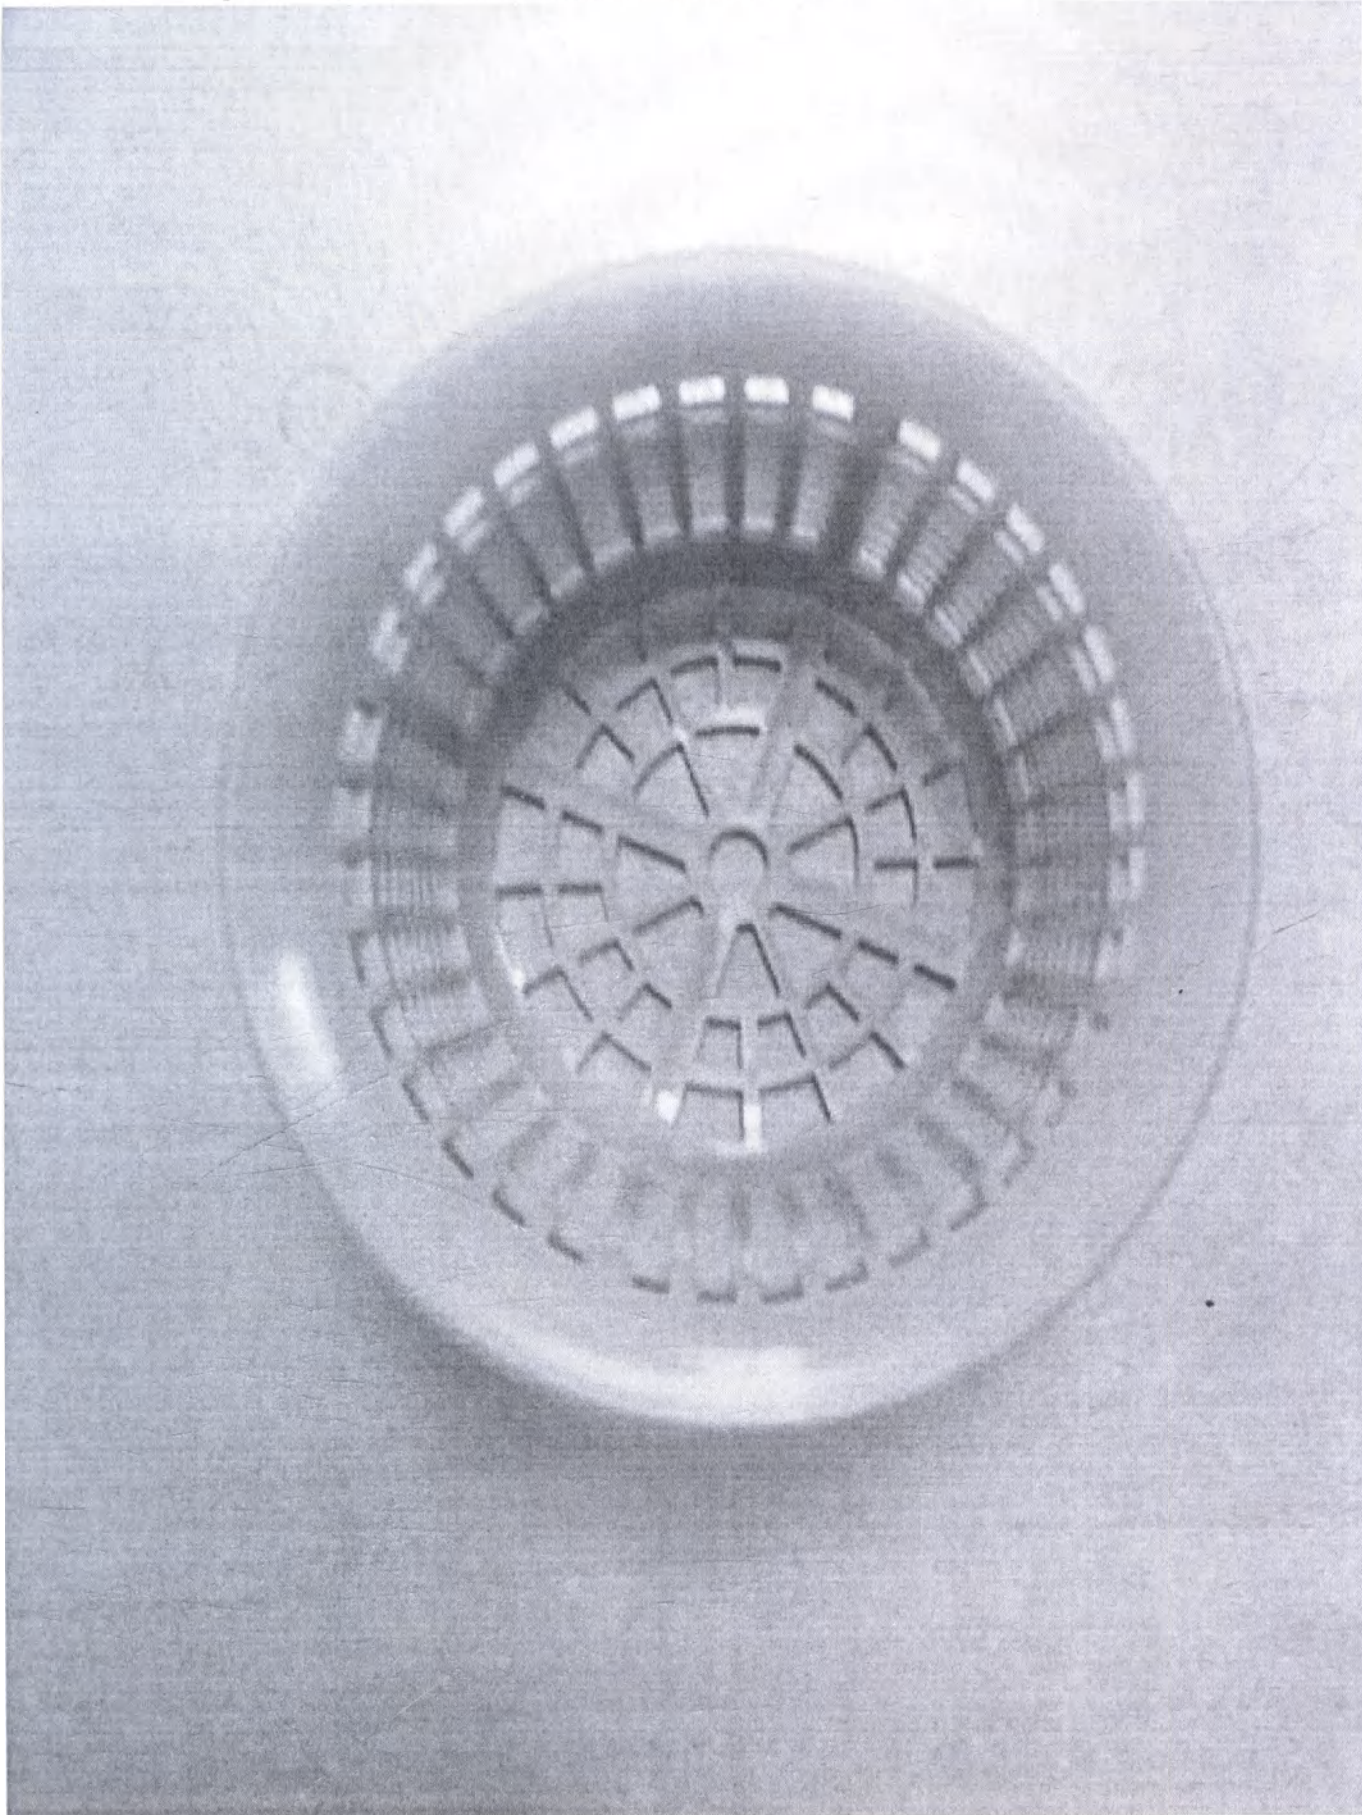


2.9. Адаптер для биопсийного (инструментального) канала О, F – 1 шт.; (при необходимости)

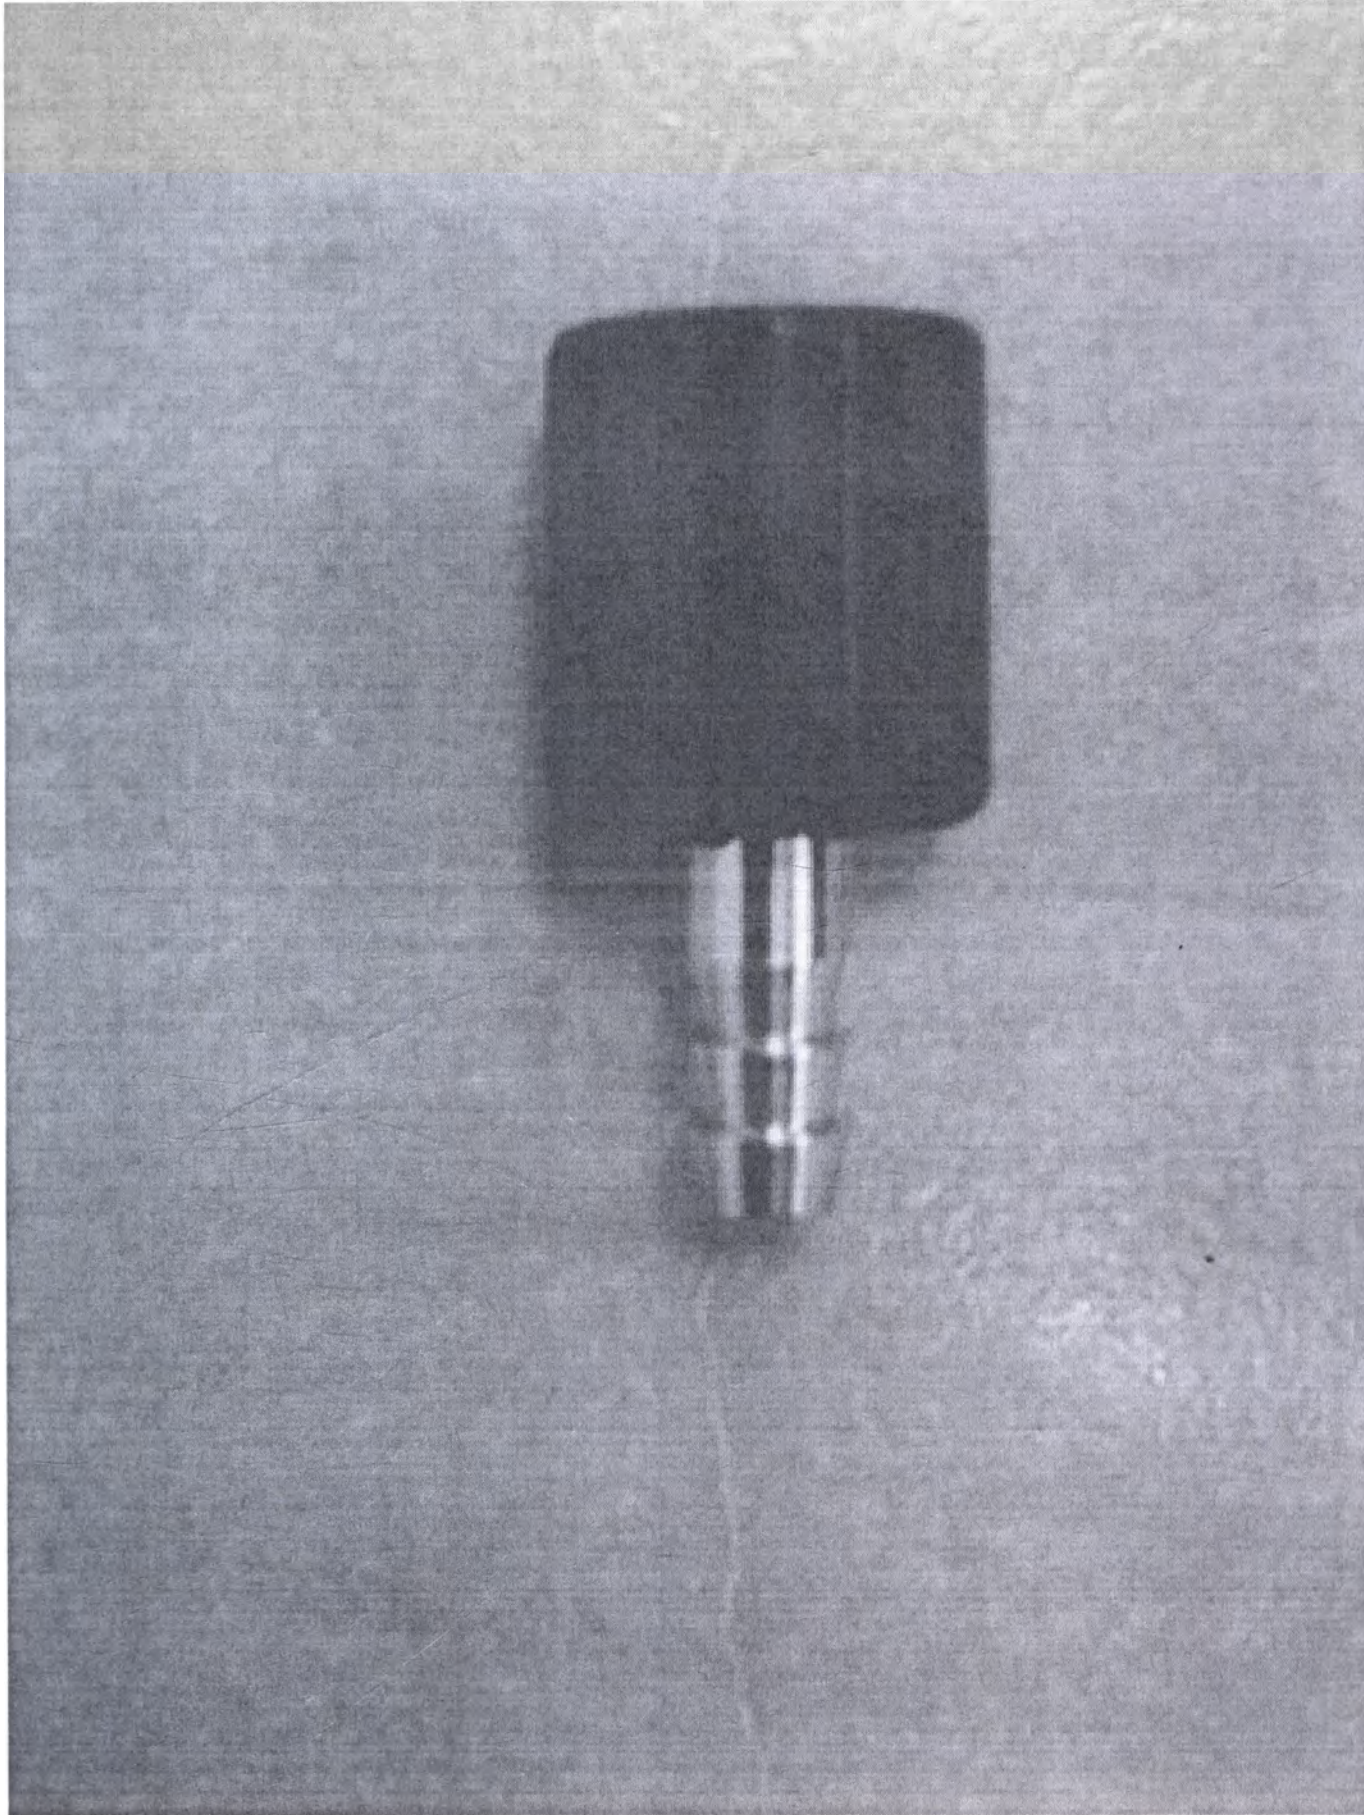


2.10. Адаптер для биопсийного (инструментального) канала Р – 1 шт.; (при необходимости)

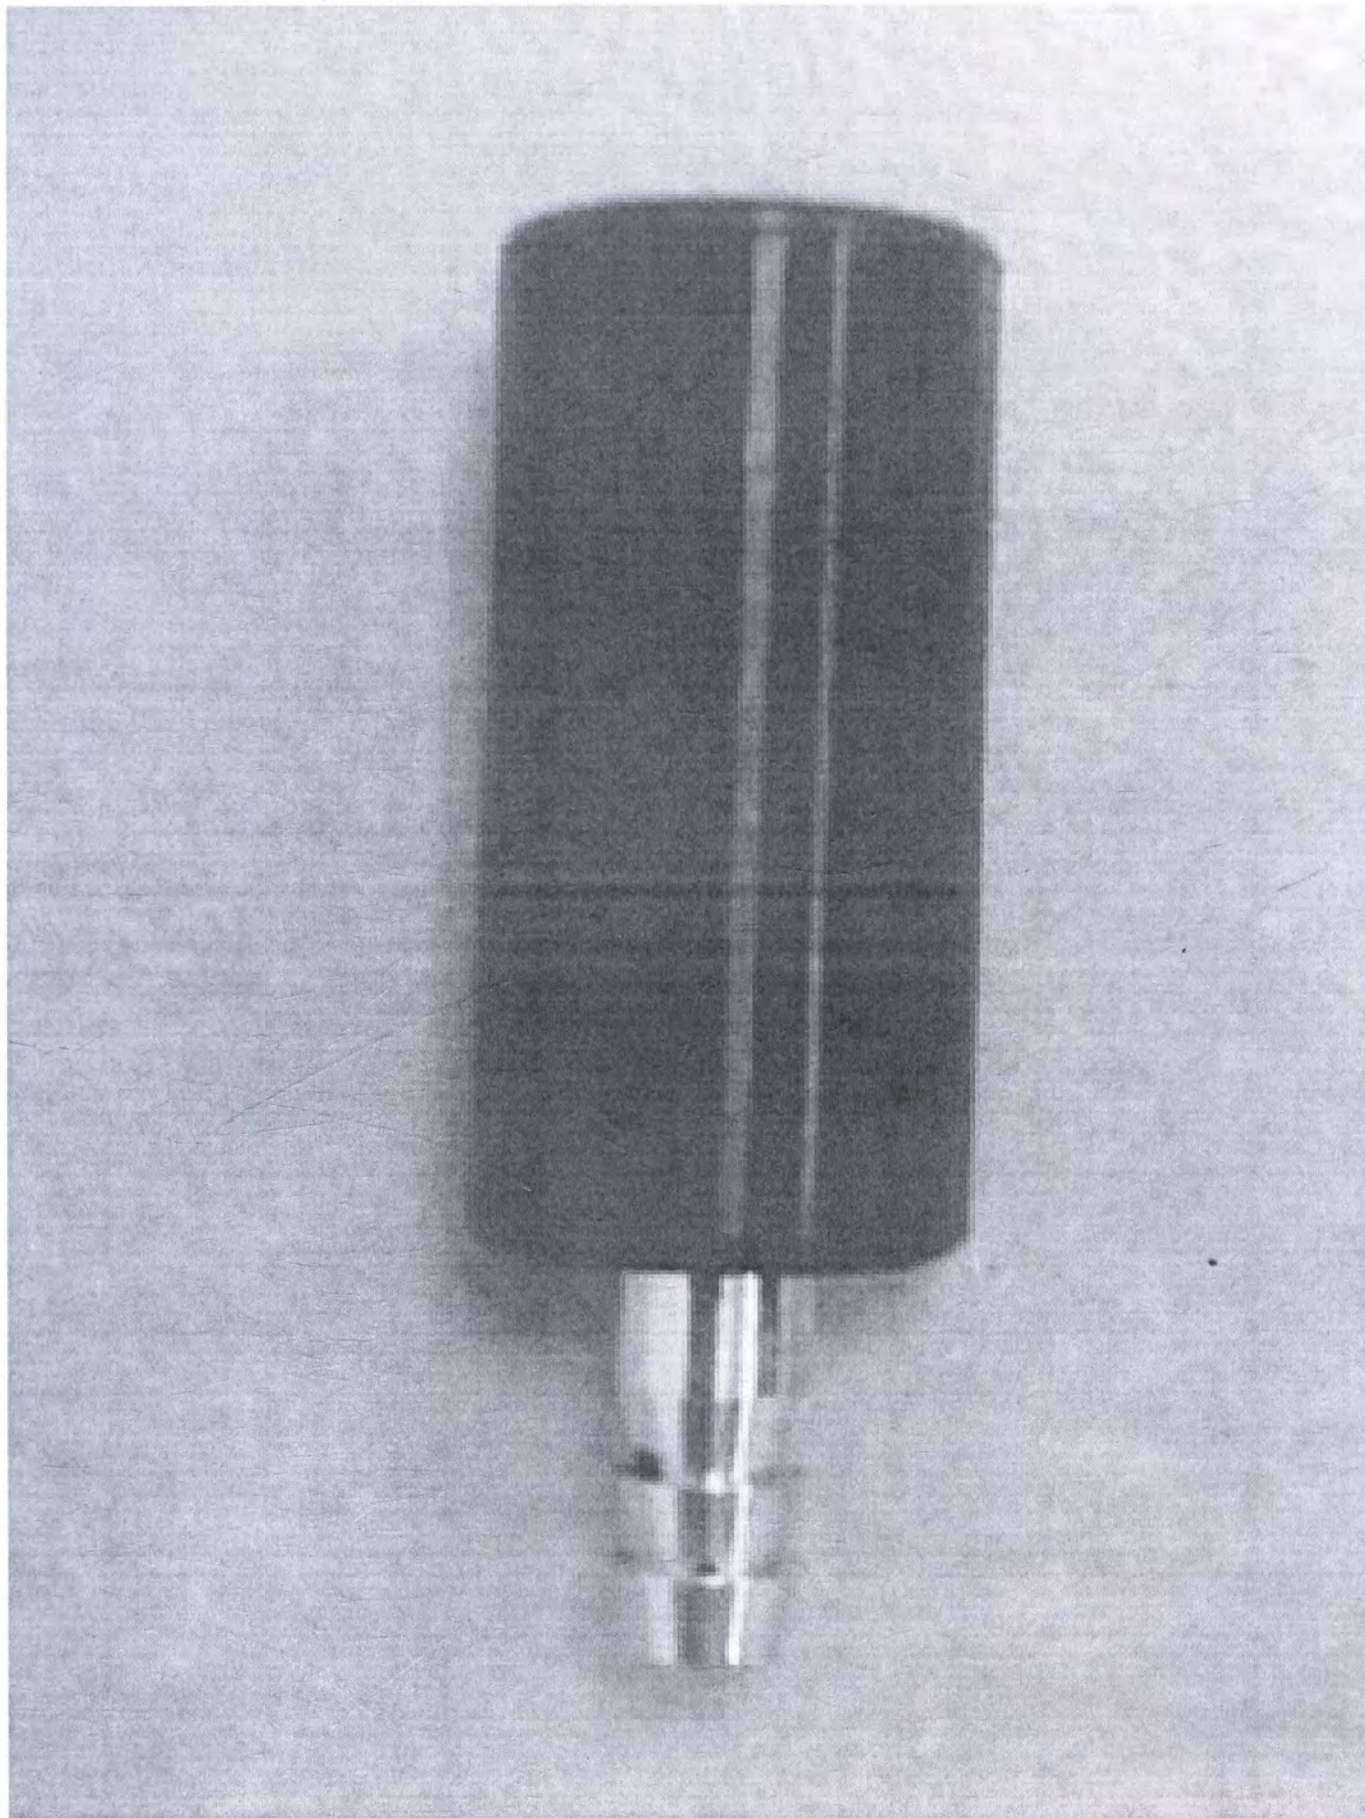


2.11. Набор адаптеров – 1 комплект (6 шт.); (при необходимости)

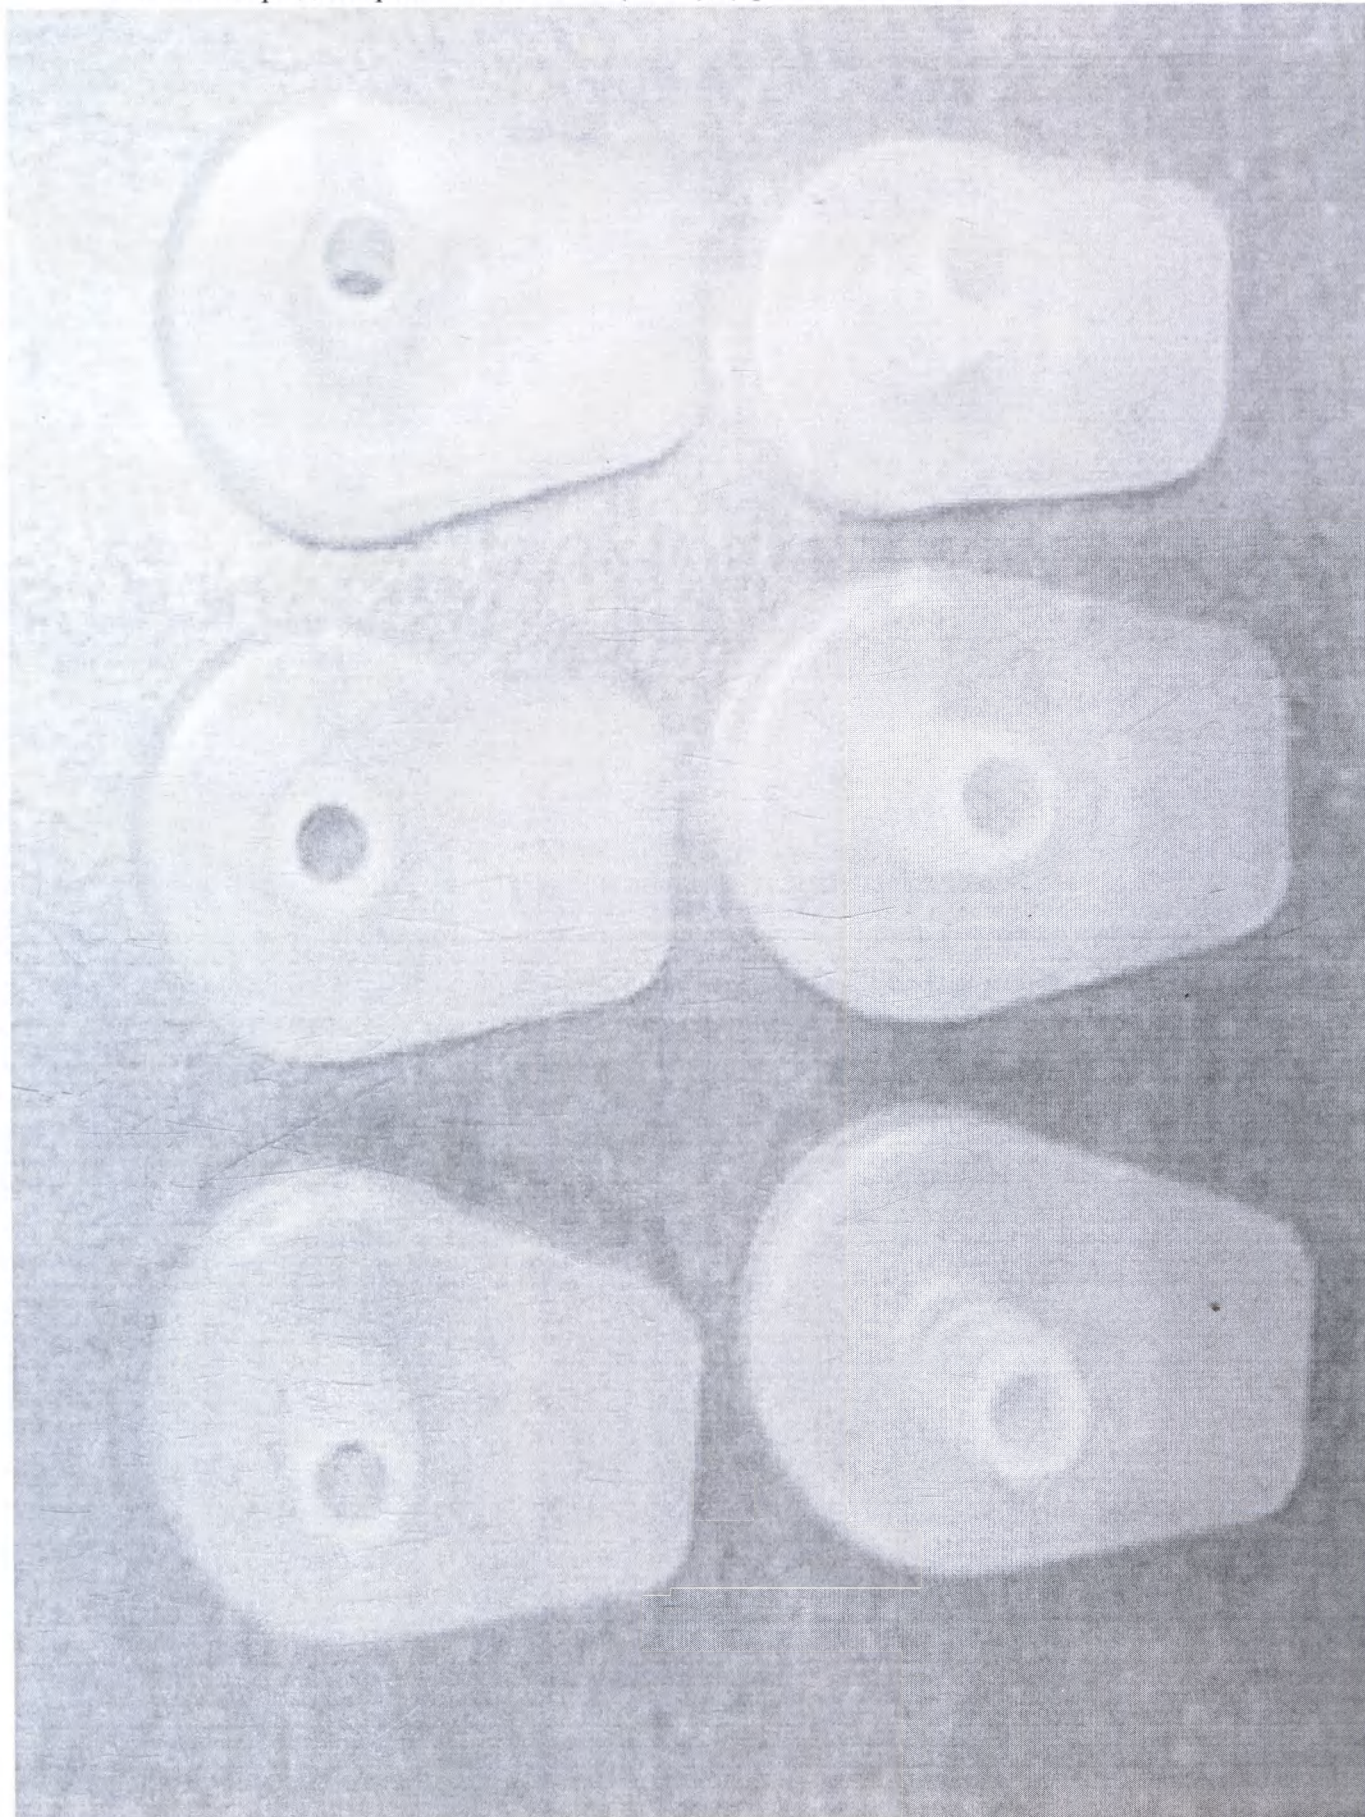

2.12. Встроенный специальный принтер для датировки цикла обработки – 1 шт.; (при необходимости).

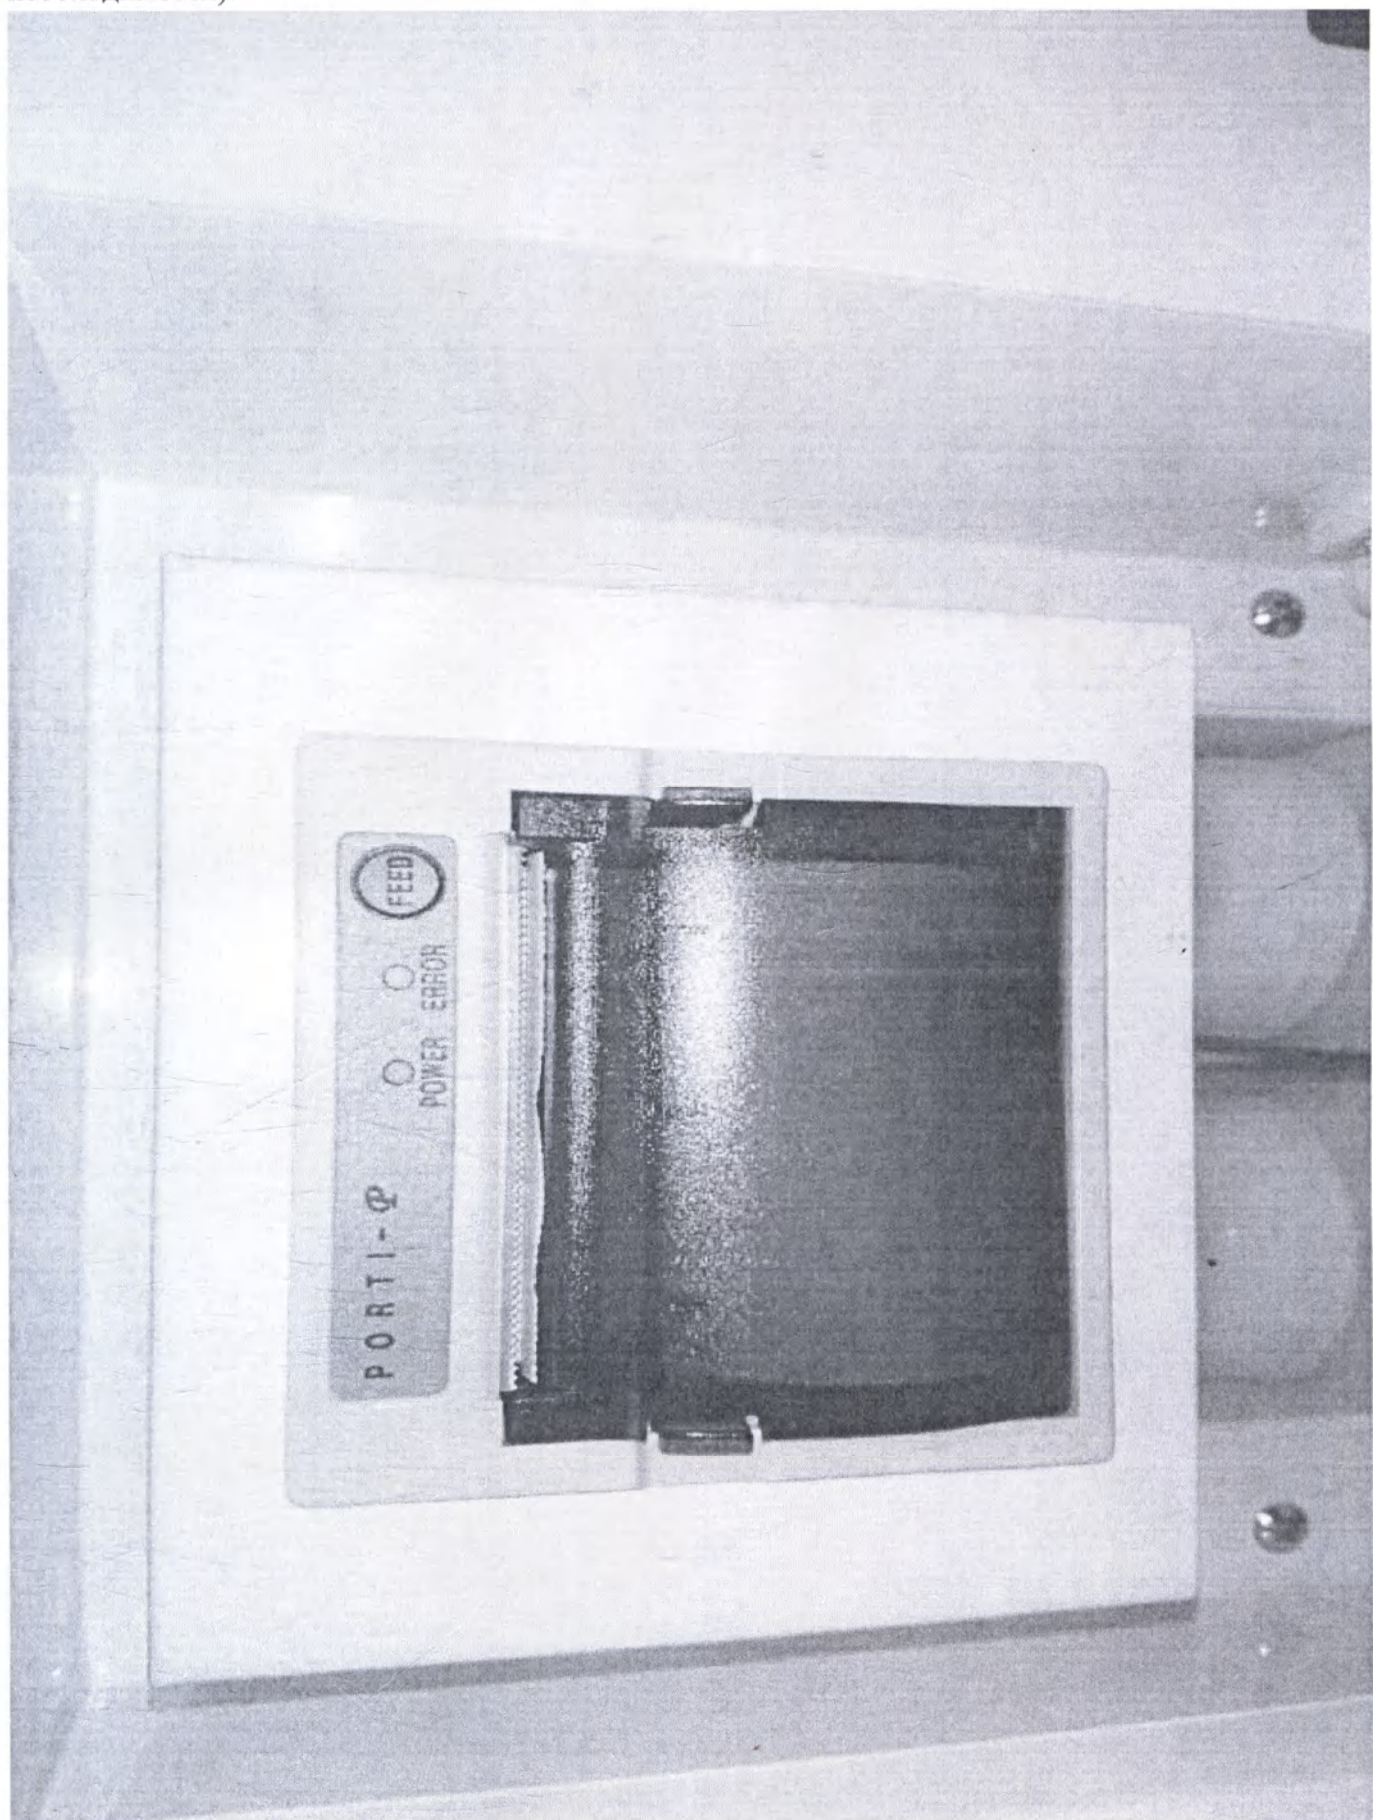

2.13. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;

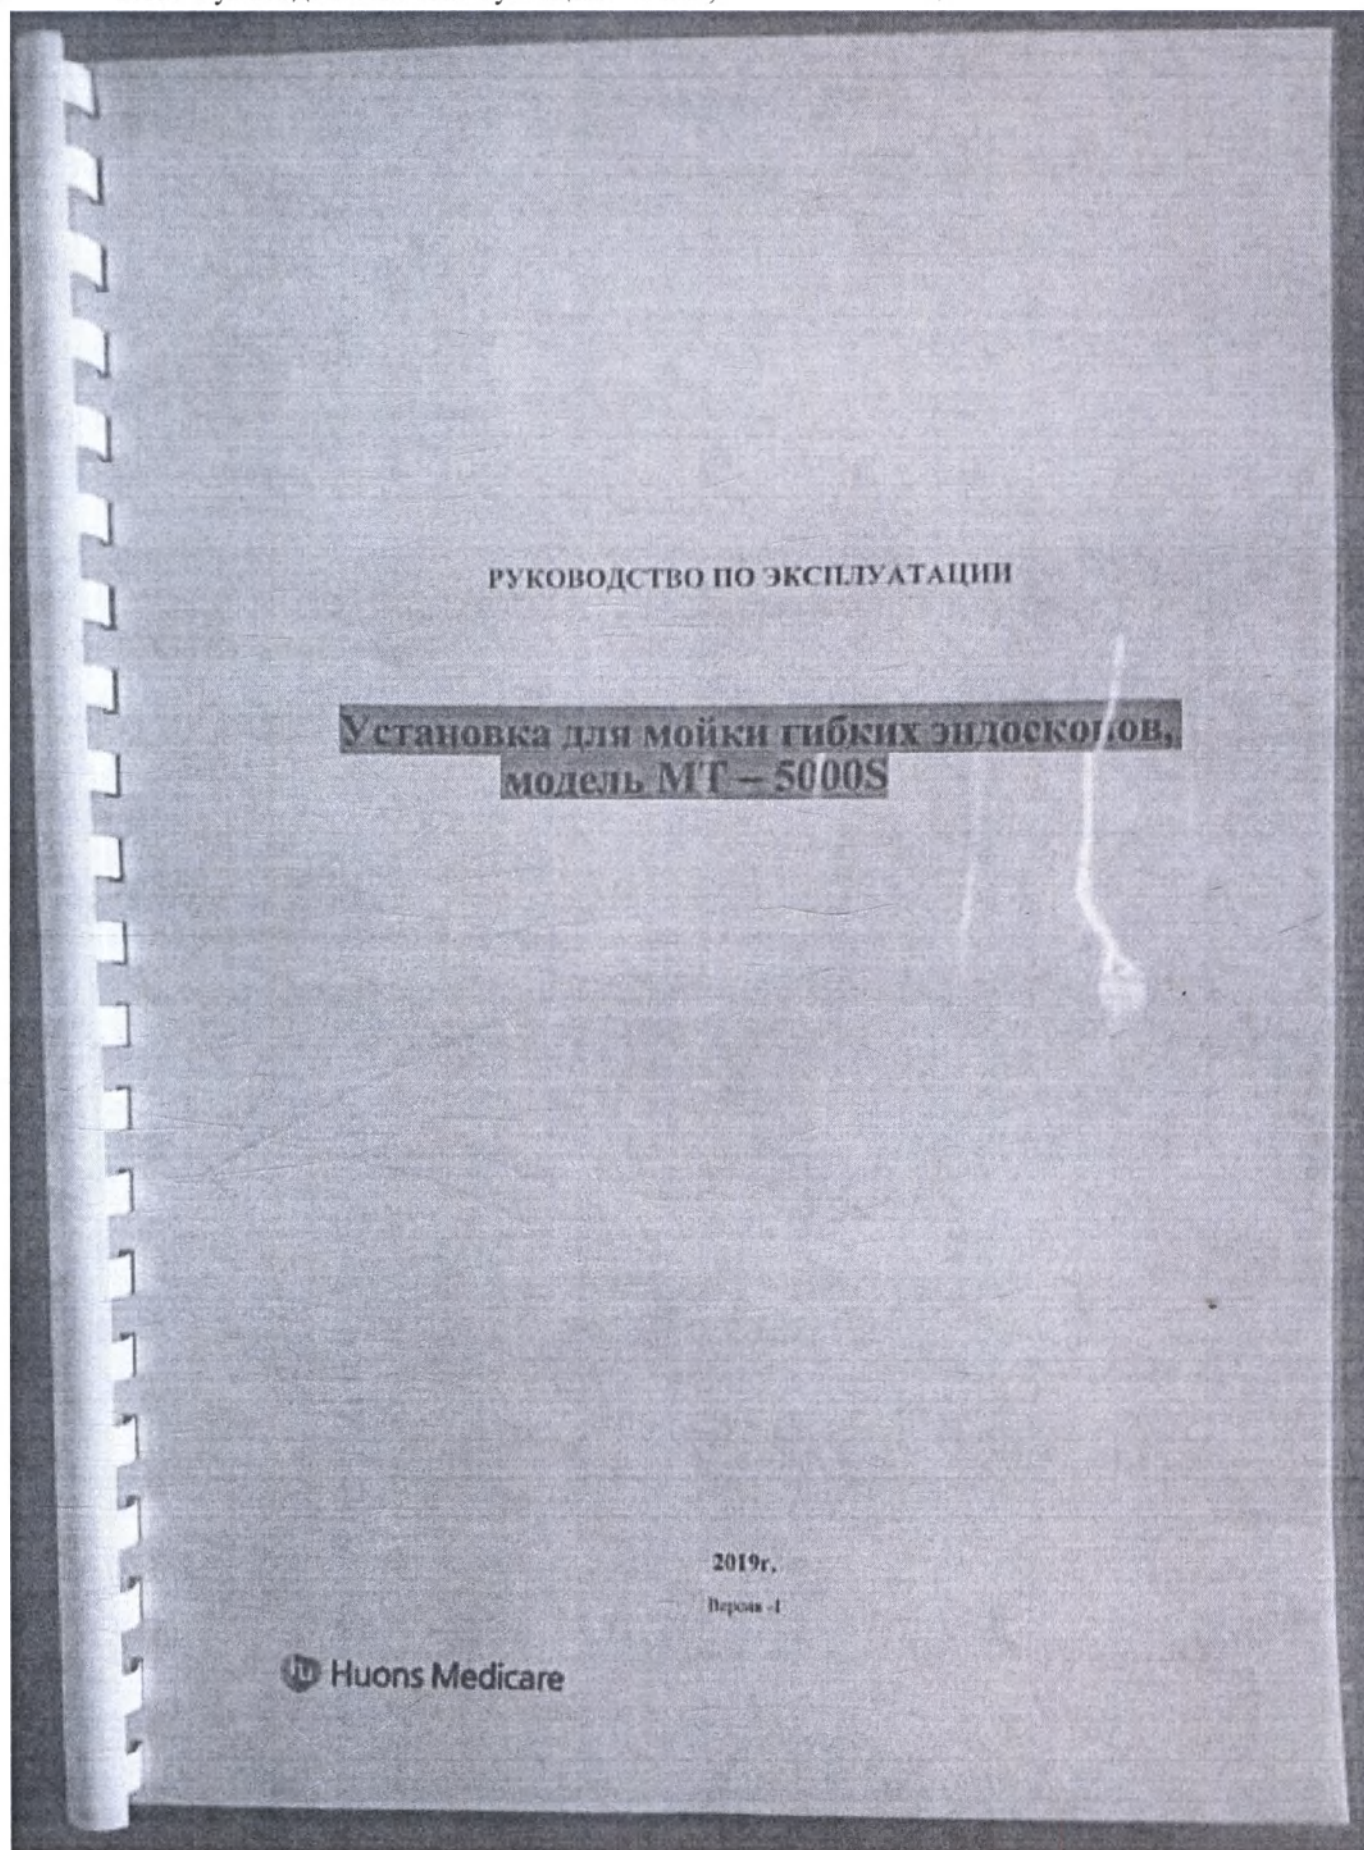

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Установка для мойки гибких эндоскопов,
модель MT – 5000S

2019г.

Версия -1

 Huons Medicare

Макет маркировки (шильдик) на Установке для мойки гибких эндоскопов MT-5000S

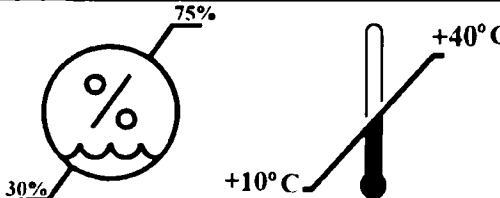 Производитель	Хуонс Медика Ко., ЛТД. 22, Ноксансандан 165-ро, Гангseo-гу, Пусан, Республика Корея Тел.:82-51-831-1030; 82-70-7410-8992 contact@huonsmedicare.com info@huonsmedicare.com
Адрес места производства	С-401, 27, Аннам-ро 418беон-гил, Бупуеонг-гу, Инчеон, Республика Корея
Регистрационное удостоверение	ФСЗ xxxx/xxxxx от xx _____ xxxx года
Наименование	Установка для мойки гибких эндоскопов
Модель	MT-5000S
 Серийный номер	xxxx-xx-xx-xxx
 Дата изготовления	xx.xx.xxxx
Вес	58 кг
Источник питания, потребляемая мощность	220В, 50/60Гц, 500Вт
Класс электробезопасности	Класс 1
Условия эксплуатации	 Пожалуйста, используйте в указанном диапазоне влажности и температуры
  Сделано в Республике Корея	

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
30 (Тридцати) листа



Генеральный директор ООО «Эксперт Медикал»

Подпись _____ Лялькина Жанна Анатольевна