Фотографические изображения «Системы медицинской для криотерапии Visual-ICE с принадлежностями»

Генеральный директор ООО «ЮРМЕД» Кищенко И.М

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Распределительная панель для подачи газов в иглы

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Система медицинская для криотерапии Visual-ICE:

- Распределительная панель для подачи газов в иглы
- Монитор жидкокристаллический.
- Переключатель для запуска системы.
- Кабель питания
- Руководство пользователя.
- Руководство справочное краткое

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

Напряжение: 100 В – 240 В
Частота 50 Гц – 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность - 250 ВА
Предохранитель: T 3.15A

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

IP1

CE

- **Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;**
- **Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;**
- **Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;**
- **Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Монитор жидкокристаллический.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Система медицинская для криотерапии Visual-ICE:

- Распределительная панель для подачи газов в иглы
- Монитор жидкокристаллический.
- Переключатель для запуска системы.
- Кабель питания
- Руководство пользователя.
- Руководство справочное краткое

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

Напряжение: 100 В – 240 В
Частота 50 Гц – 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность - 250 ВА
Предохранитель: T 3.15A

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

IP1

CE

- **Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;**
- **Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;**
- **Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;**
- **Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

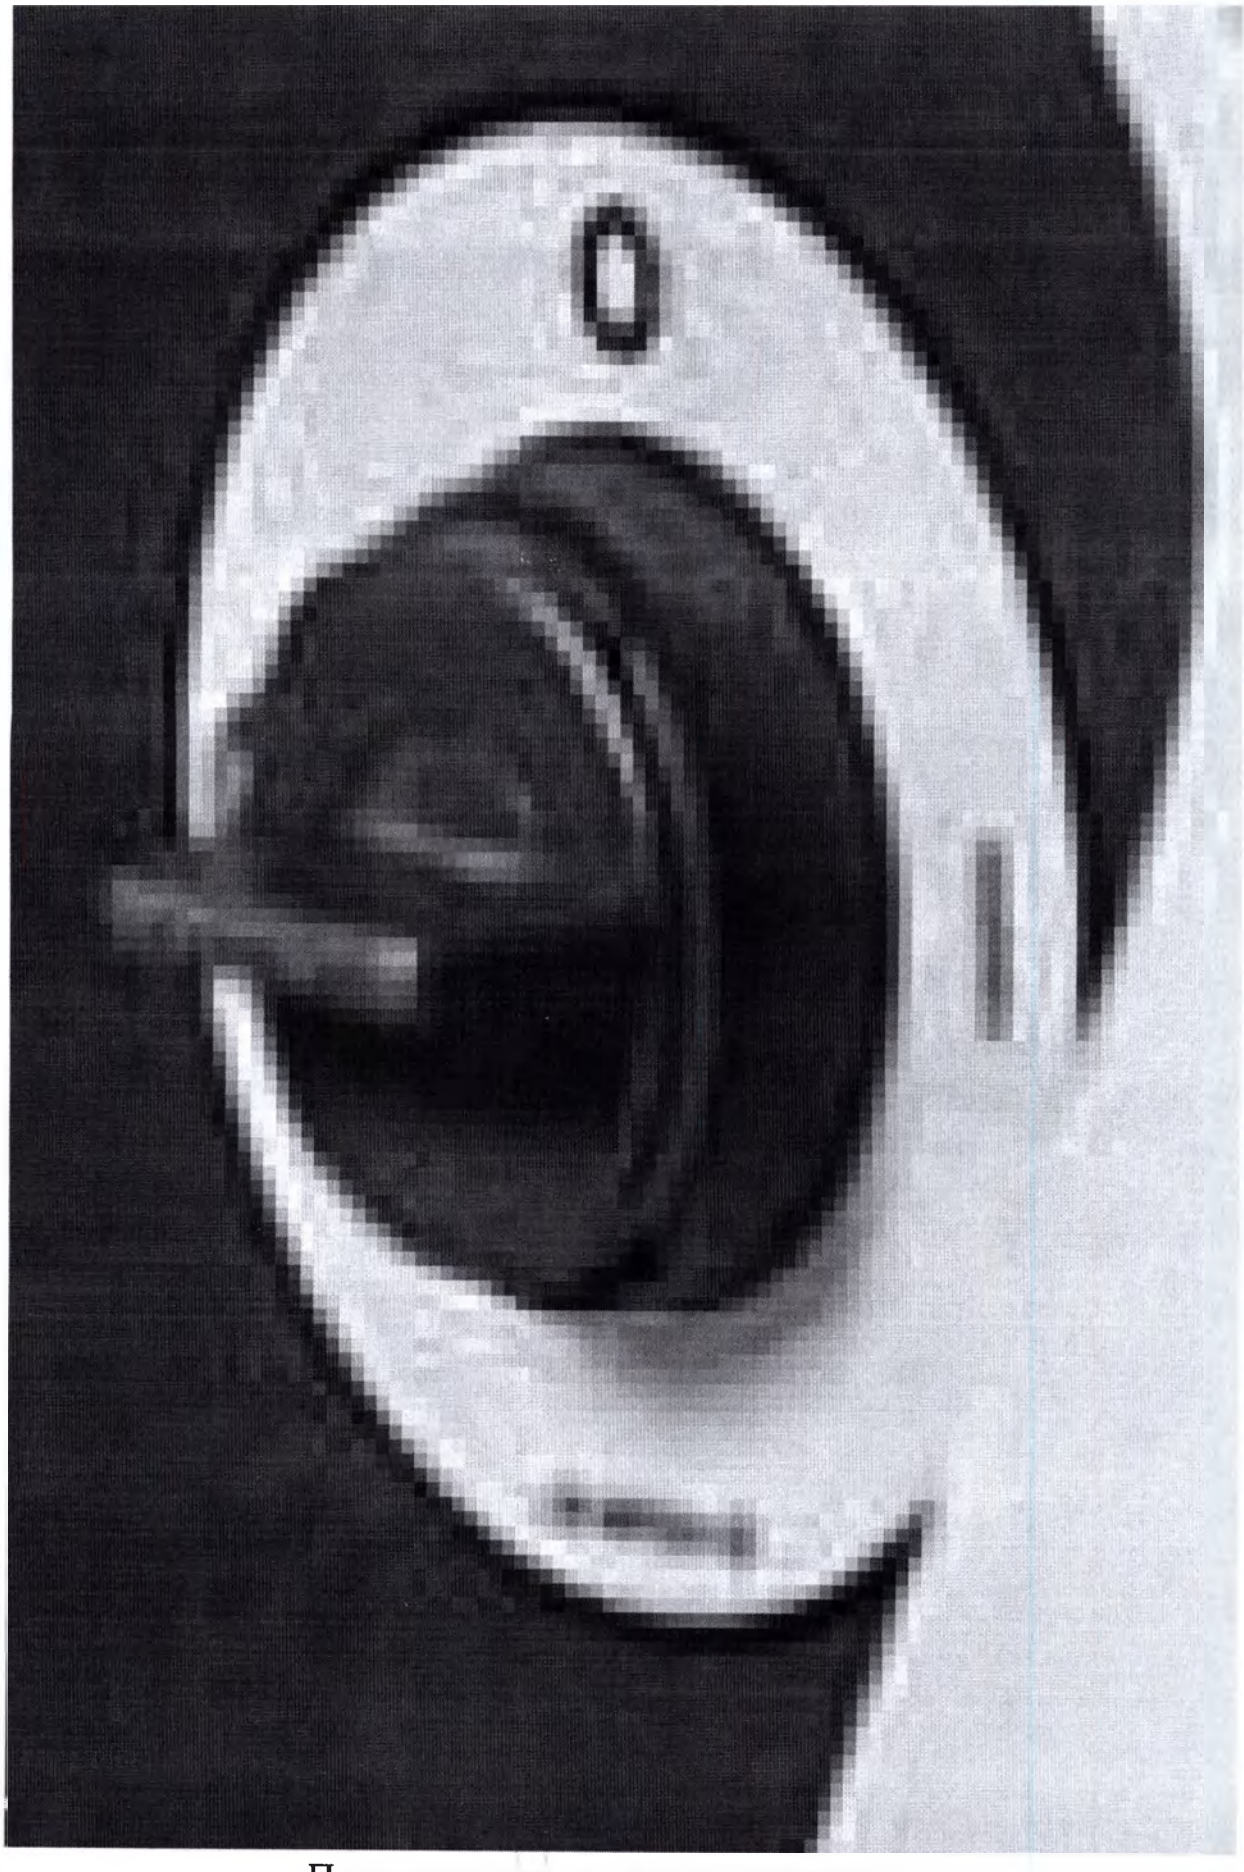

Переключатель для запуска системы.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Система медицинская для криотерапии Visual-ICE:

- Распределительная панель для подачи газов в иглы
- Монитор жидкокристаллический.
- Переключатель для запуска системы.
- Кабель питания
- Руководство пользователя.
- Руководство справочное краткое

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

Напряжение: 100 В – 240 В
Частота 50 Гц – 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность - 250 ВА
Предохранитель: T 3.15A

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

IP1

CE

- **Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;**
- **Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;**
- **Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;**
- **Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

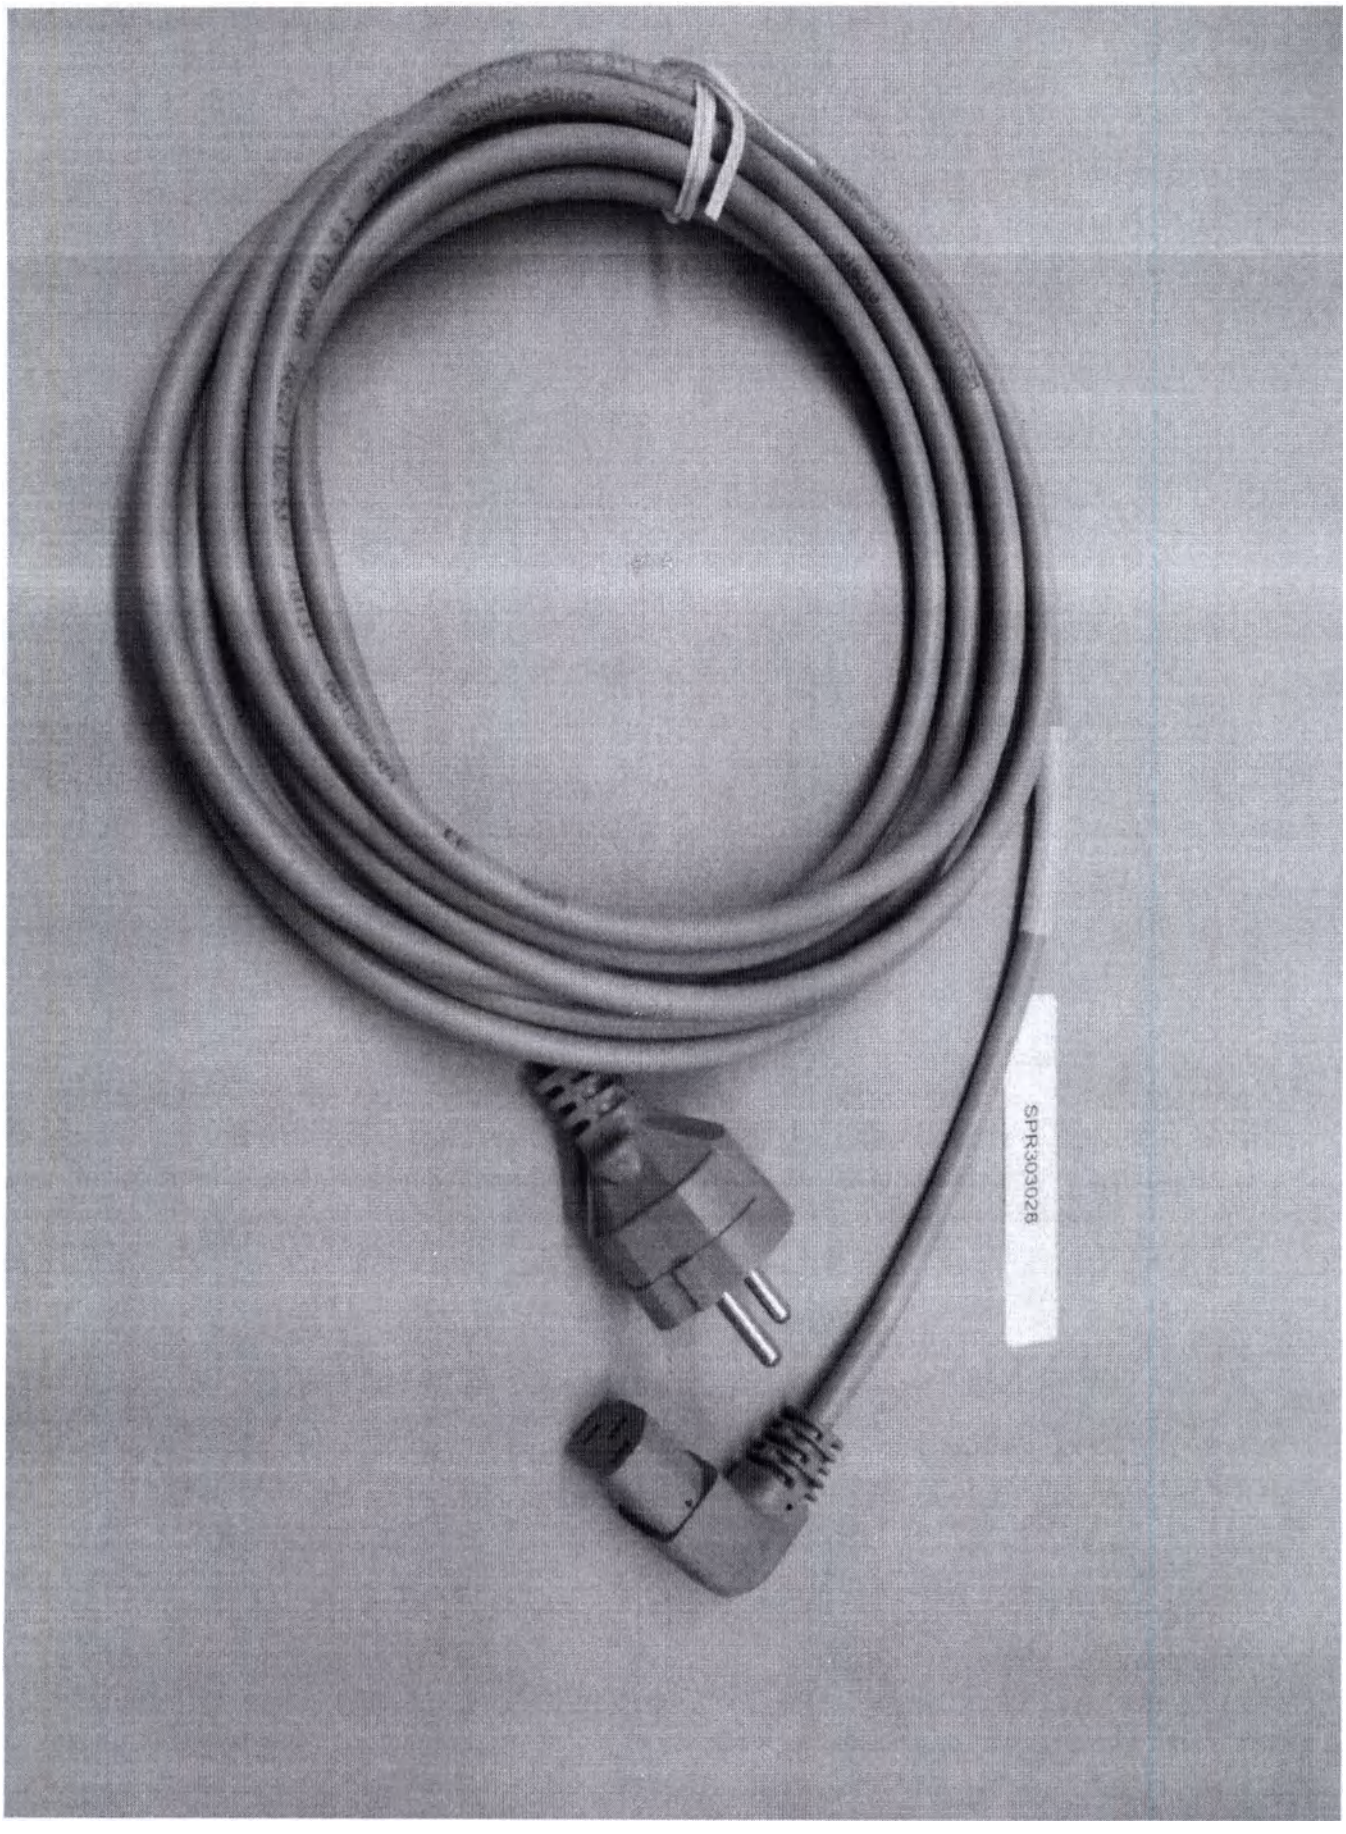

Кабель питания

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Система медицинская для криотерапии Visual-ICE:

- Распределительная панель для подачи газов в иглы
- Монитор жидкокристаллический.
- Переключатель для запуска системы.
- Кабель питания
- Руководство пользователя.
- Руководство справочное краткое

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

Напряжение: 100 В – 240 В
Частота 50 Гц – 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность - 250 ВА
Предохранитель: T 3.15A

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

IP1

CE

- **Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;**
- **Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;**
- **Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;**
- **Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

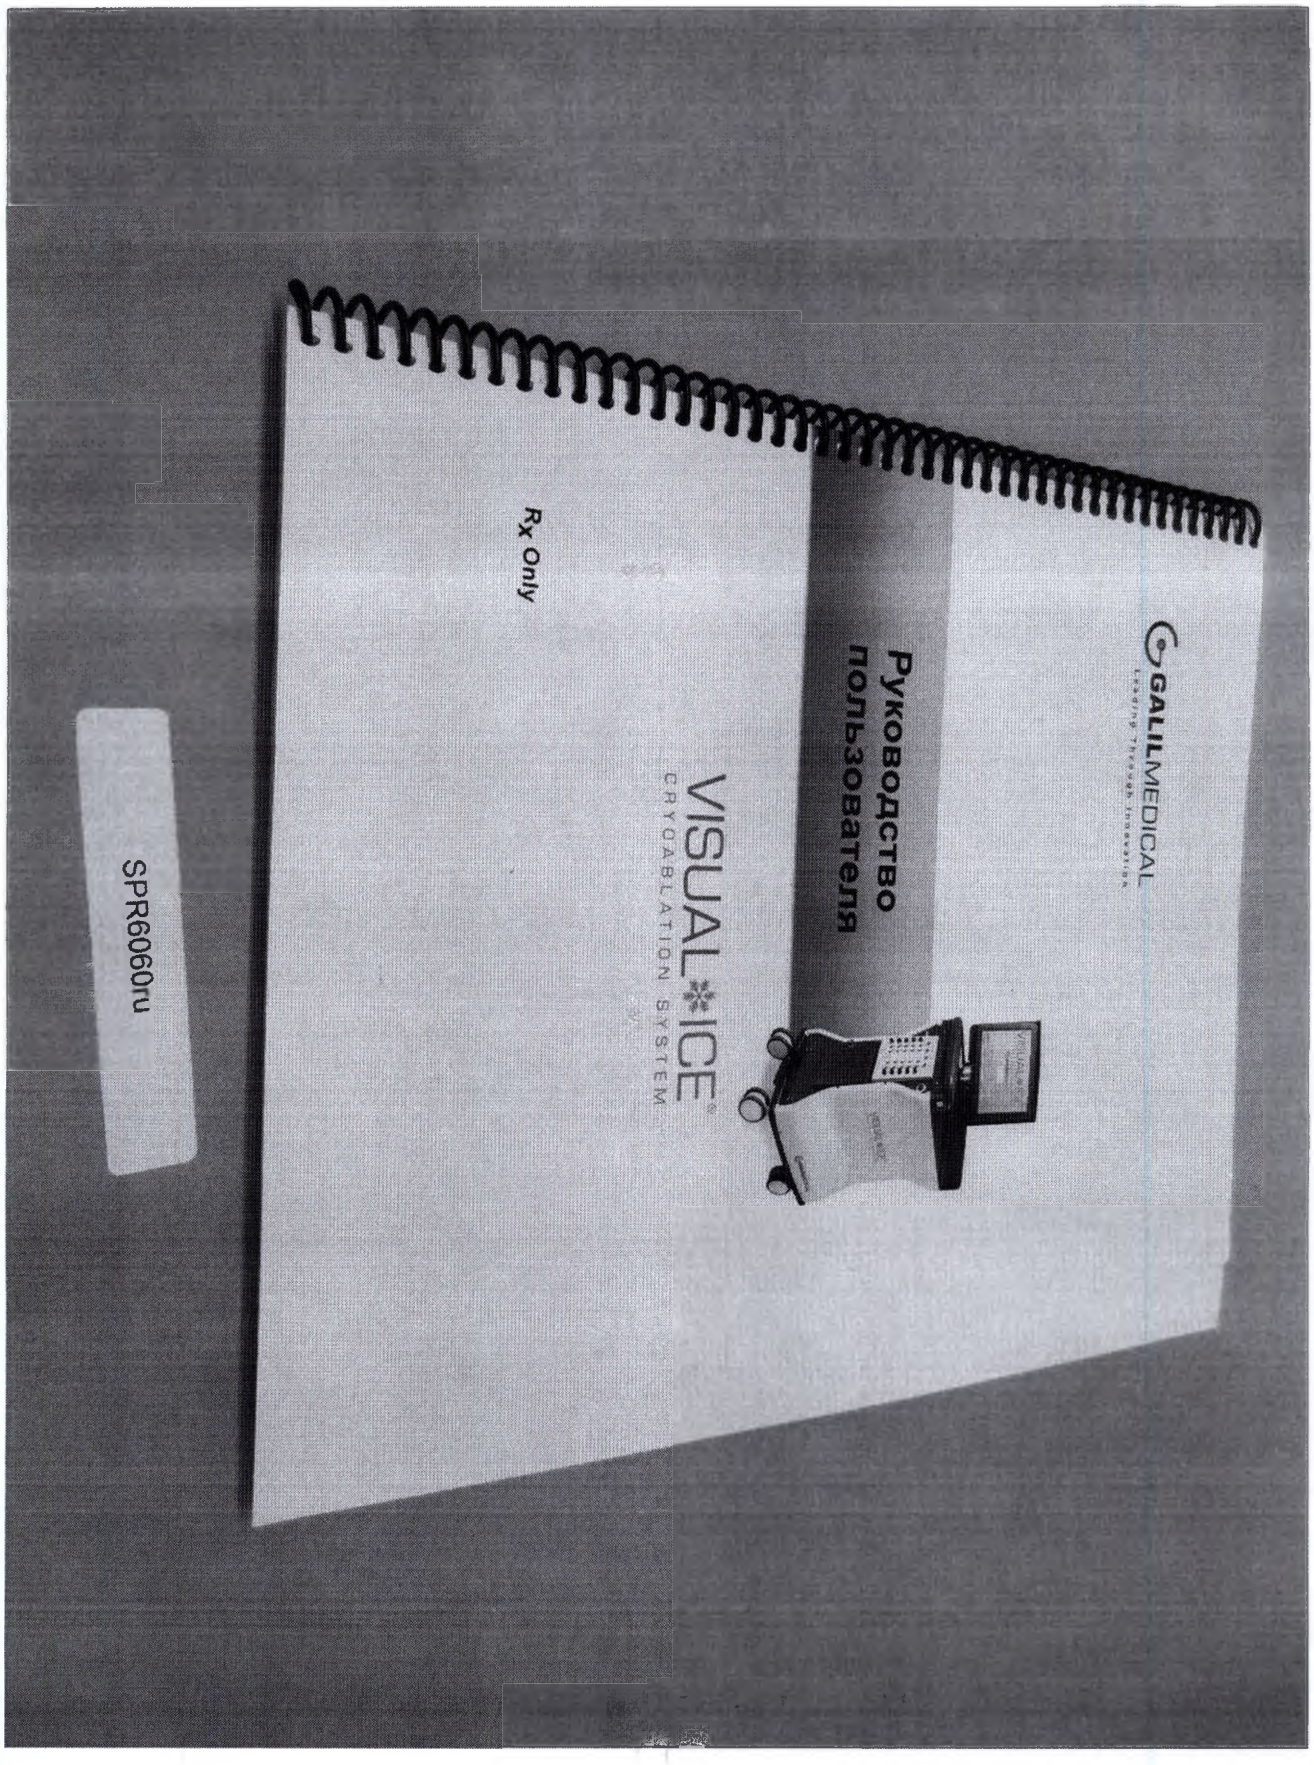

Руководство пользователя.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Система медицинская для криотерапии Visual-ICE:

- Распределительная панель для подачи газов в иглы
- Монитор жидкокристаллический.
- Переключатель для запуска системы.
- Кабель питания
- Руководство пользователя.
- Руководство справочное краткое

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

Напряжение: 100 В – 240 В
Частота 50 Гц – 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность - 250 ВА
Предохранитель: T 3.15A

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

IP1

CE

- **Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;**
- **Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;**
- **Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;**
- **Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

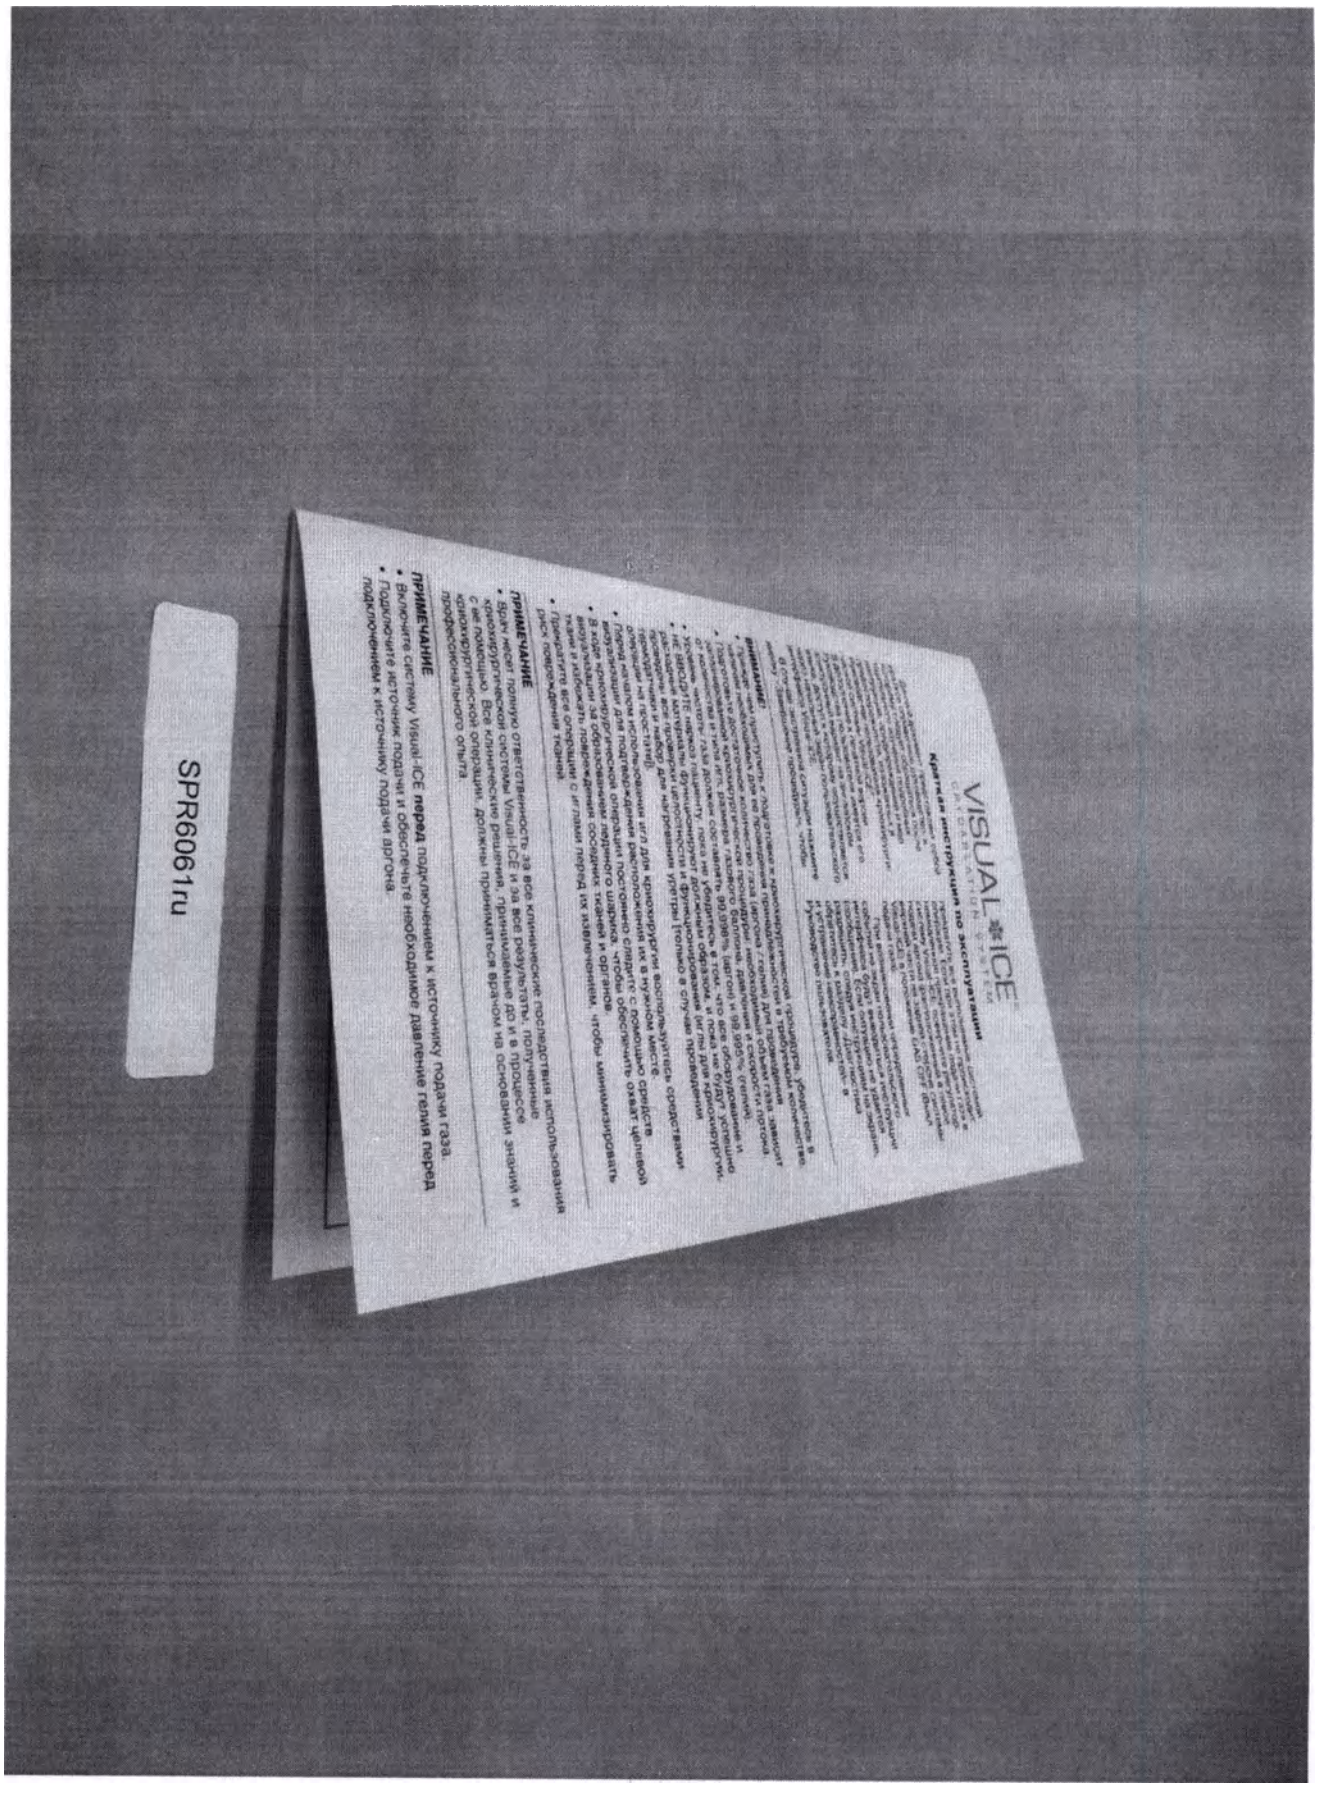

Руководство справочное краткое

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Система медицинская для криотерапии Visual-ICE:

- Распределительная панель для подачи газов в иглы
- Монитор жидкокристаллический.
- Переключатель для запуска системы.
- Кабель питания
- Руководство пользователя.
- Руководство справочное краткое

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

Напряжение: 100 В – 240 В
Частота 50 Гц – 60 Гц
Максимальная потребляемая мощность - 250 ВА
Предохранитель: T 3.15A

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

IP1

CE

- **Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;**
- **Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;**
- **Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;**
- **Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

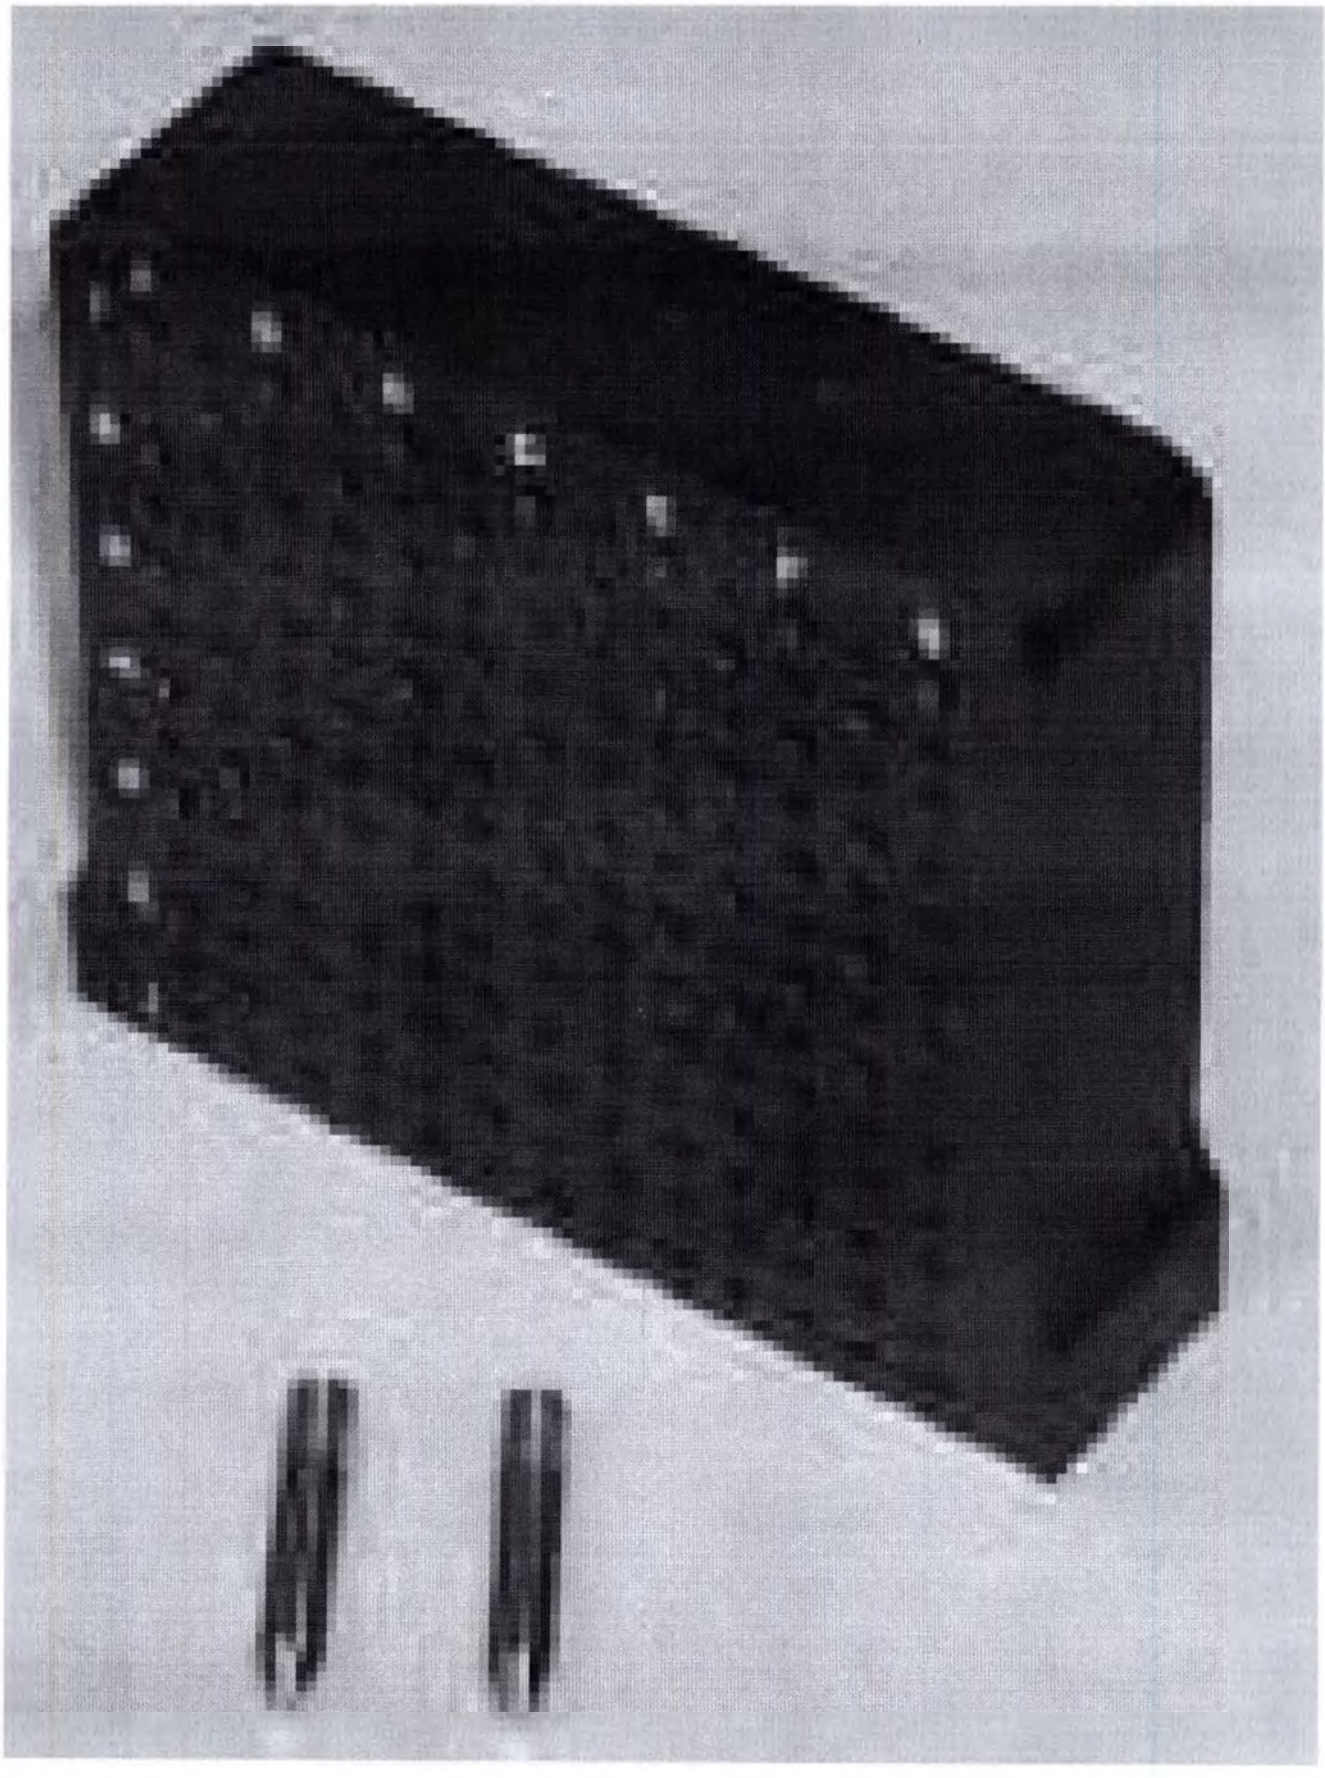

Шаблон для введения игл

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Шаблон для введения игл

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

CE

- Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;
- Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;
- Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;
- Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

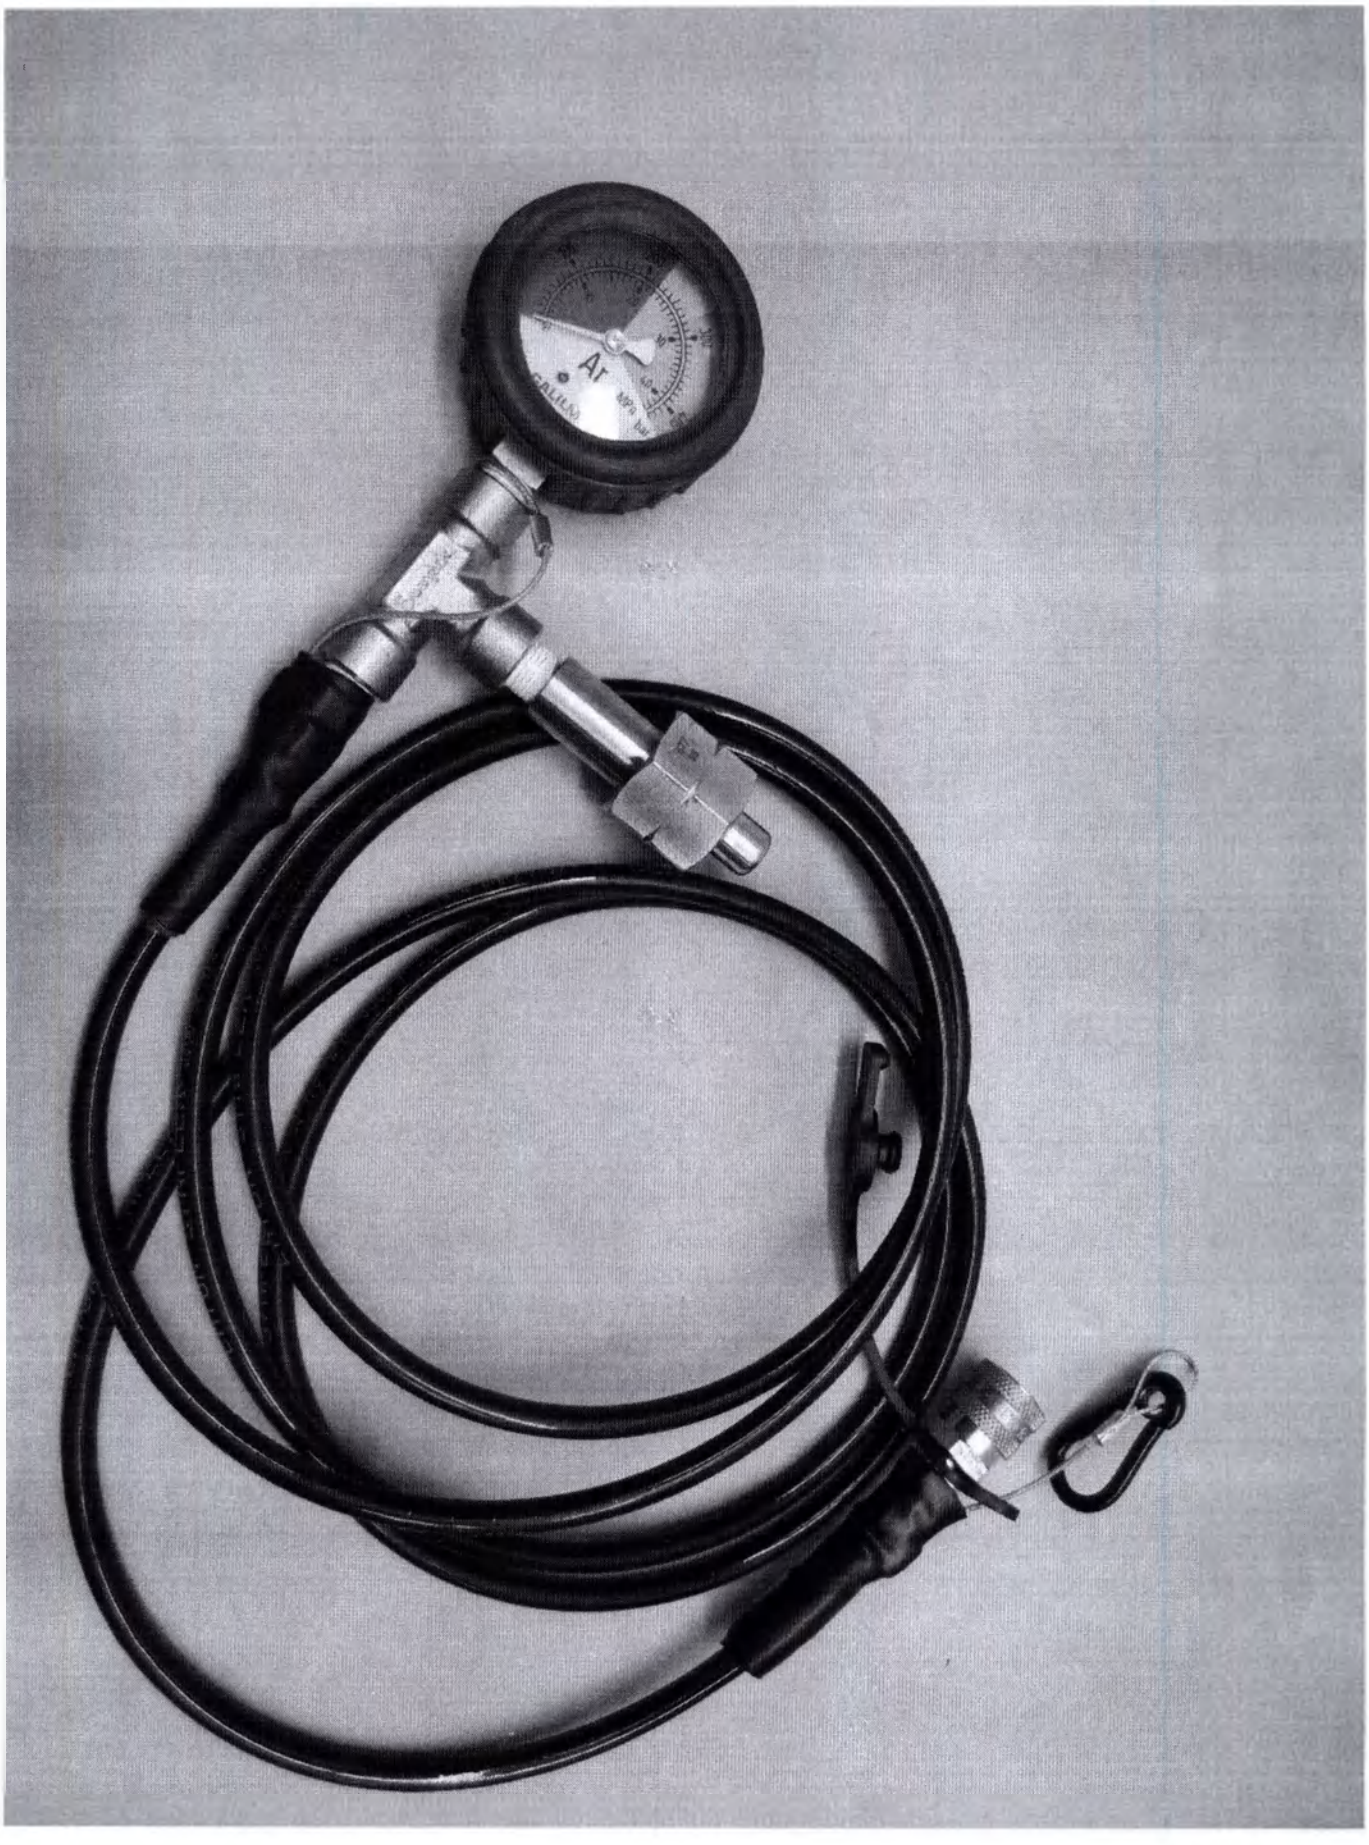

Трубка подачи аргона высокого давления с установленным манометром

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Трубка подачи аргона высокого давления с установленным манометром

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

CE

- Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;
- Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;
- Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;
- Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

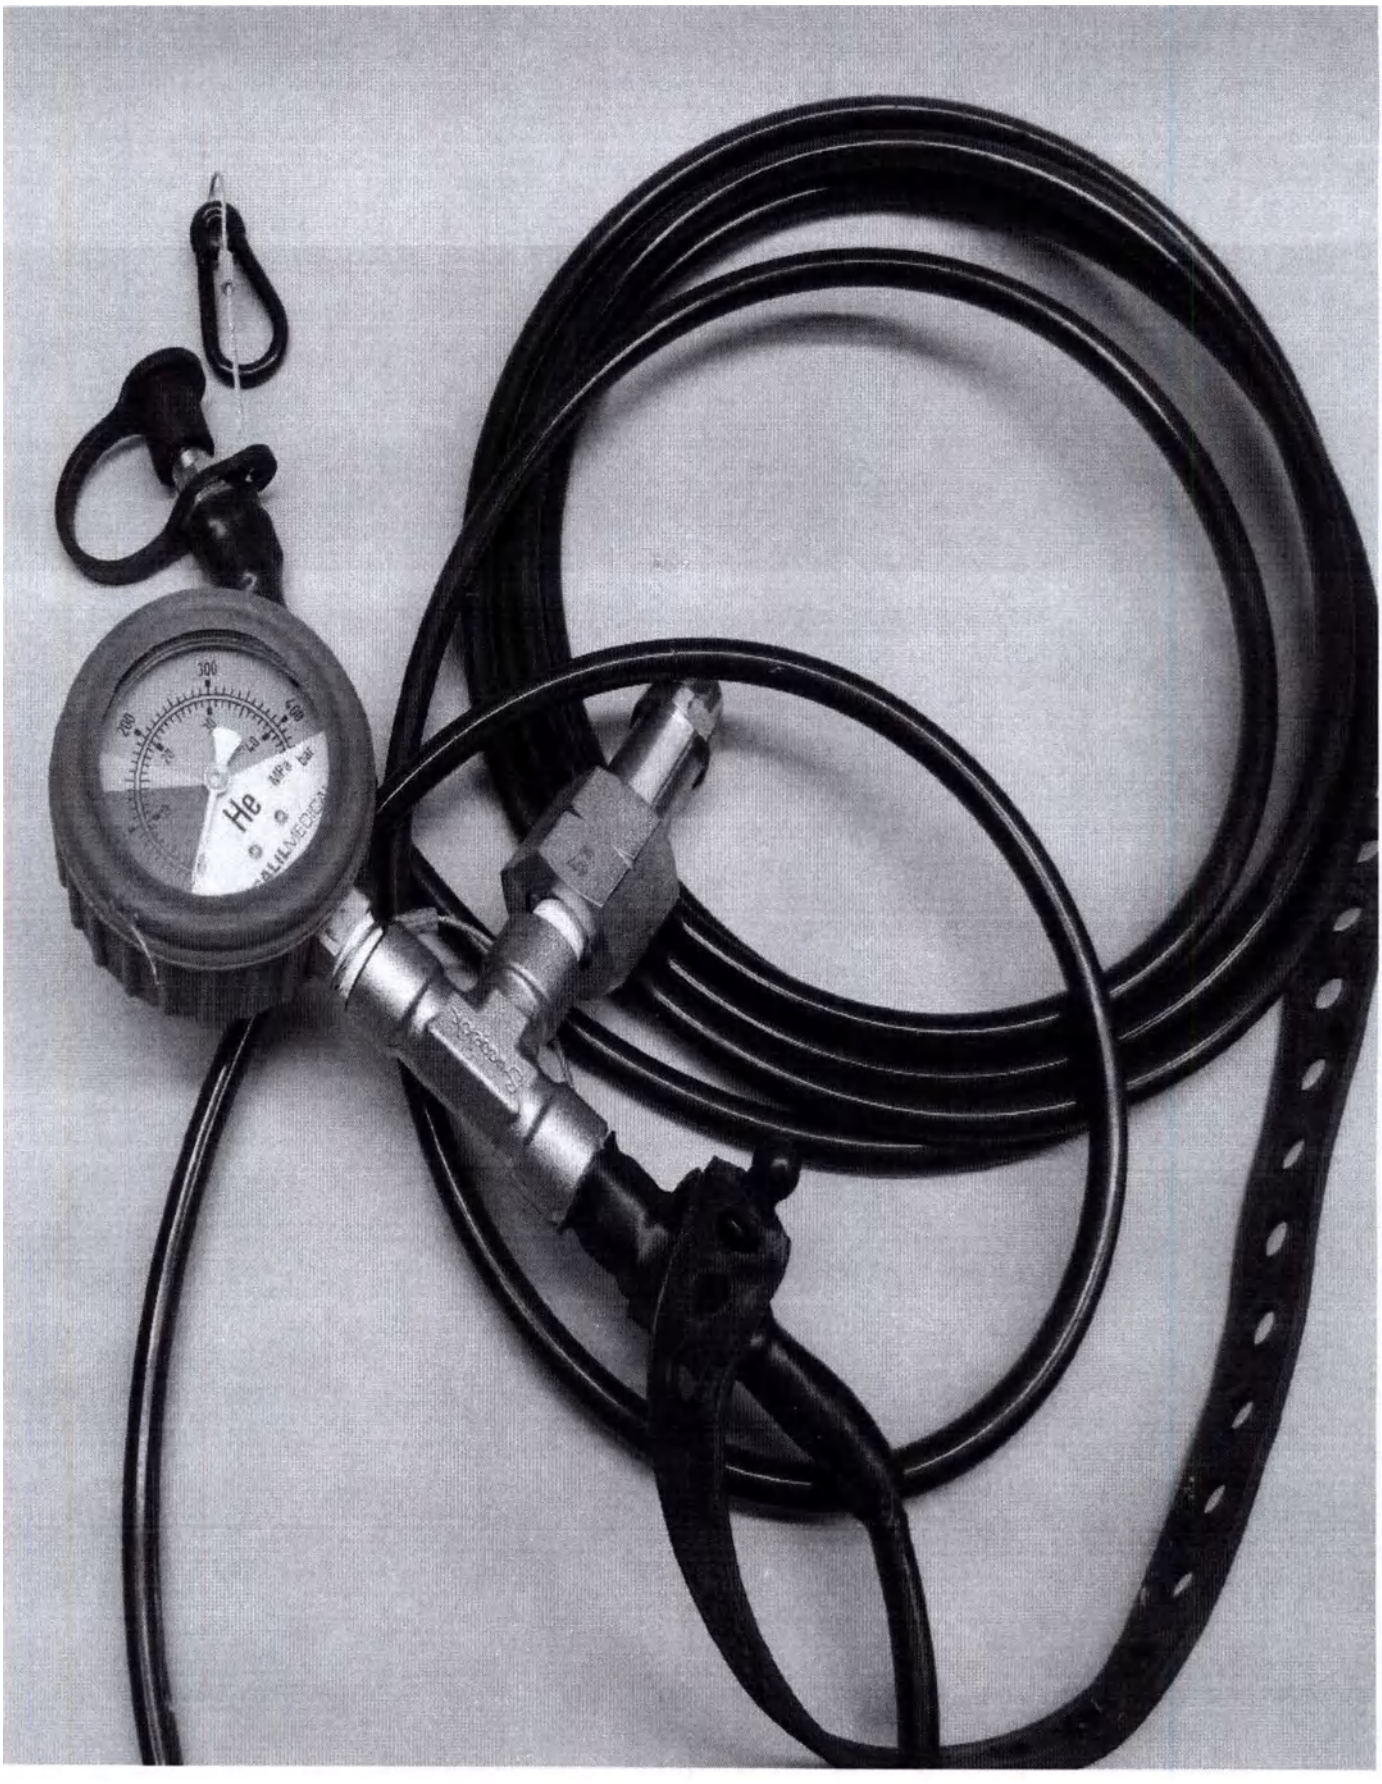

Трубка подачи гелия высокого давления с установленным манометром

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Трубка подачи гелия высокого давления с установленным манометром.

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

- Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;
- Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;
- Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;
- Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вспомогательная трубка подачи газа

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Вспомогательная трубка подачи газа.

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

CE

- Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;
- Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;
- Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;
- Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

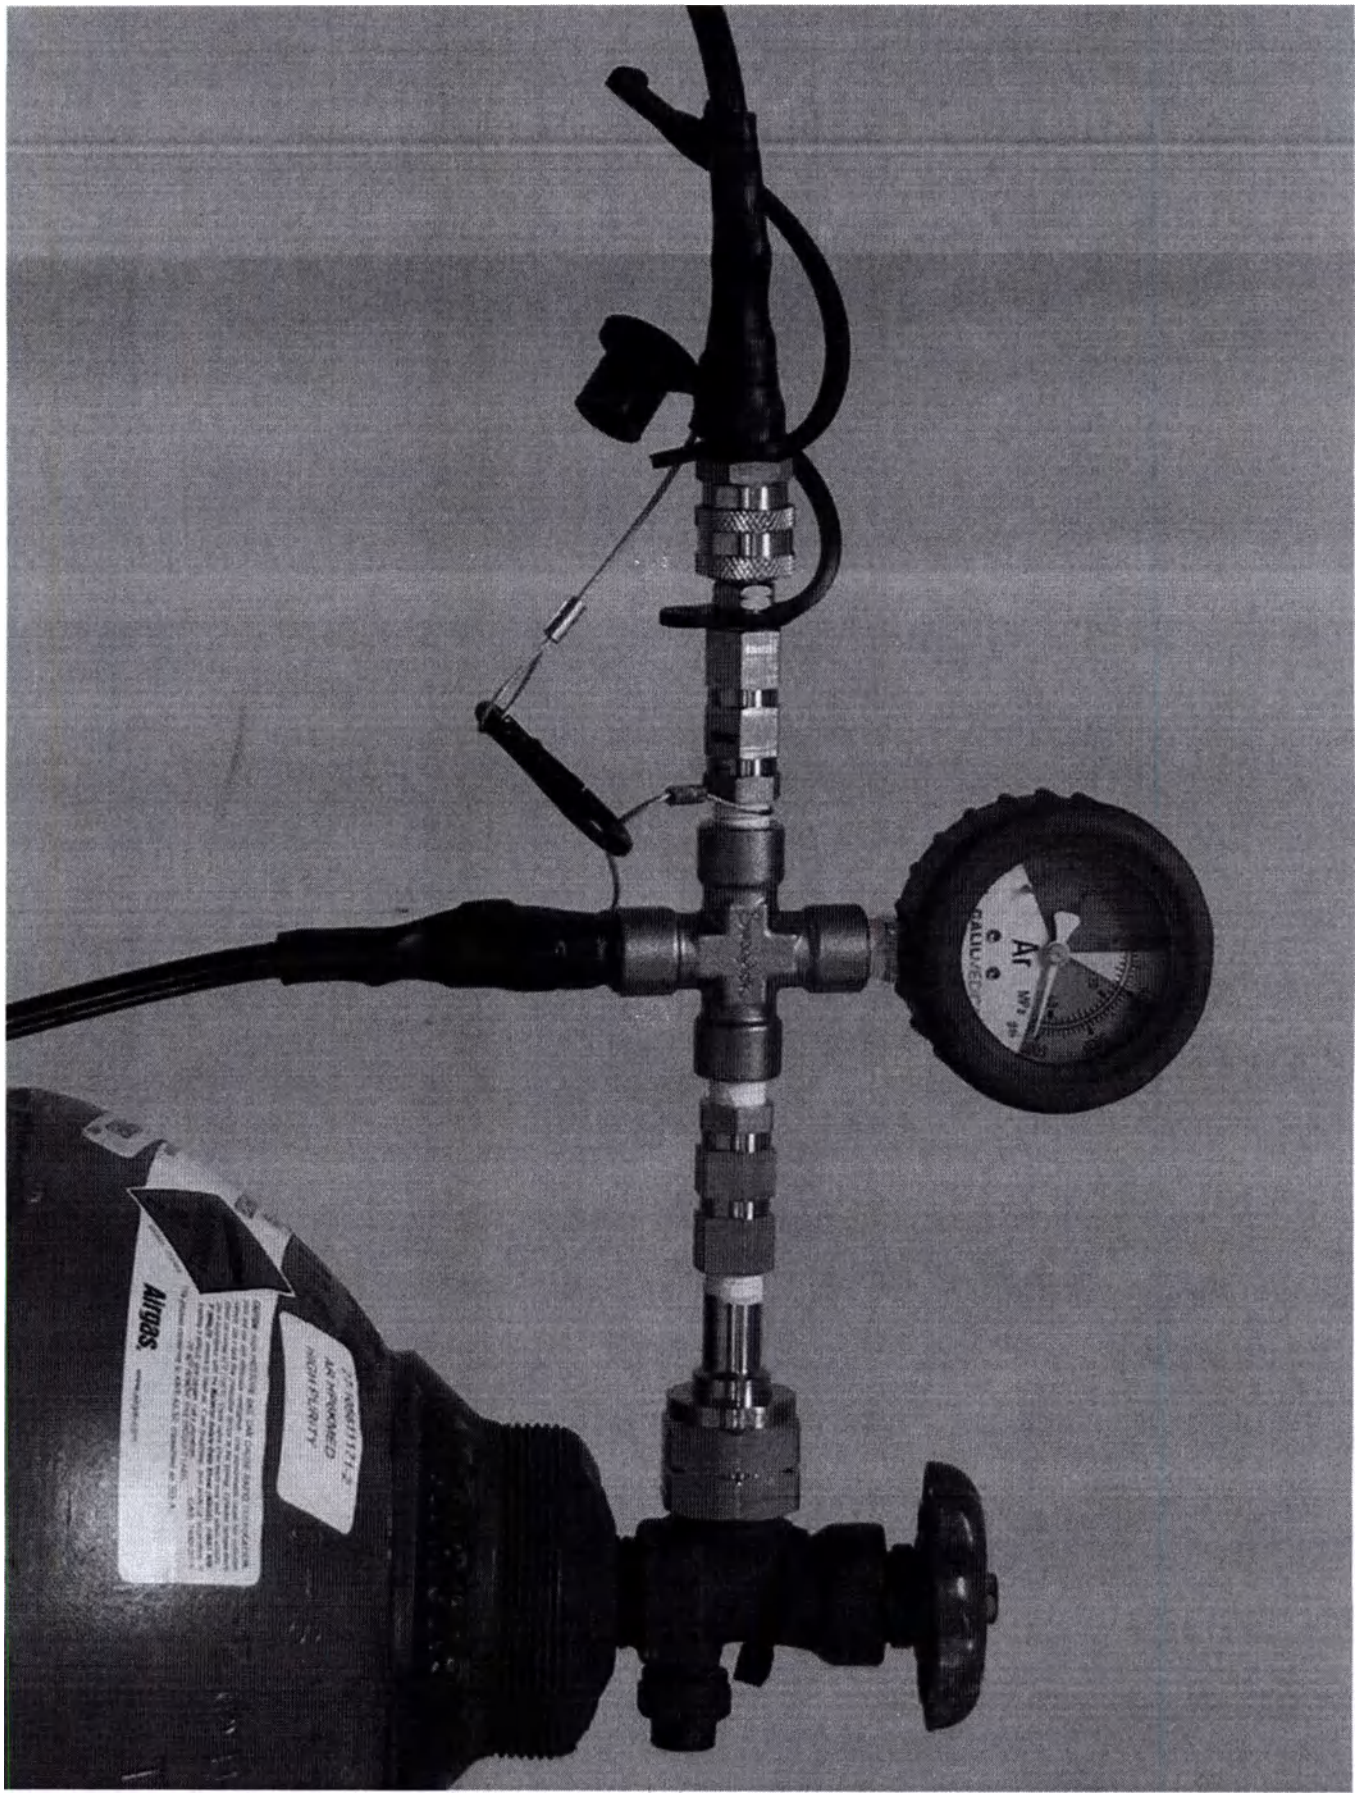

Адаптер четырехсторонний с измерителем давления Аргона

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL
Leading Through Innovation

Адаптер EZ-Connect2

дополнительный двухбаллонный:

- Адаптер четырехсторонний с измерителем давления Аргона

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

CE

- **Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;**
- **Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;**
- **Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;**
- **Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

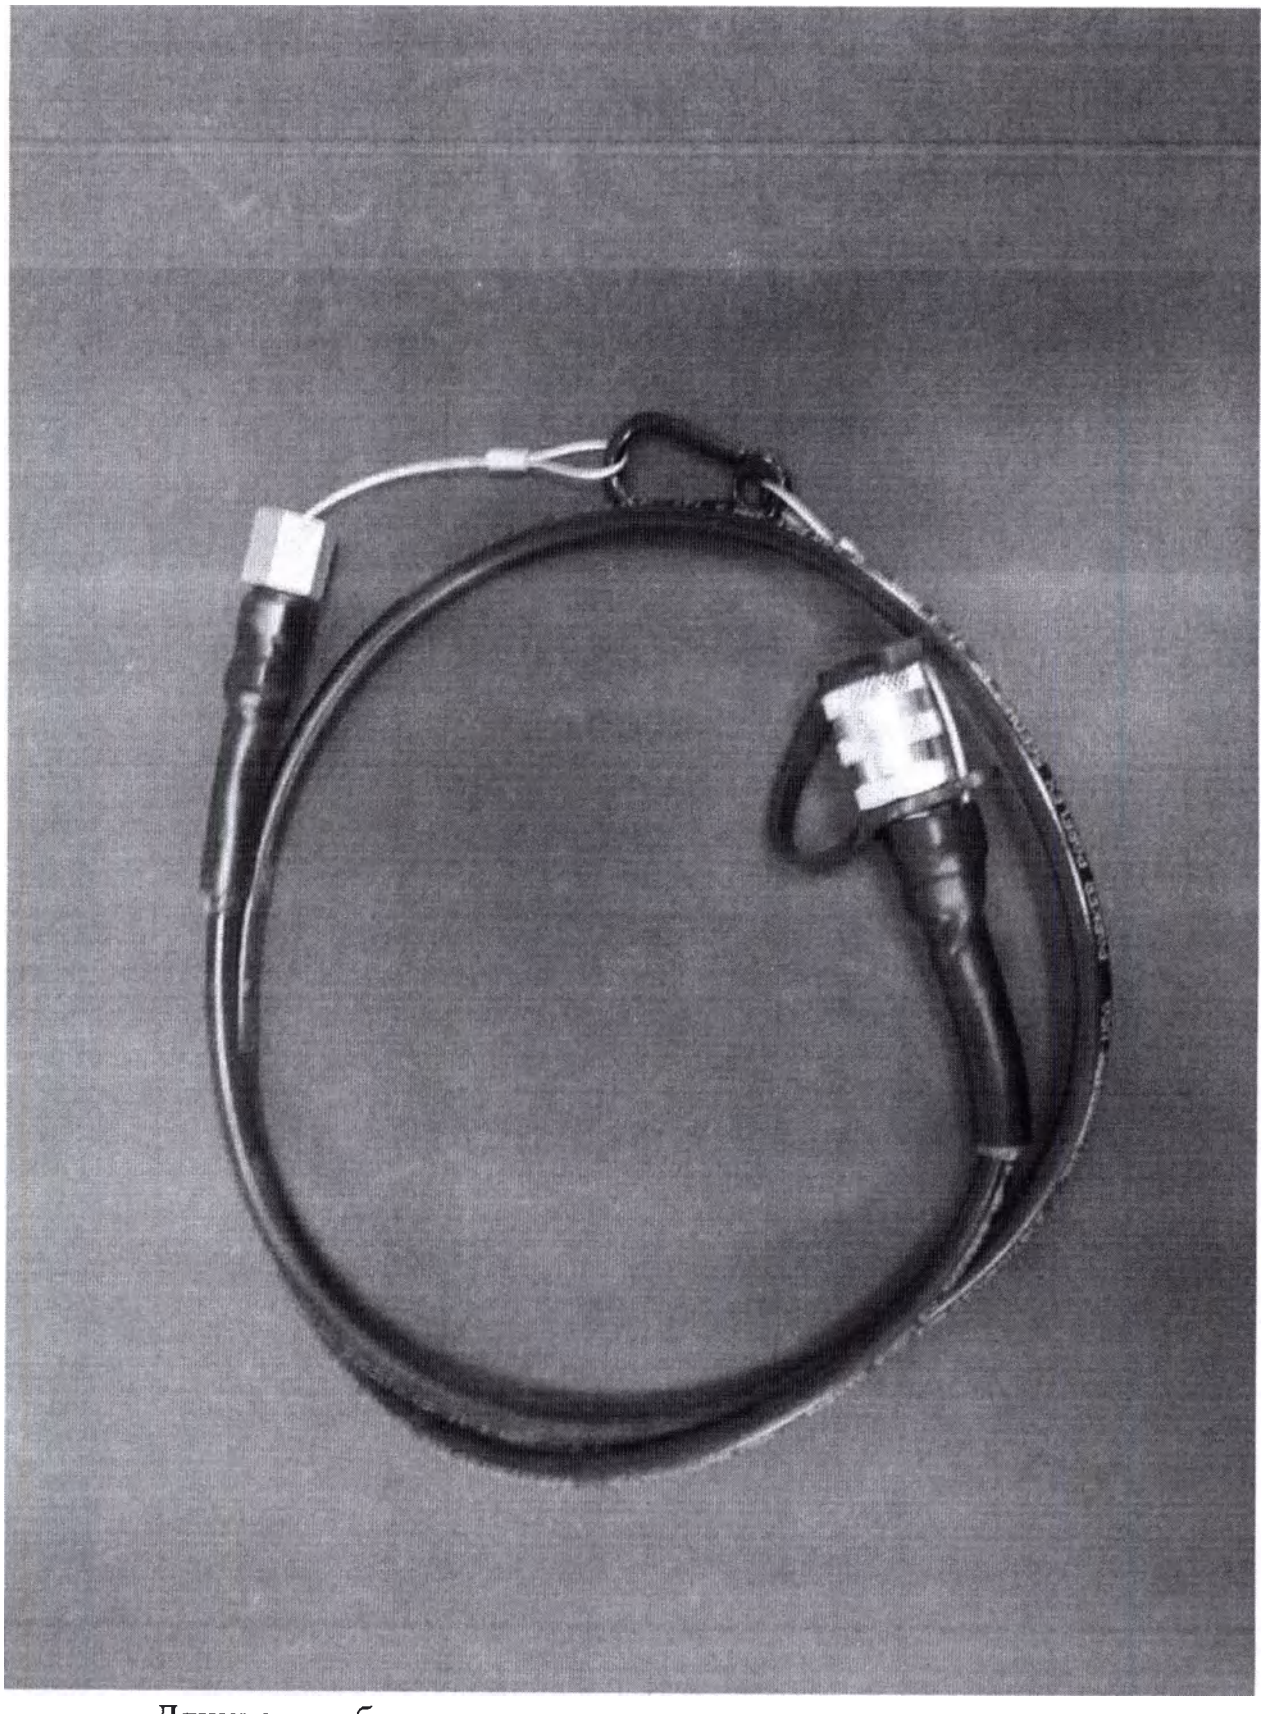

Длинная трубка для подачи газа с подключением к системе

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL
Leading Through Innovation

Адаптер EZ-Connect2

дополнительный двухбаллонный:

- Длинная трубка для подачи газа с подключением к системе

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757



CE

- **Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;**
- **Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;**
- **Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;**
- **Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

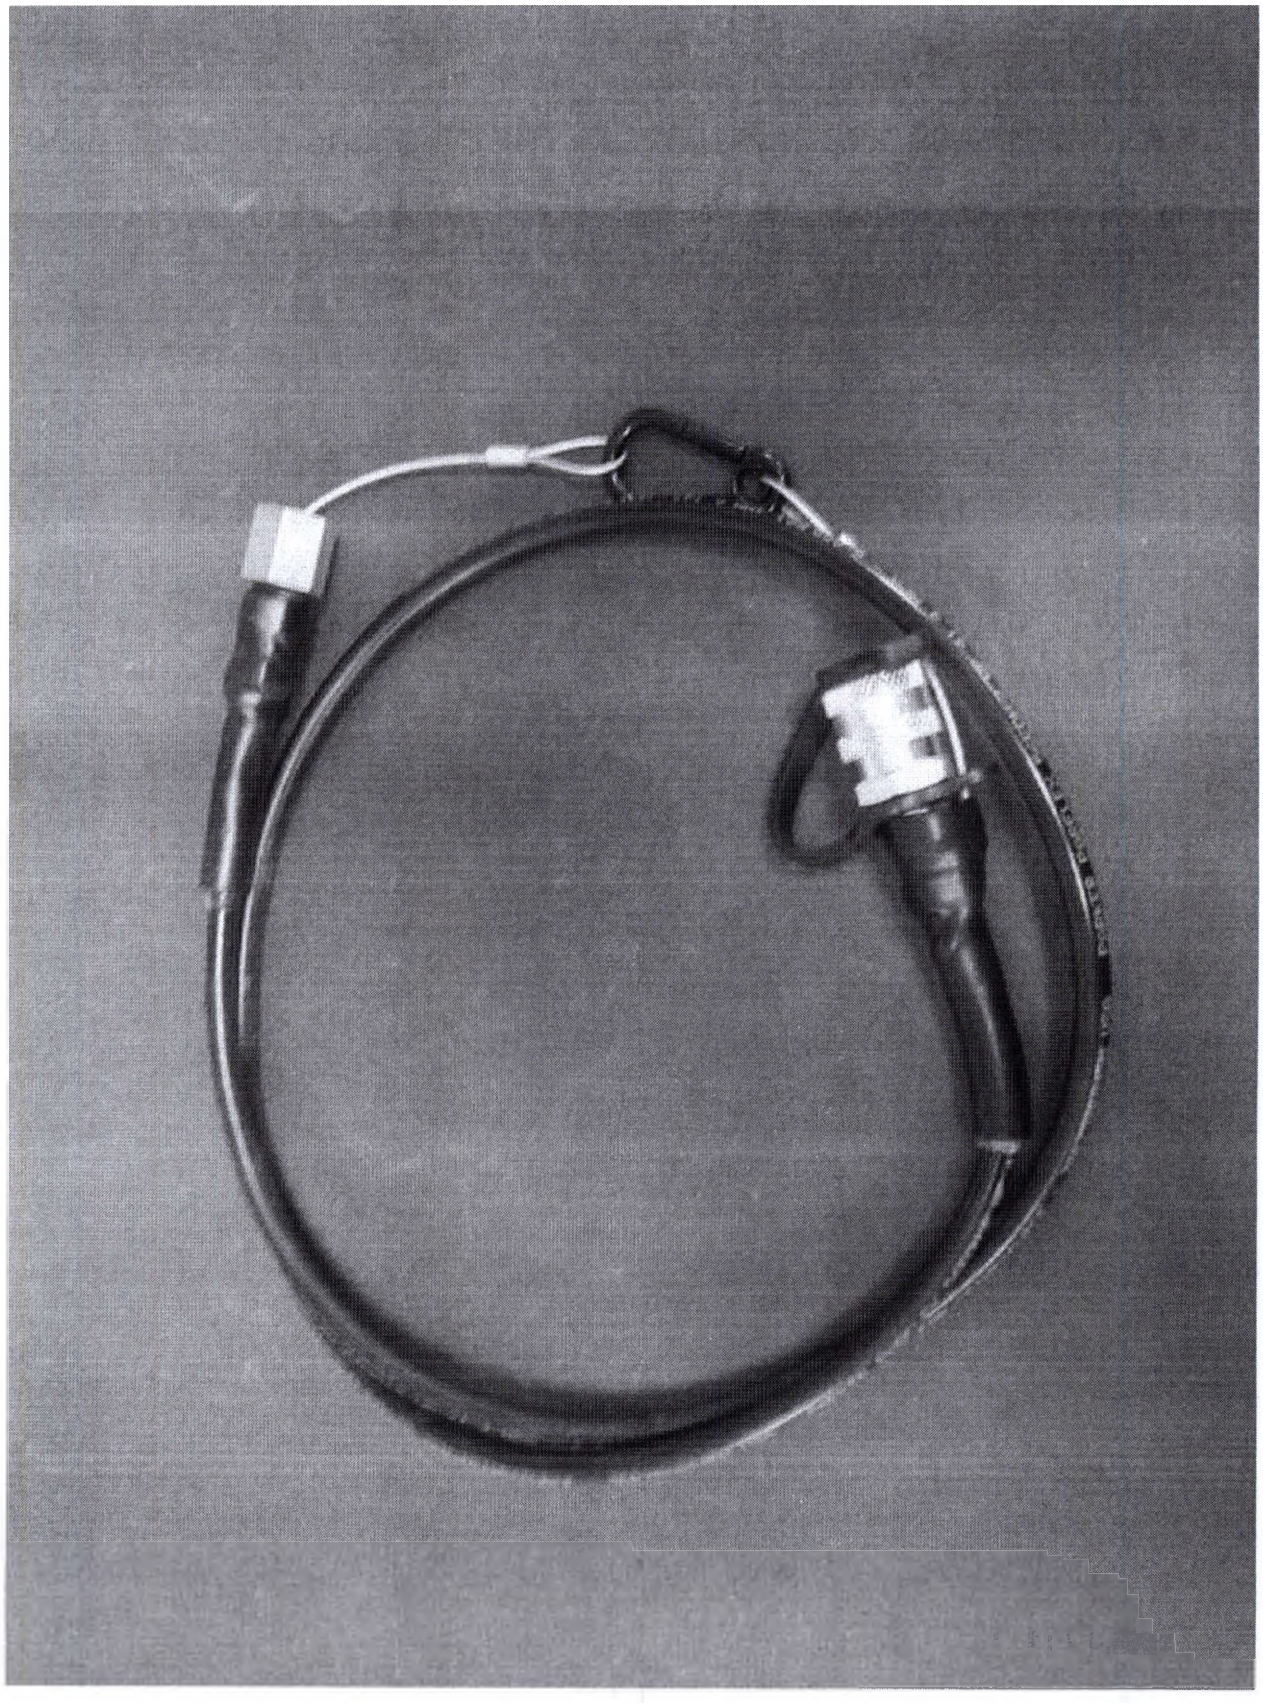

Короткая трубка для подачи газа с подключением к системе

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL
Leading Through Innovation

Адаптер EZ-Connect2

дополнительный двухбаллонный:

- Короткая трубка для подачи газа с подключением к системе

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

CE

- **Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;**
- **Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;**
- **Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;**
- **Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».**

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

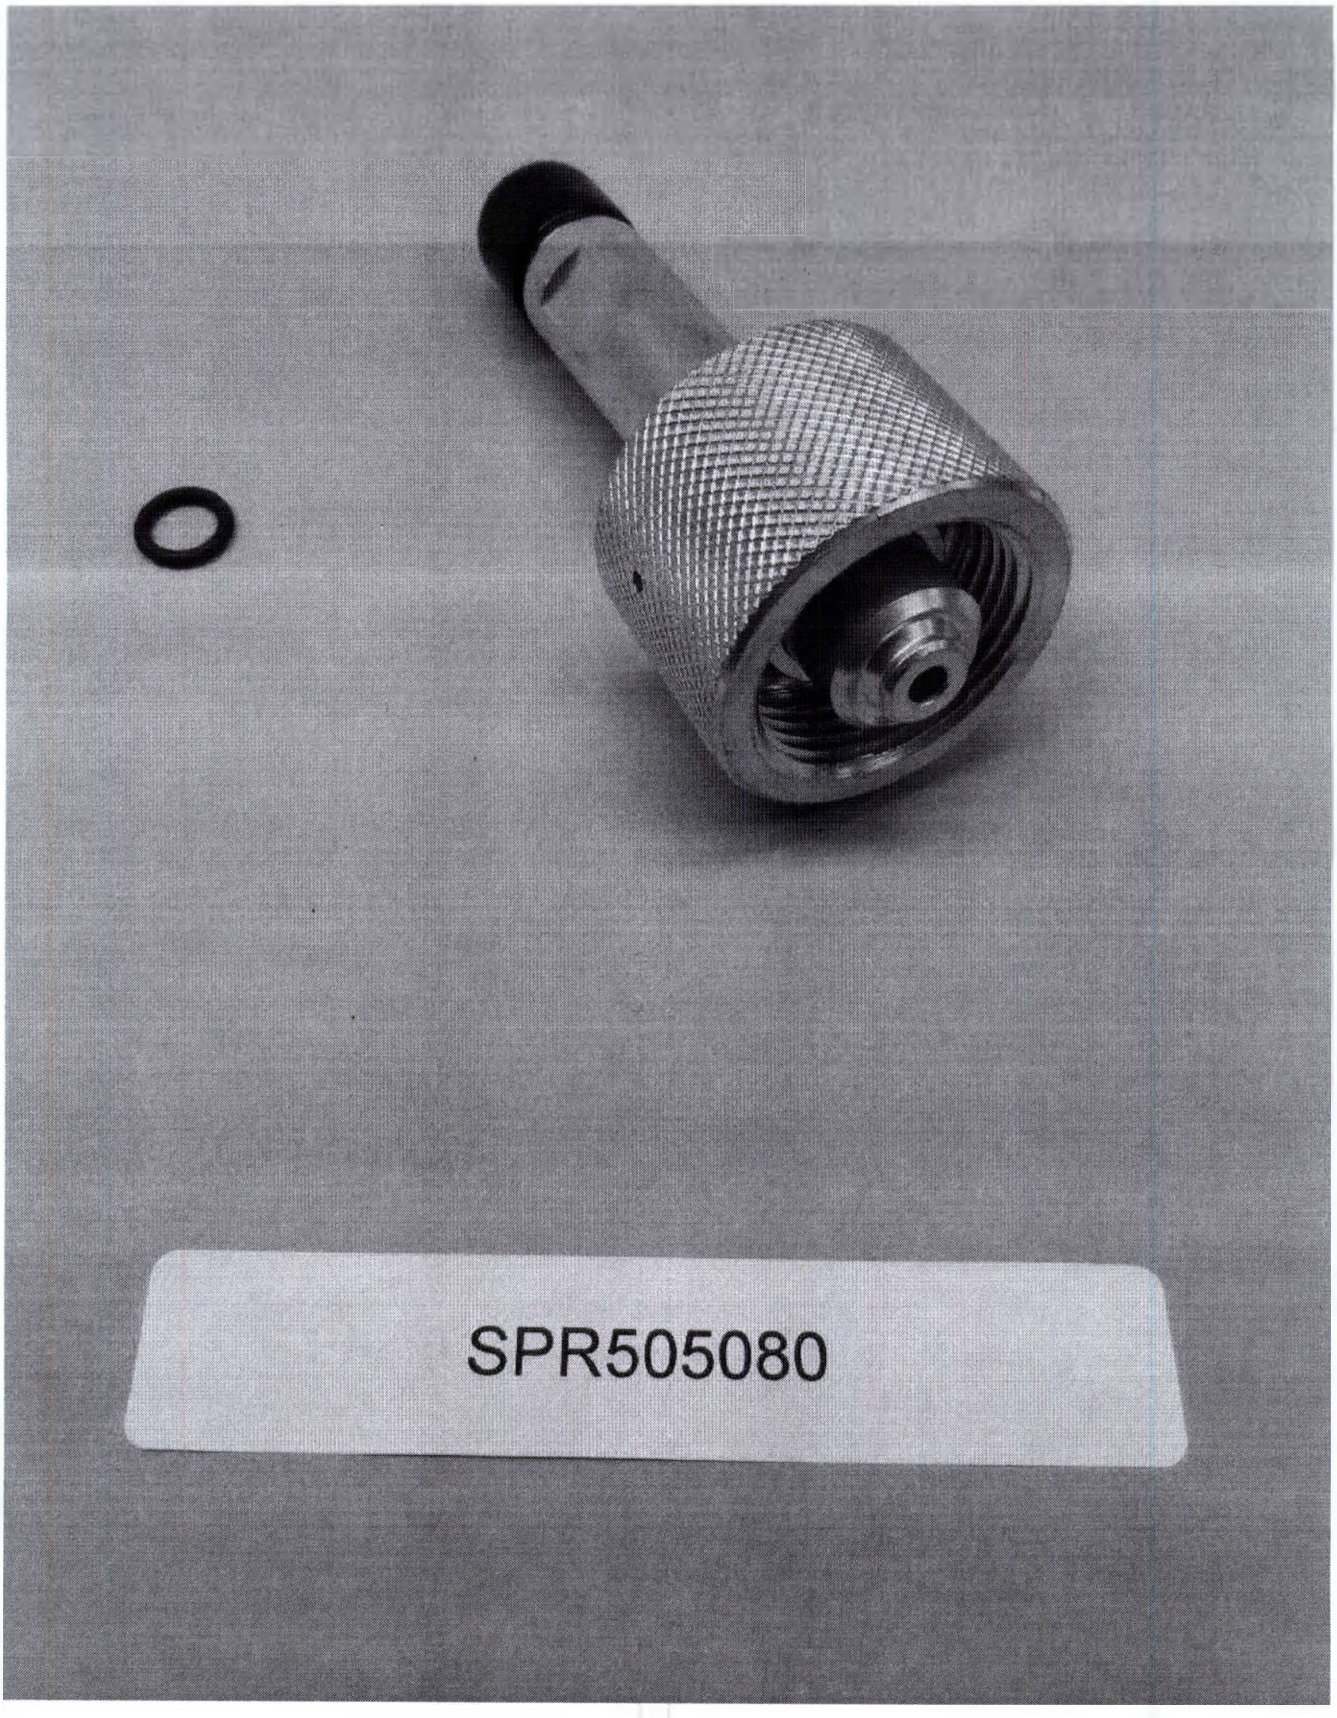

Адаптер для фиксации трубок к внешним баллонам

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Адаптер для фиксации трубок к внешним баллонам.

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

CE

- Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;
- Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;
- Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;
- Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

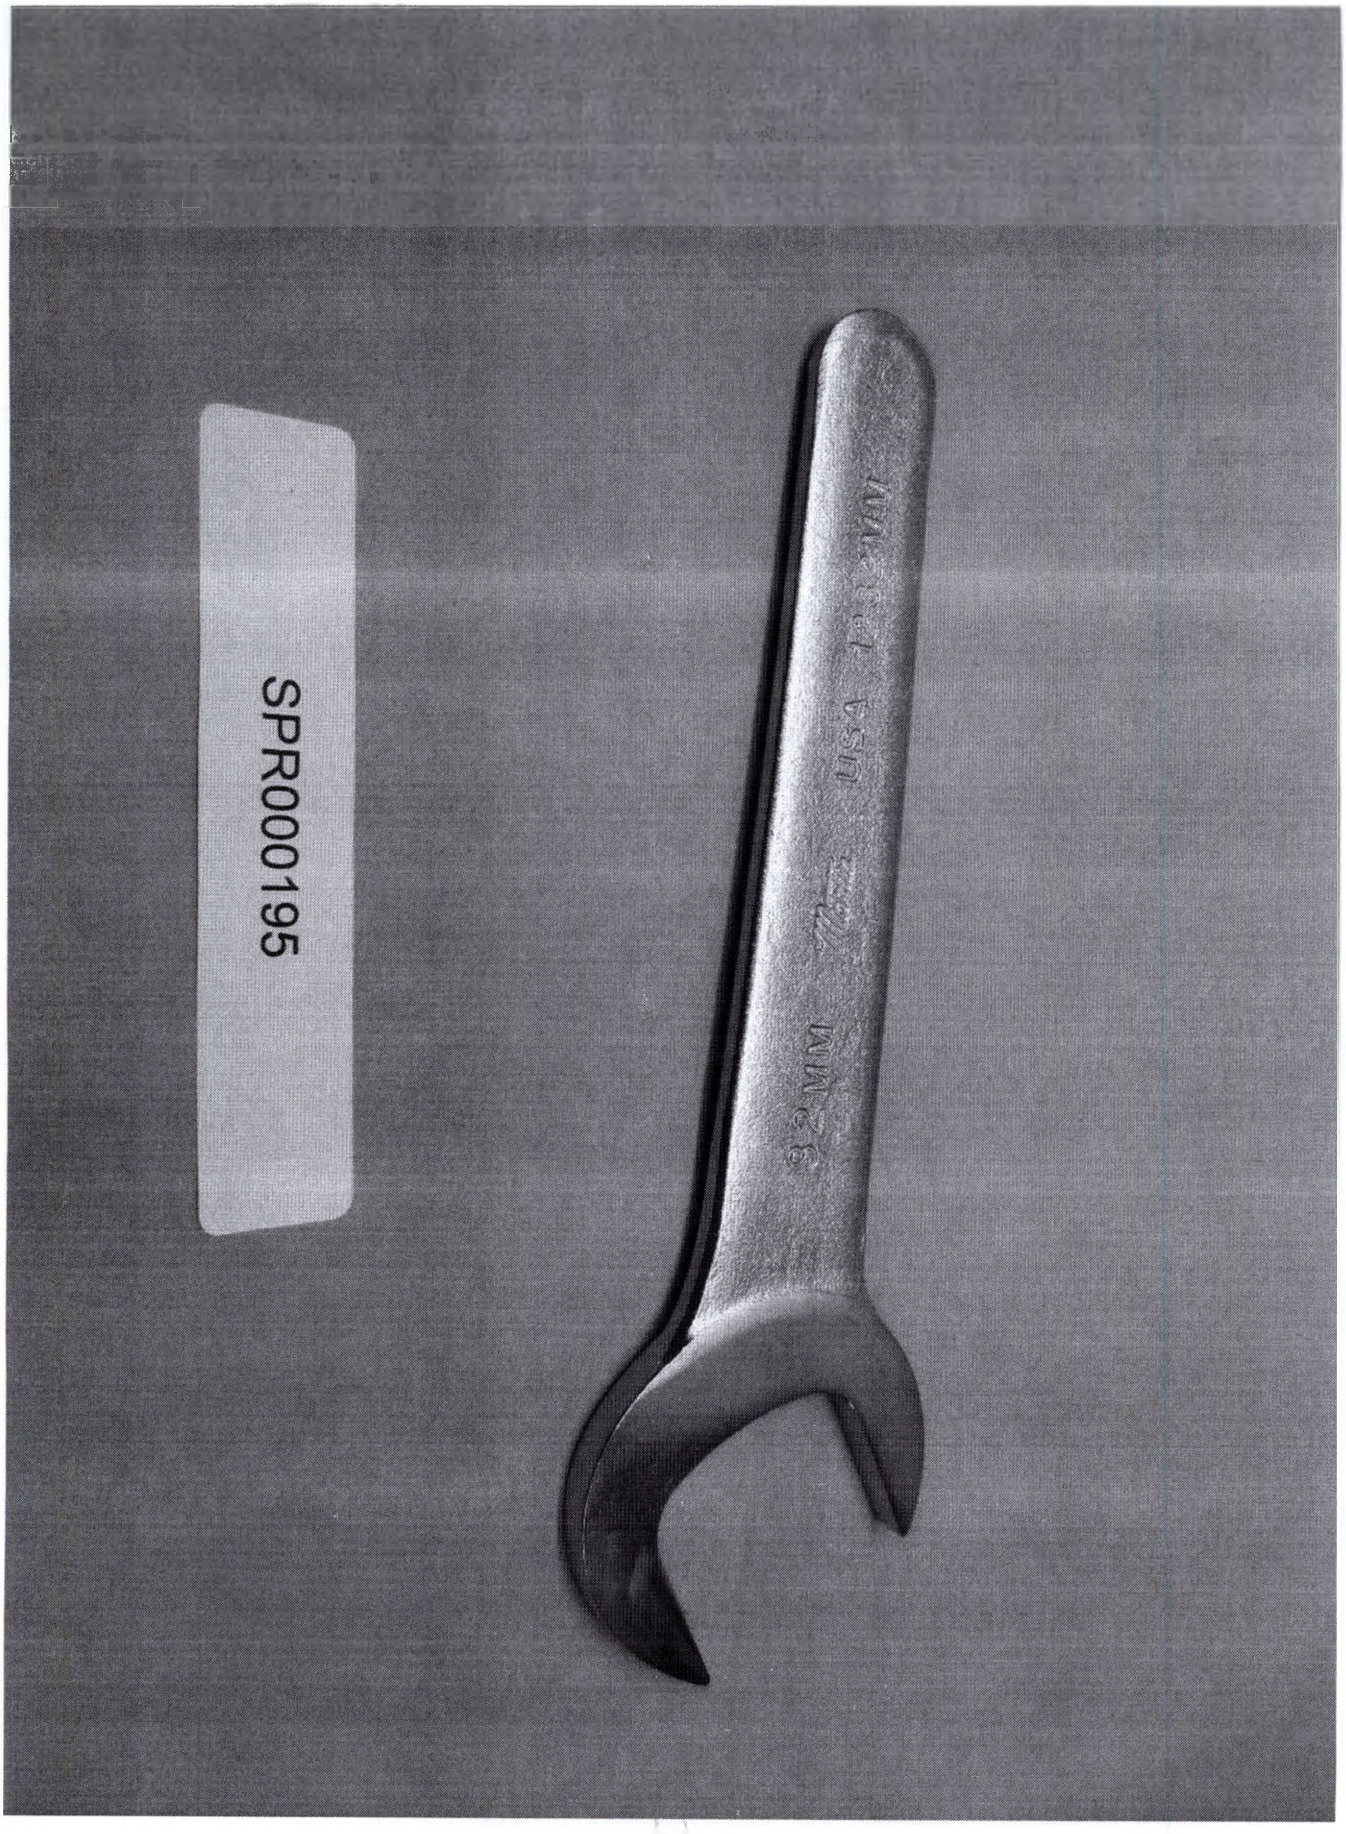

Гаечный ключ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Гаечный ключ.

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757



CE

- Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;
- Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;
- Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;
- Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

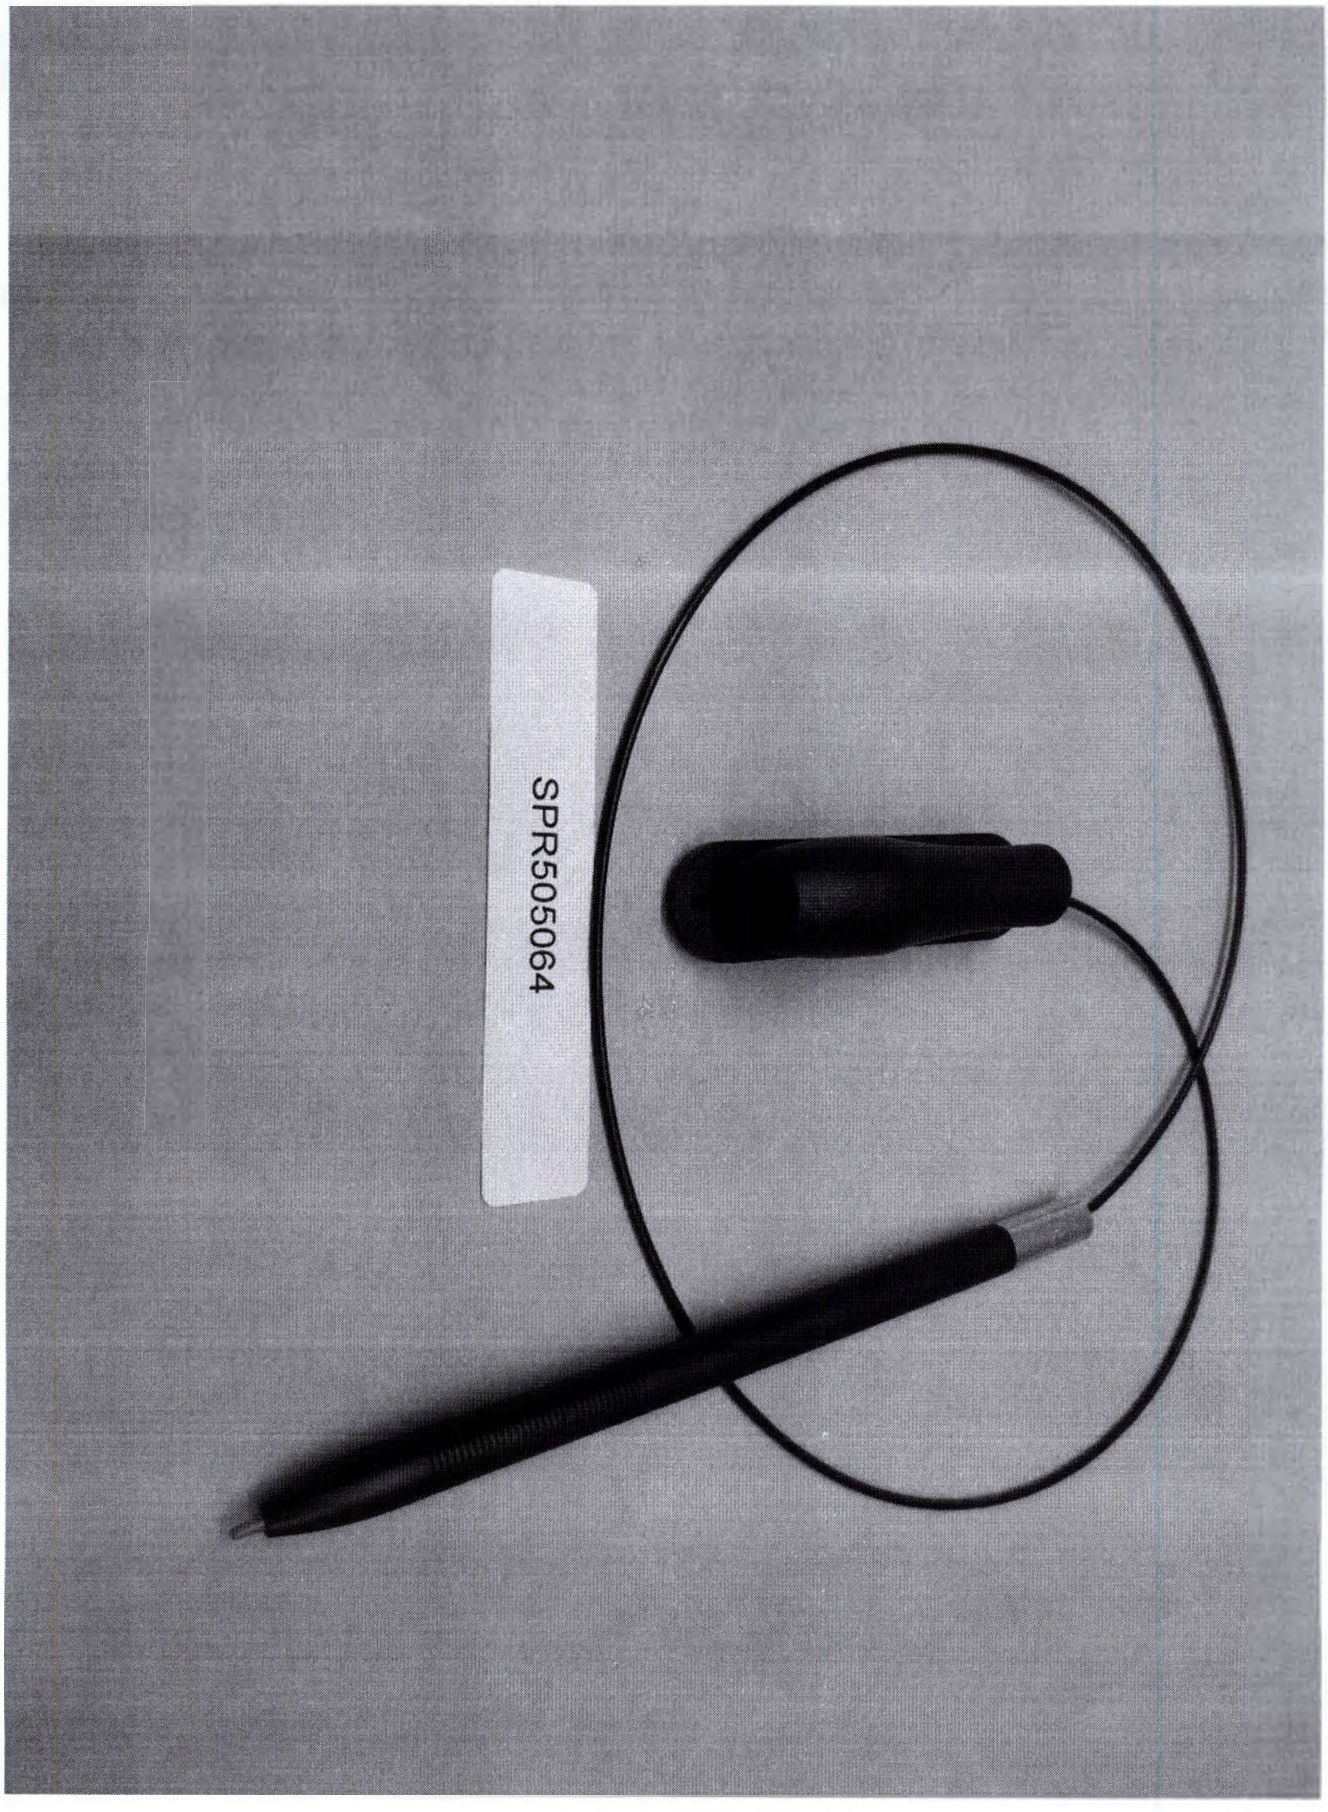

Стилус

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Стилус.

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

CE

- Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;
- Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;
- Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;
- Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

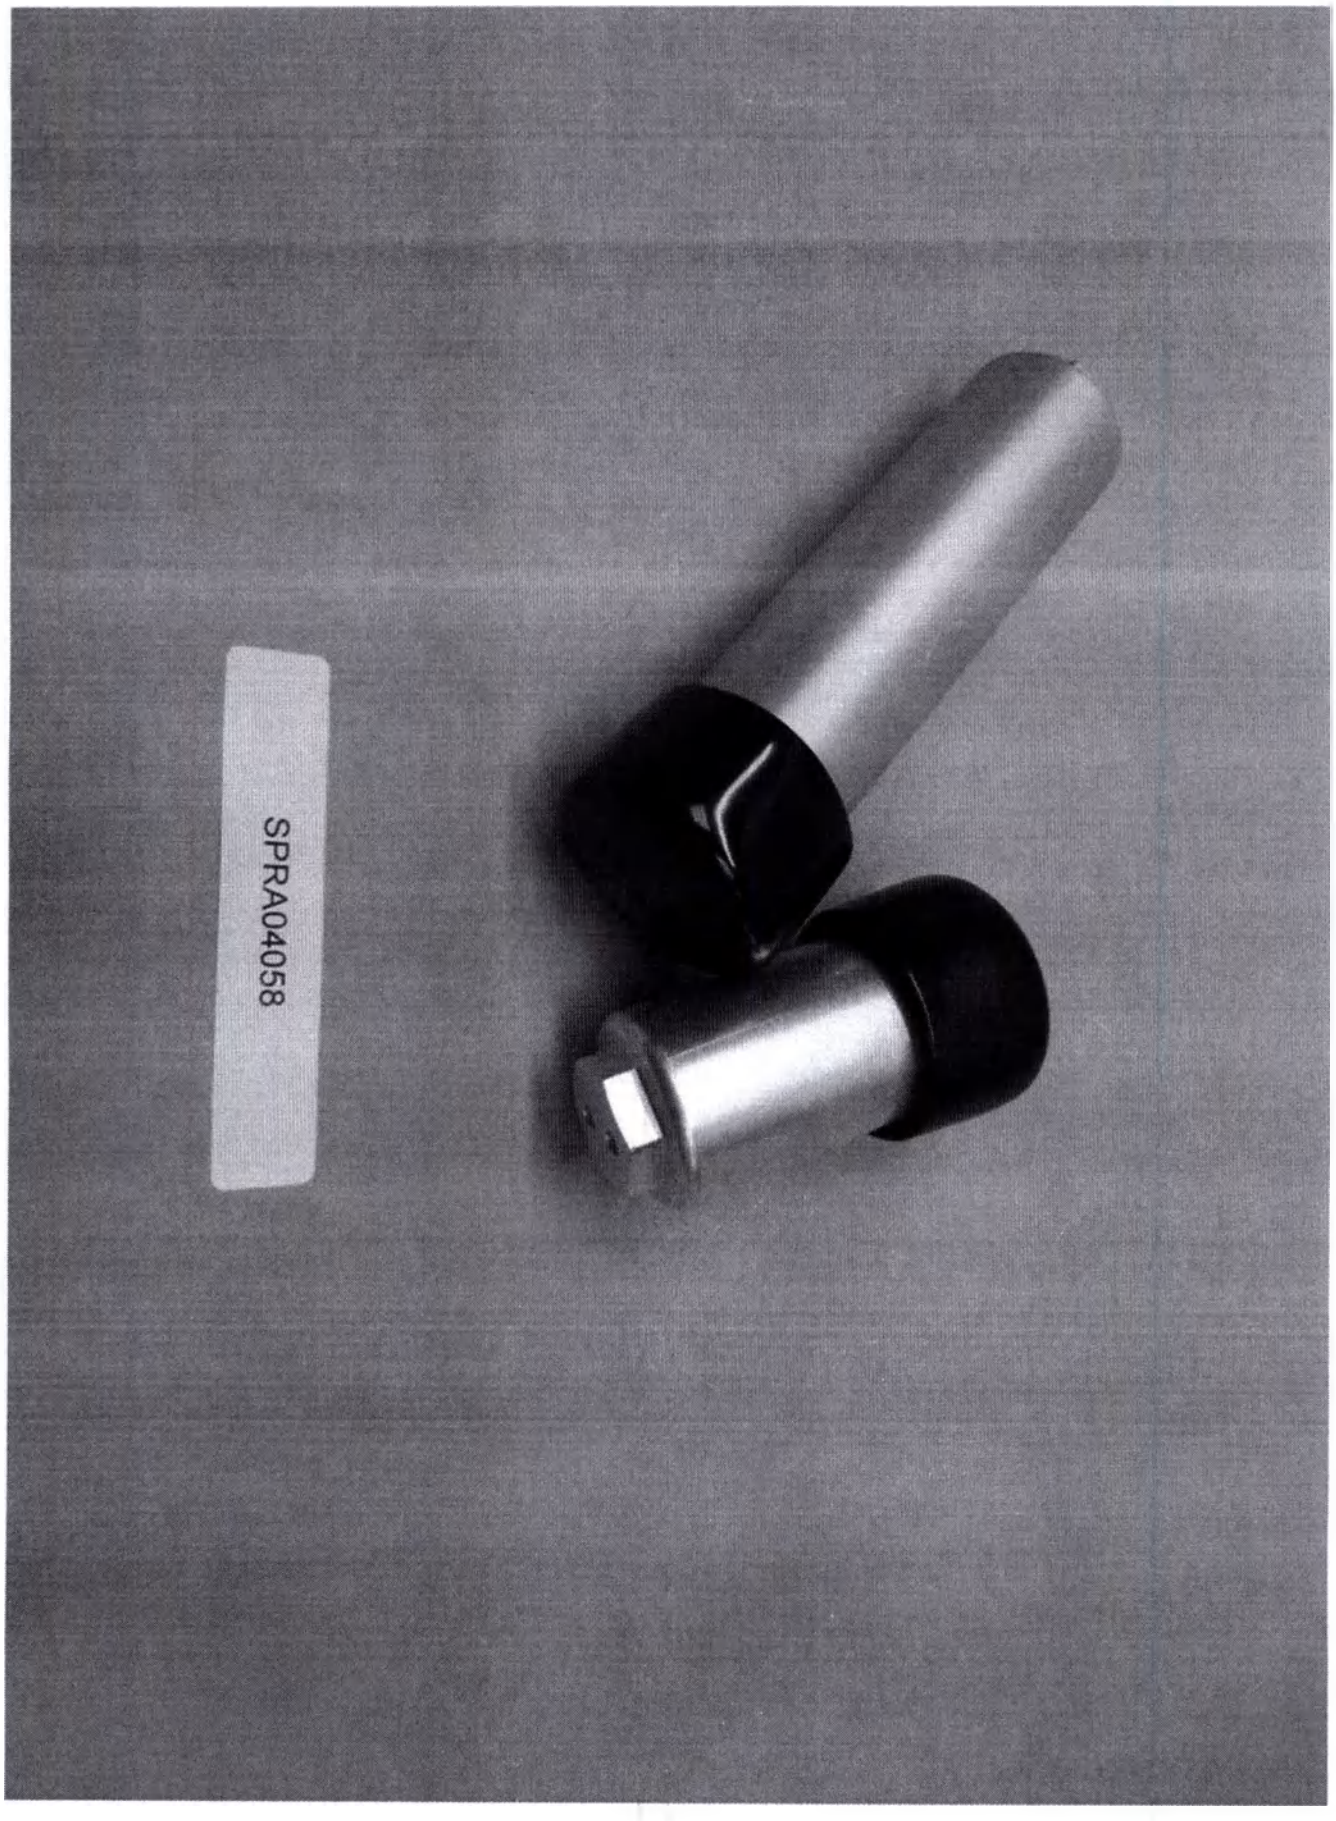

Картридж очистки Аргона, 100 куб.см и картридж очистки Гелия, 50 куб.см.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL
Leading Through Innovation

Картридж очистки Аргона, 100 куб.см.

REF XXXX

SN XXXX

XXXX

№РУ XX от XX

EC REP

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757



CE

- Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;
- Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;
- Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;
- Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».

GALILMEDICAL
Leading Through Innovation

Картридж очистки Гелия, 50 куб.см.

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

№РУ XX от XX

EC REP

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

CE

- Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;
- Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;
- Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;
- Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Предохранительная взрывная мембрана, набор проверочных клапанов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

Предохранительная взрывная мембрана, набор проверочных клапанов.

EC REP

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757



CE

- Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;
- Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;
- Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;
- Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Литиевая батарейка 3В

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Литиевая батарейка 3В

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

CE

- Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;
- Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;
- Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;
- Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Соленоидный вентиль

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Соленоидный вентиль

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

CE

- Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;
- Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;
- Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;
- Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

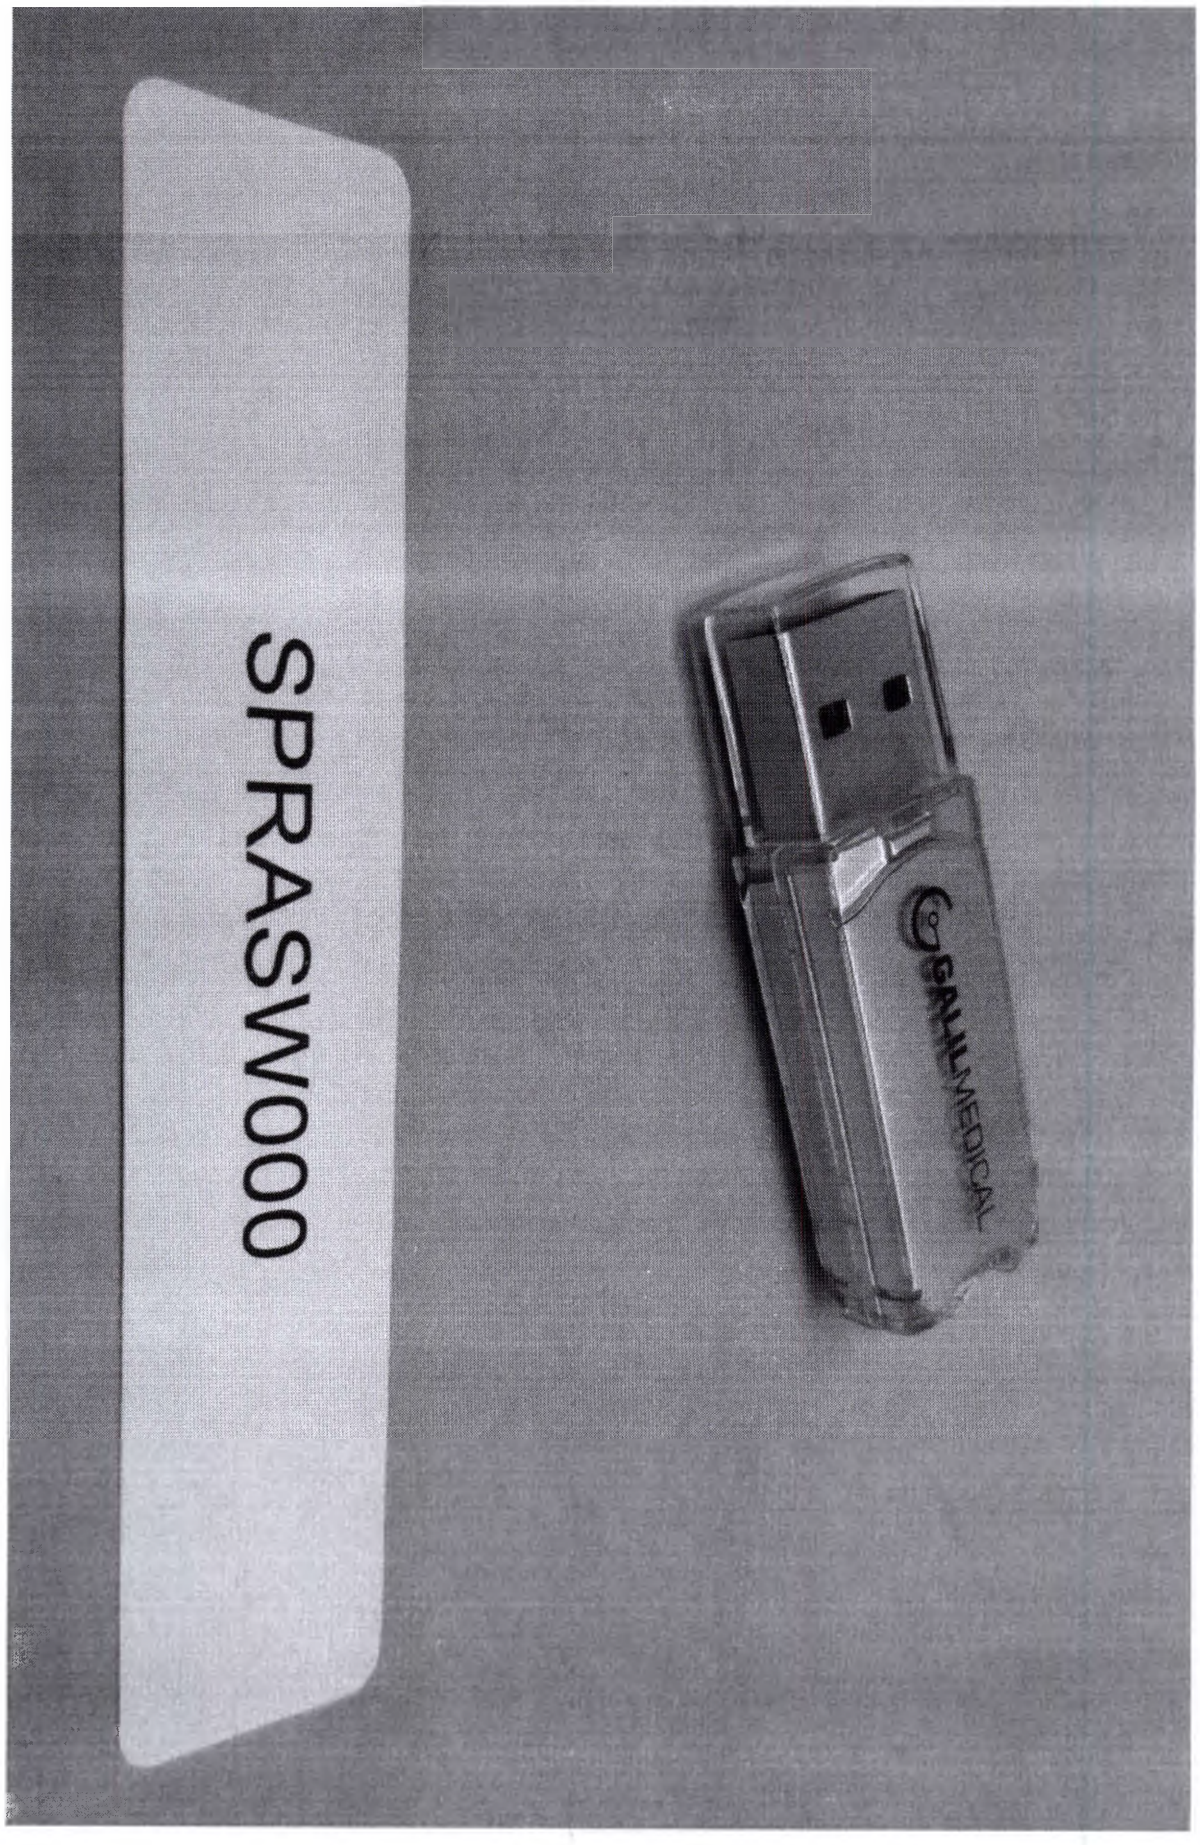

USB флеш накопитель для обновления ПО

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

USB флеш накопитель для обновления ПО

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

№РУ XX от XX

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

CE

- Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;
- Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;
- Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;
- Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

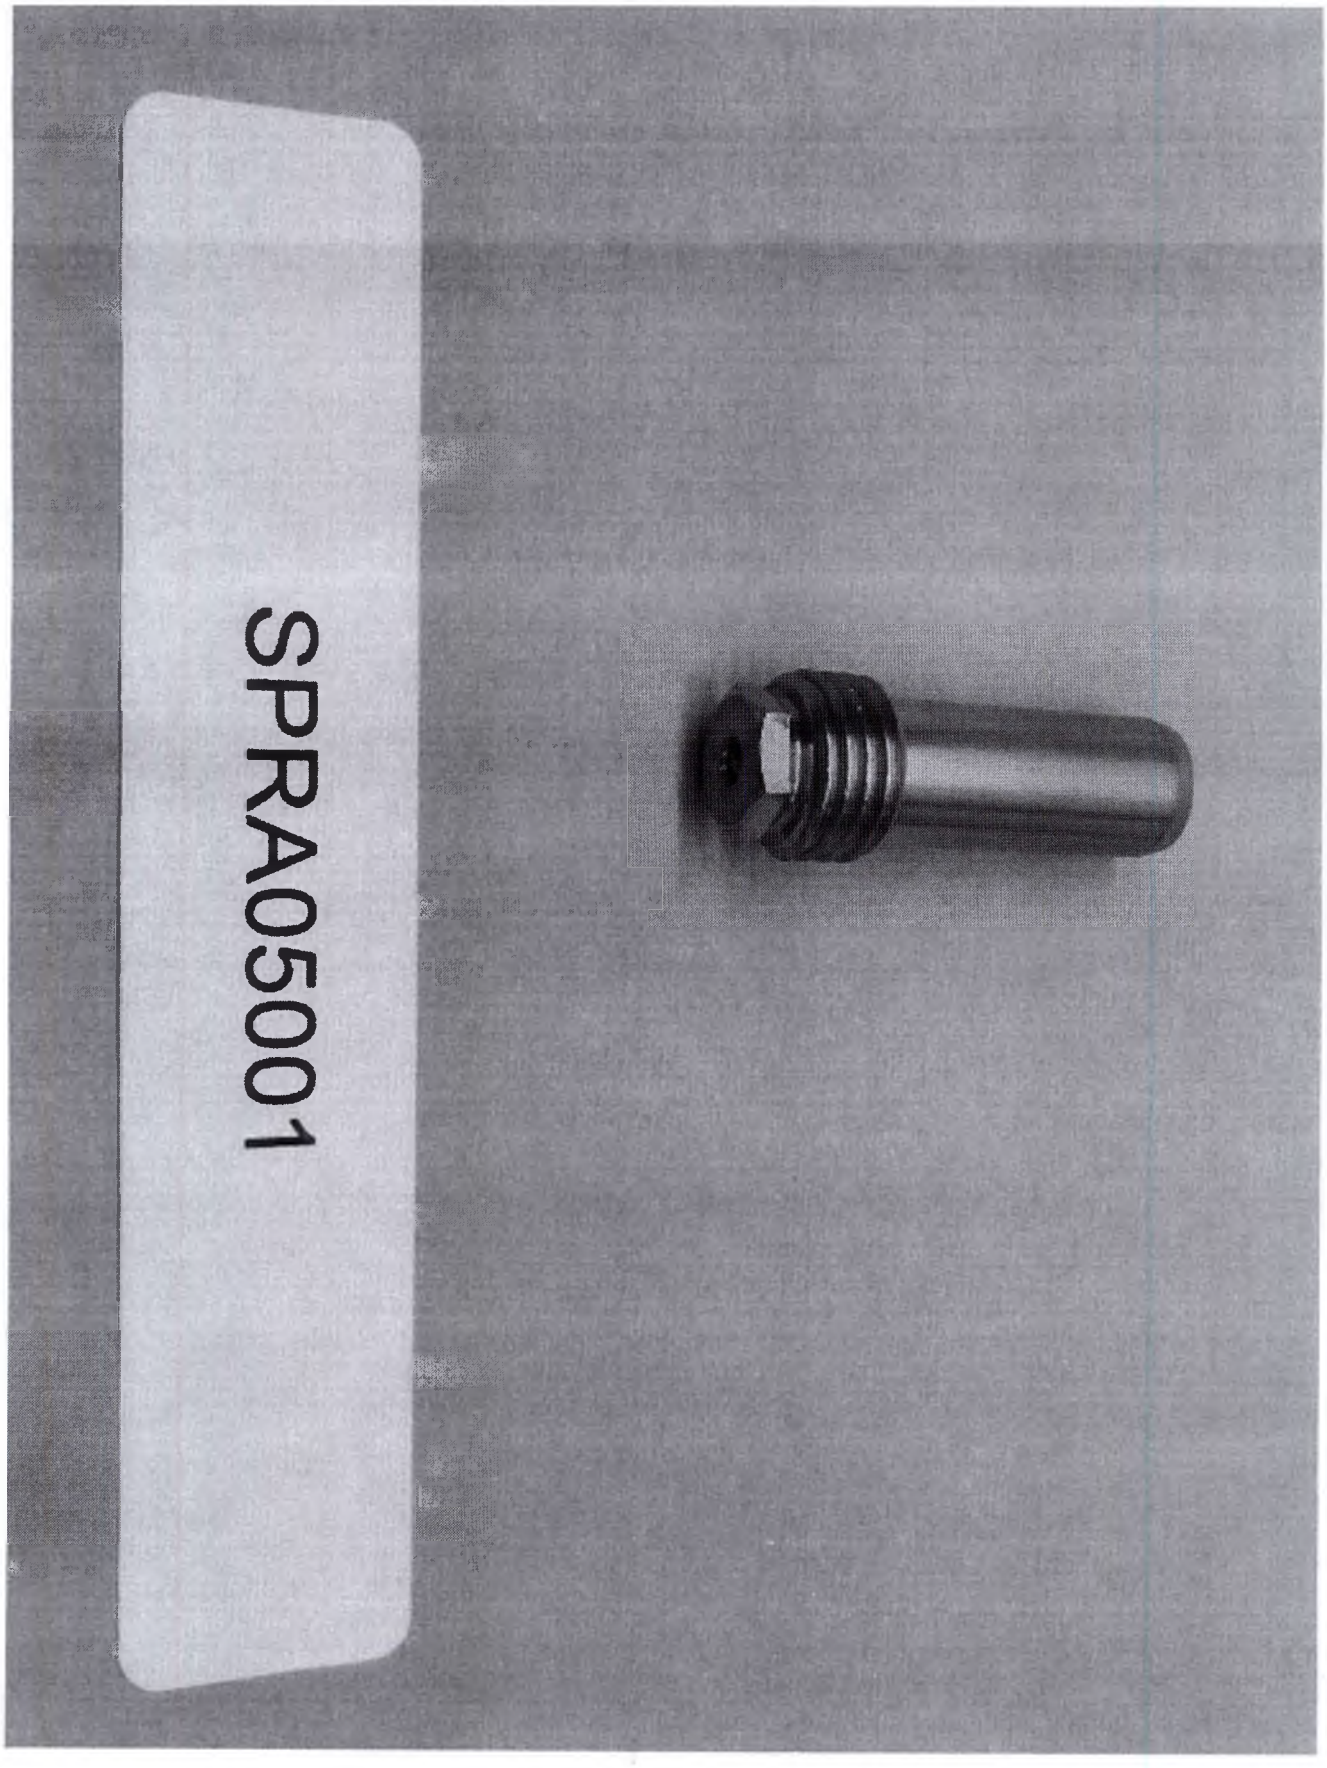

Распределить газов с резьбой

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

Распределить газов с резьбой, 20 шт

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757



№РУ XX от XX

CE

- Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;
- Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;
- Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;
- Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

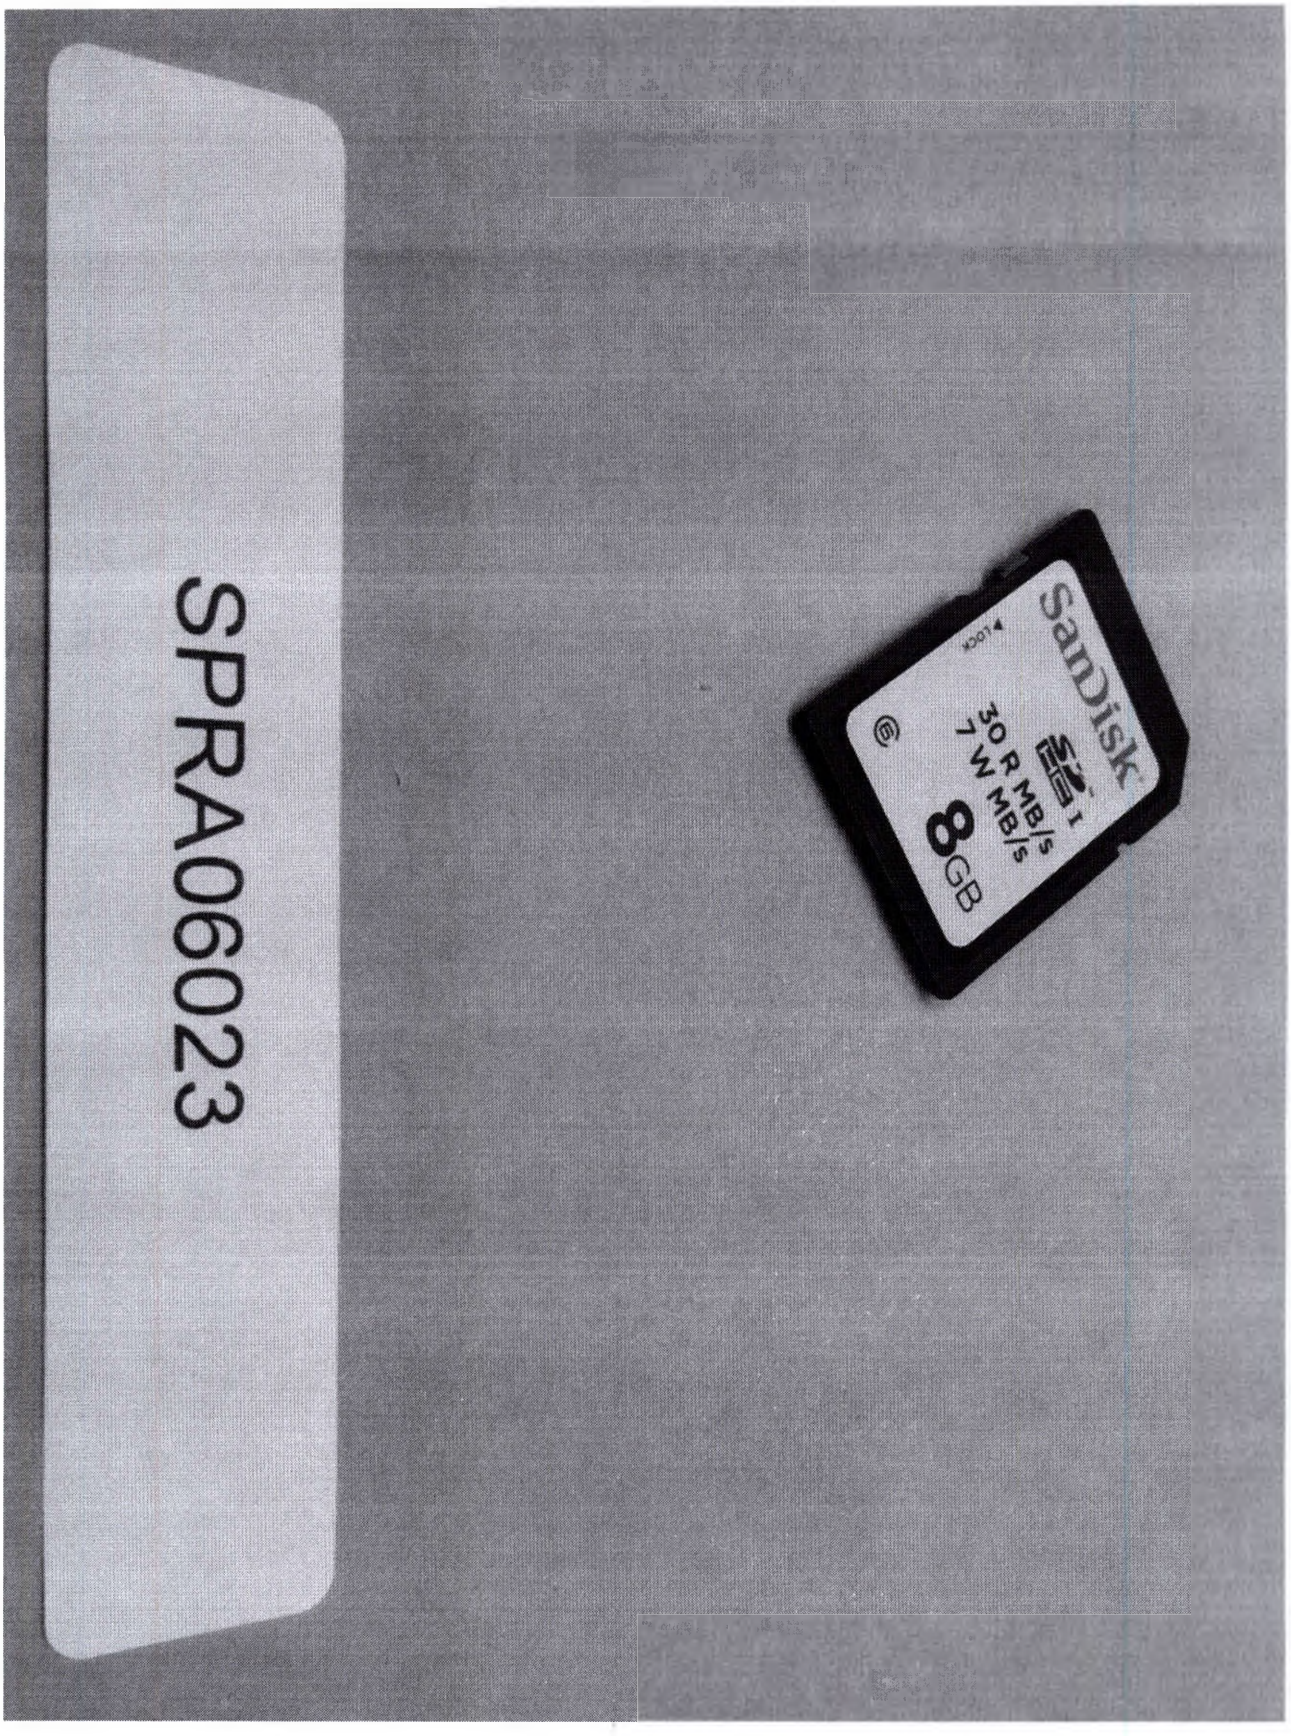

SD карта памяти

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

GALILMEDICAL

Leading Through Innovation

SD карта памяти

REF XXXX

XXXX

SN XXXX

EC REP

Galil Medical Inc., 4364 Round Lake Road, Arden Hills, MN 55112, США. Телефон: +1 877 639 2796; факс: +1 877 510 7757

№РУ XX от XX

CE

- Надпись «не допускайте превышение пределов относительной влажности от 10% до 90%»;
- Надписи: «Осторожно», «Зафиксируйте каналы, прежде чем включать систему подачи газа»;
- Надписи: «Внимание», «Прежде чем складывать монитор, удалите все предметы со столика»;
- Надписи: «Осторожно!», «Проверьте давление газа: максимальное давление на входе – 6000 фунт/кв.дюйм / 414 бар / 41,4 МПа».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Копия верна.
Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 47
(сорок семь) л.
Генеральный директор
ООО «ЮРМЕД»

Кищенко И.М.

«»_____г.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU