

Фотографические изображения


**Раствор промывочный щелочной для модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c
(Basic Wash cobas c systems), 2 бутылки, объем 2л**

.

Раствор промывочный щелочной для модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c (Basic Wash cobas c systems), 2 бутылки, объем 2л. (общий вид)




Раствор промывочный щелочной для модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c (Basic Wash cobas c systems), 2 бутылки, объем 2л. (маркировка лицевой стороны коробки)

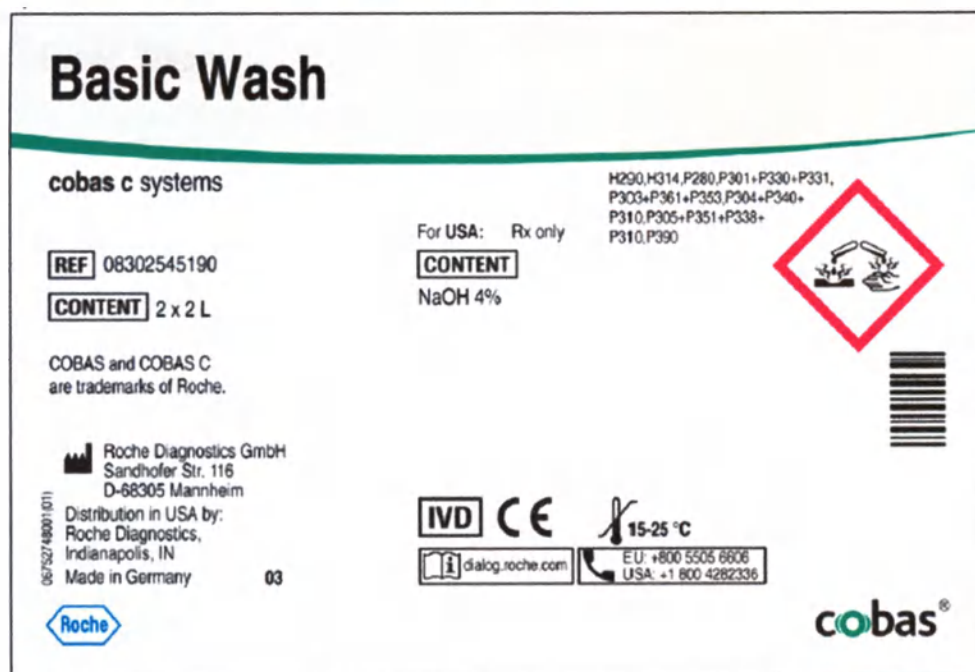

Раствор промывочный щелочной для модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c (Basic Wash cobas c systems), 2 бутылки, объем 2л. (маркировка боковой стороны коробки)



Раствор промывочный щелочной для модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c (Basic Wash cobas c systems), 2 бутылки, объем 2л. (маркировка бутылей)

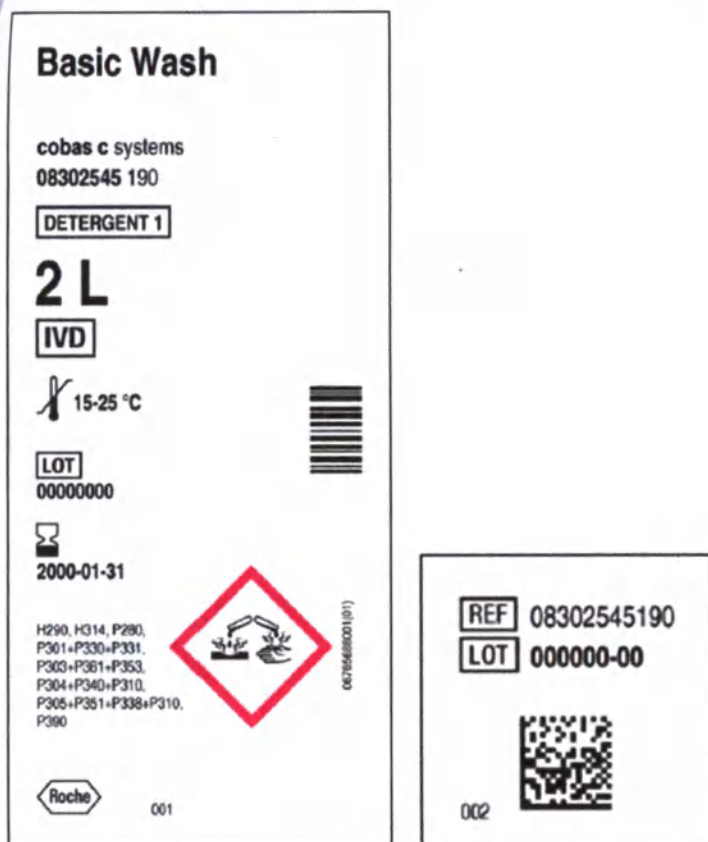

Раствор промывочный щелочной для модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c (Basic Wash cobas c systems), 2 бутылки, объем 2л. (макет маркировки на русском языке)

Раствор промывочный щелочной для модулей биохимических Roche/Hitachi cobas c (Basic Wash cobas c systems), 2 бутылки, объем 2л

Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18543 от ____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики *in vitro*

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер: 08302545190

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
4 листа (об)



по доверенности
от 30.01.2023 г.

М.А. Семенов
Е.А.