

AKM

straumanngroup

"Утверждаю"
"I certify"

Institut Straumann AG
Институт Штрауманн АГ
Manager of International
Regulatory Affairs
Менеджер по международным
вопросам регулирования
Junya Ogasawara
Джуня Огасавара


"05" June 2023

 **straumann**
Institut Straumann AG
CH-4002 Basel-Switzerland

Эксплуатационная документация на медицинское изделие

Вставка ретенционная Novaloc для фиксации съемных зубных протезов

LEGALIZATION

I, the undersigned Jacqueline Burckhardt Bertossa, Civil Law Notary in Basel (Switzerland), herewith certify the authenticity of the signature affixed on the reverse of Mr. Junya Ogasawara, citizen of Japan, domiciled in Basel (Switzerland), born on September 28th (twenty-eighth), 1974 (nineteen hundred and seventy-four), duly identified by his passport, whose signature I have identified by comparison with a doubtlessly authentic signature.

IN WITNESS THEREOF I have put my hand and seal thereunto in Basel (Switzerland) on this 13th (thirteenth) day of June, 2023 (two thousand and twenty-three).



*Jacqueline M
Not*

Leg. Prot. 525/2023

Инструкция по применению Вставка ретенционная Novaloc для фиксации съемных зубных протезов

Производитель:

«Институт Штрауманн АГ» (Institut Straumann AG), Швейцария

Адрес: Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Switzerland

Тел.: +41 61 965 11 11

info@straumann.com

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

Общество с ограниченной ответственностью «Штрауманн» (ООО «Штрауманн»)

Адрес: Российская Федерация, 119571 г. Москва, Ленинский проспект, д.119А

Тел. +7 495 139-74-74

info.ru@straumann.com

1	Оглавление	
1	Наименование медицинского изделия (далее МИ)	3
2	Информация о производителе	3
3	Назначение	3
4	Область применения	3
5	Потенциальный потребитель	3
6	Показания к применению.....	3
7	Противопоказания.....	3
8	Возможные побочные действия.....	4
9	Предупреждения	4
10	Меры предосторожности	4
11	Общее описание МИ	5
12	Технические характеристики	6
13	Сведения о стерильности и кратности применения	7
14	Подготовка к работе с МИ	8
15	Работа с МИ.....	8
16	Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие	11
17	Условия эксплуатации, хранения и транспортировки изделий	12
18	Расшифровка символов маркировки.....	13
19	Сведения об утилизации	14
20	Срок годности.....	14
21	Клиническая эффективность.....	14
22	Гарантийные обязательства	15
23	Рекламации	15

1 Наименование медицинского изделия (далее МИ)

Вставка ретенционная Novaloc для фиксации съемных зубных протезов, в вариантах исполнения:

1. Вставка ретенционная Novaloc, красная, экстра-низкая сила ретенции, РЕЕК, 4 шт./уп.
2. Вставка ретенционная Novaloc, белая, низкая сила ретенции, РЕЕК, 4 шт./уп.
3. Вставка ретенционная Novaloc, желтая, средняя сила ретенции, РЕЕК, 4 шт./уп.
4. Вставка ретенционная Novaloc, зеленая, высокая сила ретенции, РЕЕК, 4 шт./уп.
5. Вставка ретенционная Novaloc, синяя, экстра-высокая сила ретенции, РЕЕК, 4 шт./уп.
6. Вставка ретенционная Novaloc, черная, ультра-высокая сила ретенции, РЕЕК, 4 шт./уп.

(Далее по тексту: вставка ретенционная, вставка Novaloc, вставка).

2 Информация о производителе

«Институт Штрауманн АГ» (Institut Straumann AG), Швейцария

Адрес: Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Switzerland

Тел.: +41 61 965 11 11

info@straumann.com

3 Назначение

Предназначены для фиксации съемных ортопедических конструкций.

4 Область применения

Стоматология.

5 Потенциальный потребитель

Врач-стоматолог.

6 Показания к применению

МИ показано для использования у пациентов с частичной или полной адентией нижней или верхней челюсти, нуждающихся в частичных или полных съемных протезах.

7 Противопоказания

• Аллергические реакции или гиперчувствительность к используемым материалам: Полиэфирэфиркетон (РЕЕК).

- Бруксизм или другие парафункциональные привычки.
- Односторонний консольный / свободный концевой протез без поперечной опоры.
- Изделия нельзя использовать при расхождении имплантатов более чем на 60° или при расхождении, превышающем 40° между двумя абатментами.

• Отсутствие готовности пациента следовать инструкциям по последующему уходу или давать обратную связь.

8 Возможные побочные действия

- Аллергические реакции.
- Гиперчувствительность.
- Боль.

9 Предупреждения

• Для того, чтобы безопасно и правильно использовать продукцию Straumann в соответствии с данной инструкцией по применению, практикующие стоматологи должны обладать соответствующими знаниями в области дентальной имплантологии, а также быть проинструктированы относительно обращения с продукцией Straumann, описанной в настоящем документе

• Вставки ретенционные являются частью общей Матричной системы Novaloc и должны использоваться только с совместимыми абатментами:

- Novaloc;
- MedentiLOC;
- Locator.

Для работы с изделием и его функционирования согласно назначению необходимы все элементы матричной системы.

• Устанавливайте реставрационную конструкцию на имплантатах только в окклюзию после того, как имплантат полностью остеоинтегрировался.

• Для удаления ретенционных вставок необходимо использовать только Инструмент для извлечения и установки ретенционных вставок Novaloc.

• Изделия должны храниться в сухом месте в оригинальной упаковке при комнатной температуре и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Неправильное хранение может повлиять на характеристики изделия.

• Изделия должны быть проверены перед использованием. Поврежденные изделия и изделия с поврежденной упаковкой не должны использоваться.

• Изделия должны быть продезинфицированы перед применением.

• О любом серьезном инциденте, произошедшем в связи с изделиями, должно быть сообщено производителю и компетентному органу страны проживания пользователя и/или пациента.

• Не шлифуйте и не полируйте абатмент, т.к. он может утратить свою ретенционную функцию.

10 Меры предосторожности

• Аллергические реакции и гиперчувствительность на материалы не может быть исключена. Изделия не должны использоваться у пациентов с подозрением/ установленной аллергией на материалы, из которых изготовлены изделия.

• Пациент не должен прикусывать свои зубной протез, так как эта нагрузка приведет к неправильному износу абатментов и вставок ретенционных.

• В случае неожиданных осложнений или боли пациентам рекомендуется немедленно обратиться к своему стоматологу или зубному протезисту.

• Вставки ретенционные являются одноразовыми и маркируются соответствующим символом. Изделия не должны использоваться повторно.

- Использование зубных щеток и зубной пасты для механической очистки изделий может привести к преждевременному износу в функциональных зонах. Ни металлические щетки, ни абразивные средства не должны использоваться для очистки.

- Безопасно утилизируйте изделия в соответствии с локально применимыми законами и правилами.

11 Общее описание МИ

Вставка ретенционная Novaloc – это сменная пластиковая удерживающая вставка, выполненная в форме кольца с зазором, сделанная из полиэфирэфиркетона (PEEK) и представленная в шести различных цветовых кодировках: красная, белая, жёлтая, зелёная, синяя и чёрная (рис. 1). Цвет кодировки указывает на соответствующую удерживающую силу.

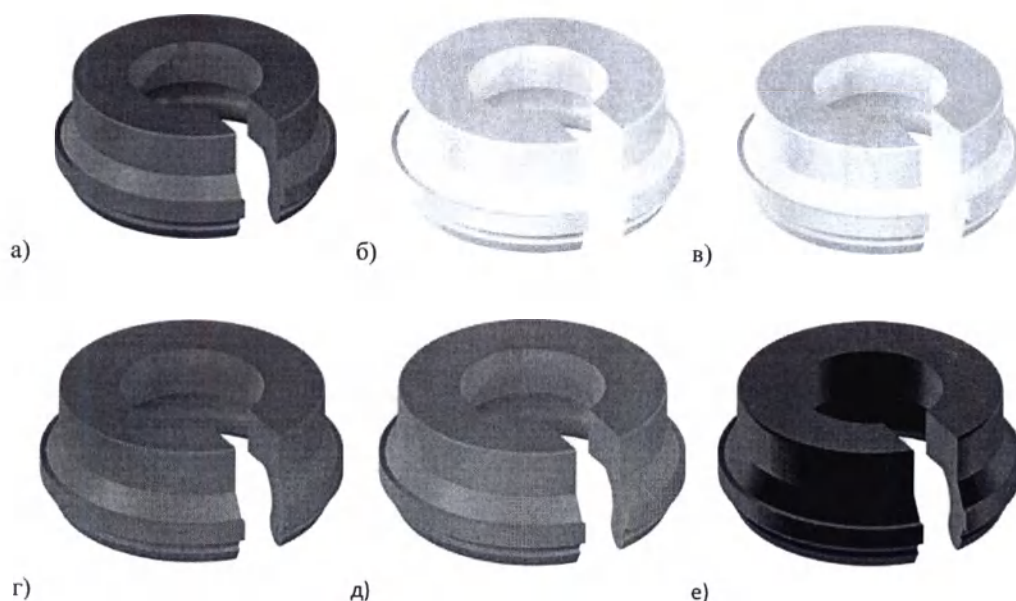


Рисунок 1 – Вставка ретенционная Novaloc для фиксации съемных зубных протезов:

- а) Вставка ретенционная Novaloc, красная, экстра-низкая сила ретенции, PEEK, 4 шт./уп;
- б) Вставка ретенционная Novaloc, белая, низкая сила ретенции, PEEK, 4 шт./уп;
- в) Вставка ретенционная Novaloc, желтая, средняя сила ретенции, PEEK, 4 шт./уп;
- г) Вставка ретенционная Novaloc, зеленая, высокая сила ретенции, PEEK, 4 шт./уп;
- д) Вставка ретенционная Novaloc, синяя, экстра-высокая сила ретенции, PEEK, 4 шт./уп;
- е) Вставка ретенционная Novaloc, черная, ультра-высокая сила ретенции, PEEK, 4 шт./уп.

12 Технические характеристики

Таблица 1. Технические характеристики с допуском.

Наименование изделия	Внешний диаметр, мм	Большой внутренний диаметр, мм	Меньший внутренний диаметр, мм	Высота общая, мм	Сила ретенции, г	Масса, г
Вставка ретенционная Novaloc, красная, экстра-низкая сила ретенции, PEEK, 4 шт./уп	$4,95 \pm 0,01$	$3,87 \pm 0,01$	$2,30 \pm 0,03$	$2,03 \pm 0,05$	300 ± 100	$0,018 \pm 15\%$
Вставка ретенционная Novaloc, белая, низкая сила ретенции, PEEK, 4 шт./уп	$4,95 \pm 0,01$	$3,825 \pm 0,01$	$2,30 \pm 0,03$	$2,03 \pm 0,05$	750 ± 100	$0,018 \pm 15\%$
Вставка ретенционная Novaloc, желтая, средняя сила ретенции, PEEK, 4 шт./уп	$4,95 \pm 0,01$	$3,795 \pm 0,01$	$2,30 \pm 0,03$	$2,03 \pm 0,05$	1200 ± 100	$0,018 \pm 15\%$
Вставка ретенционная Novaloc, зеленая, высокая сила ретенции, PEEK, 4 шт./уп	$4,95 \pm 0,01$	$3,75 \pm 0,01$	$2,30 \pm 0,03$	$2,03 \pm 0,05$	1650 ± 100	$0,018 \pm 15\%$
Вставка ретенционная Novaloc, синяя, экстра-высокая сила ретенции, PEEK, 4 шт./уп	$4,95 \pm 0,01$	$3,725 \pm 0,01$	$2,30 \pm 0,03$	$2,03 \pm 0,05$	2050 ± 100	$0,018 \pm 15\%$
Вставка ретенционная Novaloc, черная, ультра-высокая сила ретенции, PEEK, 4 шт./уп	$4,95 \pm 0,01$	$3,69 \pm 0,01$	$2,30 \pm 0,03$	$2,03 \pm 0,05$	2450 ± 100	$0,018 \pm 15\%$

13 Сведения о стерильности и кратности применения

Вставки ретенционные упакованы и распространяются в нестерильном виде, предназначены для применения у одного пациента, перед применением должны быть очищены и продезинфицированы. Изделие однократного применения.

Очистка осуществляется с помощью промывания под проточной водой с одновременной обработкой внешней и внутренней стороны щеточкой соответствующего размера.

Предварительно обработанное изделие можно очищать вручную, с использованием средств ультразвуковой очистки или с помощью метода автоматизированной очистки и дезинфекции.

При использовании метода автоматизированной очистки и дезинфекции, выбирайте подходящее моющее средство.

Изделия из разных материалов никогда не следует помещать вместе в одну баню (так как это приведет к повышенному риску контактной коррозии). Информацию о материале, из которого изготовлено изделие, можно найти на этикетке и в соответствующей инструкции по применению или в каталоге продукции Institut Straumann AG.

Изделия очень малого размера. Соблюдайте осторожность, чтобы изделие не было утеряно.

При выборе очищающих и дезинфицирующих средств необходимо учитывать следующее:

- они совместимы с материалами, из которых изготовлены очищаемые и дезинфицируемые изделия.
- компания Straumann не даёт каких-либо рекомендаций специальных дезинфицирующих средств. Однако рекомендуется использовать дезинфицирующие средства с одобренной эффективностью (например, VAH/DGHM, одобрение FDA или маркировка CE).

Очистка.

Этап 1: Промойте изделие под проточной водопроводной водой в течение 5 минут.

Этап 2: Очистите изделие, почистив их подходящей щеткой.

Этап 3: Промойте изделие под проточной водопроводной водой в течение 30 секунд.

Дезинфекция.

Этап 1: Приготовьте баню с дезинфицирующим раствором с концентрацией и температурой, указанными в инструкции производителя используемого средства.

Этап 2: Полностью погрузите изделие в баню с дезинфицирующим средством на время, указанное в инструкции производителя. Убедитесь, что все просветы заполнены дезинфицирующим раствором и все поверхности смочены им.

Этап 3: Извлеките изделие из дезинфекционной бани по истечении указанного времени воздействия и промойте изделие не менее пяти раз (5 раз) свежеприготовленной очищенной водой или стерильной водой.

Этап 4: Просушите изделие с помощью чистого сжатого воздуха или одноразовых стерильных салфеток.

Этап 5: Осмотрите продезинфицированное изделие.

14 Подготовка к работе с МИ


Для применения вставок Novaloc необходимо наличие у пациента одного из вариантов совместимых абатментов: Novaloc, MedentiLOC и Locator. Обратитесь к инструкции по эксплуатации абатментов и произведите их установку, согласно требуемому лечению. После того, как у пациента установлены совместимые абатменты их можно использовать в качестве опоры для ортопедической конструкции, элементами соединения которой выступает матричная система Novaloc.

15 Работа с МИ

Любые действия с вставками Novaloc необходимо осуществлять с использованием специально предназначенных для этого инструментов Novaloc. Эти инструменты обеспечивают удобное и безопасное взаимодействие с изделиями.

Создание нового съемного протеза с матричной системой Novaloc.

Процедура, проводимая в стоматологическом кабинете - снятие оттиска на уровне абатмента:

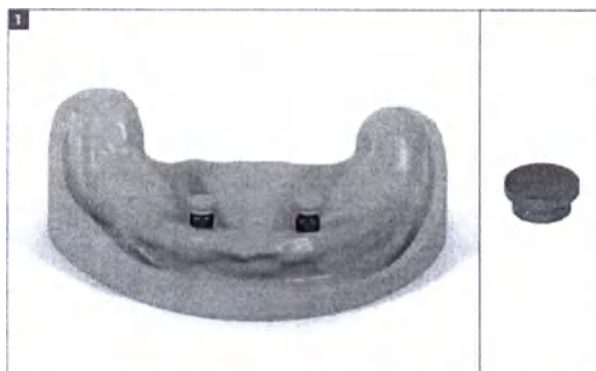

Шаг 1 – Установка лабораторных матриц Novaloc.

Установите лабораторные матрицы на абатменты.




Шаг 2 – Снятие оттиска.

Снимите оттиск с помощью винилполисилоксана или полиэфирного оттискного материала.


Отправьте оттиск в зуботехническую лабораторию.

Процедура, проводимая в зуботехнической лаборатории:

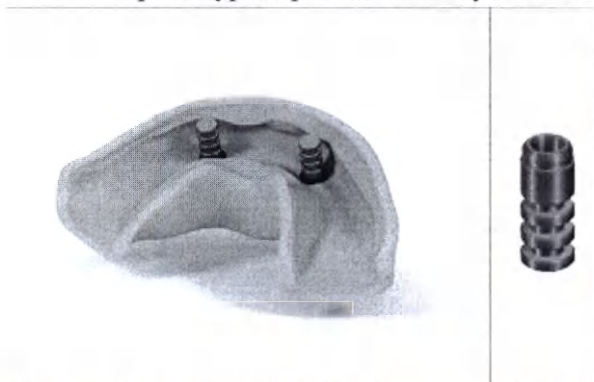

Шаг 1 – Установка аналогов абатментов Novaloc.

Вставьте аналоги абатментов Novaloc в лабораторные матрицы Novaloc.

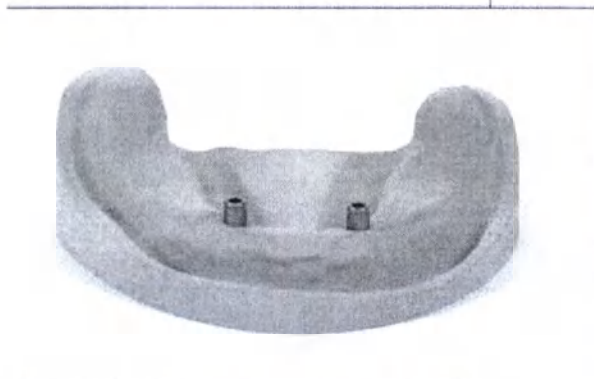


Шаг 2 – Изготовление рабочей модели.

Отлейте рабочую модель по стандартной методике, используя стоматологический гипс 4-го класса ГОСТ Р ИСО 6873.

Примечание:

Вы также можете использовать оттиск на уровне имплантатов для отливки рабочей модели.

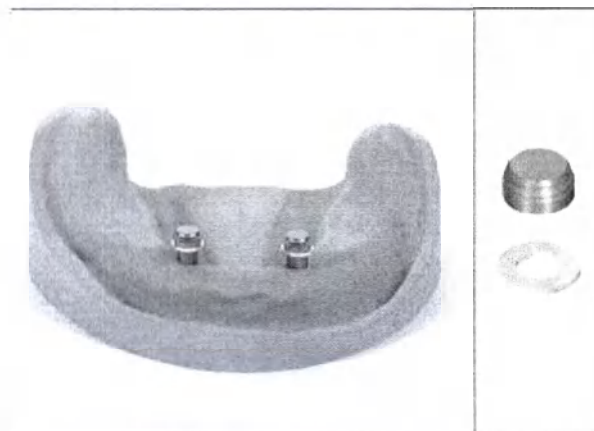

Шаг 3 – Установка манжет и матриц Novaloc

Наденьте белые манжеты на все аналоги абатментов Novaloc.

Примечание:

Используйте спейсеры Novaloc для создания необходимого пространства при фиксации матриц Novaloc в базисе протеза у кресла пациента.



Пластиковая матрица имеет нейтральный цвет. Используйте её для достижения более эстетичного результата лечения при слишком вестибулярном положении имплантата.




Модифицируемая матрица имеет большую высоту. Оно используется в ситуациях, когда абатмент расположен слишком низко или требуется дополнительная ретенция. При необходимости матрицу можно укоротить.





Спейсер Novaloc предназначен для создания пространства в базе протеза для последующей фиксации матриц Novaloc. Спейсер используется на рабочей модели, при изготовлении съемного протеза, армированного металлом, методом литья или при фиксации матриц Novaloc в базе протеза у кресла пациента. В процессе изготовления съемного протеза, армированного металлом, методом литья, спейсер сгорает, что исключает его контакт с пациентом.

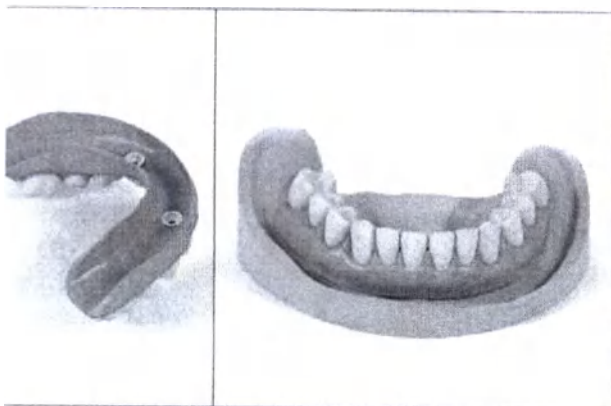

Шаг 4 – Изготовление гибридного протеза. Изготовьте гибридный протез по стандартной методике.


Зубной техник отправляет готовый гибридный протез с креплениями Novaloc обратно в клинику с установленными лабораторными ретенционными вставками.

Процедура, проводимая в стоматологическом кабинете:



Шаг 5 – Удаление лабораторных ретенционных вставок Novaloc.


Извлеките все лабораторные ретенционные вставки из матриц с помощью инструмента для удаления ретенционных вставок (голубой).

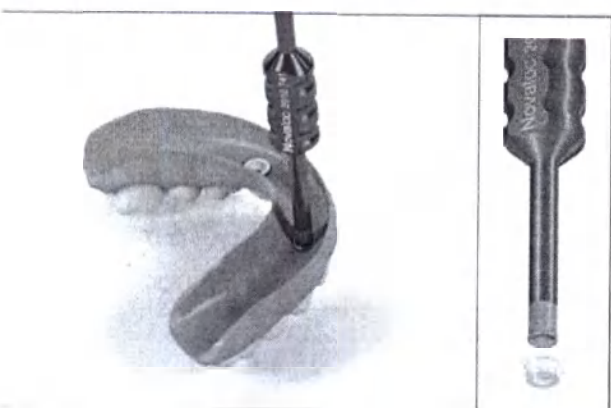

Шаг 6 – Выбор и установка ретенционных Вставок Novaloc.

Подберите оптимальные ретенционные вставки Novaloc.

Установите ретенционные вставки Novaloc в матрицы с помощью инструмента для извлечения и установки ретенционных вставок (коричневый).

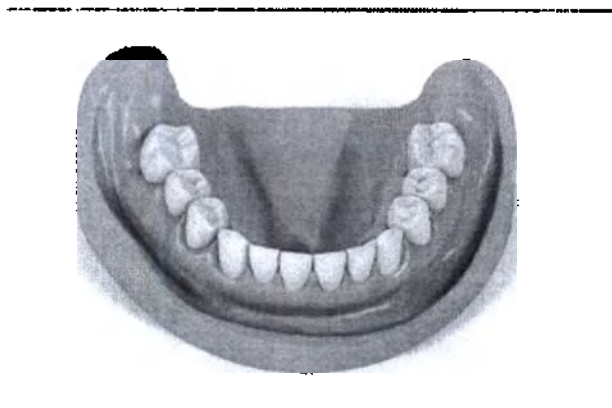

Шаг 7 - Установка съемного протеза.
Установите гибридный протез на абатменты и проверьте окклюзию.

16 Перечень национальных и международных нормативных документов/стандартов, которым соответствует медицинское изделие

Таблица 2. Перечень стандартов.

Стандарт	Название на русском языке
Соответствие международным стандартам	
ISO 13485 (пункты 4-8)	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования для целей регулирования
ISO 14971 (пункты 4-9, Приложение А)	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям
ISO 15223-1 (пункты 4, 5)	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования
EN 62366 (пункты 4-7)	Изделия медицинские. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности.
ISO 10993-1 (пункты 4-7)	Биологическая оценка медицинских устройств - Часть 1: Оценка и проверяющий в процессе управления рисками.
ISO 10993-5 (пункты 4-10)	Биологическая оценка медицинских изделий - Часть 5: Испытания in vitro на цитотоксичность.
Соответствие национальным стандартам	
ГОСТ ISO 14971-2021	Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям.
ГОСТ ISO 13485-2017	Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования к регулированию.
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования.
ГОСТ Р МЭК 62366-1-2021	Изделия медицинские. Часть 1. Проектирование медицинских изделий с учетом эксплуатационной пригодности.
ГОСТ 31214-2016	Изделия медицинские. Требования к образцам и

	документации, предоставляемым на токсикологические, санитарно-химические исследования, испытания на стерильность и пирогенность.
ГОСТ Р 52770-2016	Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.
ГОСТ ISO 10993-1-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования
ГОСТ ISO 10993-5-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro.
ГОСТ ISO 10993-10-2011	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.
ГОСТ ISO 10993-11-2021	Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия.

17 Условия эксплуатации, хранения и транспортировки изделий

Условия эксплуатации

Медицинское изделие эксплуатируется в ротовой полости организма, при температуре от +32°C до +42°C, влажность 100%.

Работа с медицинским изделием проводится в стоматологических кабинетах и зуботехнических лабораториях лечебно-профилактических учреждений, в стандартных для таких кабинетов условиях:

Таблица 3. Условия эксплуатации.

Характеристика	Значение
Температура	+18°C - +25°C
Влажность	От 40% до 60%
Атмосферное давление	86 - 106,7 кПа

Условия хранения

Изделия должны храниться в сухом месте в оригинальной упаковке при комнатной температуре и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. При хранении соблюдать следующие условия:

Таблица 4. Климатические условия хранения.

Характеристика	Значение
Температура	От +15°C до +35°C
Влажность	не более 60%
Атмосферное давление	86 - 106,7 кПа

Условия транспортирования

Транспортировка может осуществляться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на

каждом виде транспорта. Не допускается воздействие влаги и прямых солнечных лучей при транспортировании.

Таблица 5. Климатические условия транспортирования.

Характеристика	Значение
Температура	от -50°C до +50°C
Влажность	не более 80%
Атмосферное давление	86 - 106,7 кПа

18 Расшифровка символов маркировки

Таблица 6. Расшифровка символов на маркировке.

Символ (при наличии)	Значение
	Изготовитель
	Представитель в ЕС
	Импортёр в ЕС
	Каталожный номер
	Номер партии
	Дата изготовления ГГГГ-ММ-ДД
	Использовать до ГГГГ-ММ-ДД
	Не использовать повторно
	Не стерильно
	Не допускать воздействия солнечного света
	Обратитесь к инструкции по применению*
	Медицинское изделие
Qty.: 4	Количество в упаковке
Rx only	Федеральное законодательство США ограничивает продажу данного изделия для распространения только стоматологам или по заказу сертифицированного стоматолога



Маркировка CE свидетельствует об удовлетворении требований Директивы о медицинских изделиях 93/42 ЕЕС и Директивы о машинном оборудовании 2006/42/ЕС. 0123 указывает на нотифицированный орган изготовителя

** инструкции распространяются в электронном виде. Инструкции размещены на сайте производителя, который указан на русскоязычной этикетке: <http://www.straumann.ru/ifu>.*

19 Сведения об утилизации

Компания «Institut Straumann AG» заботится о защите окружающей среды и обеспечении постоянного безопасного и эффективного использования своих продуктов, предусматривая должную поддержку, обеспечение и обучение. Таким образом, продукты компании «Institut Straumann AG» разработаны и произведены в соответствии с применимыми руководствами по защите окружающей среды. При условии правильной эксплуатации и обслуживания можно избежать риска загрязнения окружающей среды.

После использования изделия должны быть очищены от всевозможных биологических материалов и должны быть надлежащим образом утилизированы в соответствии с правилами утилизации СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б. Процедура утилизации осуществляется в соответствии с требованиями медицинских учреждений.

Изделия с истекшим сроком годности или с поврежденной упаковкой и не бывшие в употреблении должны быть надлежащим образом утилизированы в соответствии с правилами утилизации СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А. Процедура утилизации осуществляется в соответствии с требованиями медицинских учреждений.

Утилизация упаковочных материалов осуществляется в соответствии с применимыми в медицинских учреждениях правилами сбора и обработки отходов.

В случае возникновения вопросов необходимо связаться с местными муниципальными органами, ответственными за утилизацию отходов.

Уничтожение должно осуществляться организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в помещениях в соответствии с требованиями, предусмотренными существующими Федеральными законами, с соблюдением обязательных требований по охране окружающей среды, при использовании методов, согласованных с территориальными органами, ответственными за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

20 Срок годности

5 лет.

21 Клиническая эффективность

Клиническая оценка проводилась методом анализа технической и эксплуатационной документации и с помощью сравнения медицинского изделия с аналогичными изделиями, представленными на рынке, а также методом литературного обзора по:

- характеристикам,

- контролю за инцидентами, связанными с использованием медицинских изделий для изделия «Вставка ретенционная Novaloc для фиксации съемных зубных протезов», и эквивалентных изделий,

- клиническим случаям.

Изделия разработаны и изготовлены для обеспечения безопасности пациента и пользователей при использовании в нормальных условиях эксплуатации и по заявленным показаниям.

Отчет и анализ рисков демонстрируют, что использование изделий не сопряжено с каким-либо чрезмерным риском для пациента при условии анализа практикующим врачом преимуществ, связанных со здоровьем пациента, медицинским и хирургическим анамнезом.

В заключении клинического исследования было продемонстрировано, что «Вставка ретенционная Novaloc для фиксации съемных зубных протезов», производства компании Institut Straumann AG, и аналогичные изделия других производителей имеют положительное соотношение выгода/риск.

22 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок годности и хранения изделий составляет 5 лет с даты производства медицинского изделия.

С гарантийной программой клиенты могут ознакомиться на официальном сайте www.straumann.ru в разделе Обслуживание клиентов.

23 Рекламации

Контактные данные для обращения по вопросам, связанным с эксплуатацией, техническим обслуживанием, качеством и соответствием изделий нормативным требованиям на территории Российской Федерации:

Общество с ограниченной ответственностью "Штрауманн" (ООО "Штрауманн"), Российская Федерация.

Юридический адрес: Российская Федерация, 119571 г. Москва, Ленинский проспект, д.119А.

Контактный телефон: +7 495 139-74-74

Электронный адрес: reginfo@straumann.com

/Перевод с английского языка на русский язык/

/Логотип: Straumanngroup/

**/подписано/
«04» июня 2023 г.**

**/Штамп: Straumann
Институт Штрауманн АГ
CH-4002 Базель-Швейцария/**

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

Я, нижеподписавшаяся Жаклин Буркхардт Бертосса, нотариус по гражданским делам в Базеле (Швейцария), настоящим удостоверяю подлинность подписи, проставленной на оборотной стороне, г-ном Джуния Огасавара, гражданином Японии, проживающим в Базеле (Швейцария), рожденного 28 (двадцать восьмого) сентября 1974 (тысяча девятьсот семьдесят четвертого) года, личность которого установлена на основании паспорта, подпись которого я идентифицировала путем сравнения с несомненно подлинной подписью.

ВО СВИДЕТЕЛЬСТВО ЧЕГО проставляю свою подпись и скрепляю настоящий документ печатью в Базеле (Швейцария) 13-го (тринадцатого) июня 2023 (две тысячи двадцать третьего) года.

/Печать: Жаклин Буркхардт Бертосса * Нотариус в Базеле/ /подписано/

Законодательный акт 525/2023

Перевод данного текста выполнен переводчиком Кинах Валентиной Петровной.

Российская Федерация

Город Москва

Восемнадцатого октября две тысячи двадцать третьего года

Я, Квитко Федор Александрович, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Кинах Валентины Петровны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 62/137-н/77-2023-60-1075

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.



Всего пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью 08 лист(а)(ов)

Нотариус

Квитко

