

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Эстетиклазер»




О.В.Киселев

«25» декабря 2019 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Аппарат лазерный неодимовый для косметологических процедур по ТУ 26.60.13-004-20852573-2018

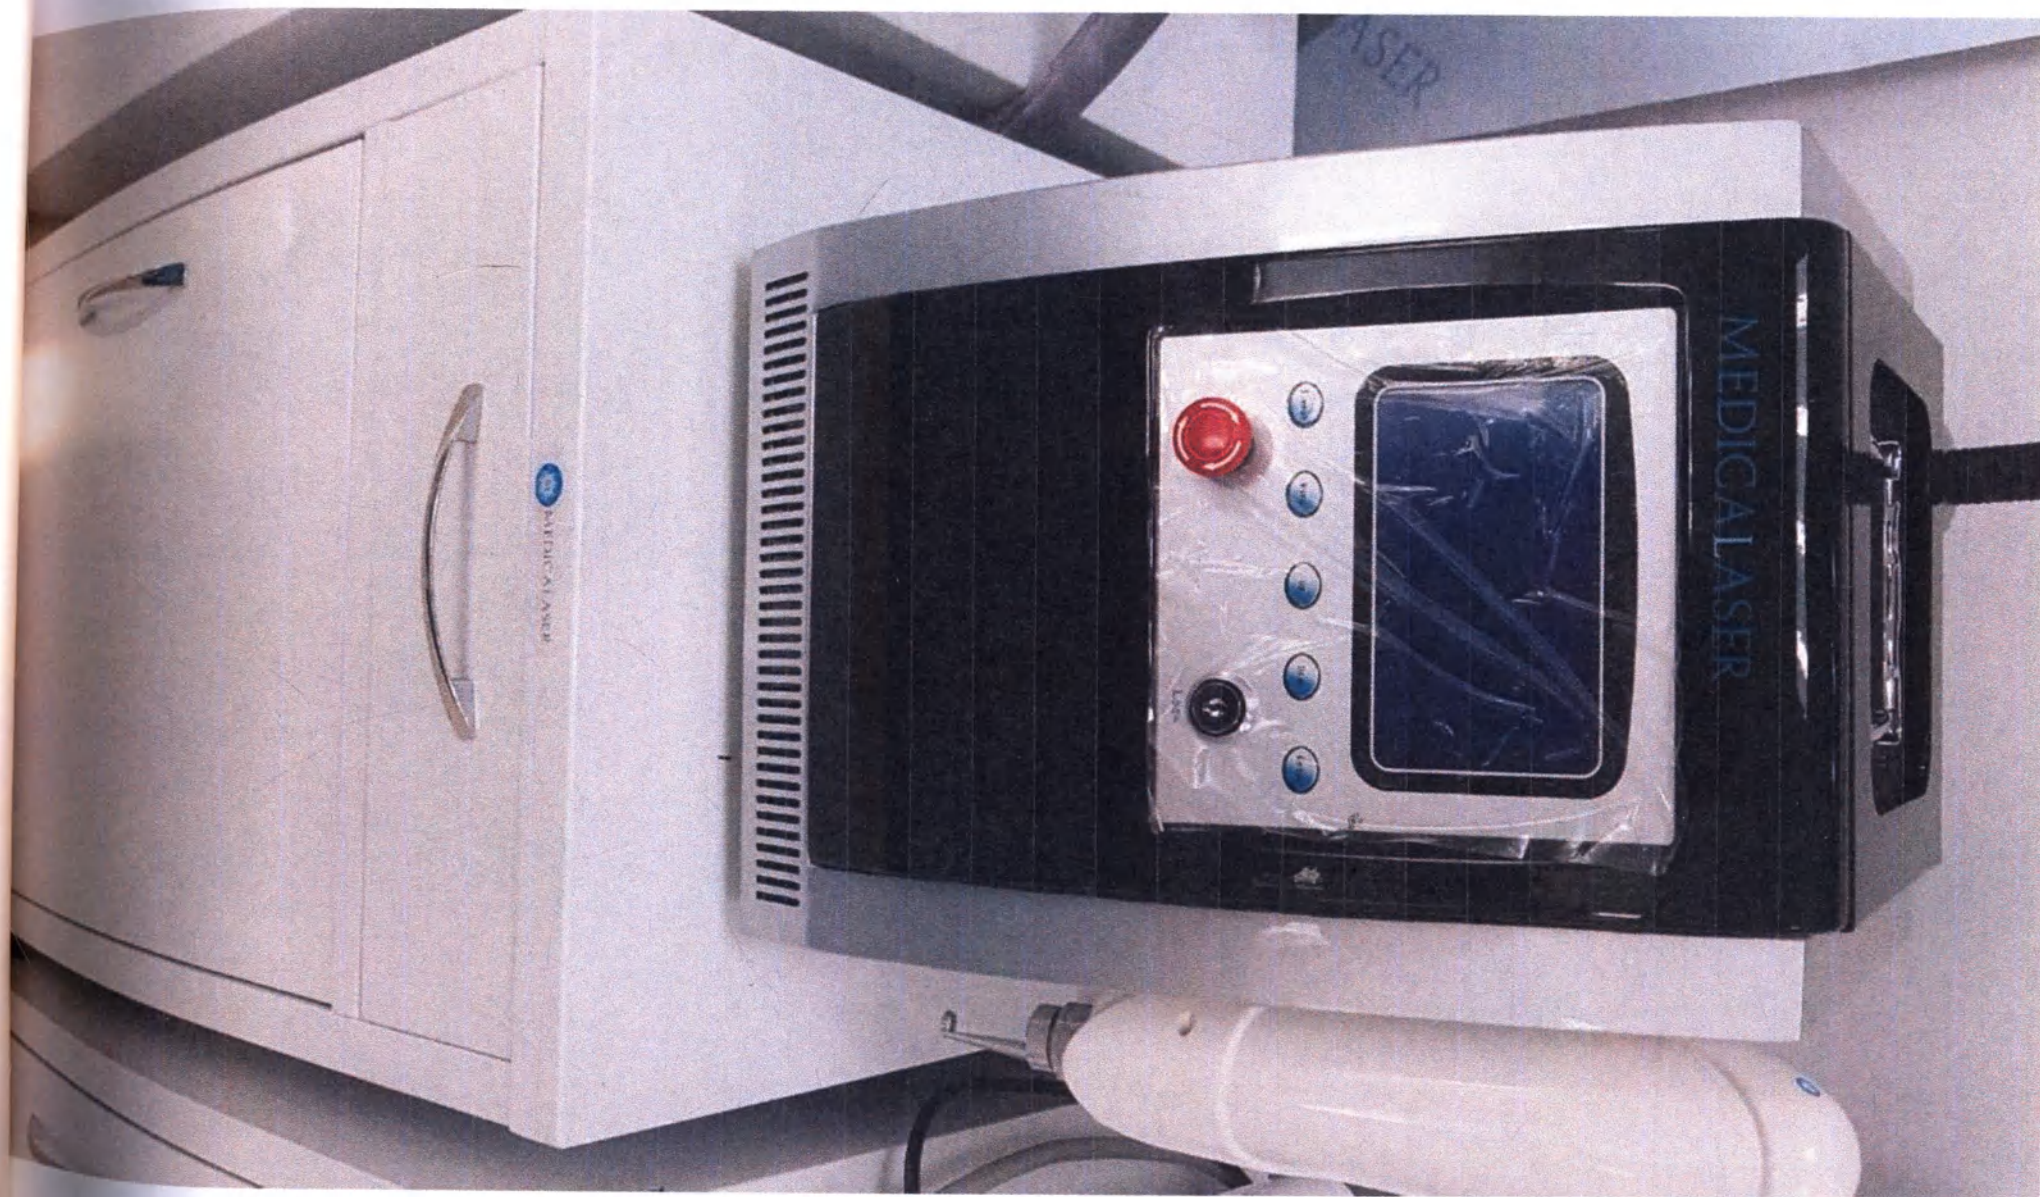




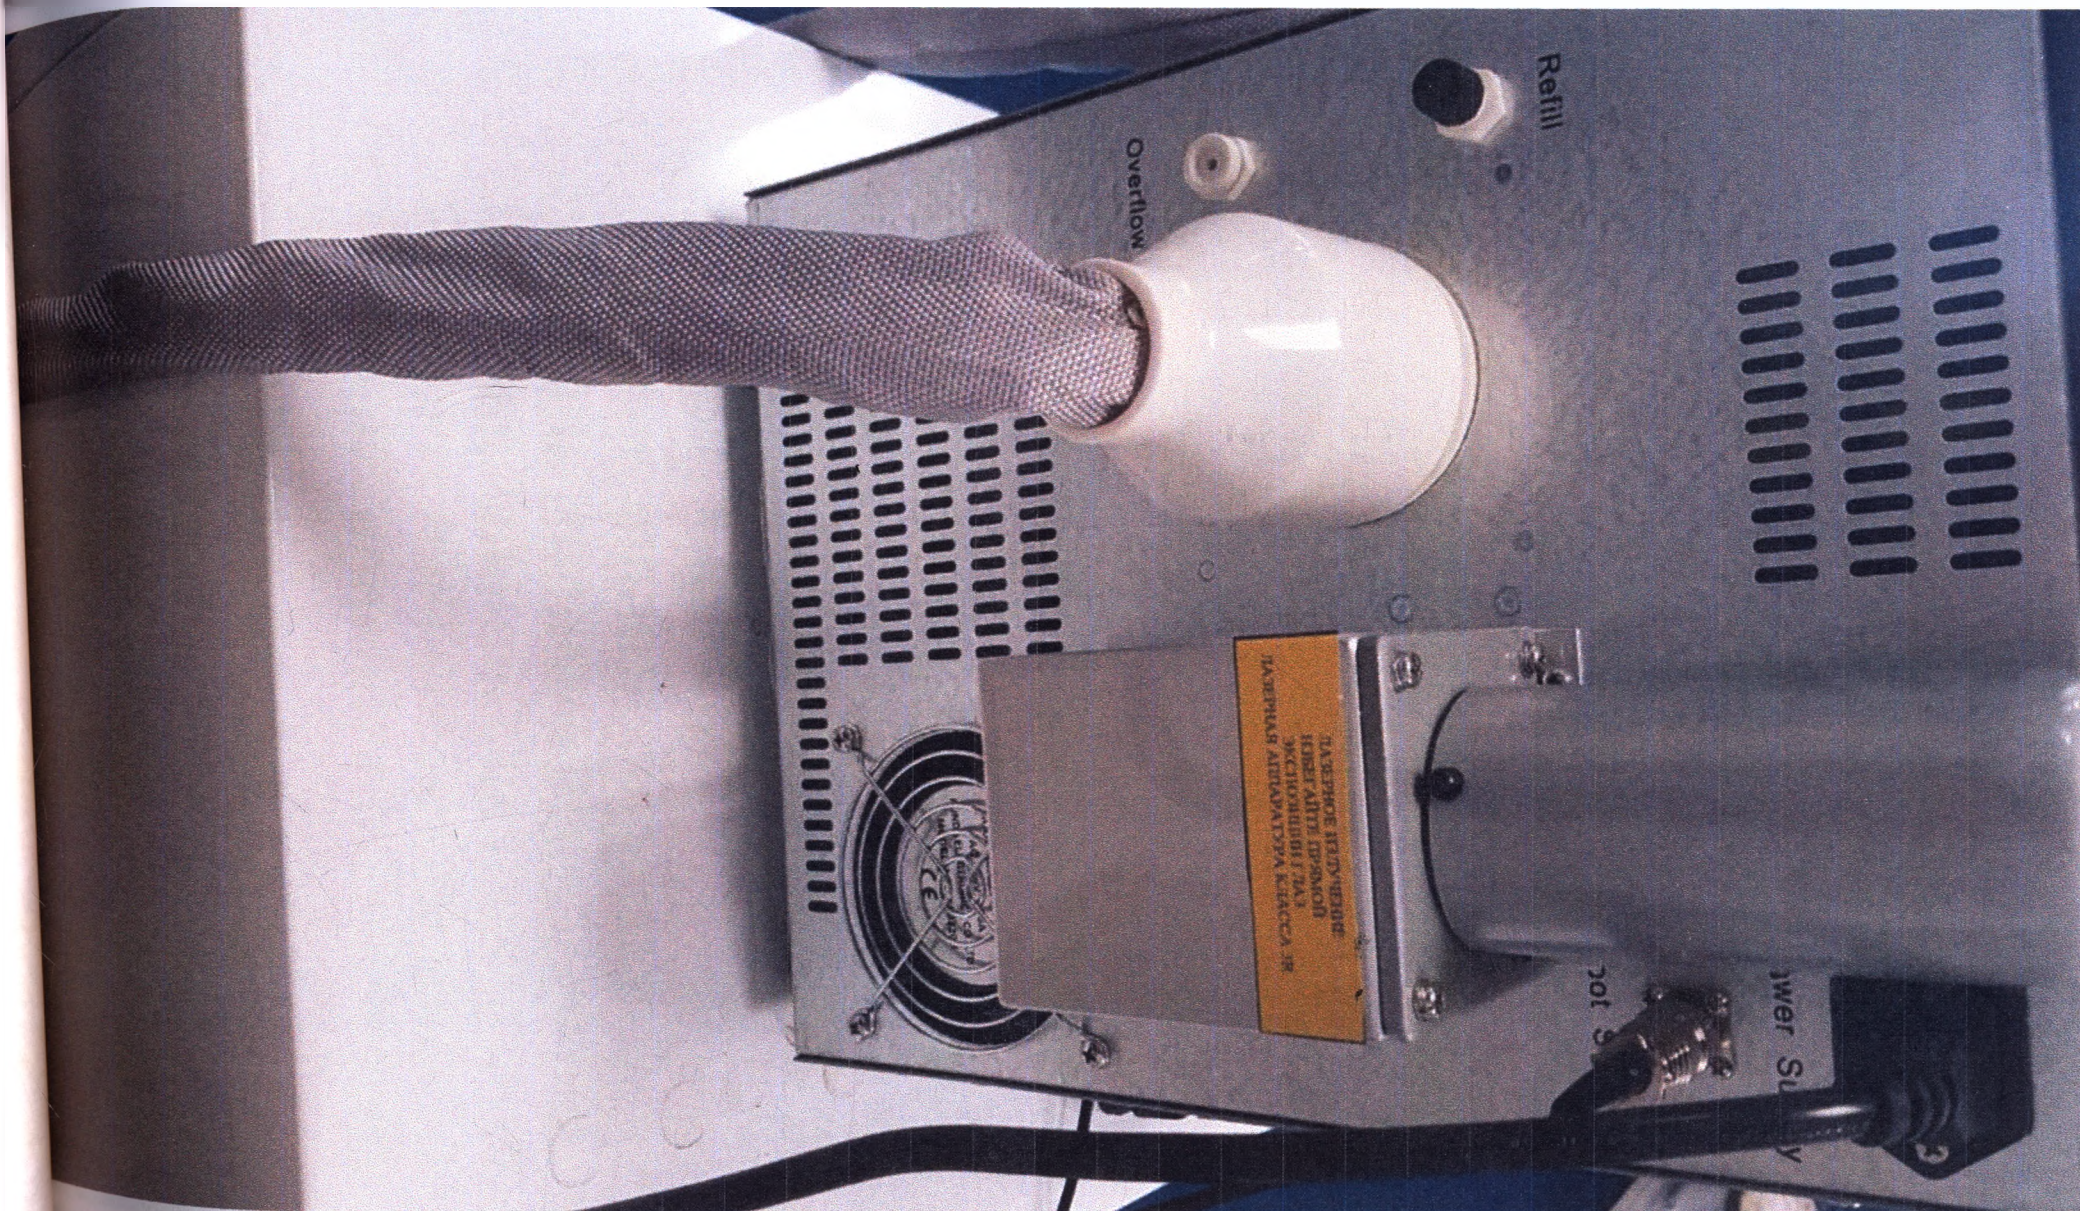


Рис. 3- Вид сзади: Аппарат лазерный неодимовый Medicalaser Nano-Light 9

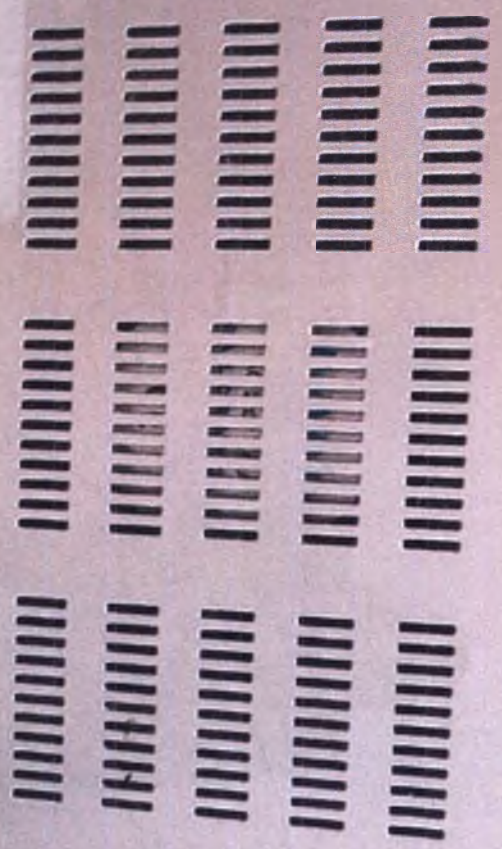

Аппарат лазерный неодимовый для нечетотопических процедур по
ТУ 26.60.13-004.20852573.2019 верный исполнения: Medicalaser Nano-
Light 9 220V-100W-50Hz PV № 07

Сертификат № 000-07-2017

ООО "Эстетикс", РФ, 115142, г. Москва, Космогонская наб., д. 24,
пом. 1, этаж 2

Макс. время активации — 30 минут,
время деактивации — 20 минут

Средний срок службы 8 лет

IP 50

Предельная мощность 600 Вт

SN NL9

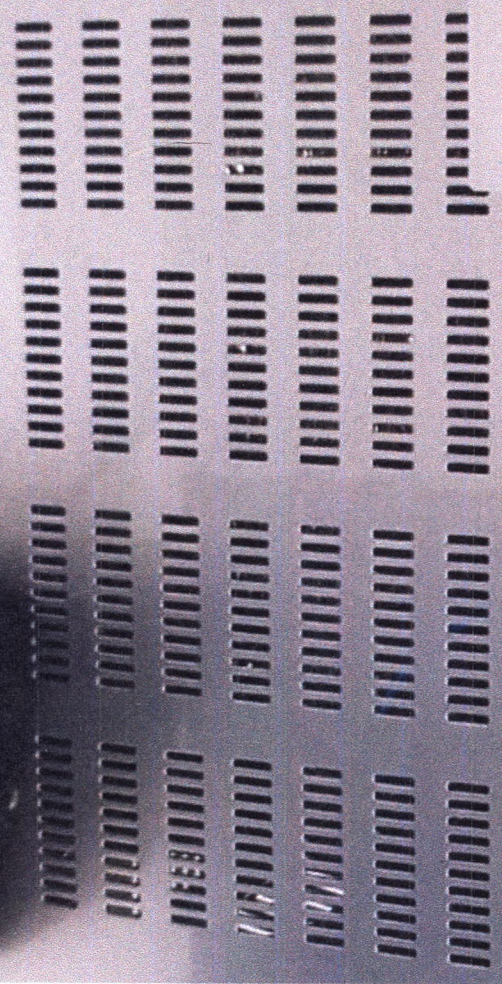


Рис. 4 - Аппарат лазерный неодимовый Medicalaser Nano-Light 9 (Маркировка)



Рис. 5- Общий вид лазерного аппарата: Аппарат лазерный неодимовый Medicalaser Nano-Light 10

86313
26122019

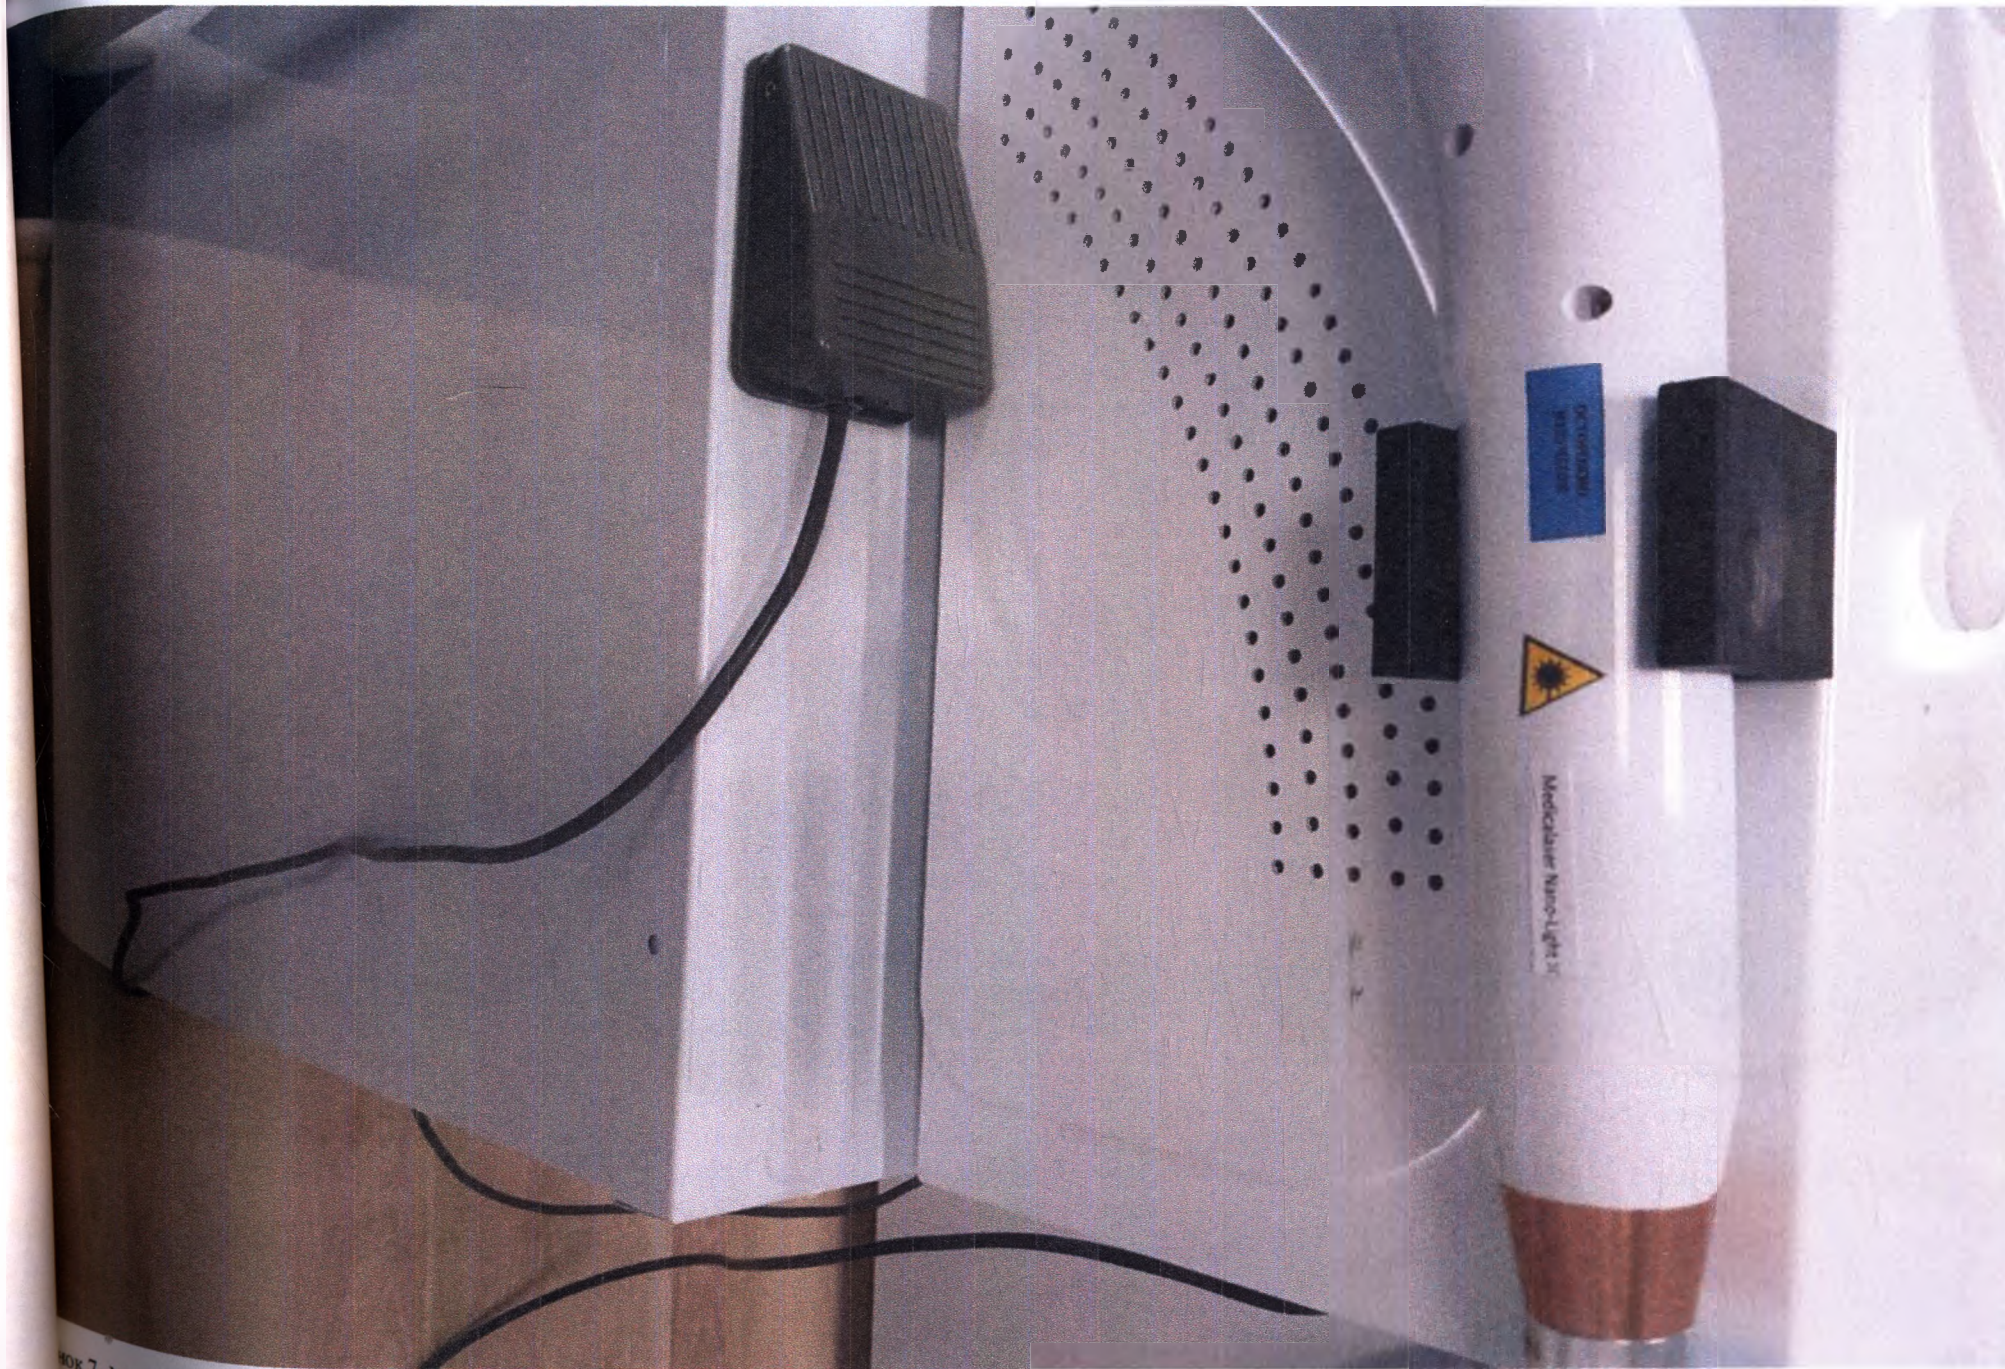




Рис. 8 – Общий вид лазерного аппарата: Аппарат лазерный неодимовый Medicalaser Nano-Light 12



НАЗНАЧЕНИЕ
ПОДЪЕЗДАЮЩИХ
ПОСРЕДСТВОМ
НАЗНАЧЕНИЯ
НАЗНАЧЕНИЯ

Аппарат лазерный неодимовый для косметологических процедур
ТУ 26.60.13-004-20052573-2018 аппарат неодимовый. Медицинский
Лазер 12 220-100, 500 Вт РХ № 017
Серийный номер 017 2017
ООО "Экспозитив", РФ, 115142, г. Москва, Каширский наб., д. 24,
ком. 1, этаж 2
Срок службы изделия - 10 лет
Срок гарантии - 20 месяцев

IP 50

Вид сзади: Аппарат лазерный неодимовый Medicalaser Nano-Light 12

Foot Switch

Power Supply

REPAIR SERVICE NOT
GRANT THE SEAL
BE TORE

11 & Drain

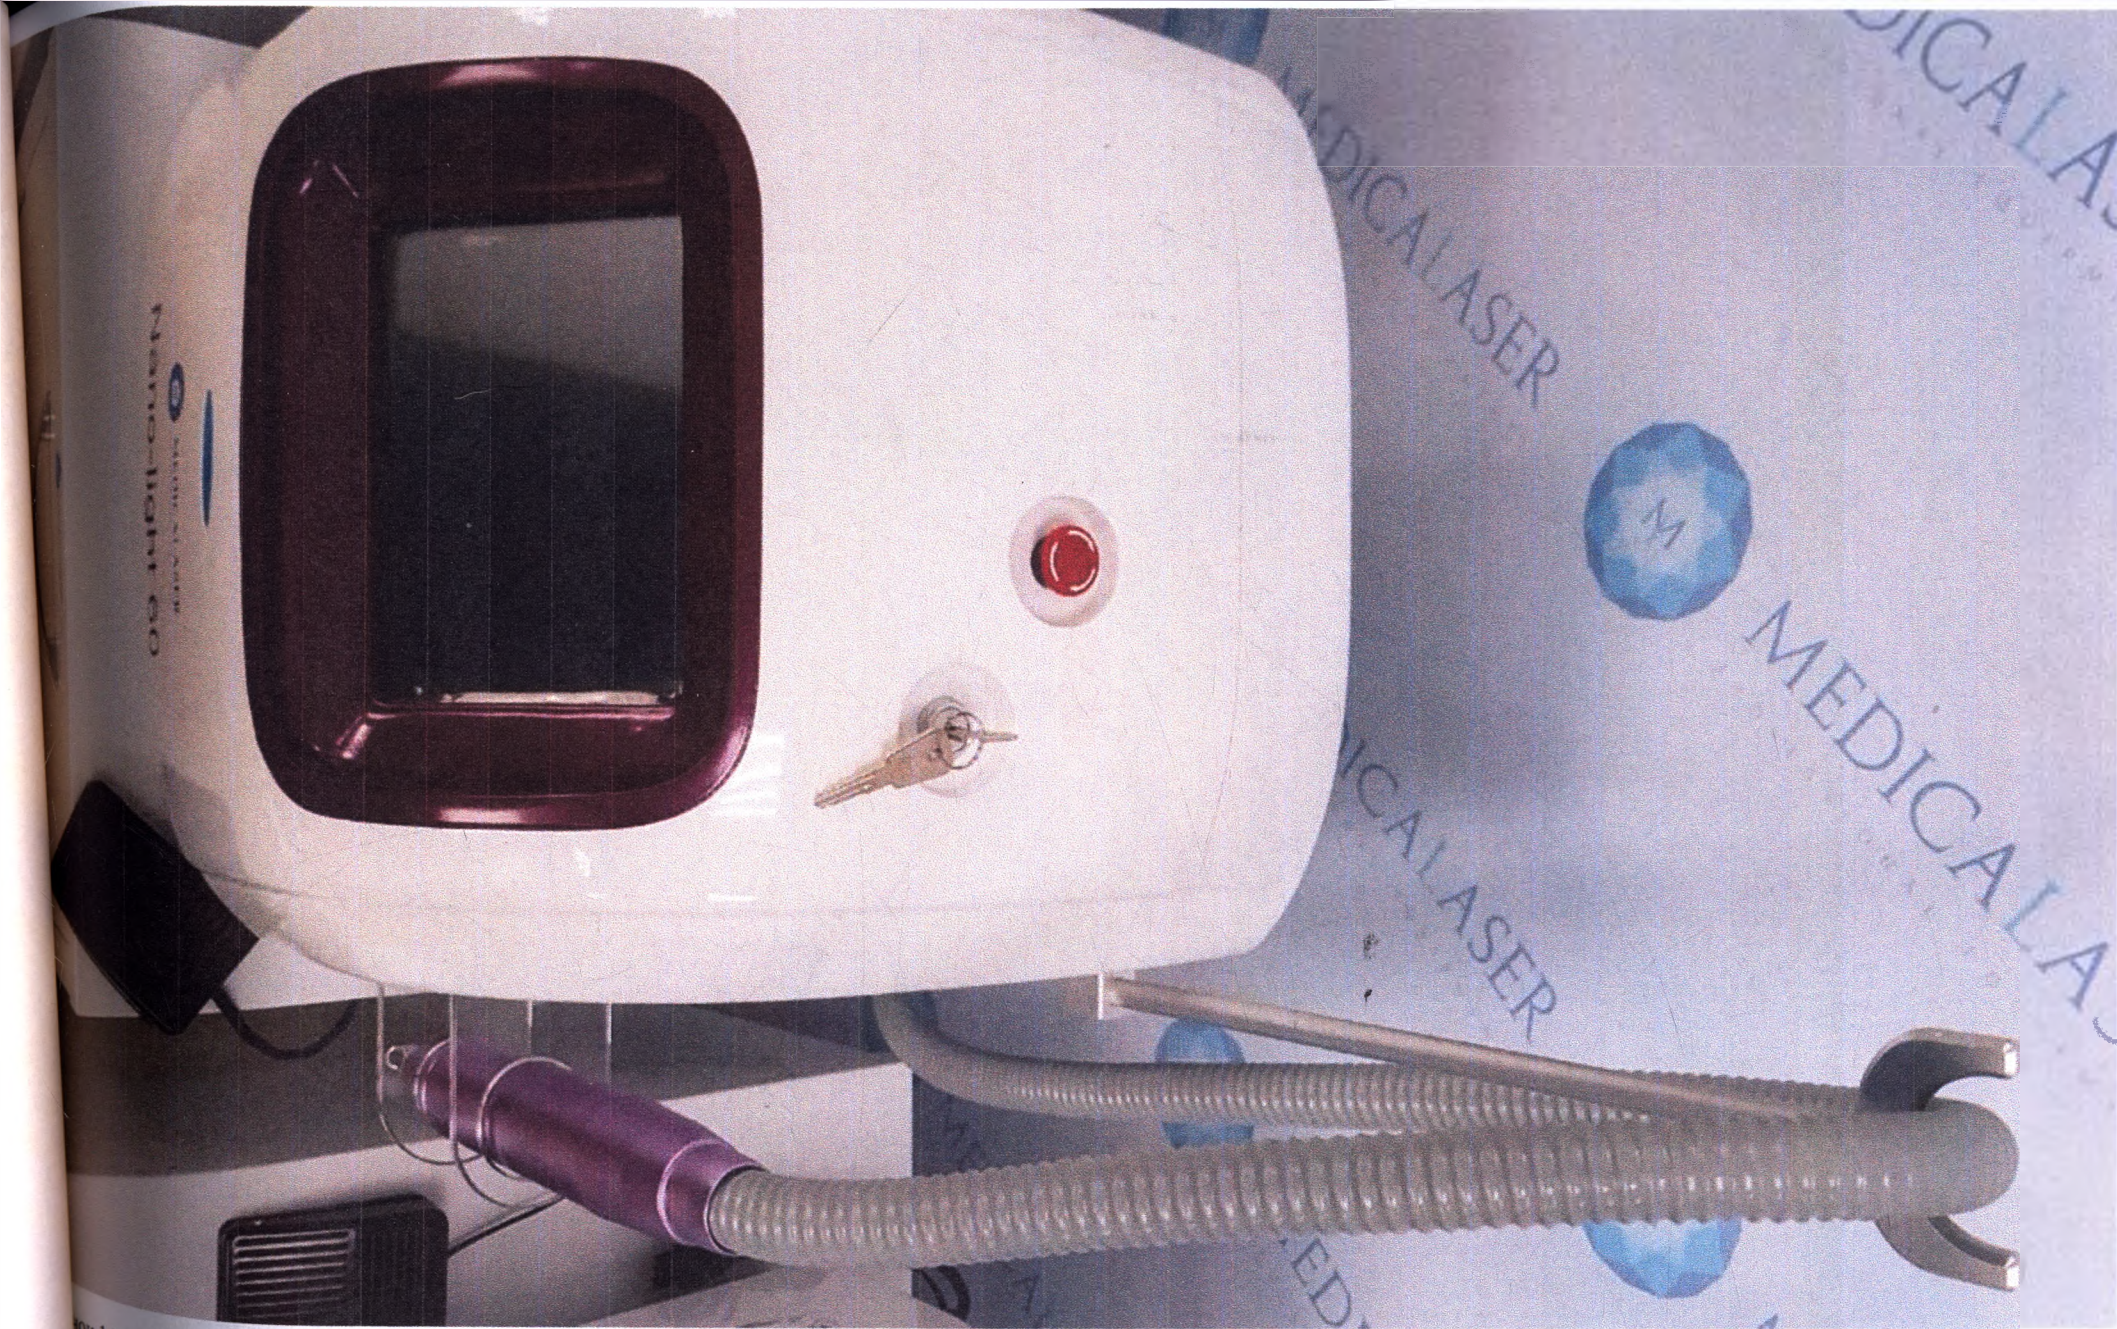


Рис. 11 – Общий вид лазерного аппарата: Аппарат лазерный неодимовый Medicalaser Nano-Light 100

Аппарат — первый неинвазивный для косметологических процедур по
 TS 26 60.13.004.20852573.2018 наливает исследование: Medicalaser Nano-
 Light 100, 507U, RU №... от
 Попробуйте мощность 600 Вт
 NL 100
 07.2017
 ООО "Здоровье", Р/О: 115142, г. Москва, Коммунальная фаб. 1, 24,
 100% 1, 100% 2
 Срок службы аппарата — 20 лет
 Срок службы аккумулятора — 20 лет
 Средний срок службы 1 лет


НАЗНАЧЕНИЕ
 ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
 ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
 ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ


FILL




03613
 26.12.2019

Вид сзади: Аппарат лазерный неодимовый Medicalaser Nano-Light 100



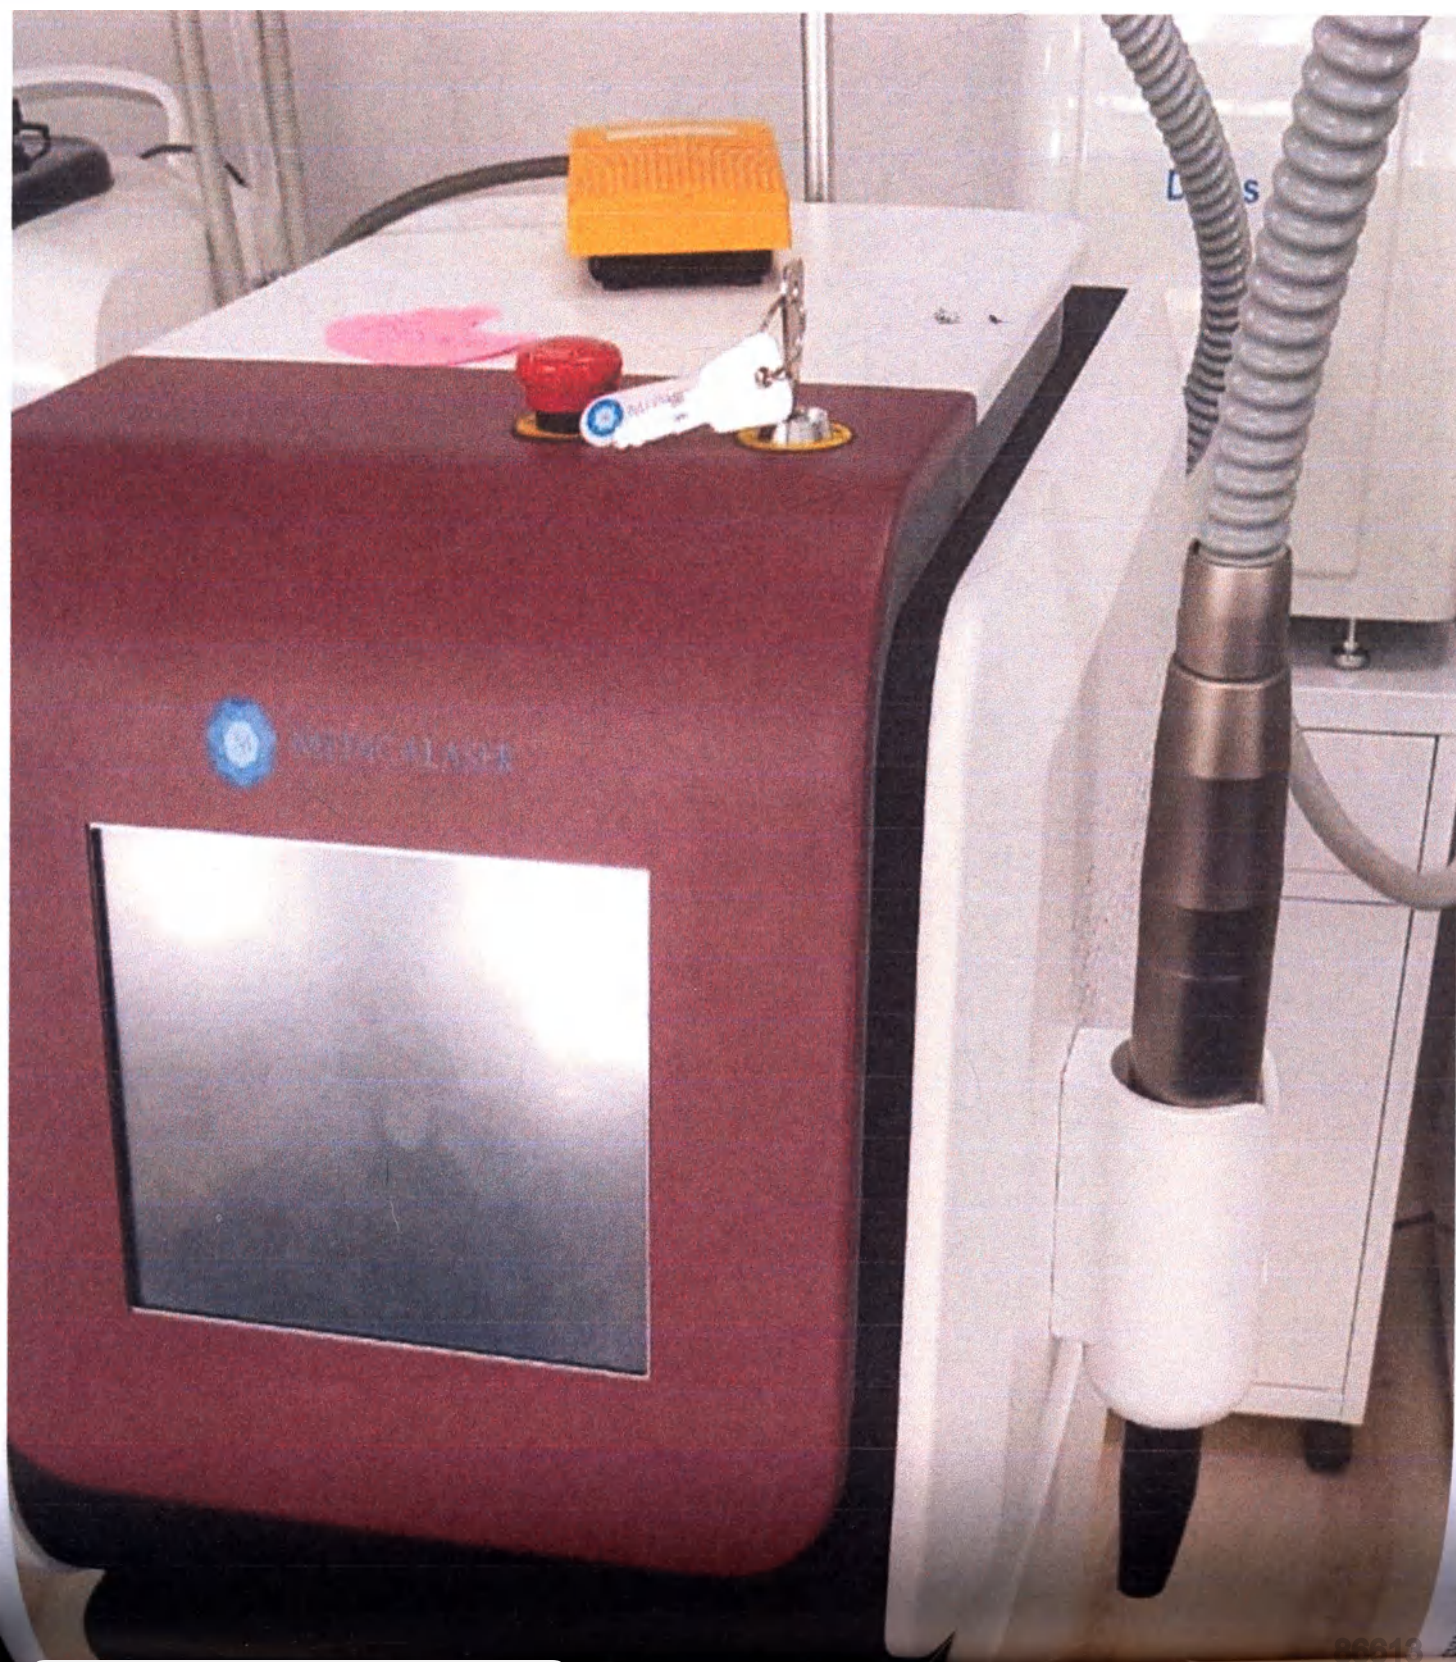

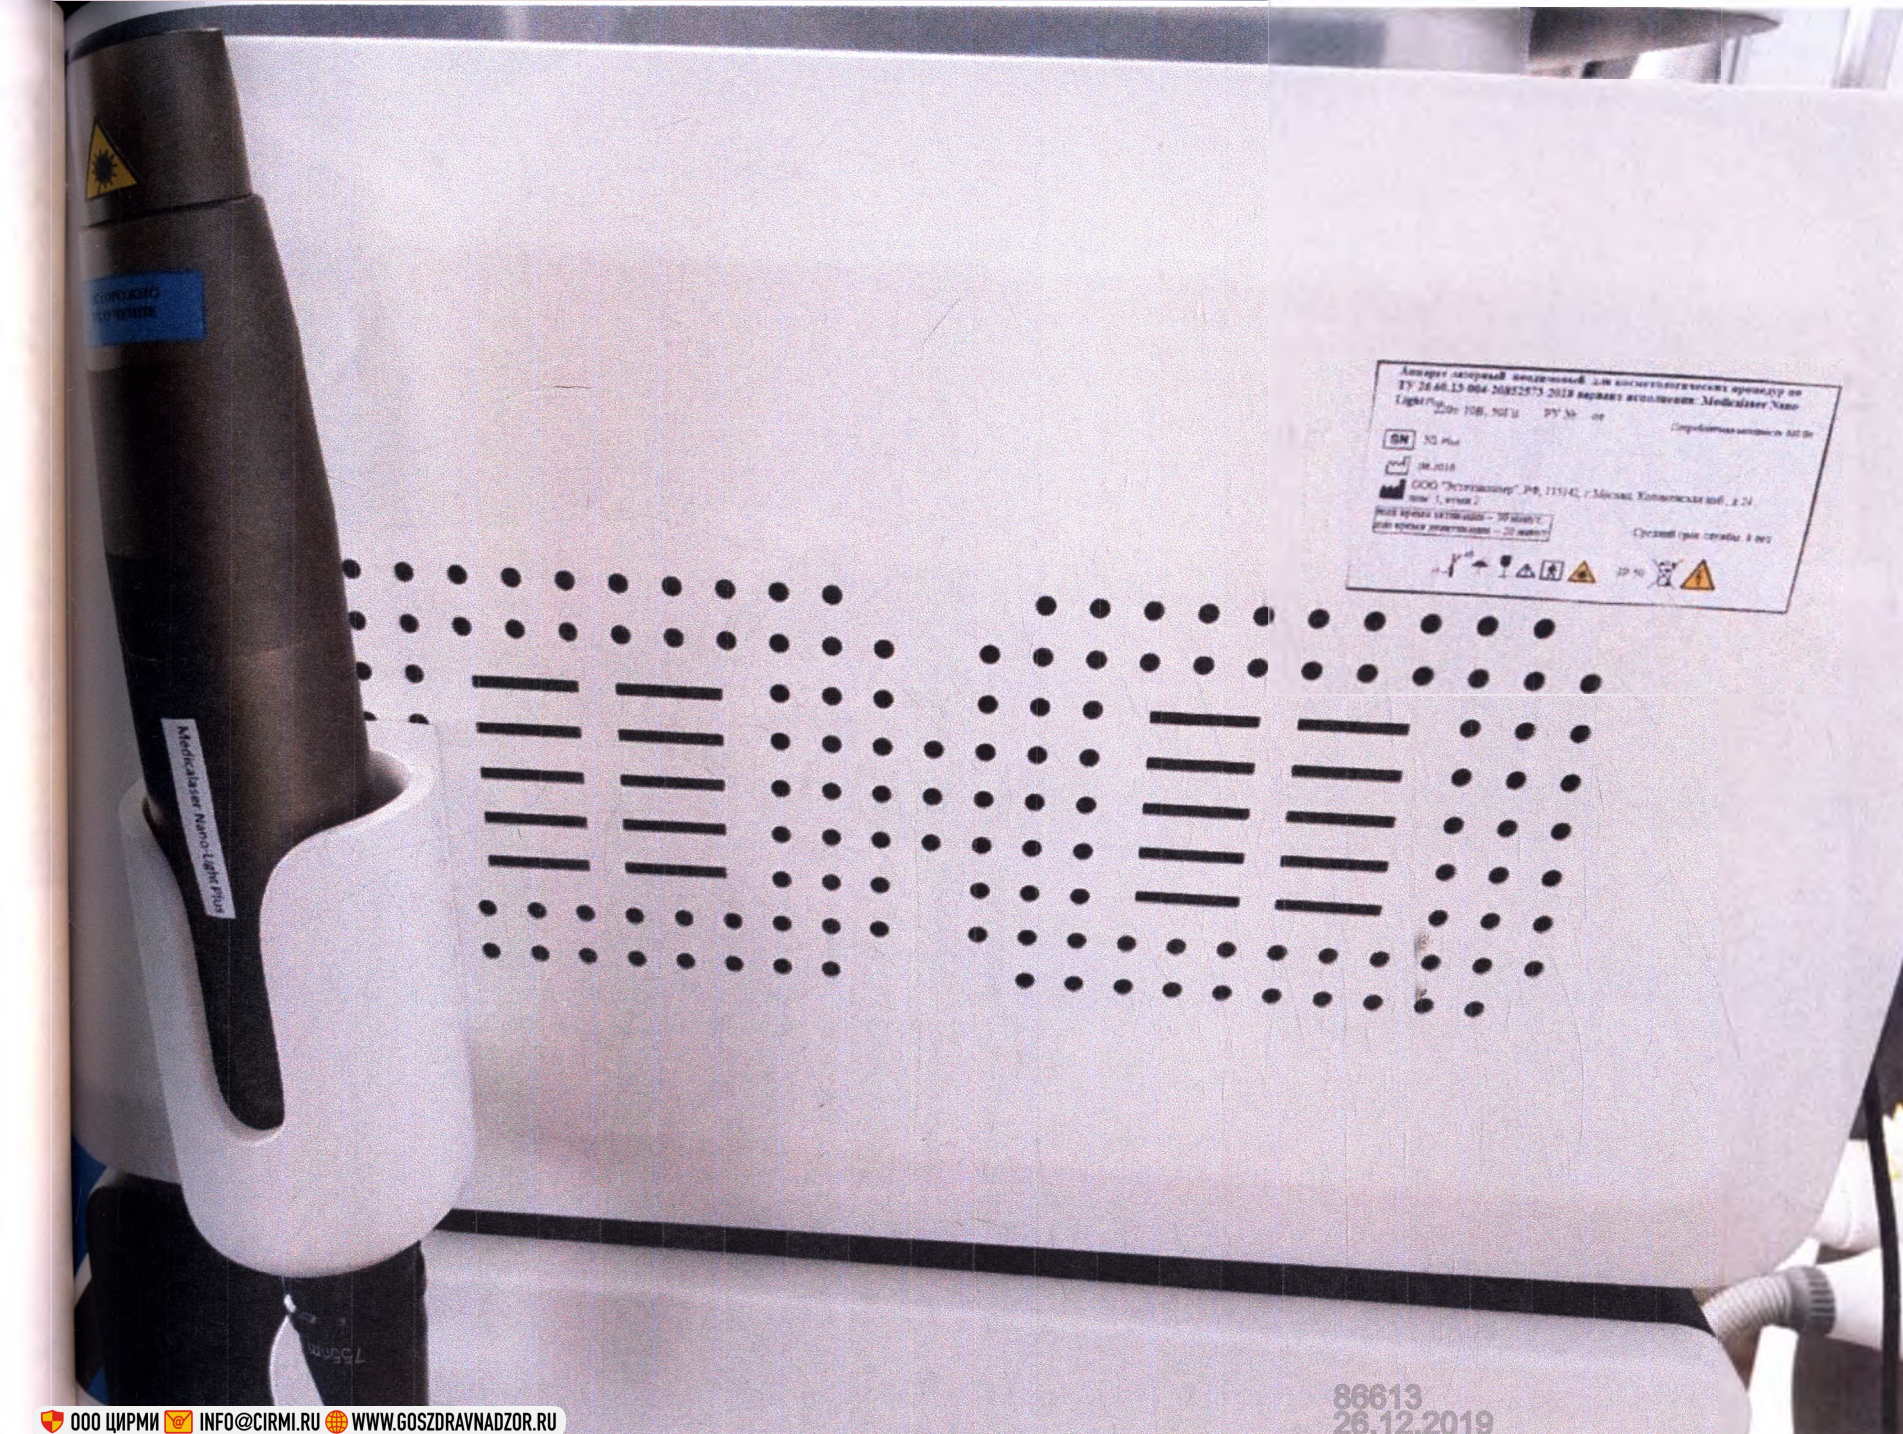

Аппарат лазерный неодимовый для косметологических процедур по
ТУ 24.46.15.004-2002/2573-2018 вариант исполнения: Medicalaser Nano-
Light Plus
Зав. ТОВ, ПОС. ПУ № 08 Сертификат соответствия АЛ 01

SN 86.613
08.2018
ООО "Цирми", РФ, 115142, г. Москва, Калужская обл. д. 24
этаж 1, этаж 2
Время работы непрерывное - 30 минут
Время работы импульсное - 20 минут

Срок службы от даты выпуска 8 лет

IP 50





ОСТОРОЖНО
ИЗЛУЧЕНИЕ

Аппарат имеет сертификат на соответствие требованиям
ГОСТ Р 51684-2014 (ГОСТ 51684-2014) и является безопасным для жизни и здоровья
человека. Технические характеристики:
Модель: XXXX
Серийный номер: 123456789
Год выпуска: 2018
Гарантия: 3 года
Срок службы: 10 лет
Энергопотребление: 100 Вт
Масса: 10 кг
Объем: 10 л

ВНИМАНИЕ
НЕ ПОДНИМАТЬ
АППАРАТ ЗА РУКОВОДСТВО
ИЛИ ЗА СЕРВИС



AC220V/50Hz



Water input

Overflow

Add water & in the machine

Keep the plug inserted

Remote Intra







86613
26.12.2019



VENT

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНО
ЭЛЕКТРОМАНИПУЛЯЦИИ
ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 3B

ОСТОРОЖНО
ИЗЛУЧЕНИЕ

Аппарат лазерный неодимовый для косметологических процедур по
ТУ 26.60.15-004-20852573-2018 вариант исполнения: Medicalaser Nano-
Light 40, 220v 100, 50Гц PV:30, от Потребляемая мощность 400 Вт

SN NL40

08.2019

ООО "Эстетиксизер", РФ, 115147, г.Москва, Каширская наб., д.54,
пол. 1, комн.2

пол. время активации - 30 минут,
пол. время деактивации - 20 минут

Средний срок службы: 5 лет



220V~50/60HZ

Foot Sw.

REFILL
DRAIN

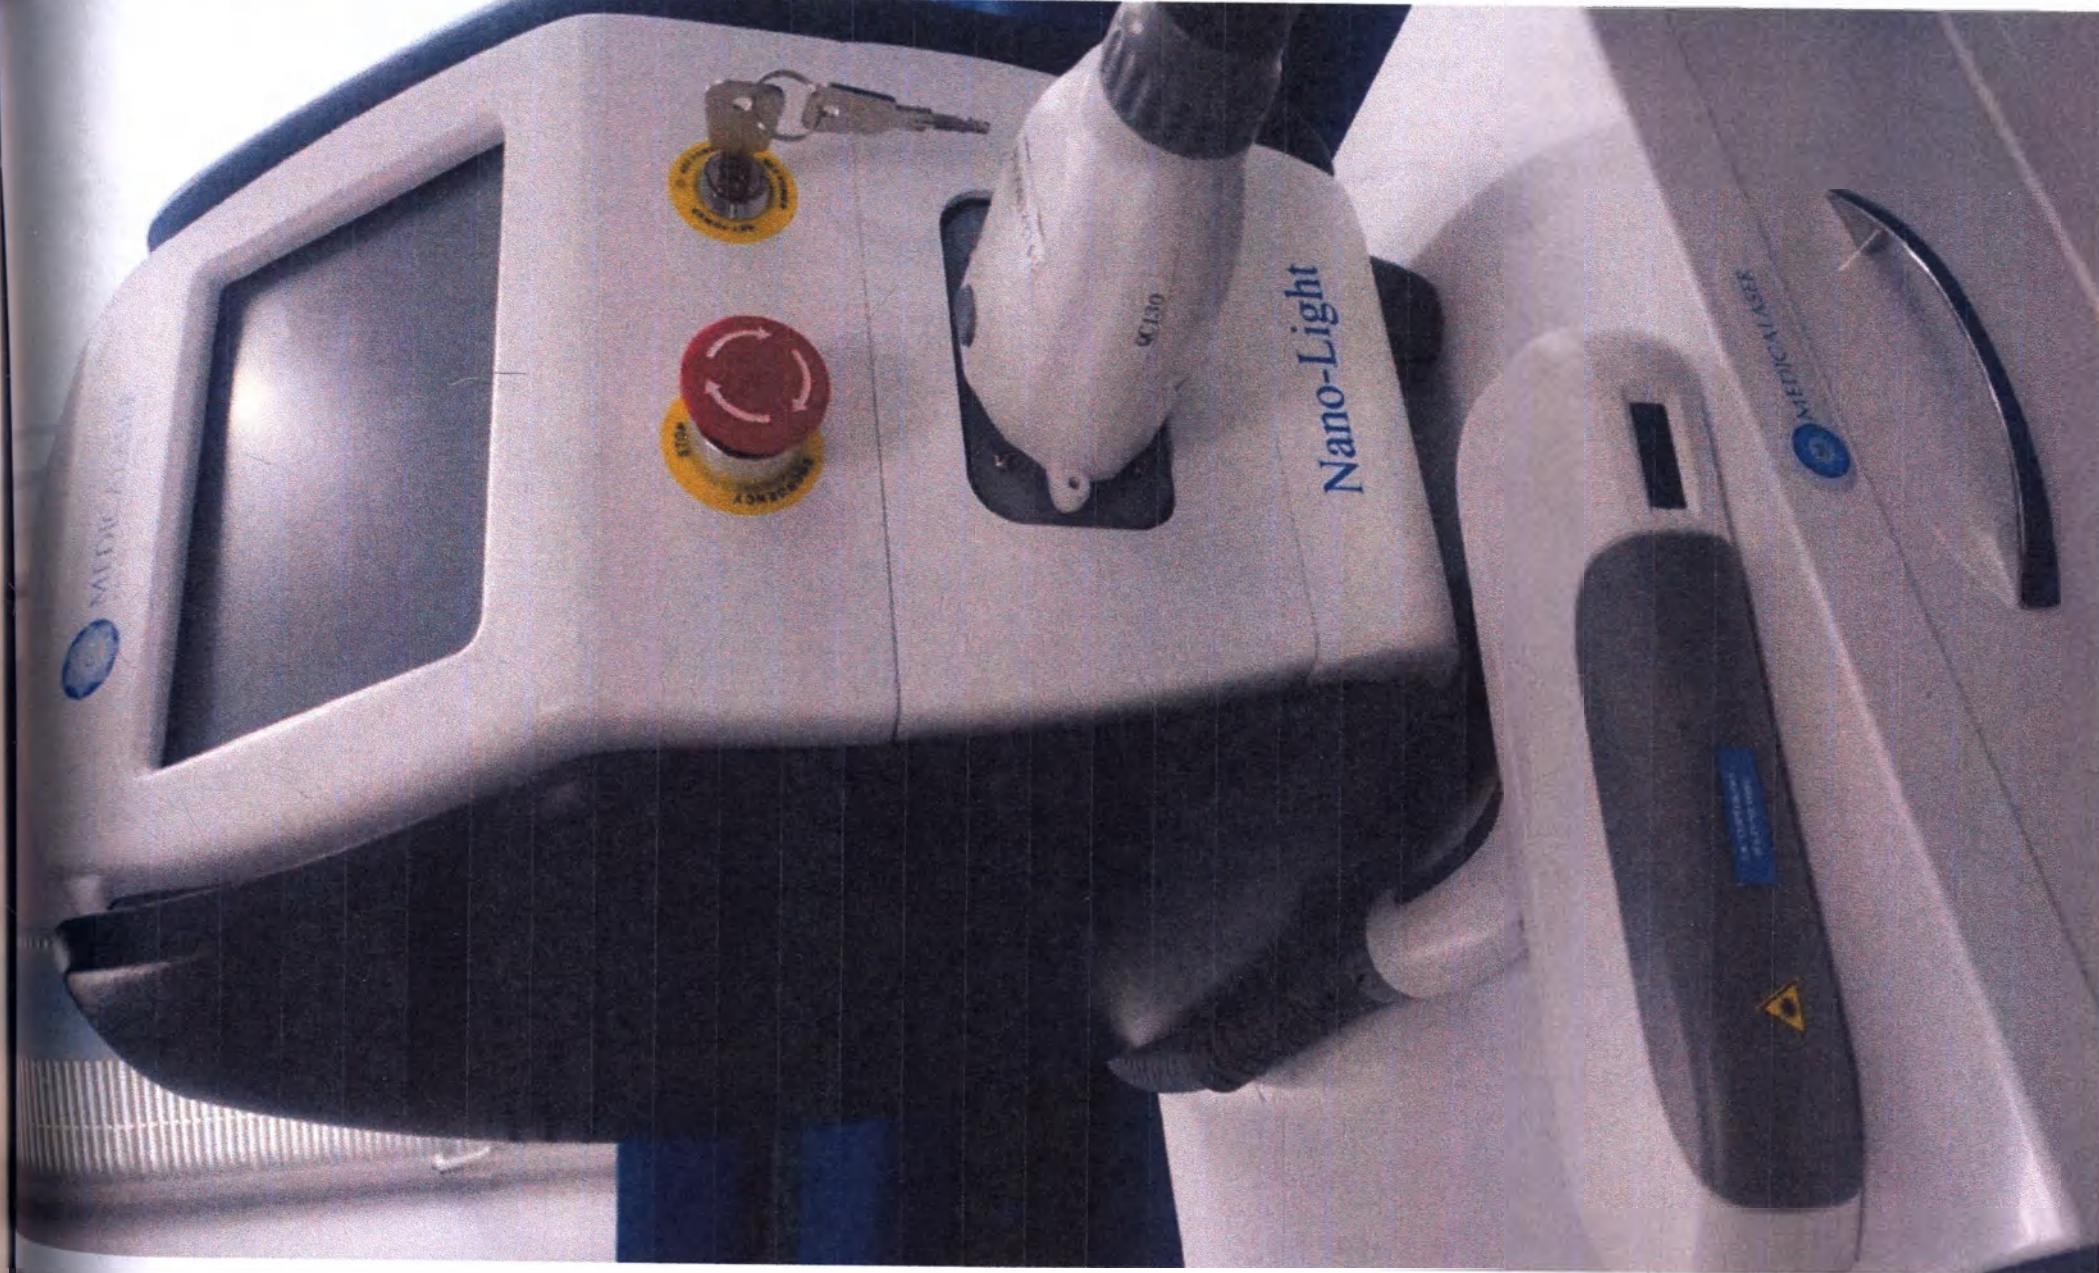


Рисунок 23 – Общий вид лазерного аппарата: Аппарат лазерный неодимовый Medicalaser Nano-Light 50

Аппарат лазерный неодимовый для косметологических процедур по
 ЛП 36.66.13.004-2016 приказом введённым Минздрава РФ
 № 188, от 18.04.16 г. Сер. №: 01
 Подпись: [подпись]

SN 08.2016
 08.2016
 ООО "СтильСтор", Р/о, 115114, г. Москва, Коломенская ул., д. 24,
 пом. 1, 4-й этаж
 Дата выпуска из производства - 20.10.2017
 Срок службы изделия - 20 лет
 Срок гарантии - 20 лет

IP 50

Осторожно
 Излучение

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
 НЕБЕЗОПАСНО ДЛЯ ЗНАЧЕНИЯ КЛАССА IIR
 ЗАЩИЩАЮЩАЯ АППЕРАТУРА КЛАССА IIR



Power S/W

AC220V 50Hz

Foot S/W

Vent

Injection Water
 Draining Water





Рис. 26 – Общий вид лазерного аппарата: Аппарат лазерный неодимовый Medicalaser Nano-Light 200

Medicalaser Nano-Light 200

ОСТОРОЖНО
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ





ПЕРВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ПРЕСТАВЛЯЕТ СЕБЕ
ЭКСПОЗИЦИОННУЮ
ПОВЕРХНУЮ АППАРАТУРА КЛАССА 3B

Аппарат лазерный неодимовый для косметологических процедур по
ТУ 26.60.13-004-20852573-2018 вариант исполнения: Medicalaser Nano-
Light20, 220±10В, 50Гц РУ №... от Гидравлическая мощность 600 Вт

SN NL 20

08.2018
ООО "ЭстетикЛазер", РФ, 115142, г. Москва, Холмогорская пбл. д.24.


пом. 1, кодмд. 2

Средний срок службы: 8 лет
Гарантийный срок эксплуатации - 30 месяцев
Гарантийный срок службы - 20 месяцев








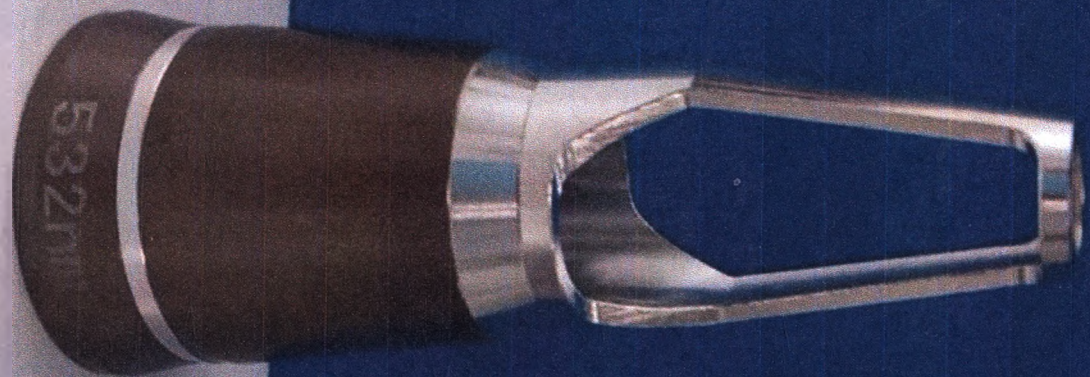

533 – Насадка 532 нм для всех вариантов исполнения аппаратов

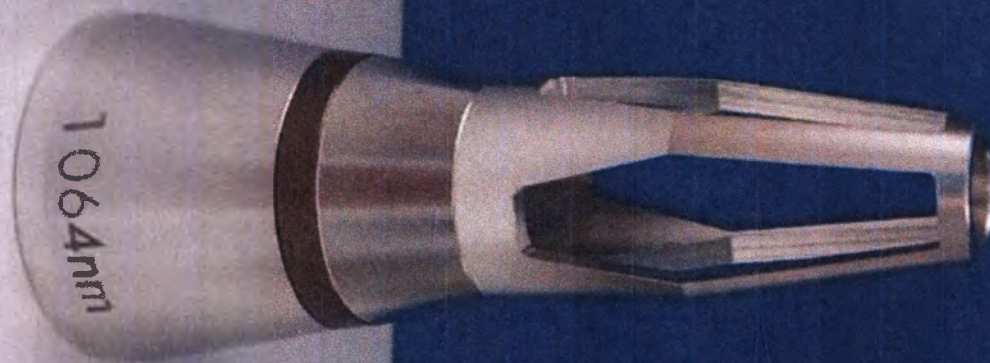

1064 - Насадка 1064 нм для всех вариантов исполнения аппаратов



к 35 – Насадка 1320 нм для всех вариантов исполнения аппаратов



36- Ножной выключатель для всех





к 38 – Лейка с трубкой для всех вариантов исполнения аппаратов



39 – Очки защитные для доктора и пациента для всех вариантов исполнения аппаратов

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «ЭстетикаЛазер»
О.В.Киселев
« » 2018 г.

Руководство по эксплуатации совмещенное с паспортом
АППАРАТ ЛАЗЕРНЫЙ НЕОДИМОВЫЙ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР

