




УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО Компания «ТерраМед»

Василиотти К.А.
«13» июня 2023 г.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ,
МАРКИРОВКА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации по ТУ 32.50.50-005-01432322-2023


1. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 120°C/45 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., класс 6 (общий вид)

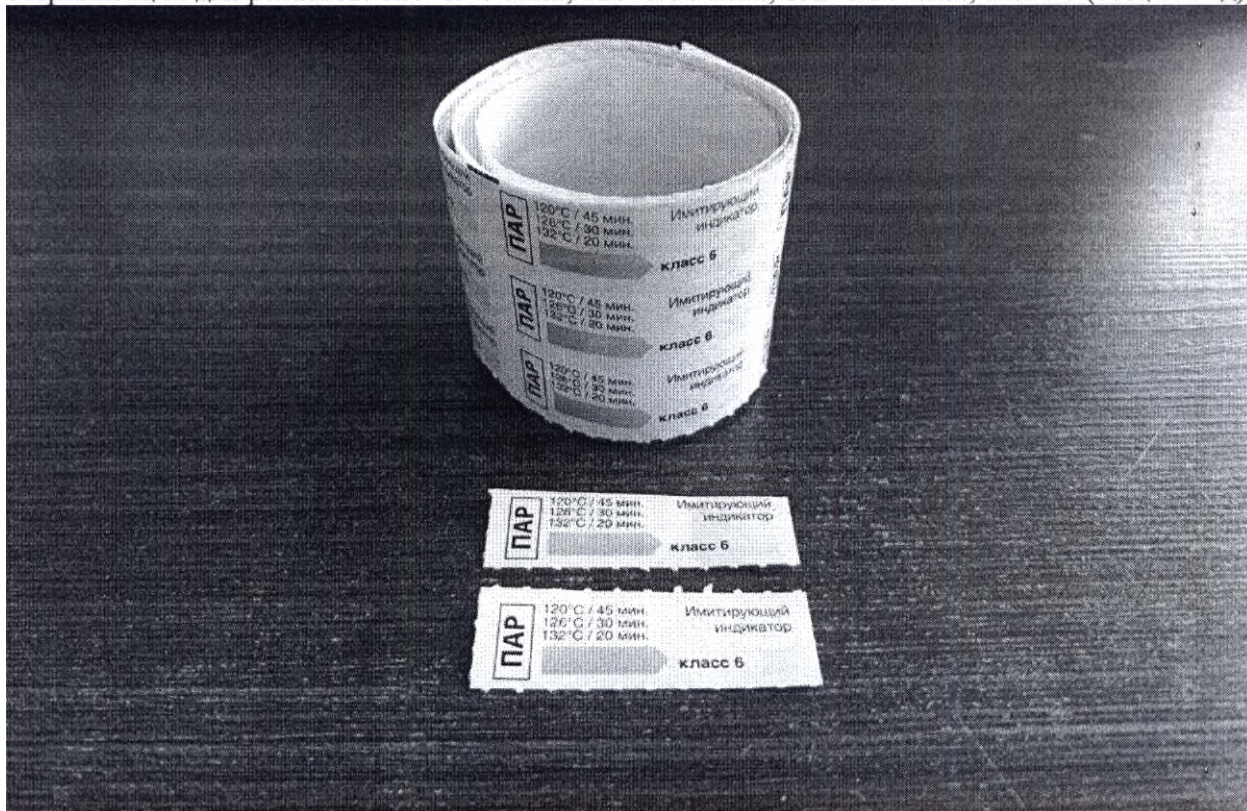

2. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 120°C/45 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

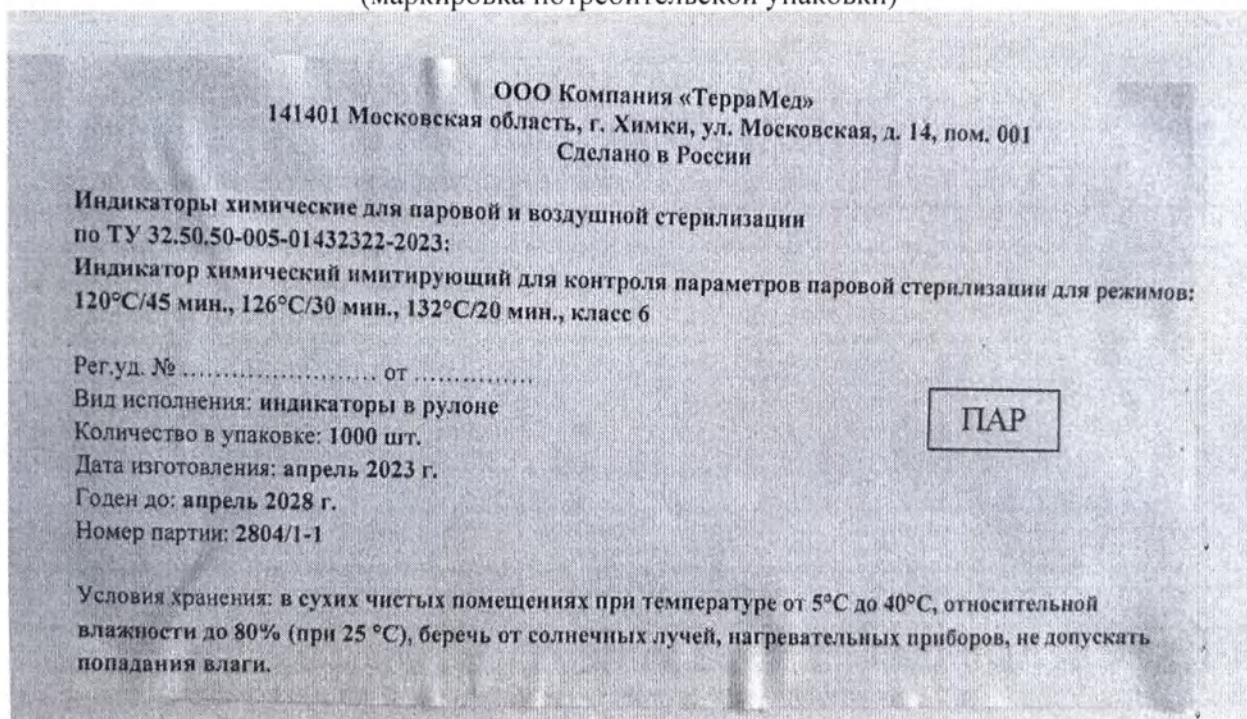

3. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., класс 6 (общий вид)

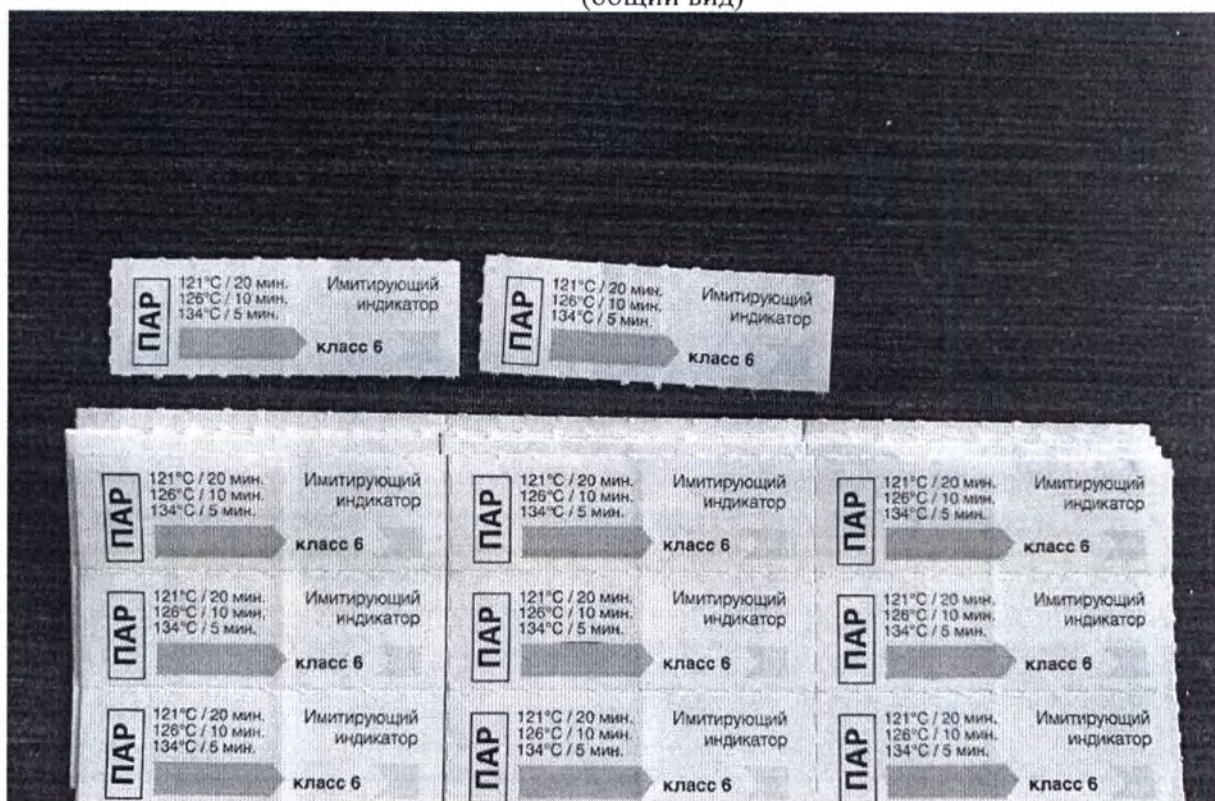

4. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации
по ТУ 32.50.50-005-01432322-2023:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:
121°C/20 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: индикаторы на листе

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2023 г.

Голен до: апрель 2028 г.

Номер партии: 2804/1-2


ПАР

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

5. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C 25 мин., 126°C/20 мин., 134°C/10 мин., класс 6 (общий вид)




6. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C 25 мин., 126°C/20 мин., 134°C/10 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

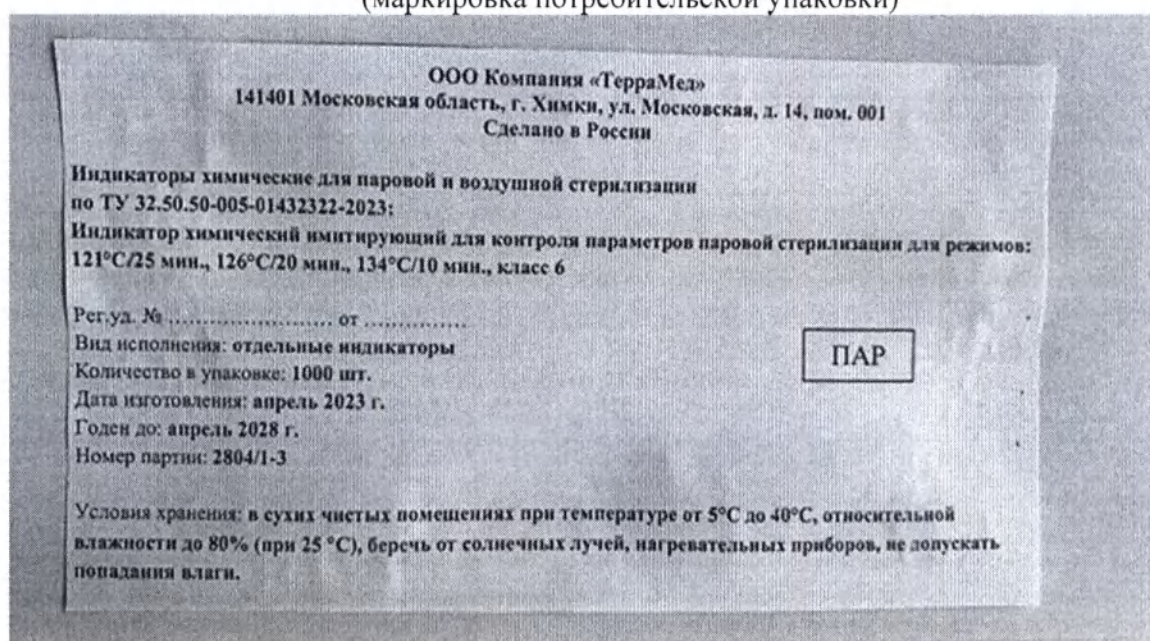


7. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/30 мин., 126°C/25 мин., 134°C/12 мин., класс 6 (общий вид)



8. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/30 мин., 126°C/25 мин., 134°C/12 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

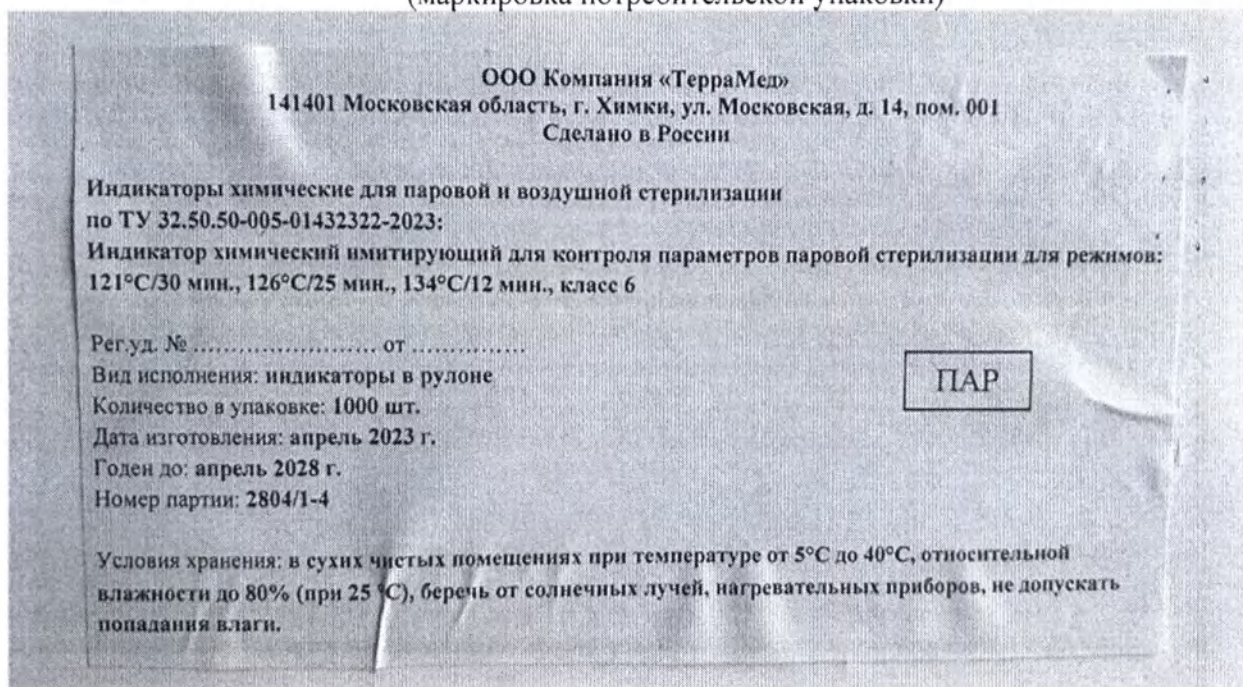

9. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/35 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., 134°C/14 мин., класс 6 (общий вид)

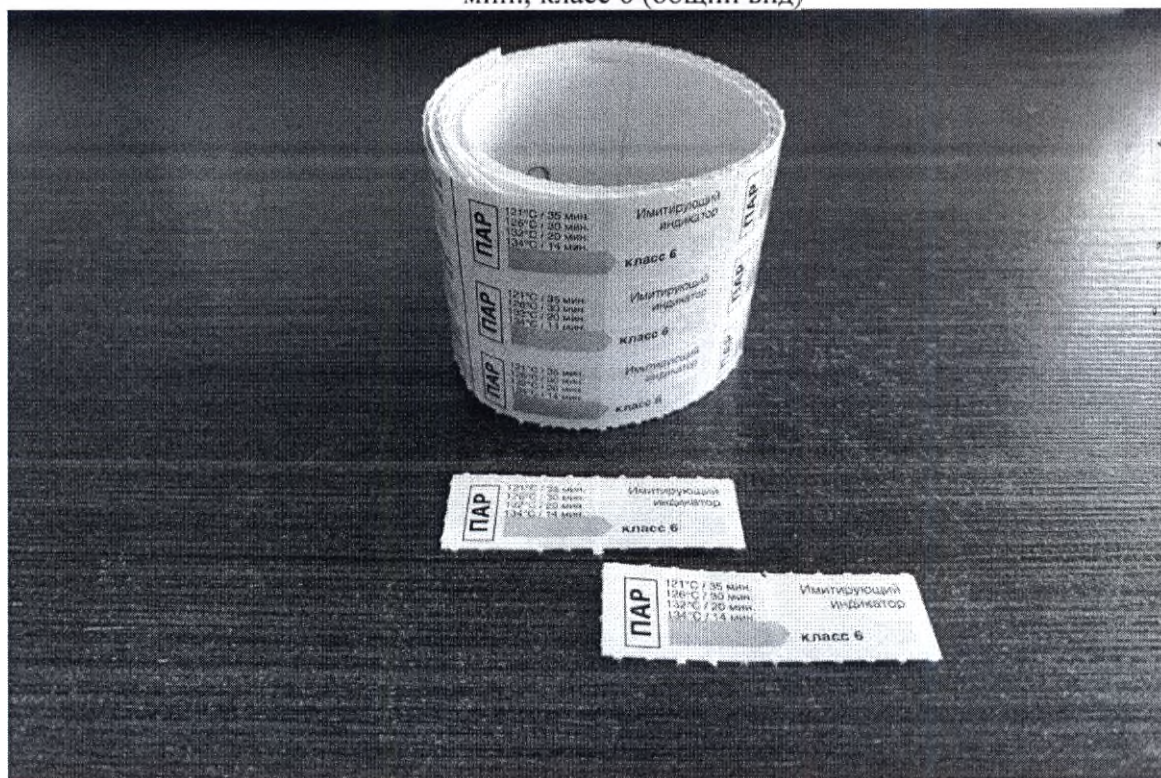

10. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/35 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., 134°C/14 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой и воздушной стерилизации по ТУ 32.50.50-005-01432322-2023:
Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/35 мин., 126°C/30 мин., 132°C/20 мин., 134°C/14 мин., класс 6

Рег.уд. № от
Вид исполнения: отдельные индикаторы
Количество в упаковке: 1000 шт.
Дата изготовления: апрель 2023 г.
Годеи до: апрель 2028 г.
Номер партии: 2804/1-5


ПАР

Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать попадания влаги.

11. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/60 мин., 126°C/45 мин., 132°C/30 мин., 134°C/20 мин., класс 6 (общий вид)




12. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/60 мин., 126°C/45 мин., 132°C/30 мин., 134°C/20 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

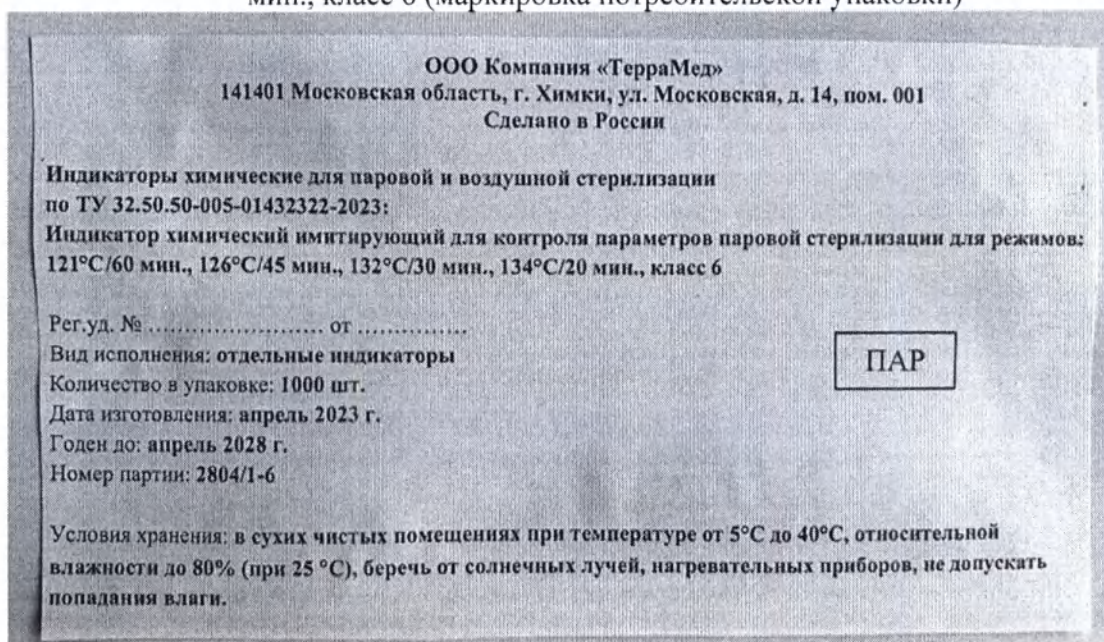


13. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/15 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., 143°C/1 мин., класс 6 (общий вид)




14. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/15 мин., 126°C/10 мин., 134°C/5 мин., 143°C/1 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

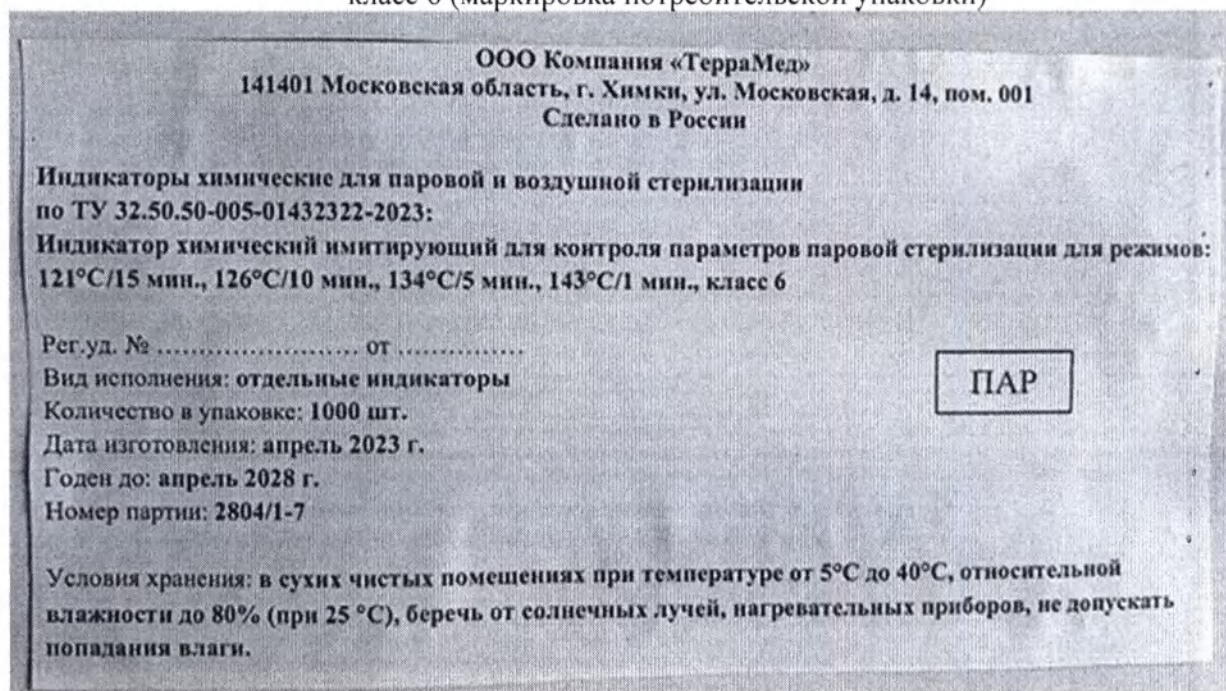

15. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров воздушной стерилизации для режимов: 160°C/150 мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 6 (общий вид)

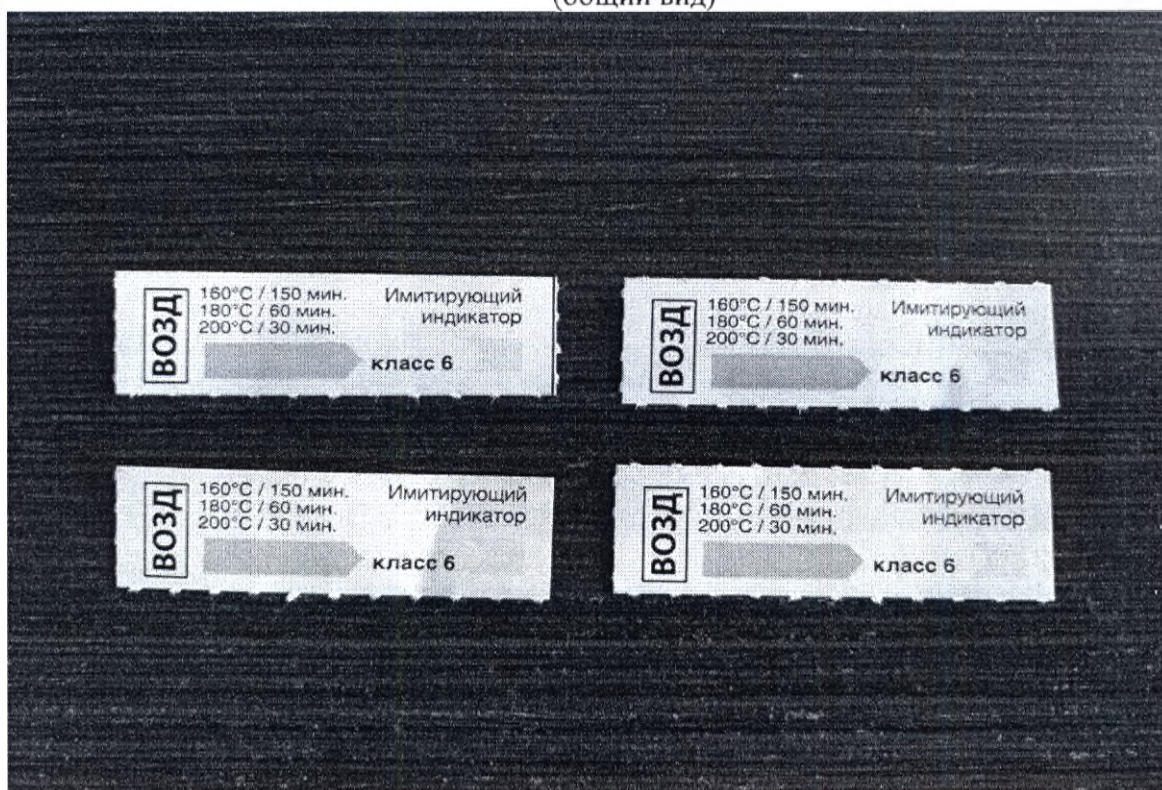


16. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров воздушной стерилизации для режимов: 160°C/150 мин., 180°C/60 мин., 200°C/30 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

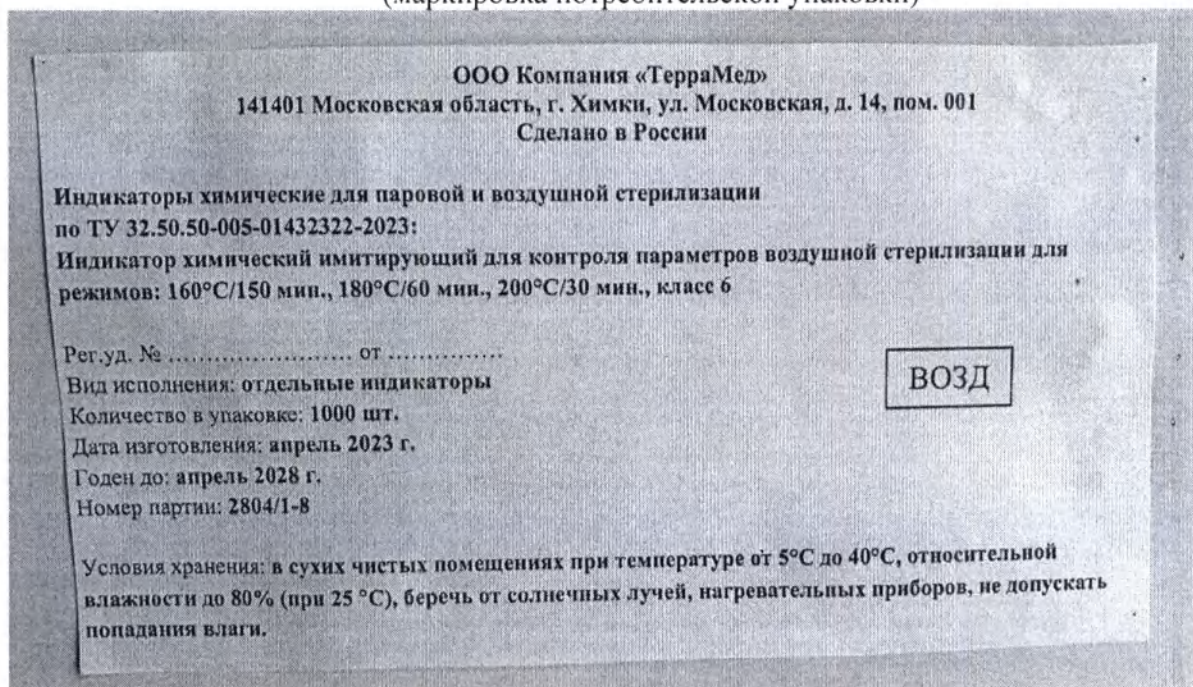

17. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/10 мин., 134°C/5,3 мин., класс 6 (общий вид)




18. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 121°C/10 мин., 134°C/5,3 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

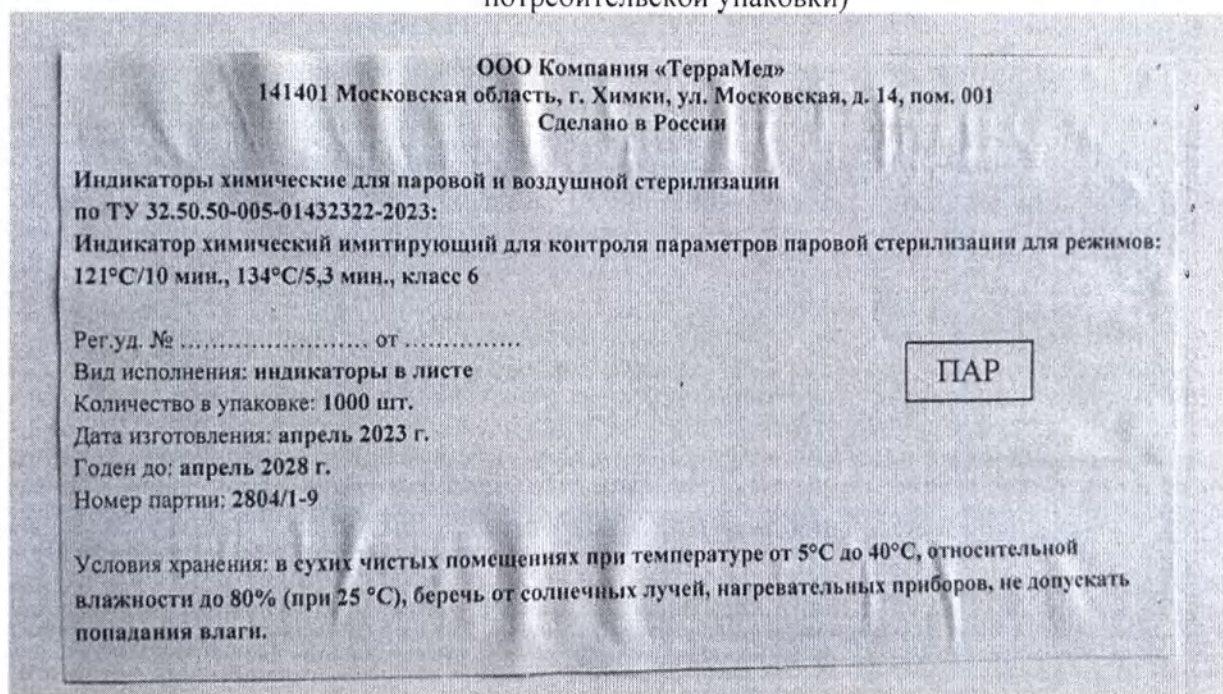


19. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 110°C/45 мин., 120°C/30 мин., 132°C/20 мин., класс 6 (общий вид)




20. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров парового обеззараживания для режимов: 110°C/45 мин., 120°C/30 мин., 132°C/20 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

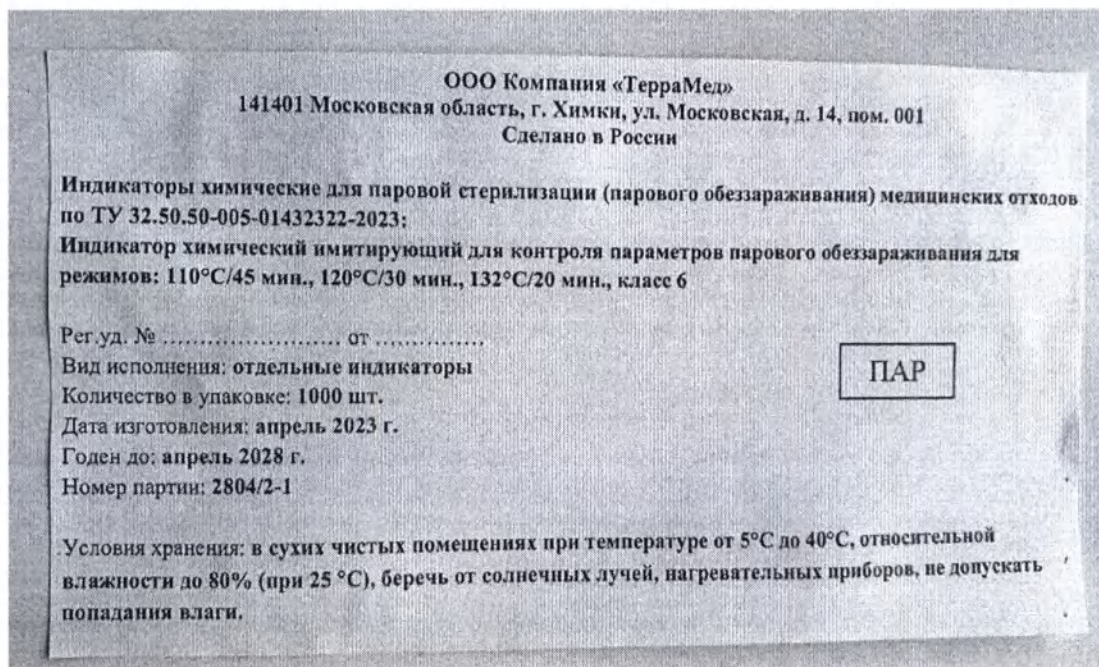

21. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 100°C/30 мин., 110°C/20 мин., 120°C/15 мин., 180°C/30 мин., класс 6 (общий вид)

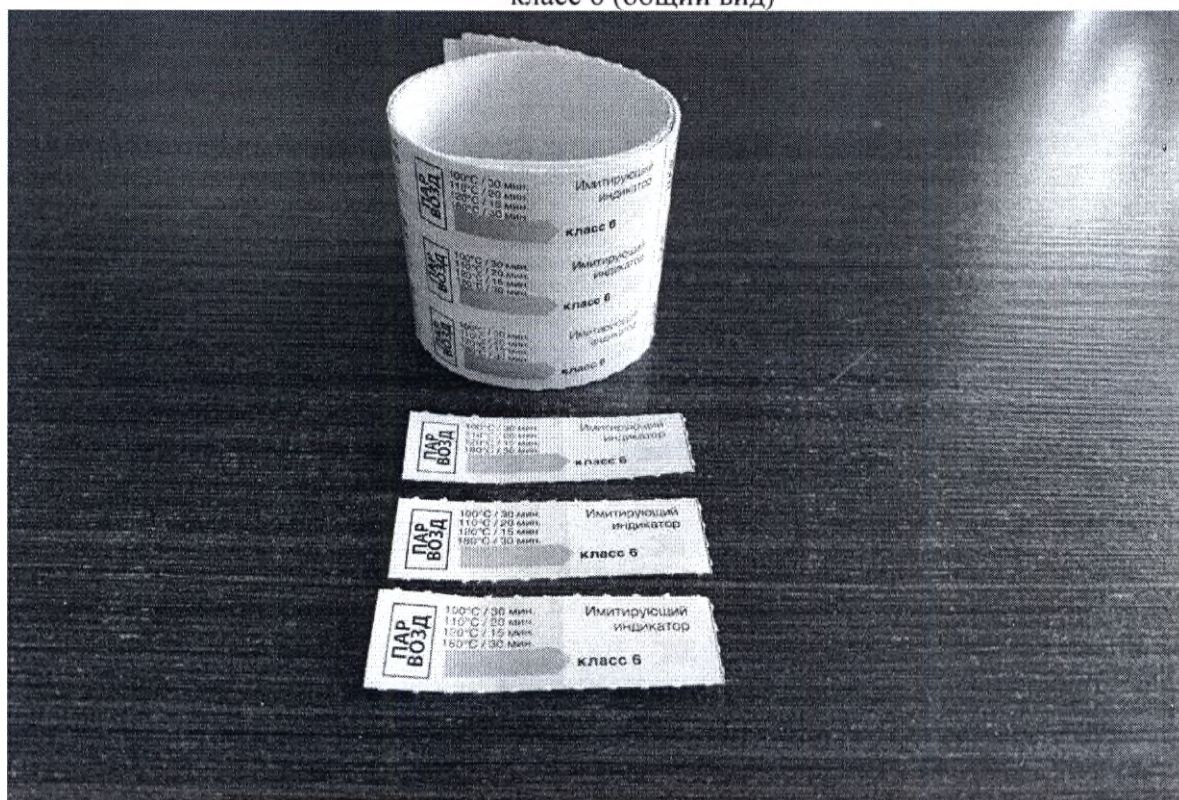


22. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой и воздушной стерилизации для режимов: 100°C/30 мин., 110°C/20 мин., 120°C/15 мин., 180°C/30 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

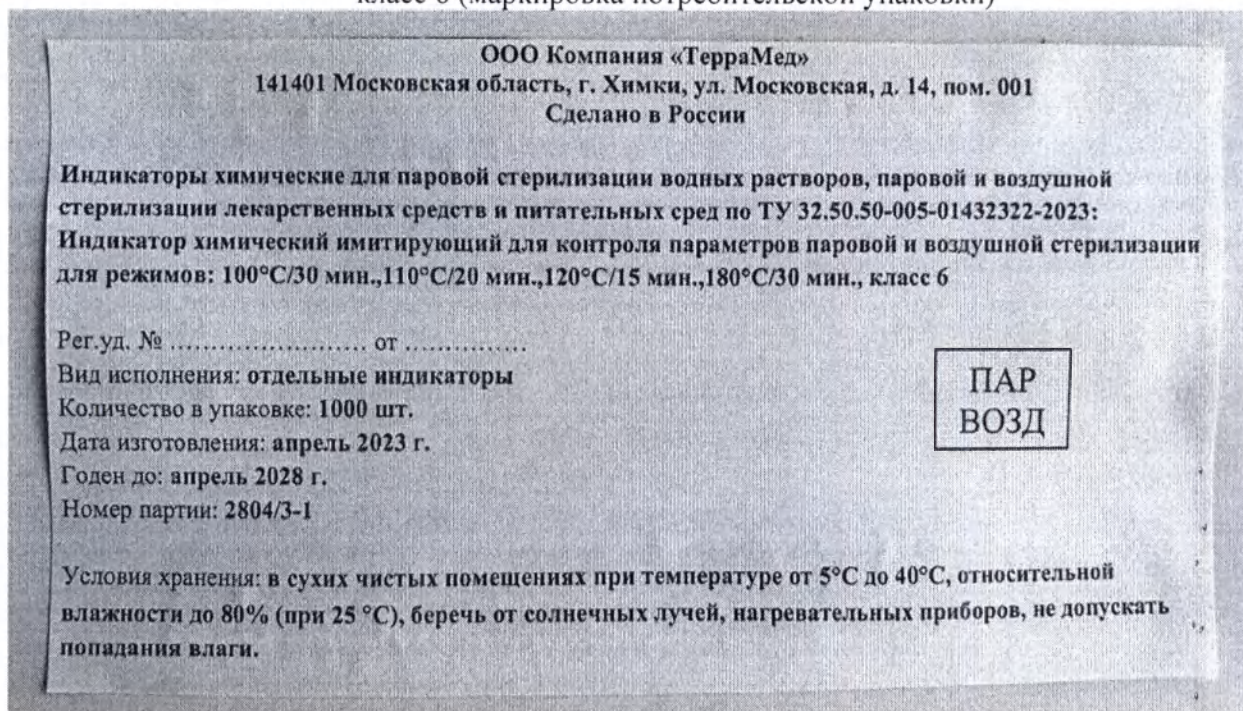


23. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/15 мин., 110°C/10 мин., 120°C/8 мин., класс 6 (общий вид)




24. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/15 мин., 110°C/10 мин., 120°C/8 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

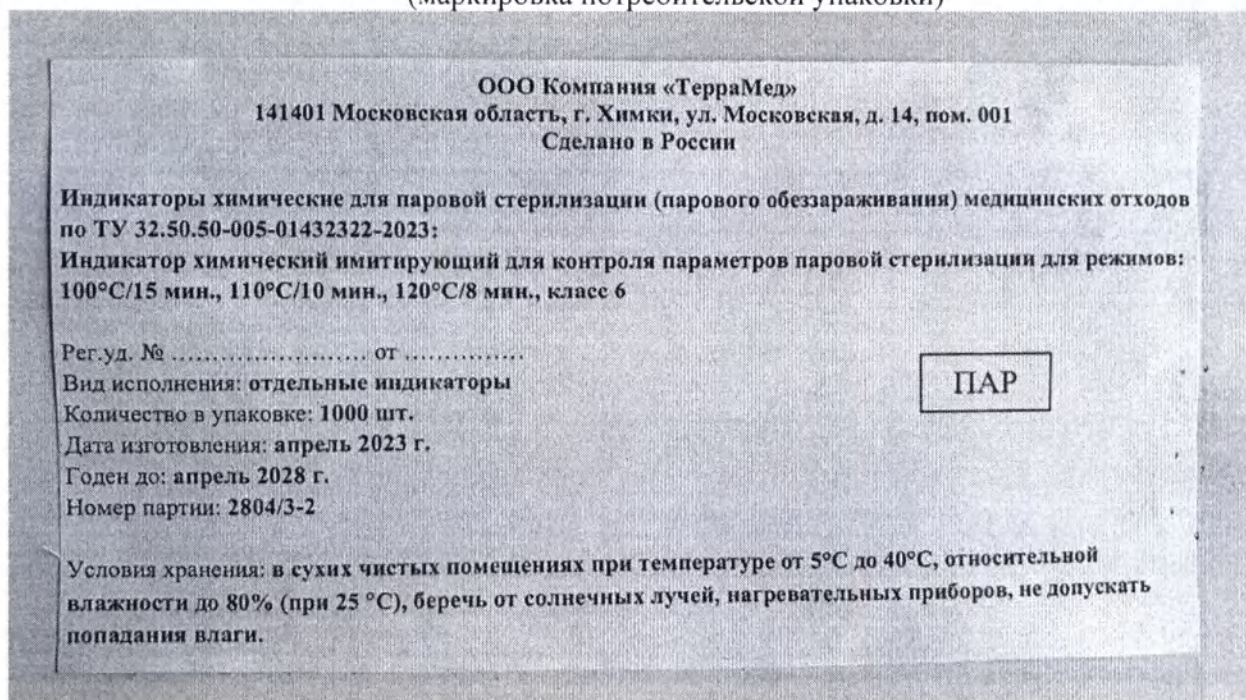


25. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 110°C/15 мин., 120°C/12 мин., класс 6 (общий вид)

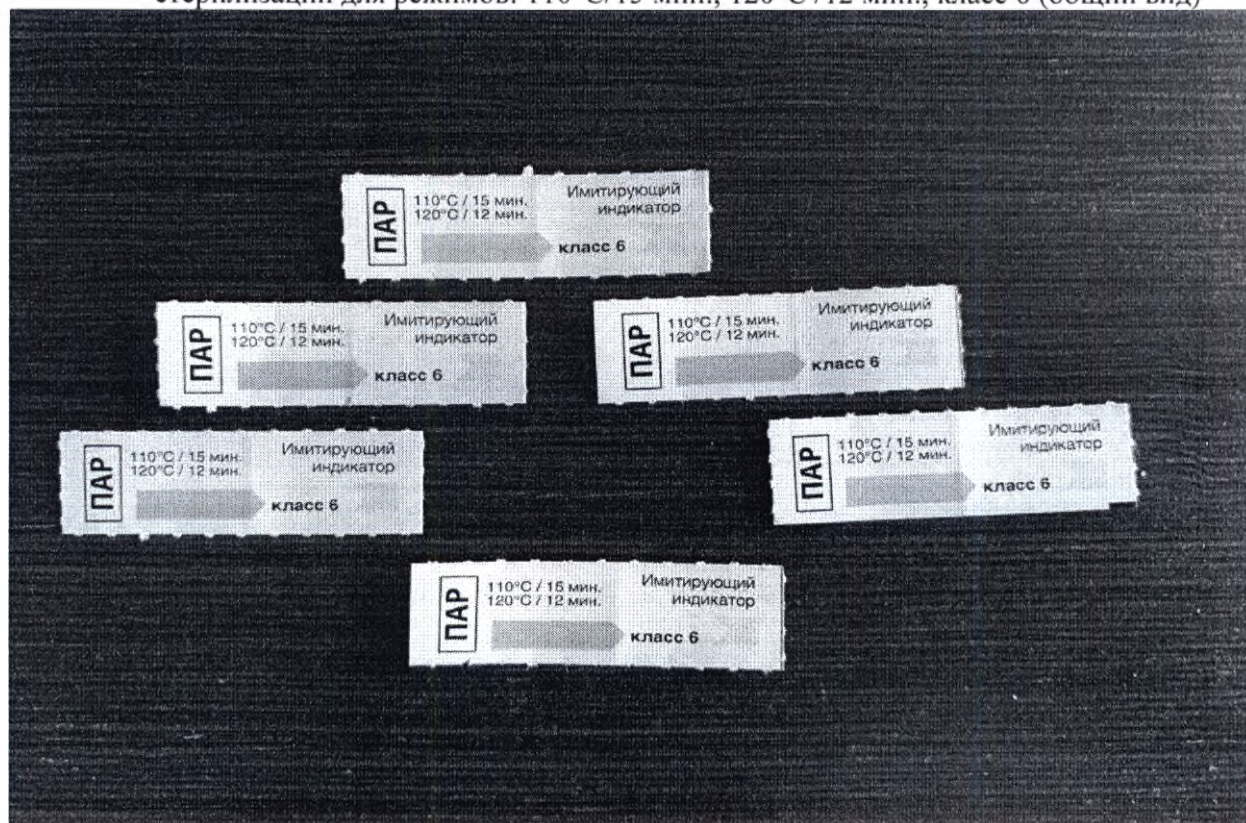


26. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 110°C/15 мин., 120°C/12 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

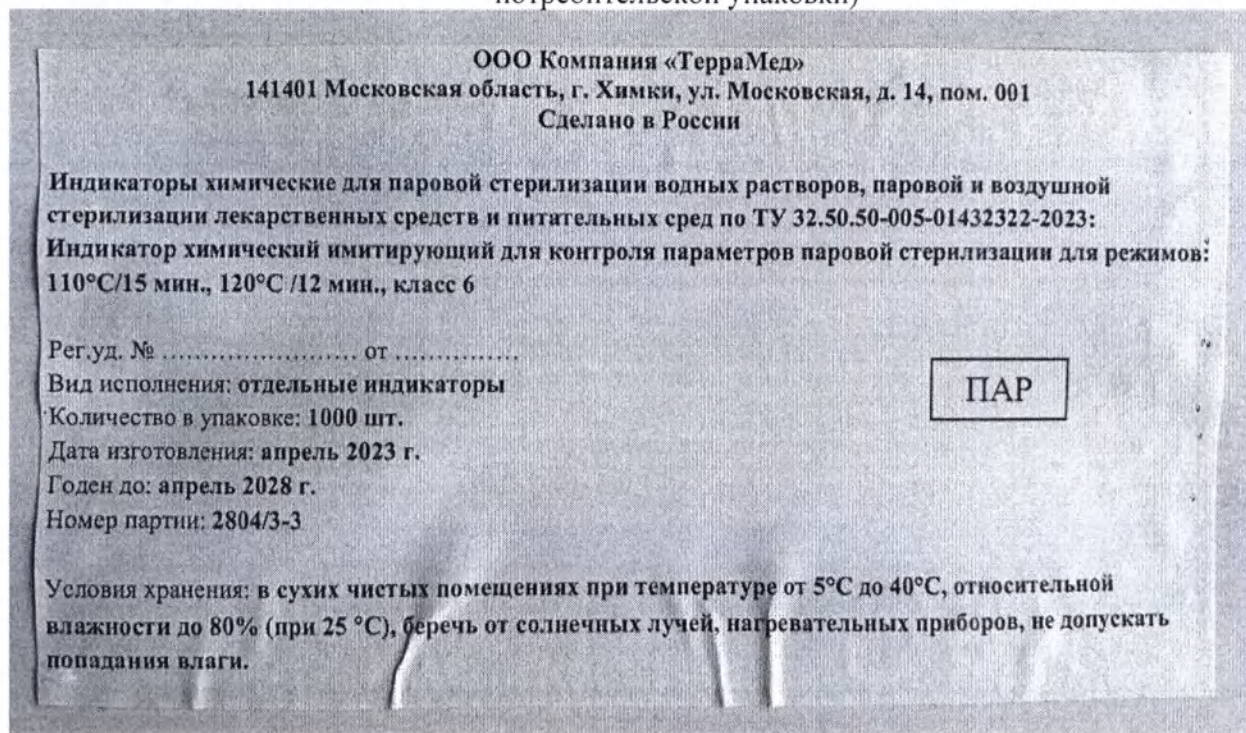


27. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/30 мин., 110°C/20 мин., 120°C/15 мин., класс 6 (общий вид)

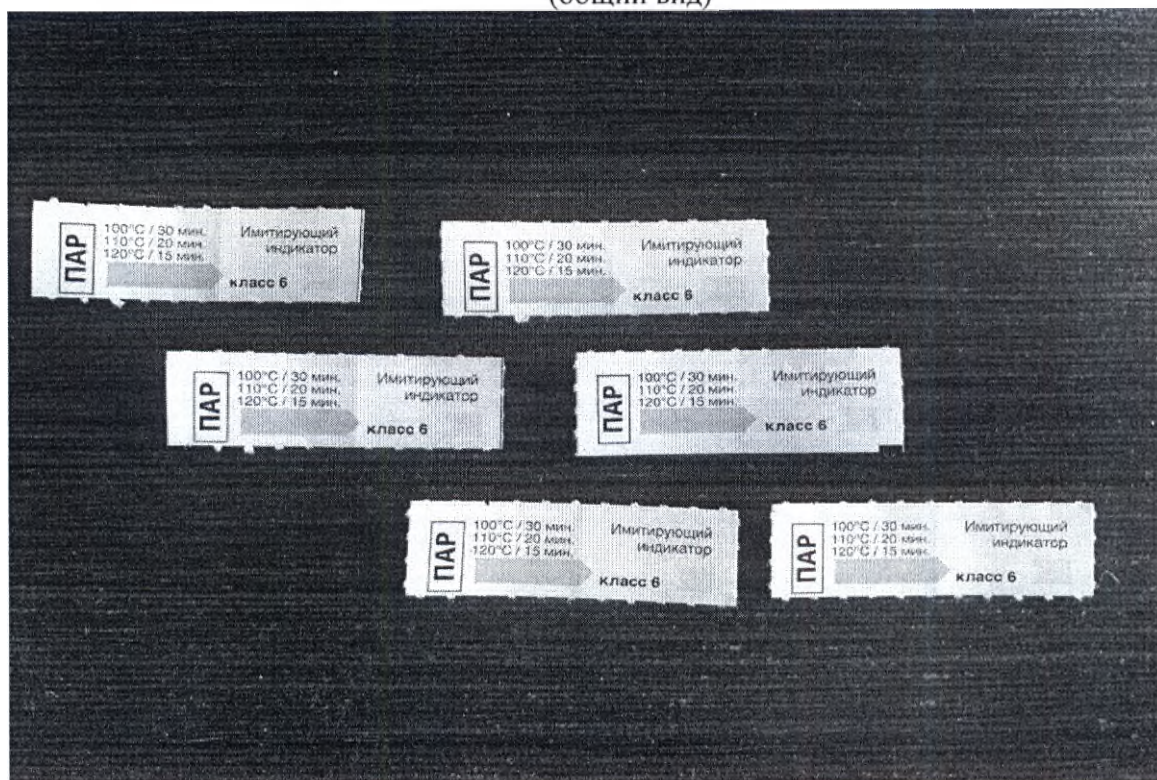


28. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/30 мин., 110°C/20 мин., 120°C/15 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

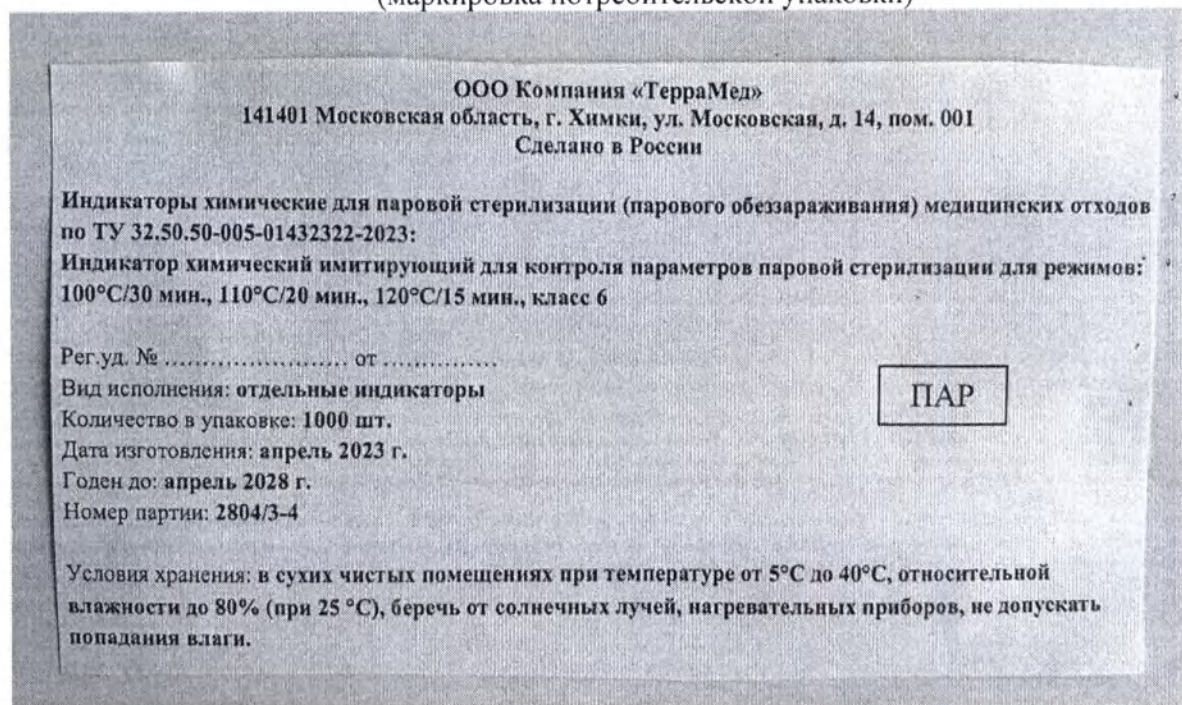


29. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 112°C/20 мин., 121°C/15 мин., класс 6 (общий вид)

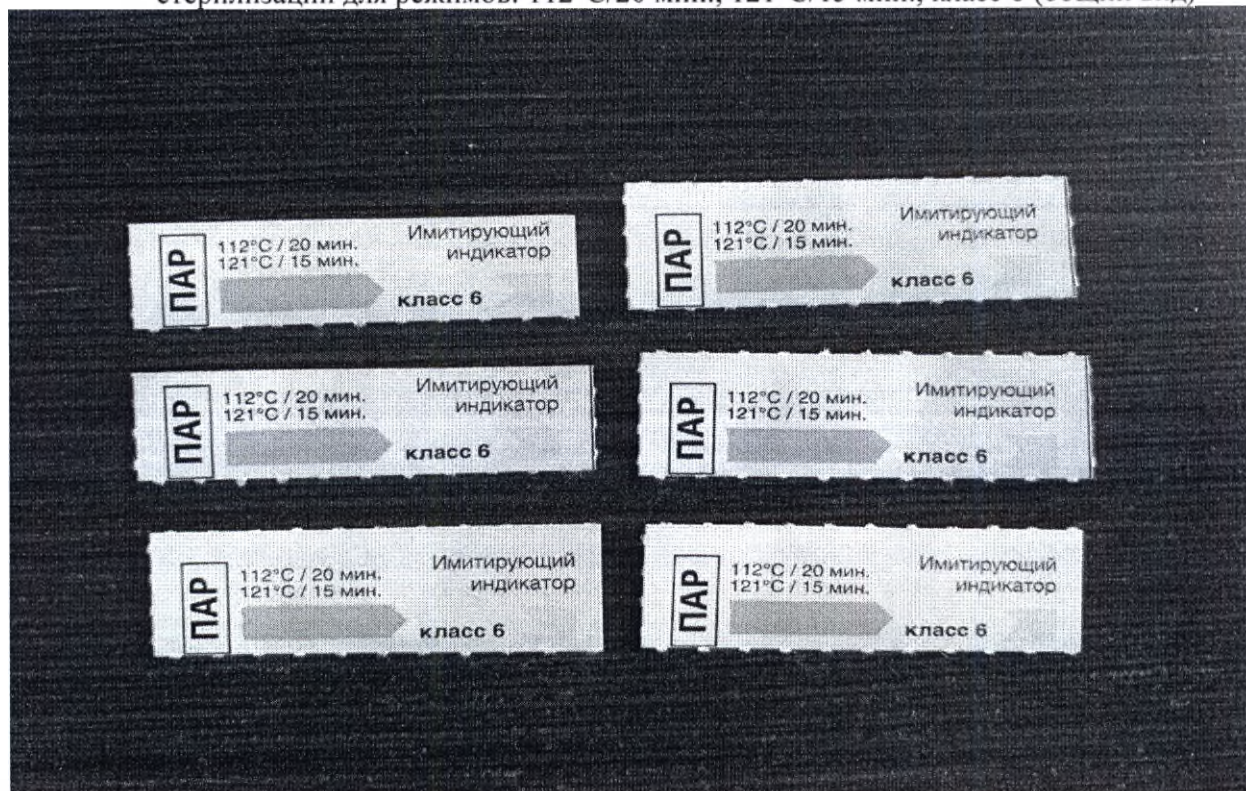


30. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 112°C/20 мин., 121°C/15 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

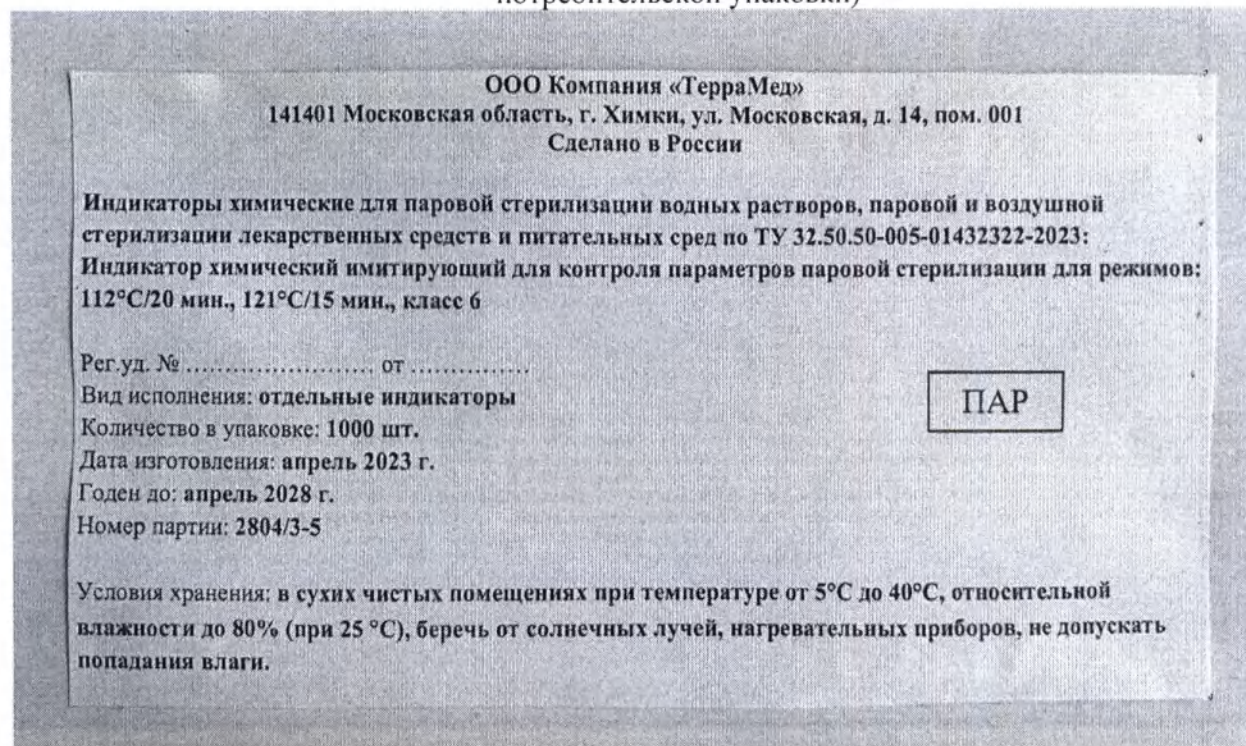


31. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 110°C/30 мин., 121°C/20 мин., класс 6 (общий вид)

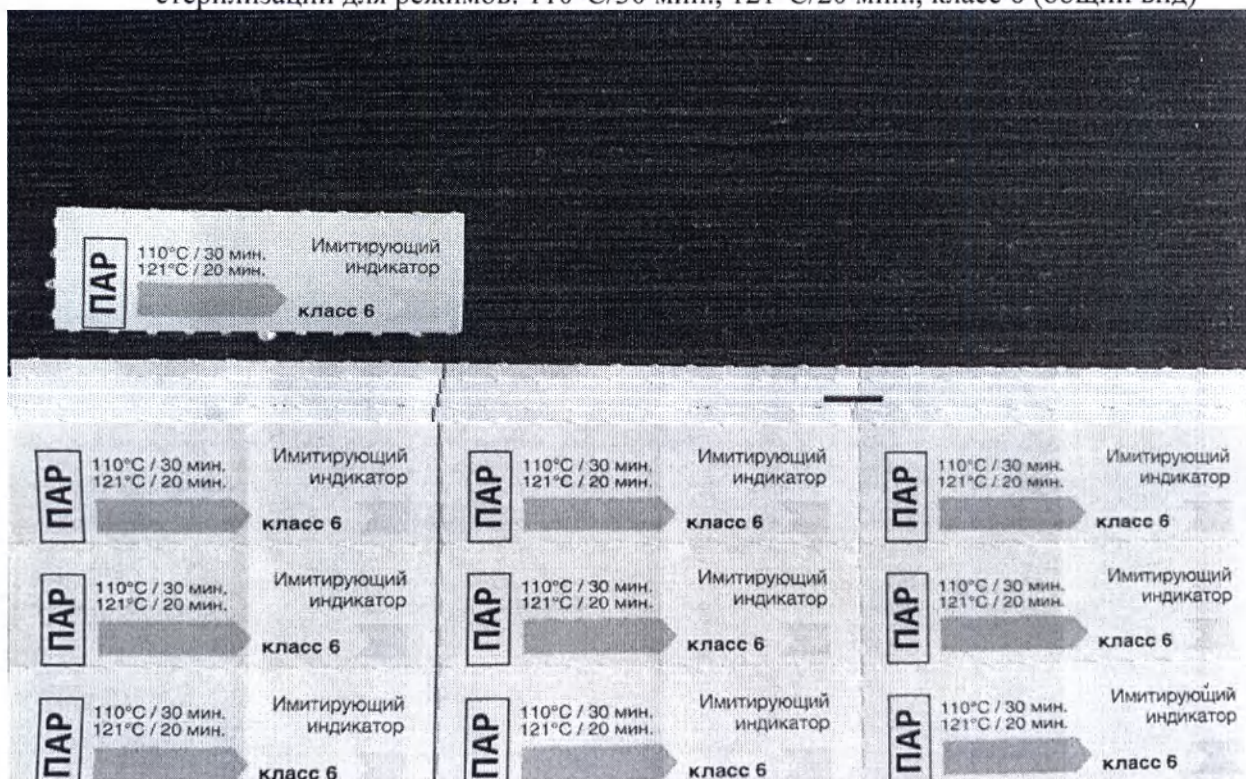


32. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 110°C/30 мин., 121°C/20 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

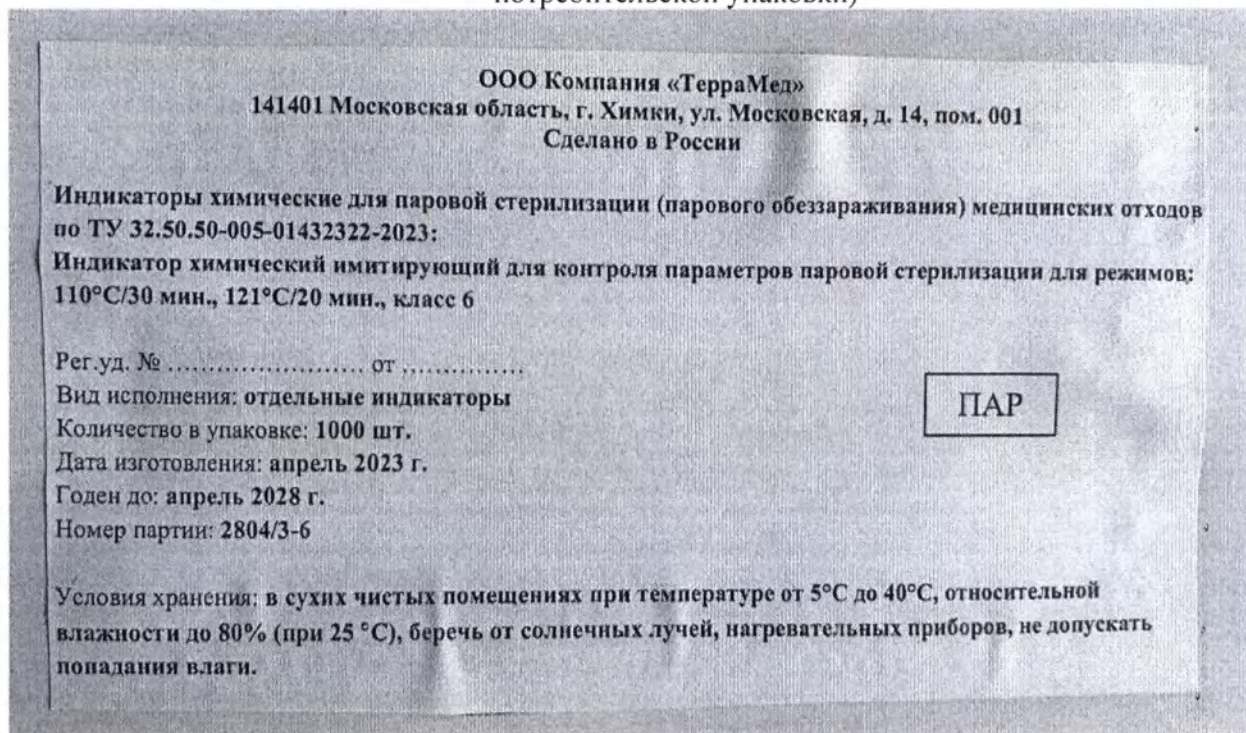

33. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/100 мин, 110°C/60 мин, 120°C/30 мин., класс 6 (общий вид)

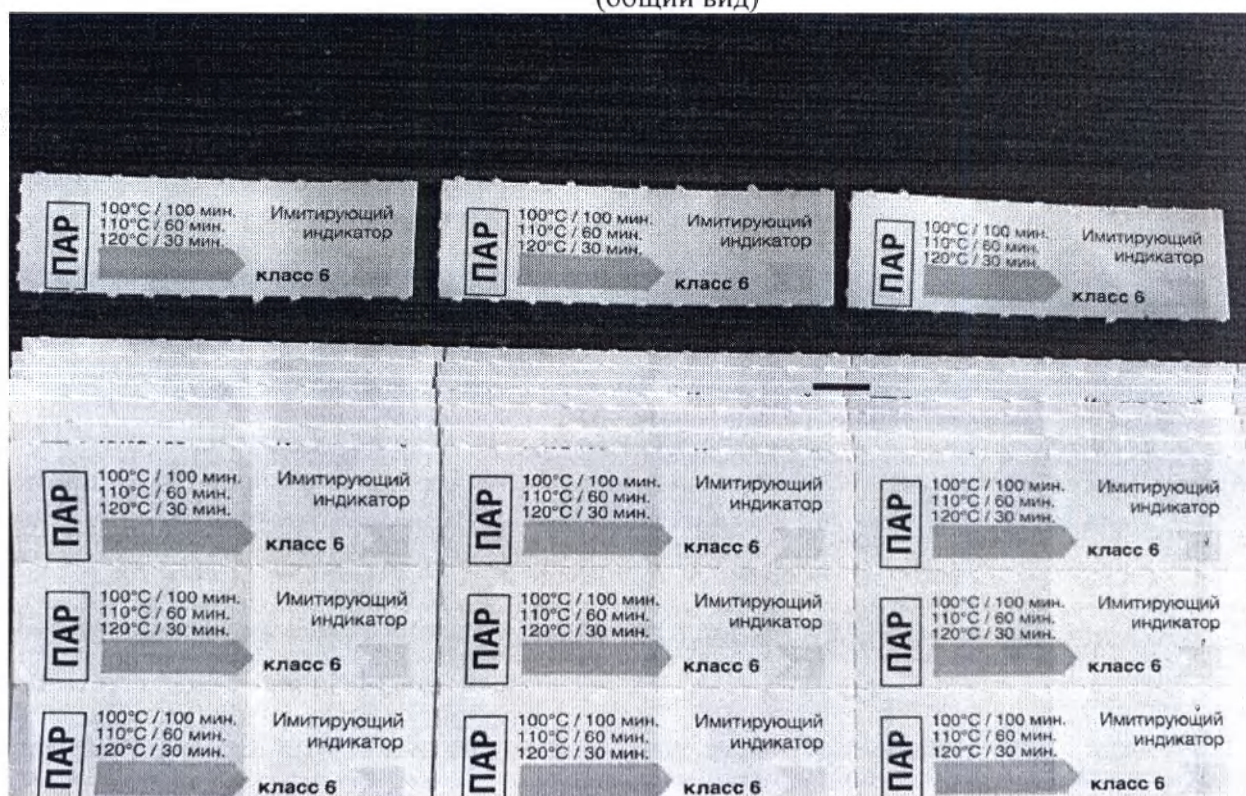

34. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/100 мин, 110°C/60 мин, 120°C/30 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

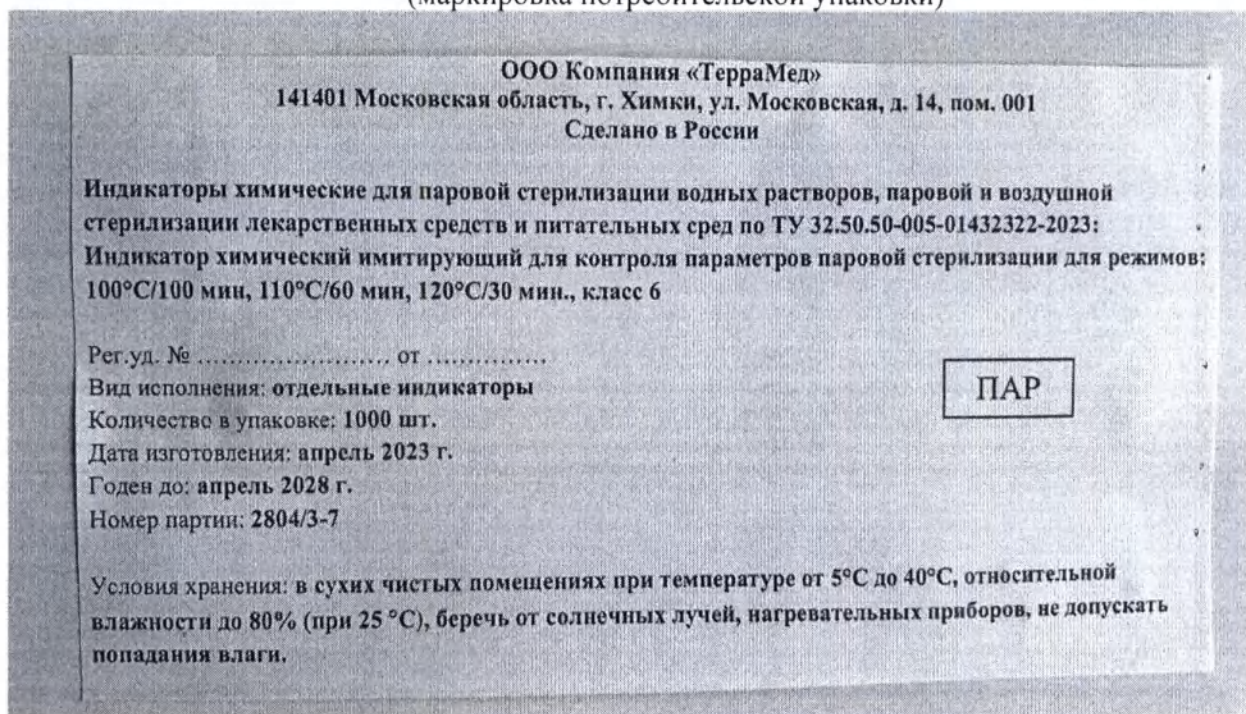

[illegible]

ООО Компания «ТерраМед»
141401 Московская область, г. Химки, ул. Московская, д. 14, пом. 001
Сделано в России

Индикаторы химические для паровой стерилизации (парового обеззараживания) медицинских отходов
по ТУ 32.50.50-005-01432322-2023:

Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов:
100°C/60 мин, 110°C/90 мин., класс 6

Рег.уд. № от

Вид исполнения: отдельные индикаторы

Количество в упаковке: 1000 шт.

Дата изготовления: апрель 2023 г.


Годен до: апрель 2028 г.

Номер партии: 2804/3-8


Условия хранения: в сухих чистых помещениях при температуре от 5°C до 40°C, относительной
влажности до 80% (при 25 °C), беречь от солнечных лучей, нагревательных приборов, не допускать
попадания влаги.

ПАР

37. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/150 мин, 105°C/100 мин, 112°C/45 мин., 115°C/30 мин., 121°C/15 мин., класс 6 (общий вид)

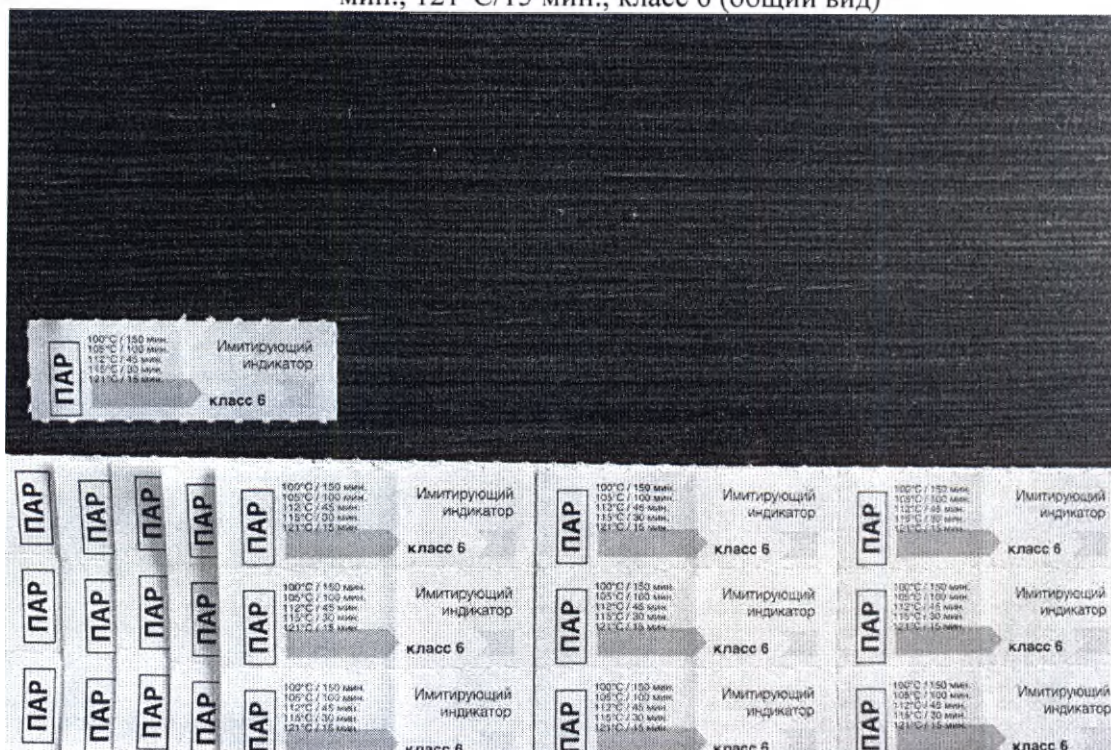


38. Индикатор химический имитирующий для контроля параметров паровой стерилизации для режимов: 100°C/150 мин, 105°C/100 мин, 112°C/45 мин., 115°C/30 мин., 121°C/15 мин., класс 6 (маркировка потребительской упаковки)

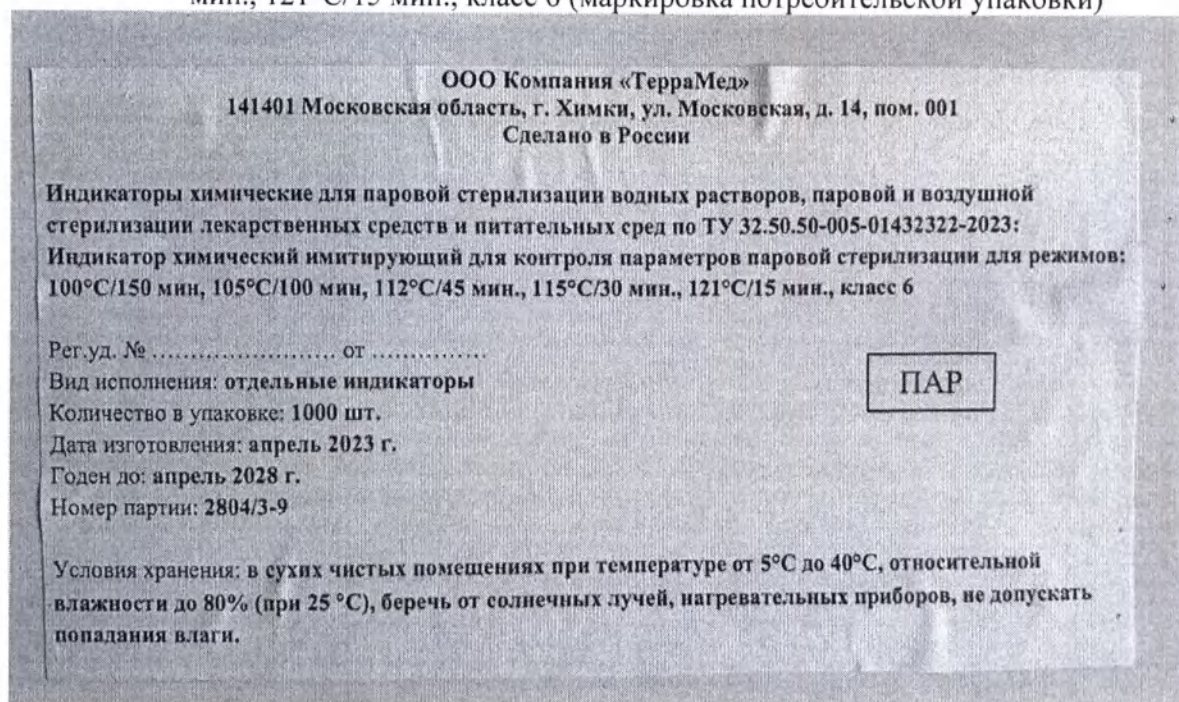



Генеральный директор
ООО Компания «ТерраМед»

 К. А. Василютти

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

20 (двадцать) листов