[redacted]

PHILIPS

"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель отдела нормативного

регулирования ООО «ФИЛИПС»

_____ Град А.А.

"__" _____ 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система рентгеновская диагностическая цифровая DigitalDiagnost C90 с принадлежностями»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

I. Базовый блок:

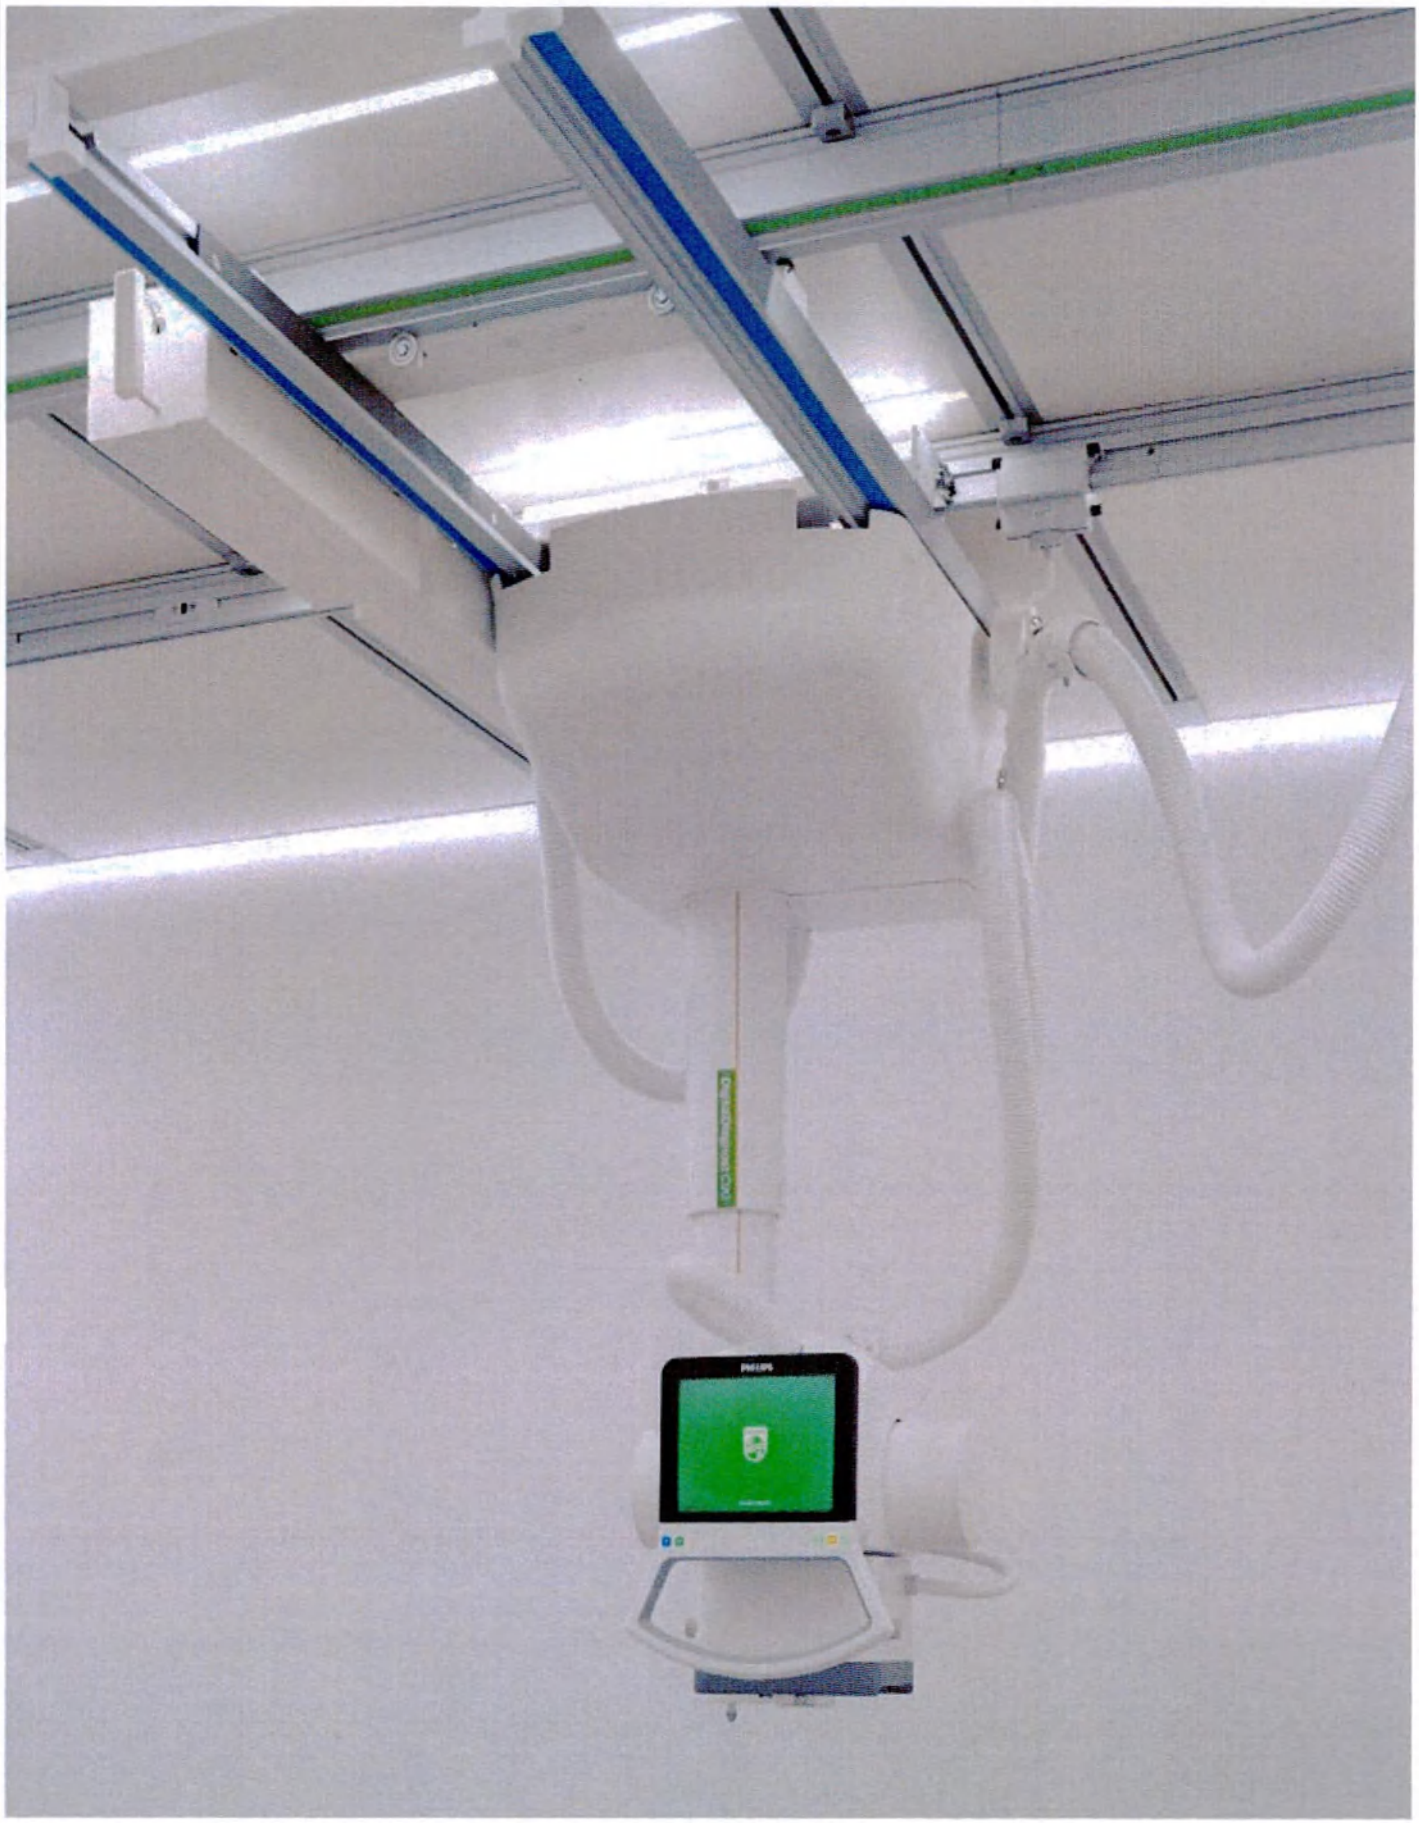

1. Подвес потолочный CSM3.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. Подвес потолочный CSM3, в составе: 1.1. Блок потолочного подвеса.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

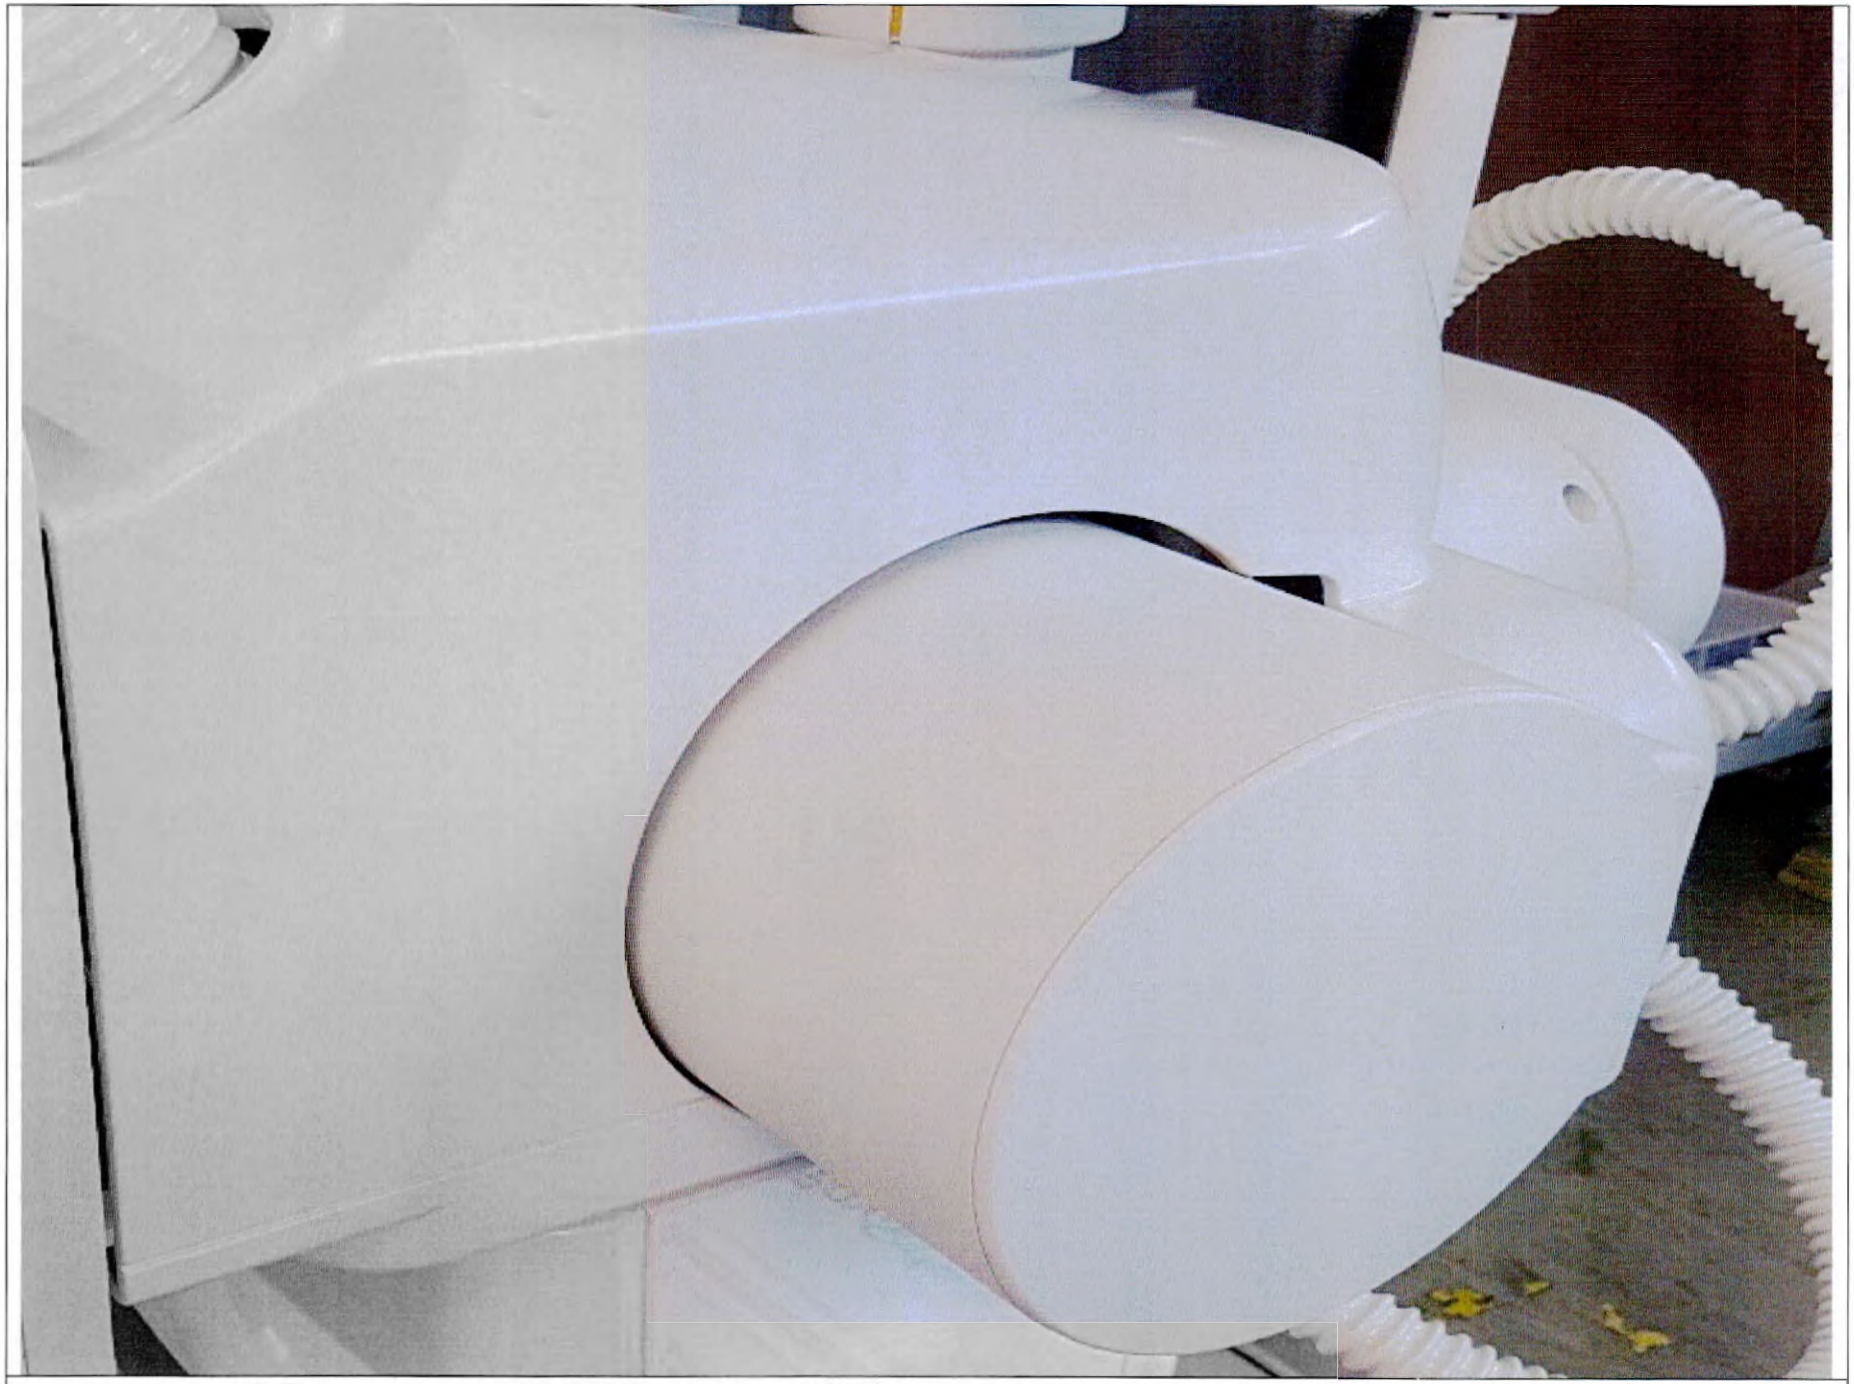

1. Подвес потолочный CSM3, в составе: 1.2. Блок рентгеновского излучателя SRO 33100 ROT 380.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

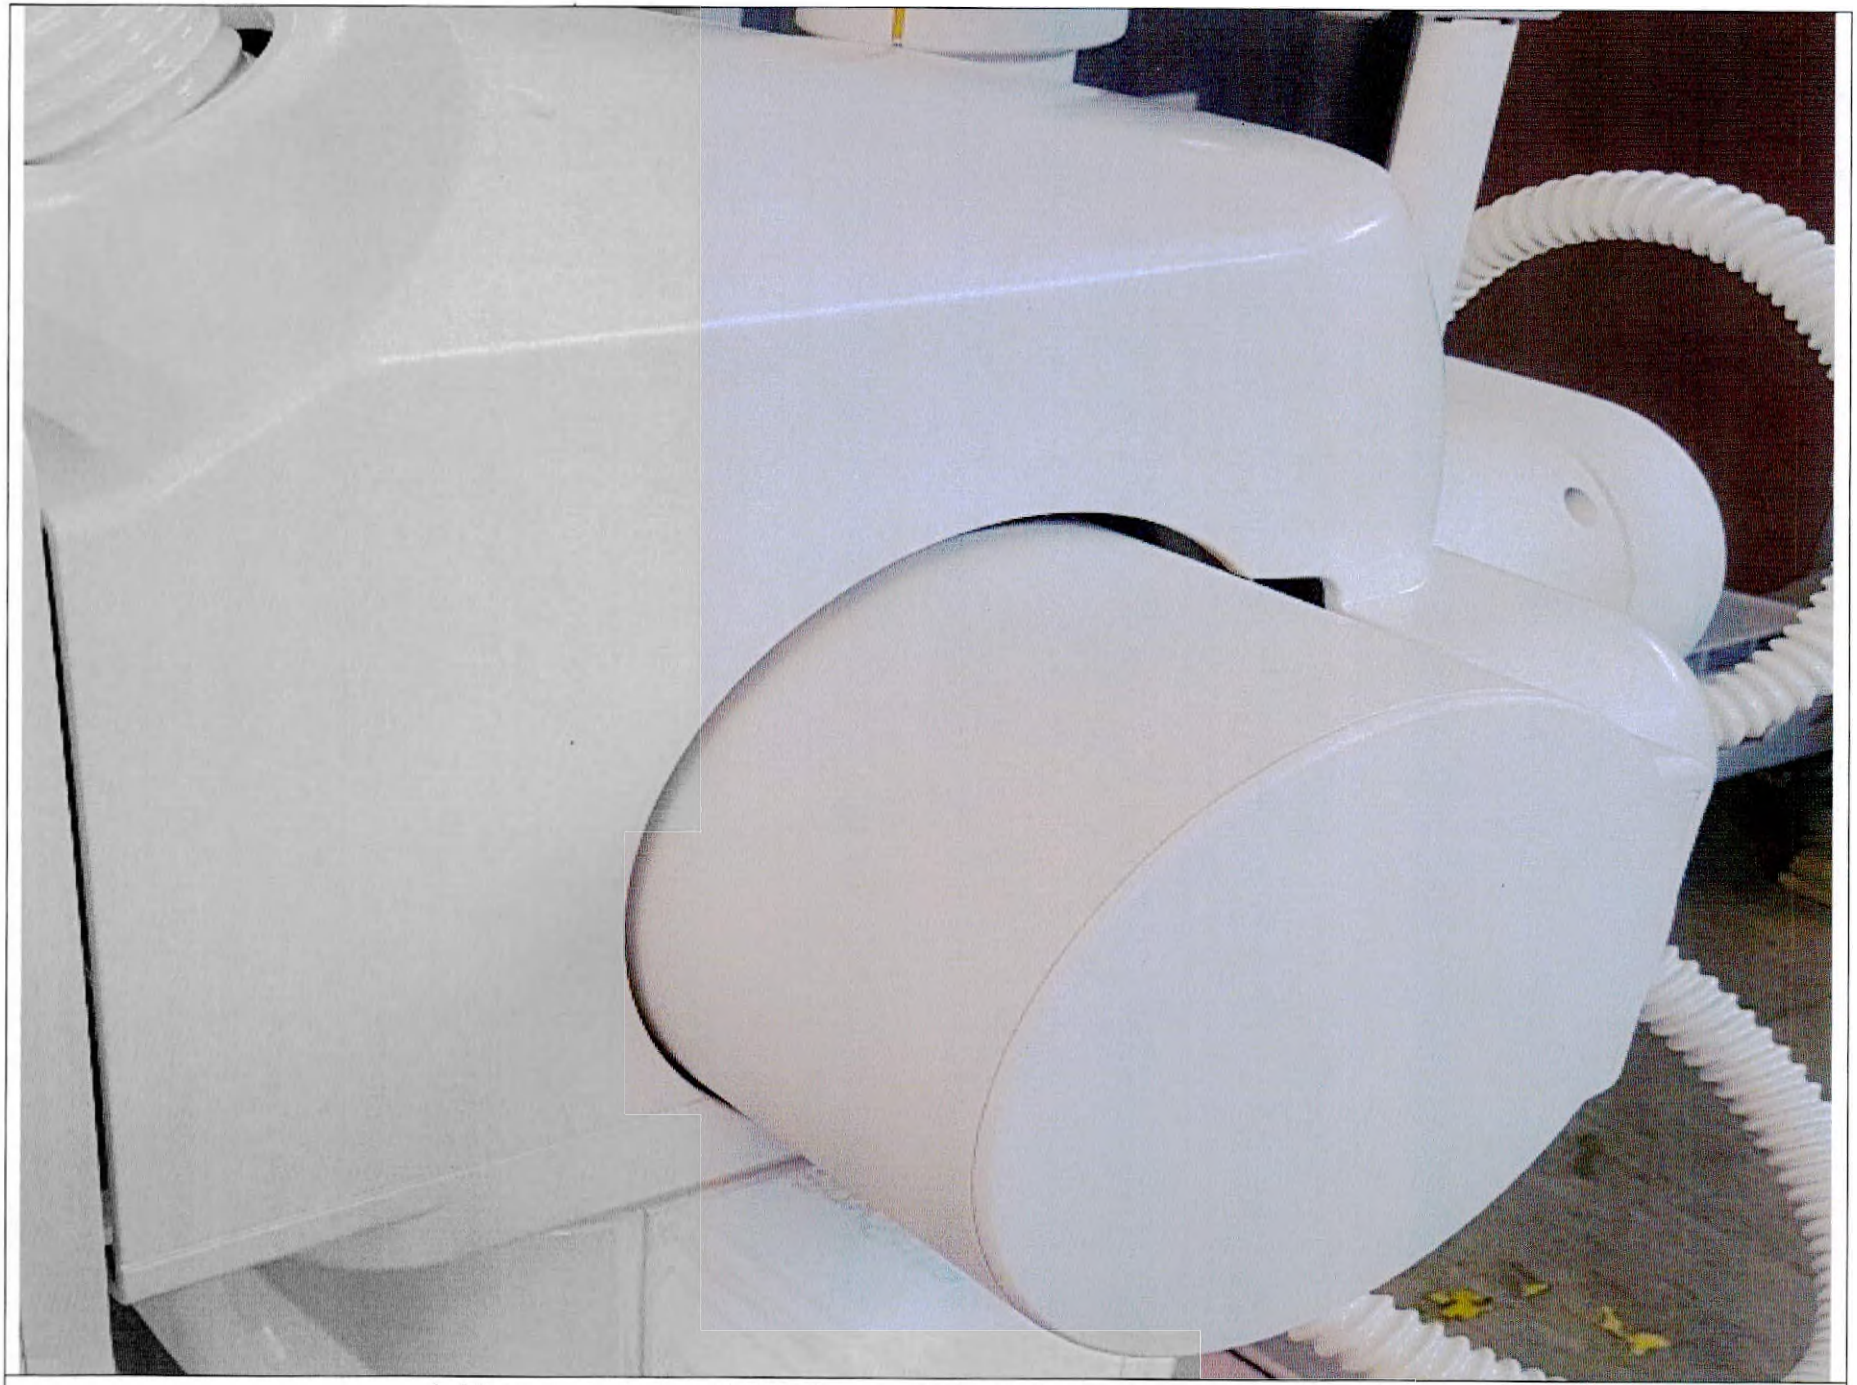

1. Подвес потолочный CSM3, в составе: 1.3. Блок рентгеновской трубки.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. Подвес потолочный CSM3, в составе: 1.4. Рукоятка управления.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

1. Подвес потолочный CSM3, в составе: 1.5. Коллиматор с камерой Ralco.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

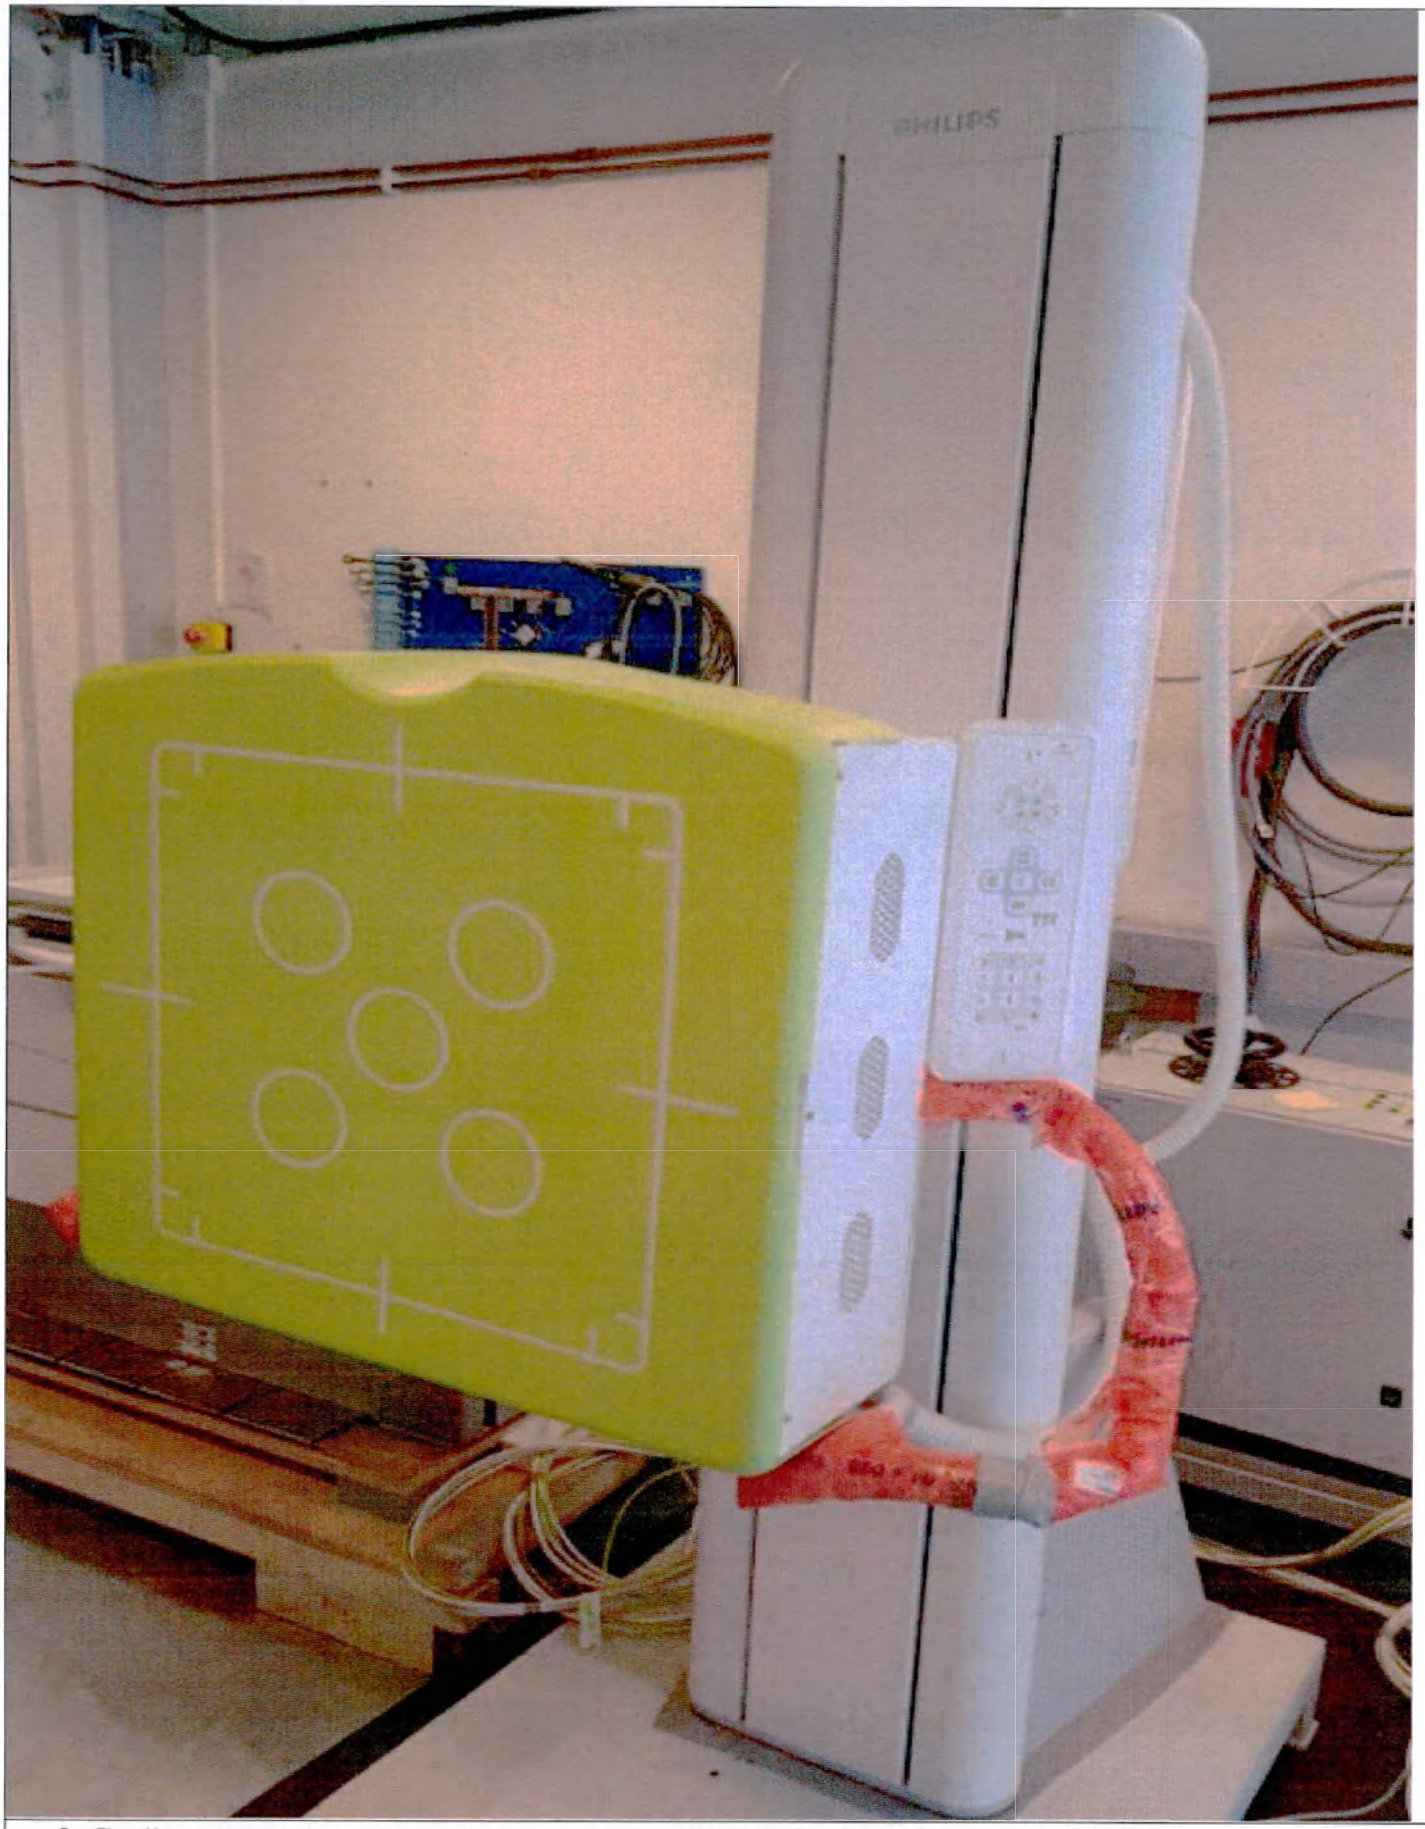

2. Стойка вертикальная, варианты исполнения: 2.1. Стойка вертикальная VS с фиксированным детектором Pixium 4343.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2. Стойка вертикальная, варианты исполнения: 2.2. Стойка вертикальная VS с лотком для переносного детектора.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

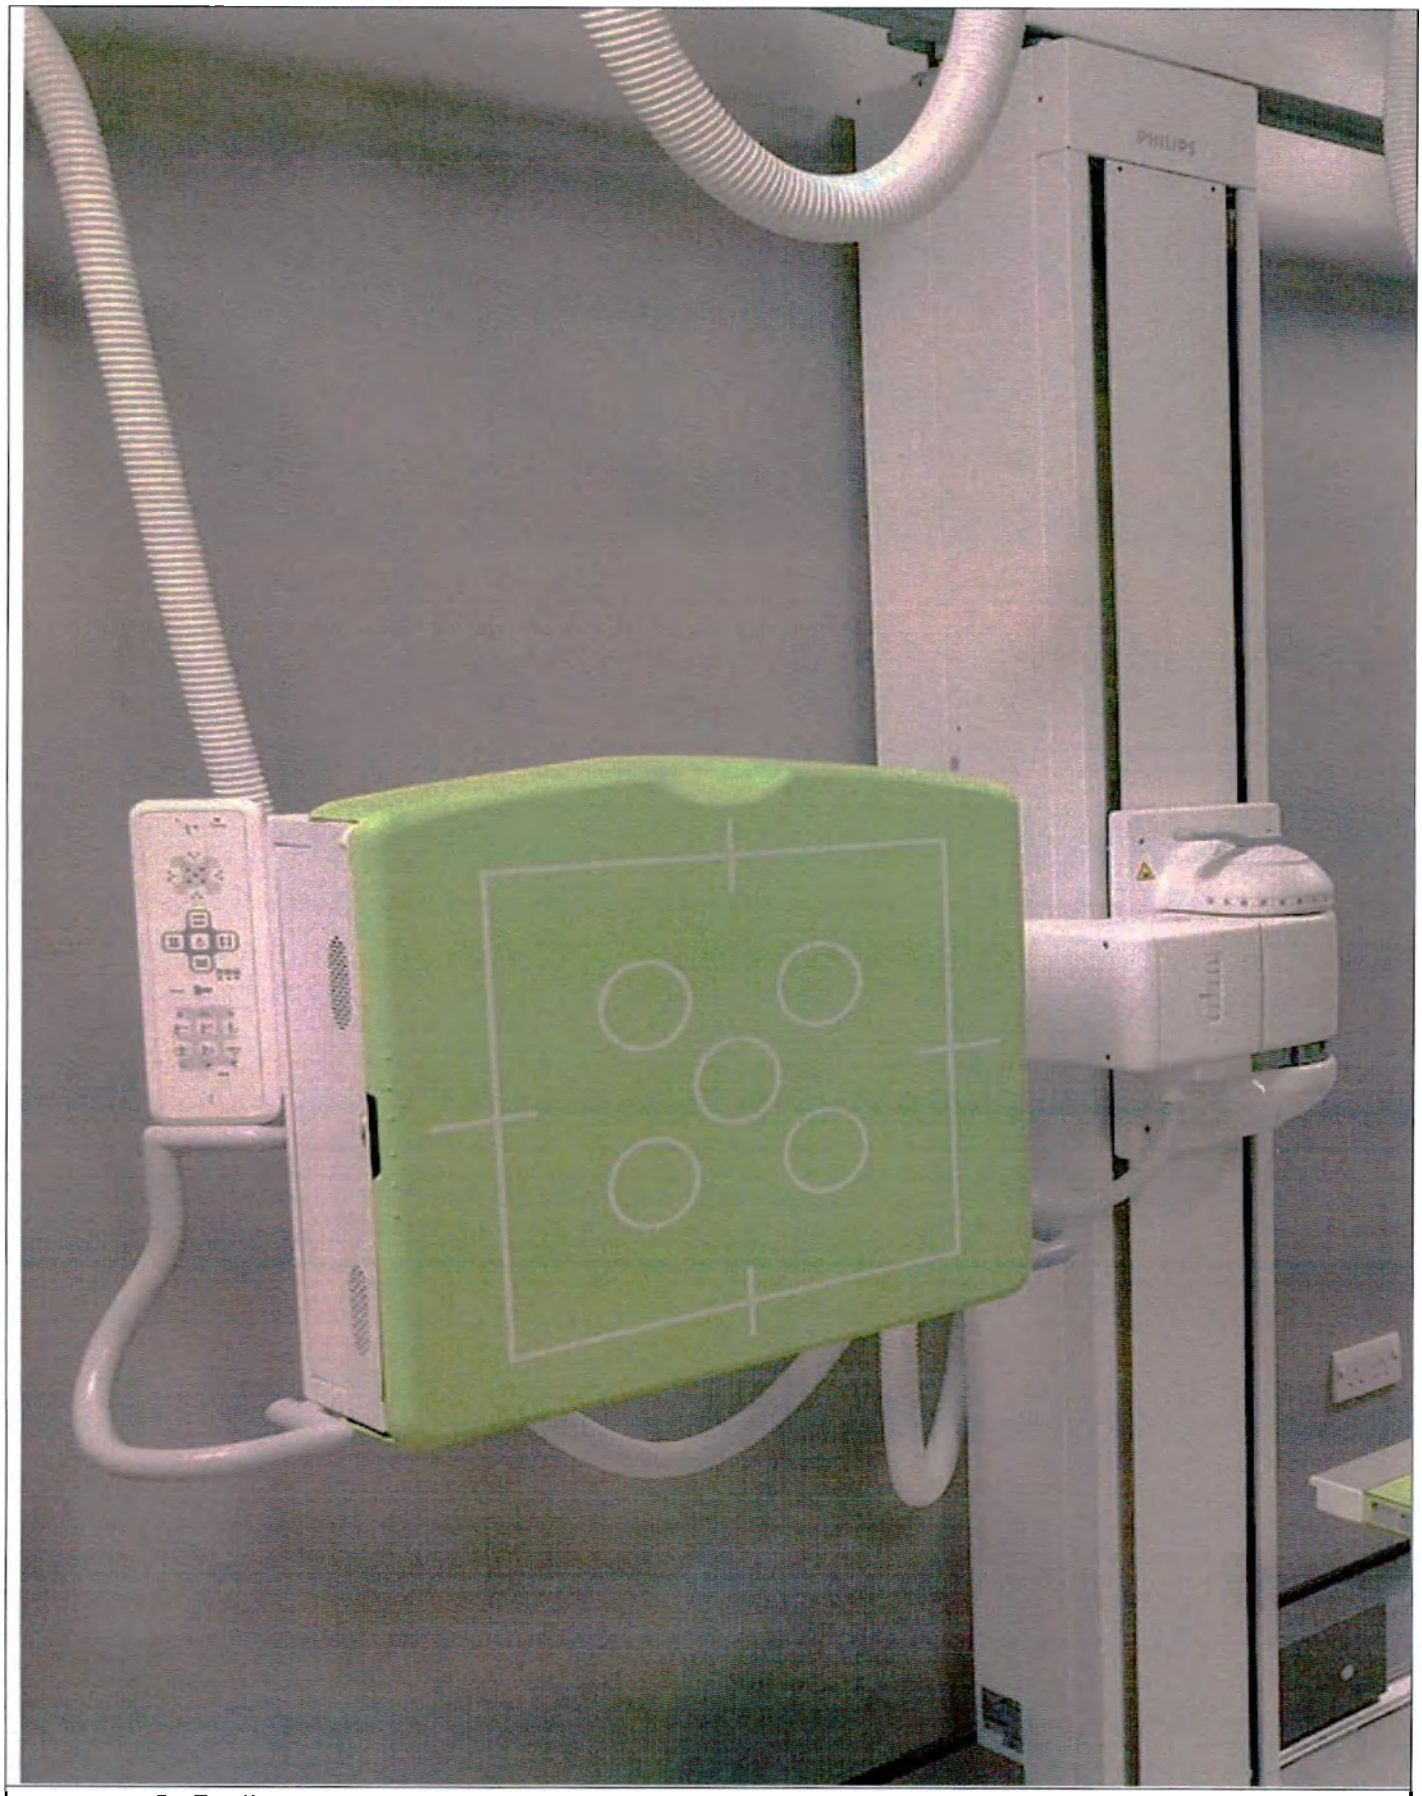

2. Стойка вертикальная, варианты исполнения: 2.3. Стойка универсальная VM моторизированная.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

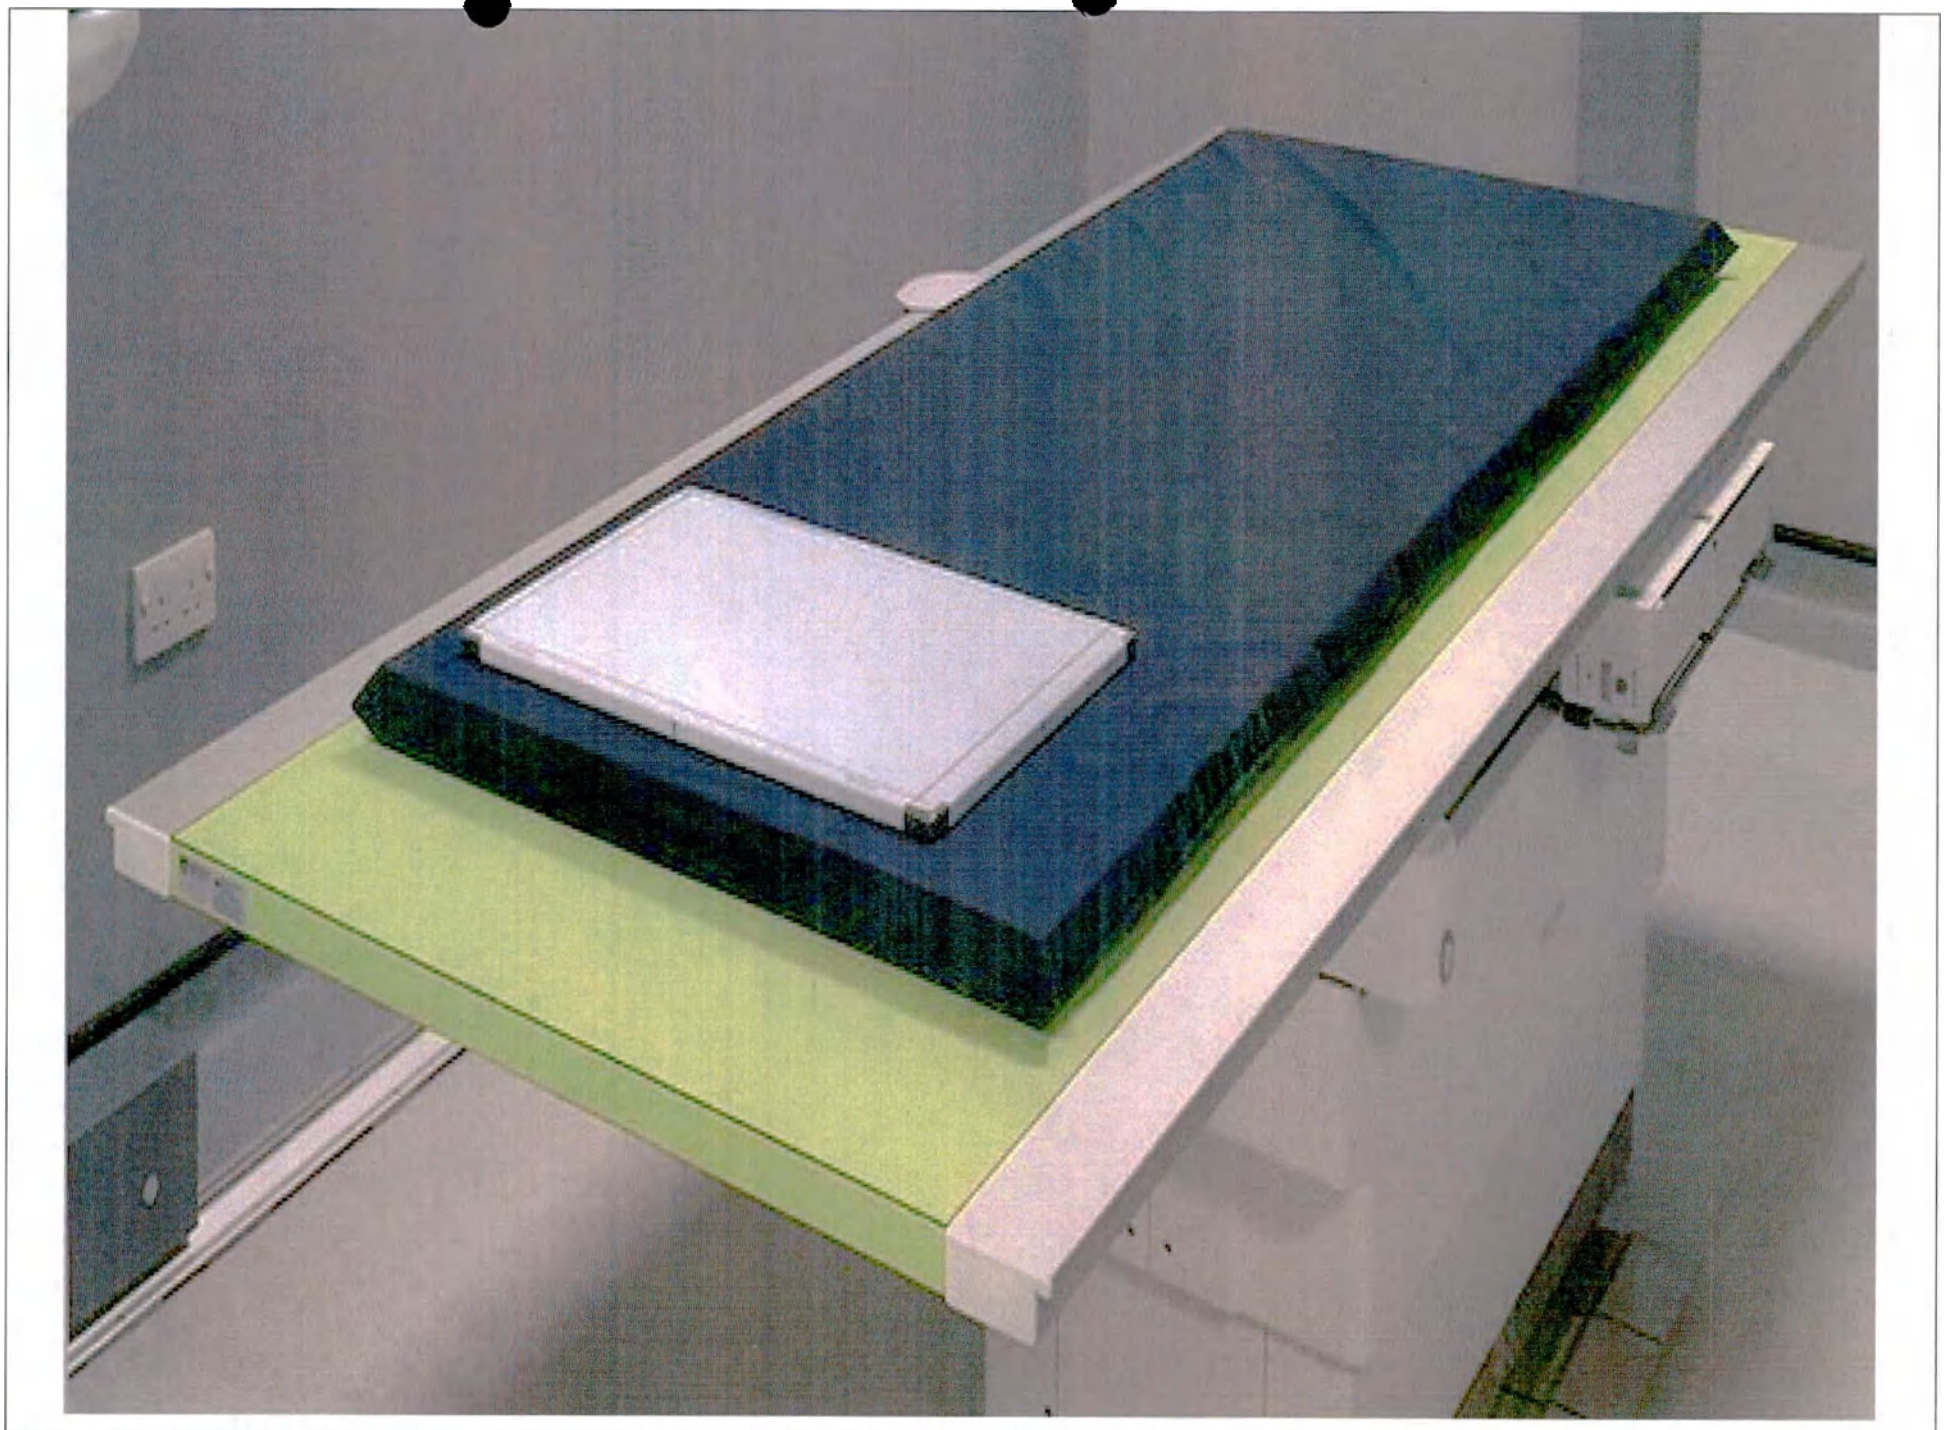

3. Стол для пациента, варианты исполнения: 3.1. Стол ТН-2 для пациента с фиксированным детектором Pixium 4343.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Стол для пациента, варианты исполнения: 3.2. Стол ТН-2 для пациента с лотком для переносного детектора.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Стол для пациента, варианты исполнения: 3.3. Стол TH-S с односторонним подвесом для стойки универсальной VM моторизированной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Рабочая станция для сбора и обработки данных Eleva Workspot.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

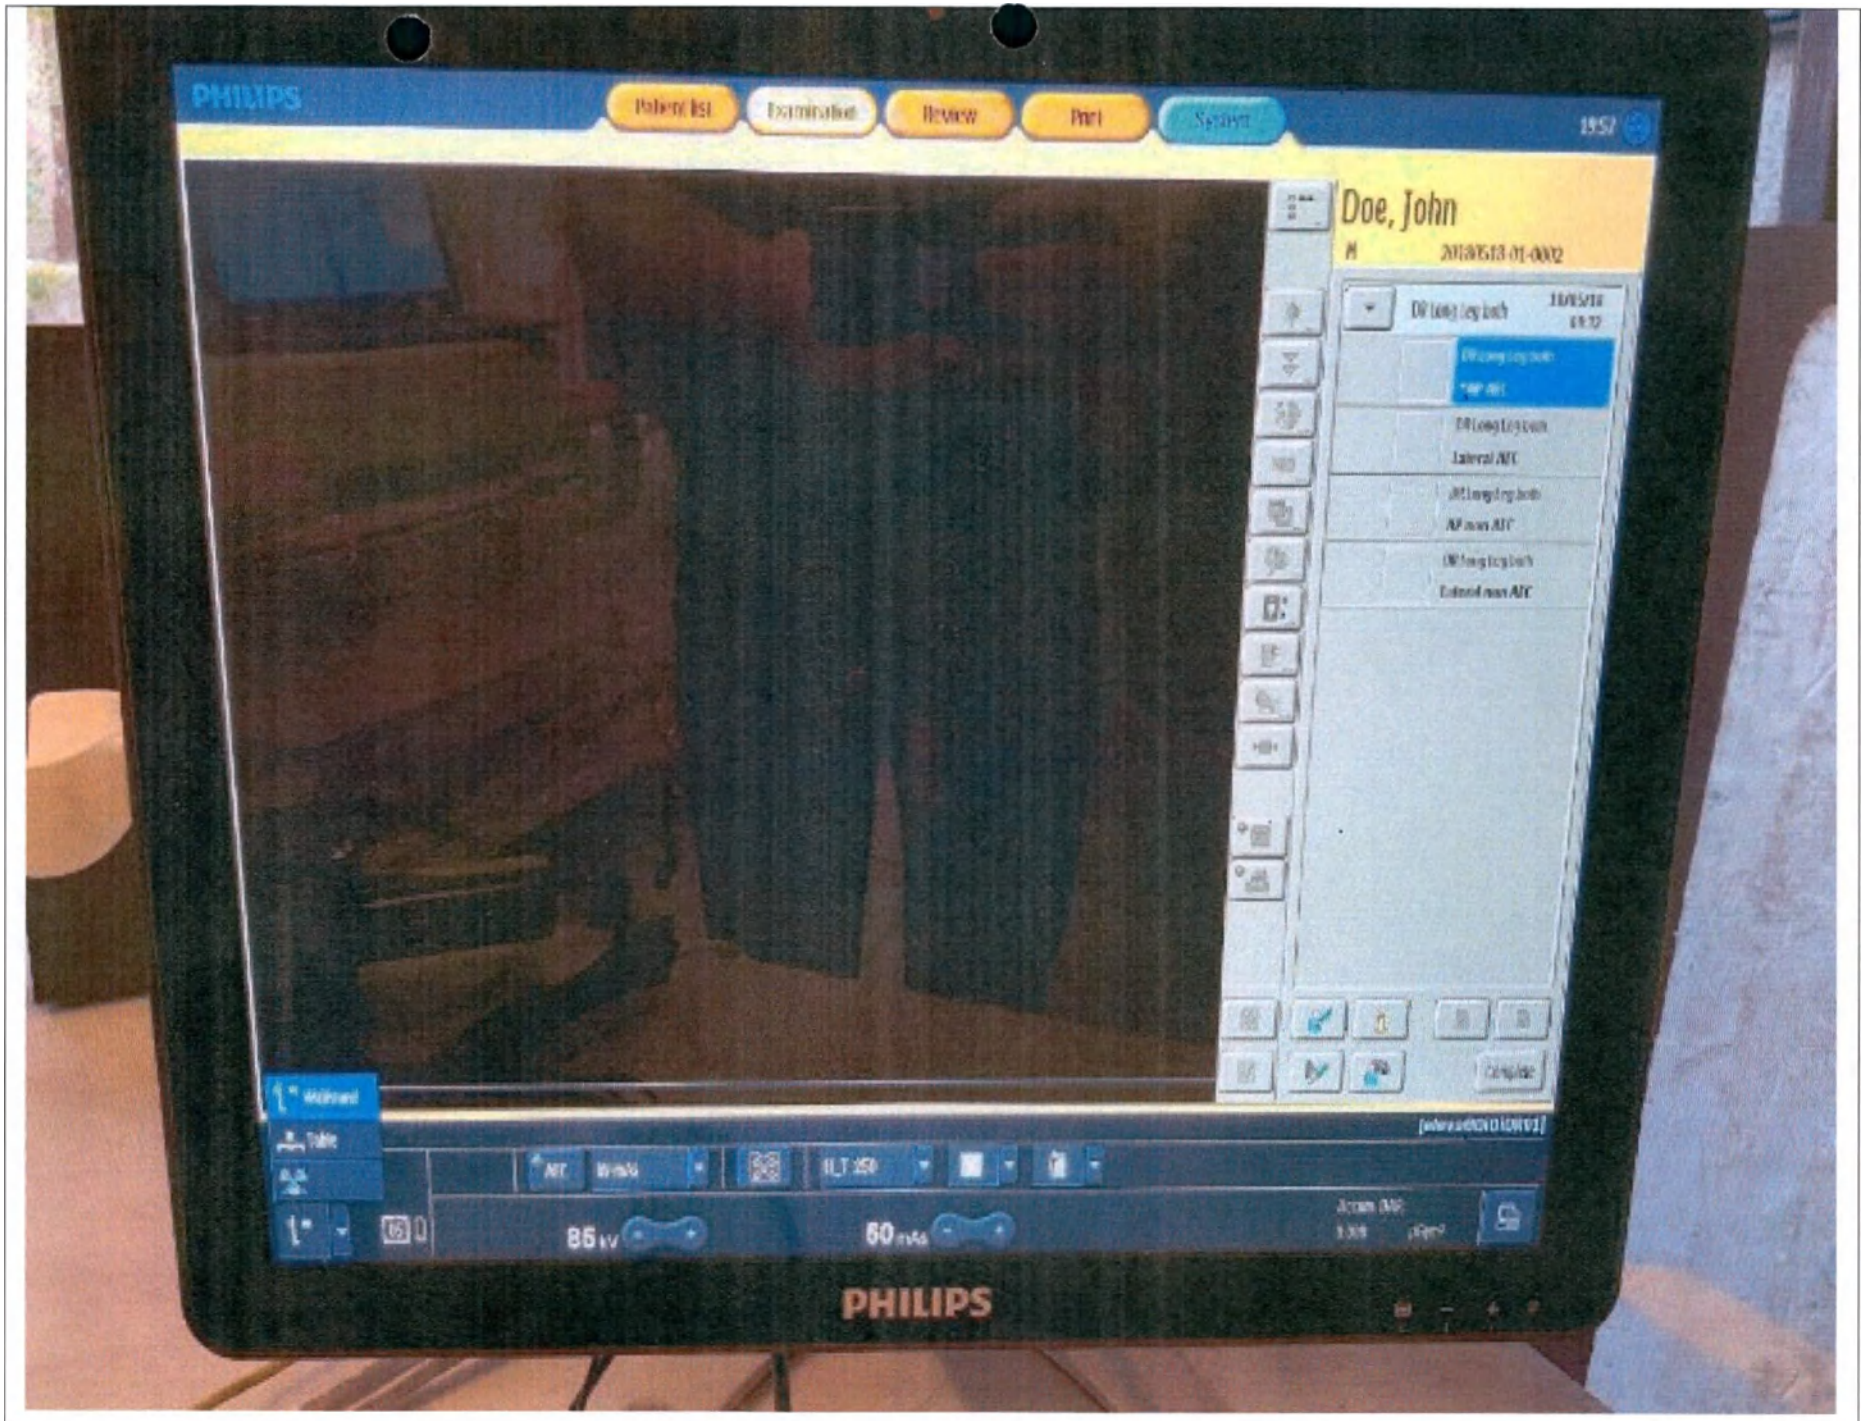

4. Рабочая станция для сбора и обработки данных Eleva Workspot, в составе: 4.1. Монитор.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Рабочая станция для сбора и обработки данных Eleva Workspot, в составе: 4.2. Компьютер.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

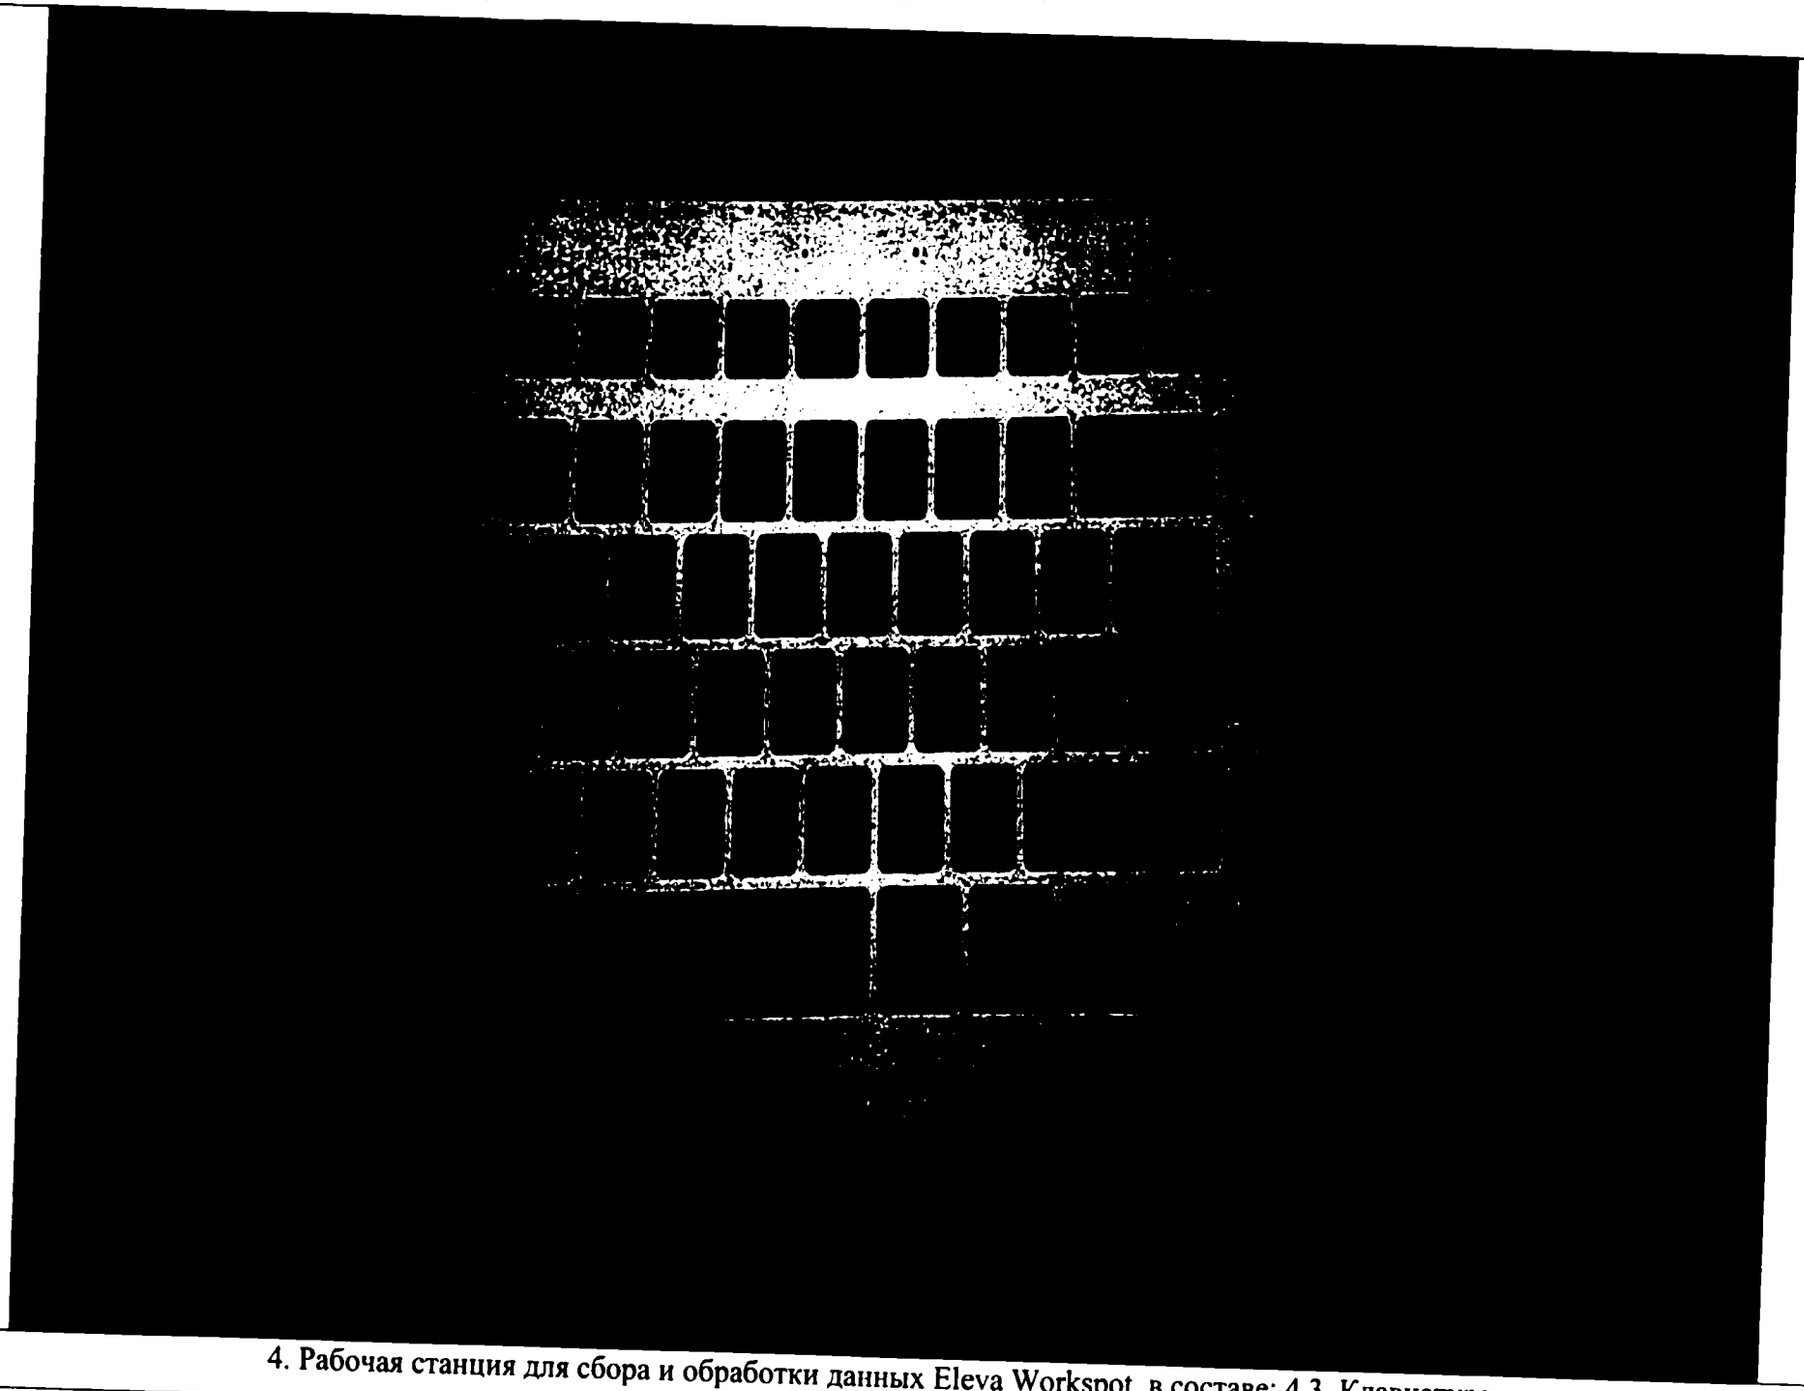

4. Рабочая станция для сбора и обработки данных Eleva Workspot, в составе: 4.3. Клавиатура.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

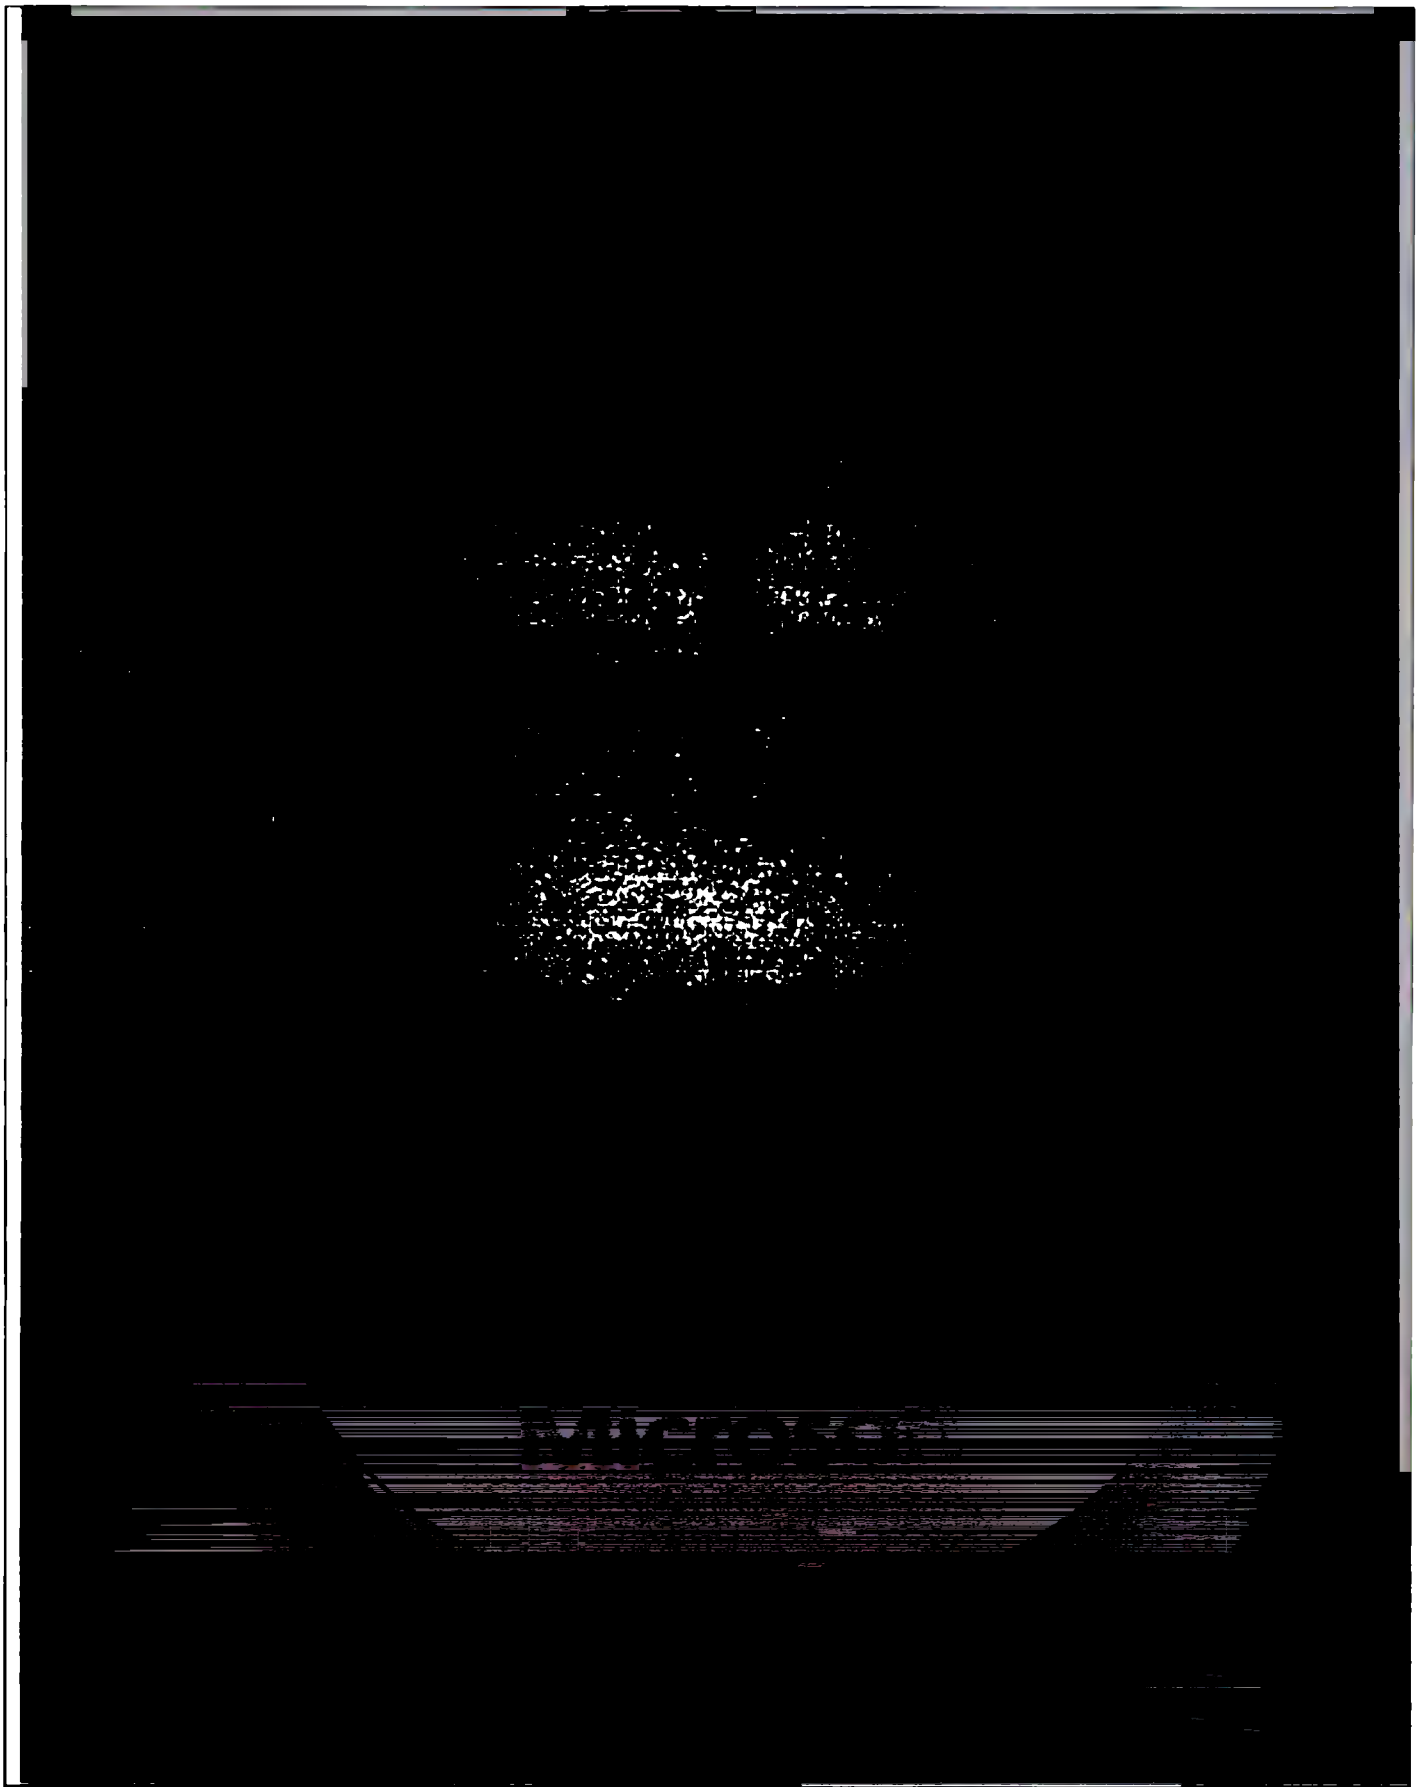

4. Рабочая станция для сбора и обработки данных Eleva Workspot, в составе: 4.4. Мышь.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Рабочая станция для сбора и обработки данных Eleva Workspot, в составе: 4.5. Источник бесперебойного питания для рабочей станции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. Выключатель экспозиции ручной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

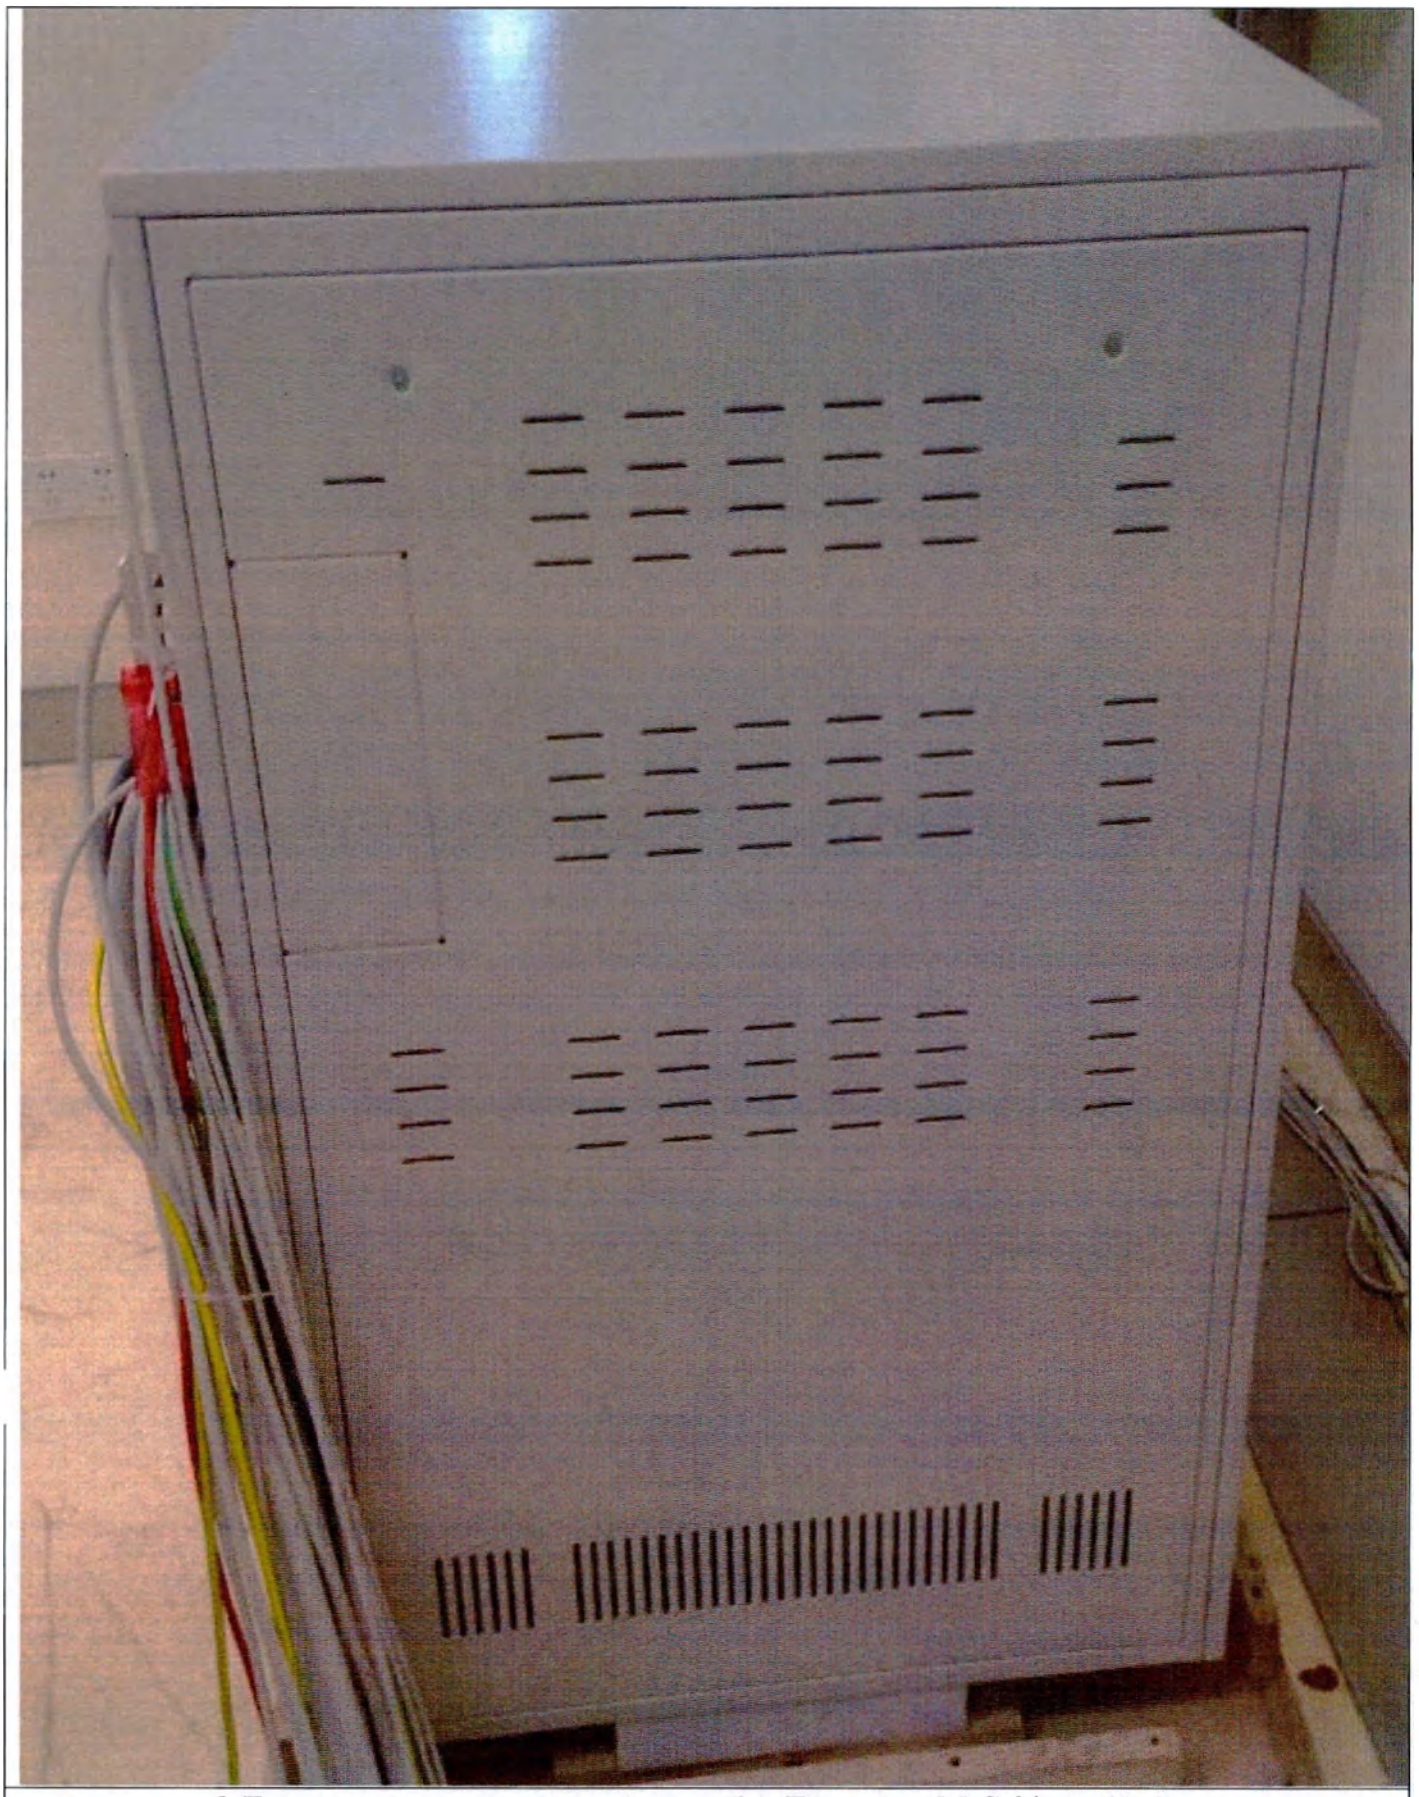

6. Генератор, варианты исполнения: 6.1. Генератор M-Cabinet, 65 кВт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

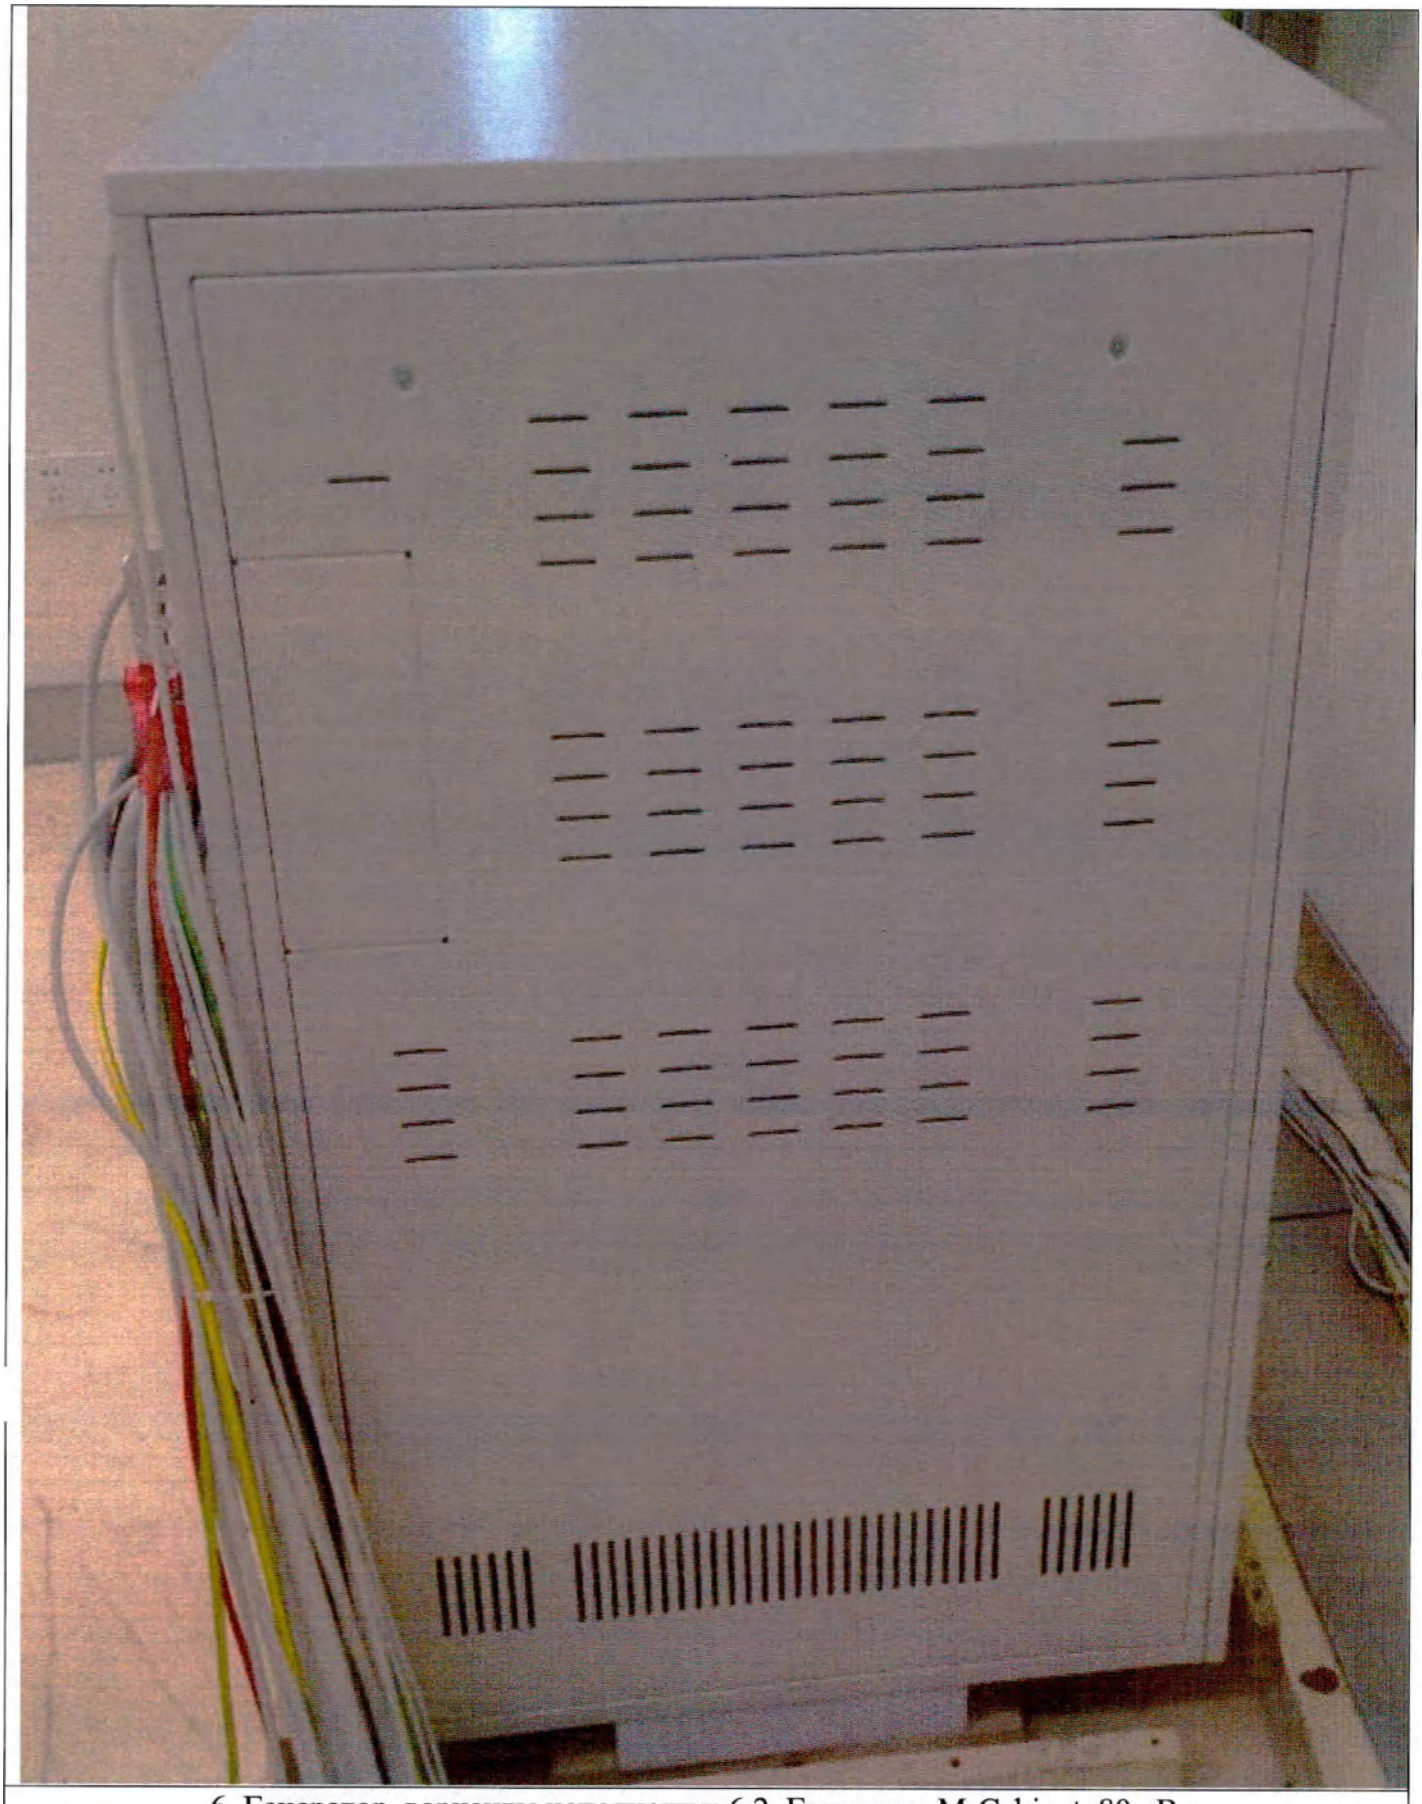

6. Генератор, варианты исполнения: 6.2. Генератор M-Cabinet, 80 кВт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



7. Детекторы переносные беспроводные, варианты исполнения: 7.1. Детектор переносной беспроводной SkyPlate Pixium 3543.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

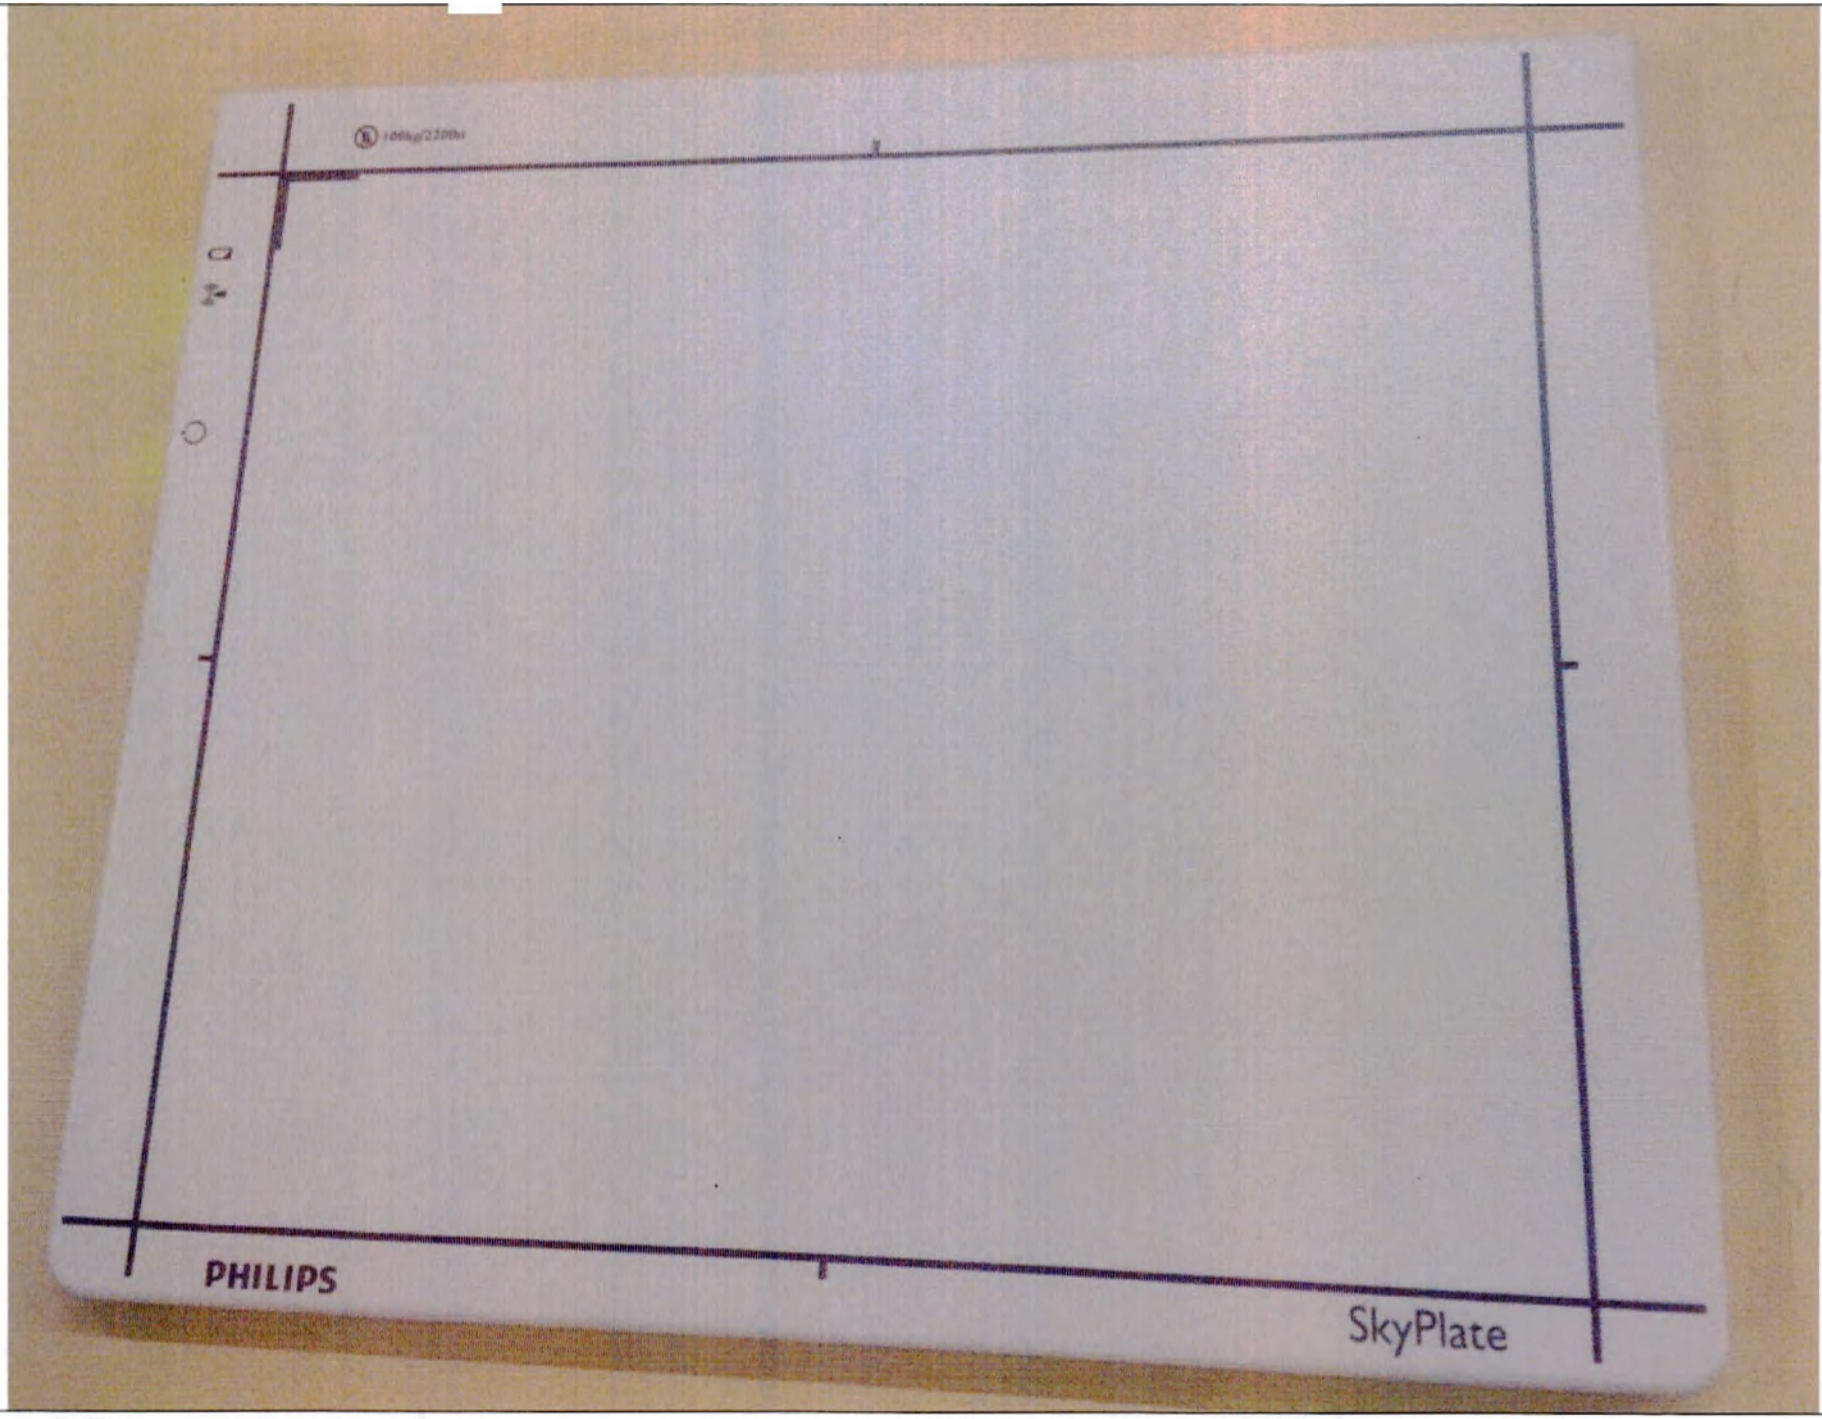

7. Детекторы переносные беспроводные, варианты исполнения: 7.2. Детектор переносной беспроводной SkyPlate Pixium 2430.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

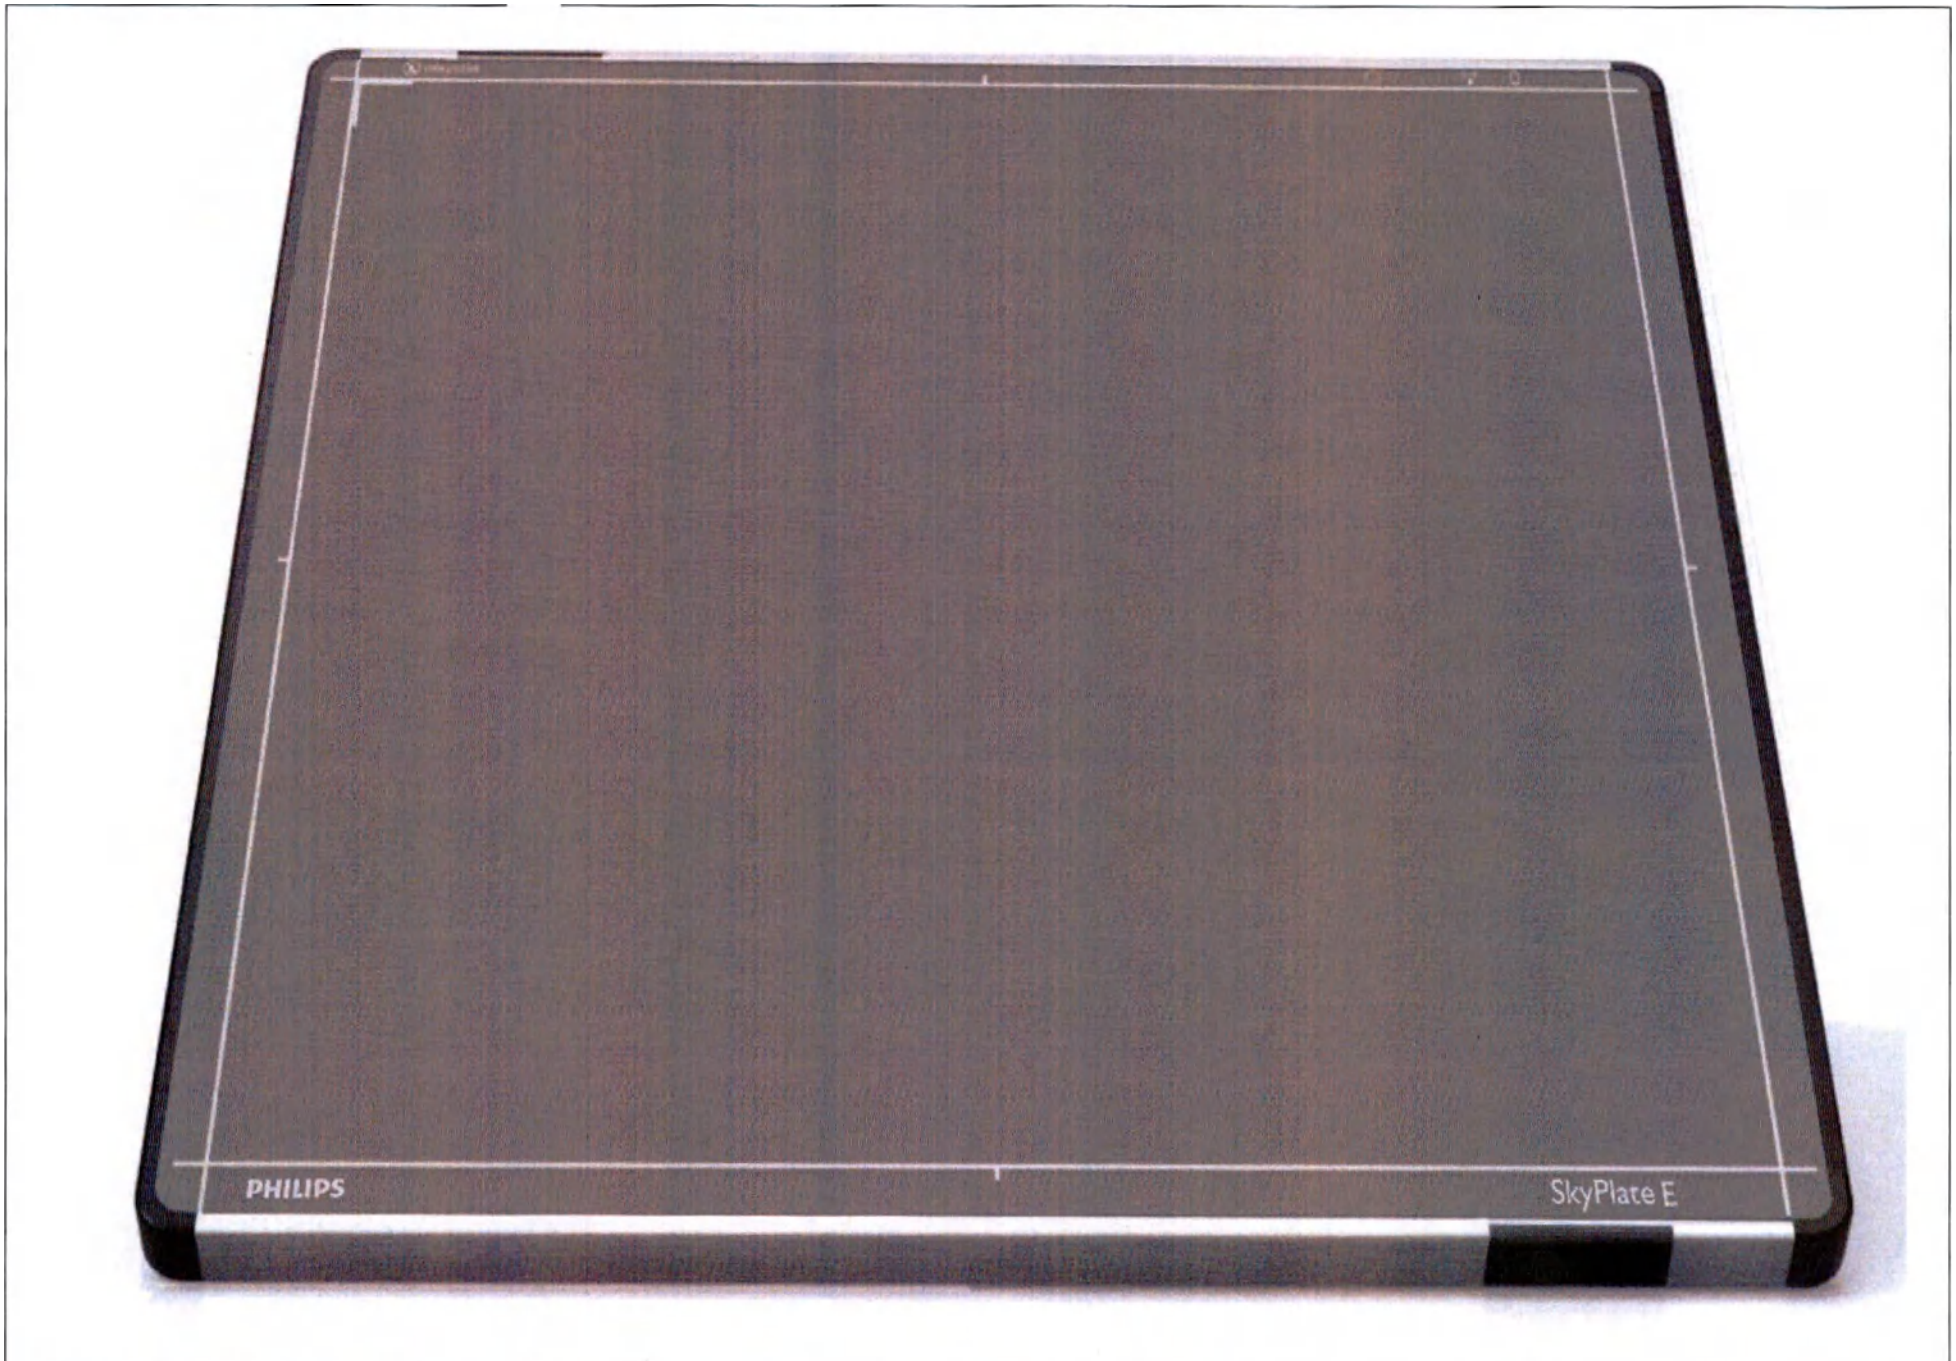

7. Детекторы переносные беспроводные, варианты исполнения: 7.3. Детектор переносной беспроводной SkyPlate E Pixium 3543.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. Программное обеспечение на USB, в составе: 8.1. «VarioFocus», 8.2. «Сшивка», 8.3. «SkyFlow», 8.4. «Bone Suppression (Подавление костей)»; 8.5. «mShield»; 8.6. «DICOM Q/R»; 8.7. «Advanced DICOM»; 8.8. Программное обеспечение интерфейса АРМ лаборанта; 8.9. «Dose Report in DICOM SR Format»; 8.10. «Clinical QC».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. Программное обеспечение на CD/DVD дисках, в составе: 8.1. «VarioFocus», 8.2. «Сшивка», 8.3. «SkyFlow», 8.4. «Bone Suppression (Подавление костей)»; 8.5. «mShield»; 8.6. «DICOM Q/R»; 8.7. «Advanced DICOM»; 8.8. Программное обеспечение интерфейса АРМ лаборанта; 8.9. «Dose Report in DICOM SR Format»; 8.10. «Clinical QC».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Руководство по эксплуатации

Русский

DigitalDiagnost C90

Версия 1.0

PHILIPS

9. Эксплуатационная документация на электронных и/или бумажных носителях.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

II. Принадлежности:

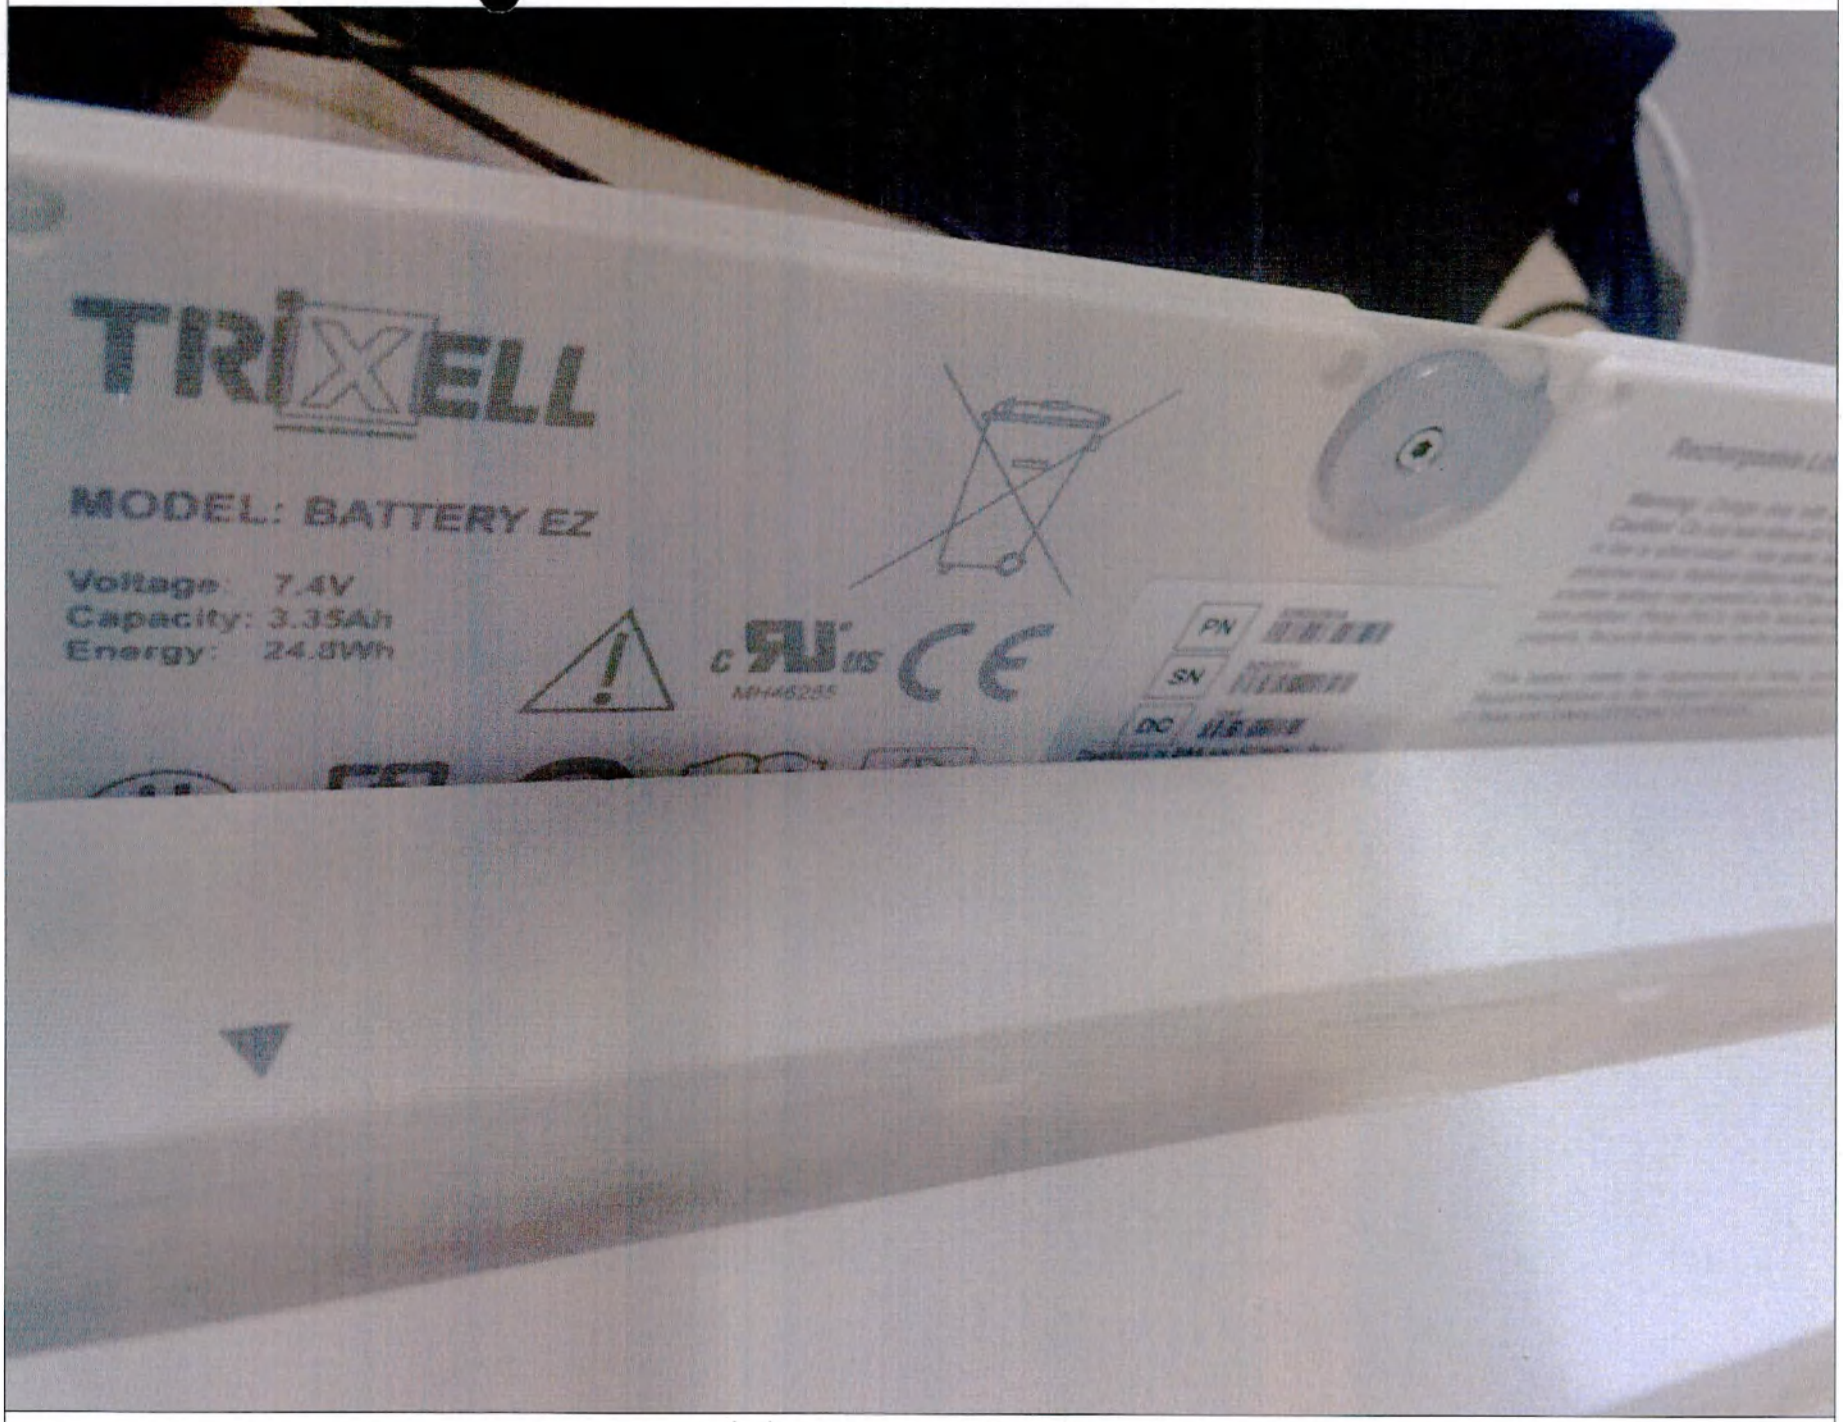

1. Аккумуляторы детектора.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2. Зарядные устройства для аккумулятора детектора.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Решетки отсеивающие для переносного детектора, варианты исполнения: 3.1. Решетка отсеивающая горизонтальная 40/8/130 для детектора SkyPlate Pixium 3543.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

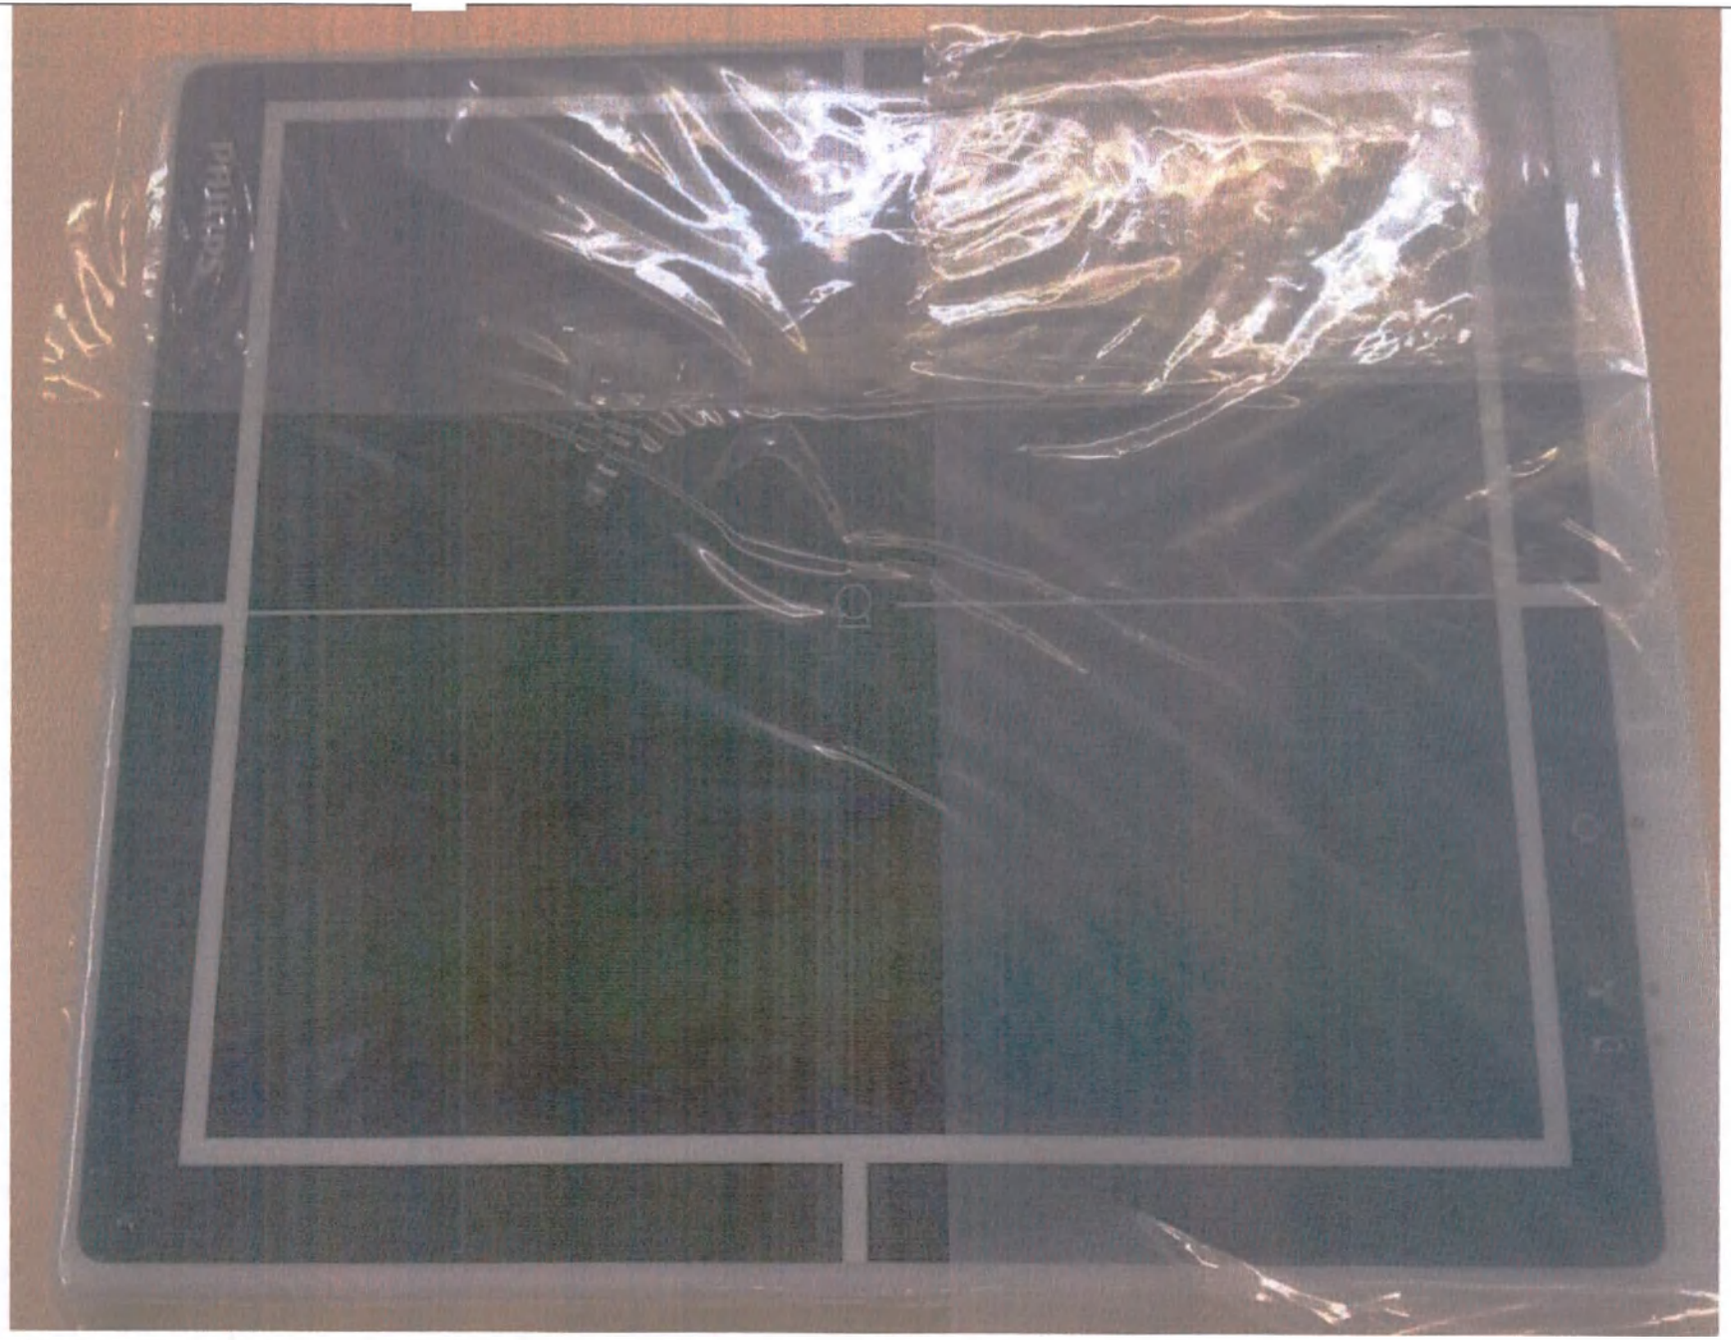

3. Решетки отсеивающие для переносного детектора, варианты исполнения: 3.2. Решетка отсеивающая вертикальная 40/8/130 для детектора SkyPlate Pixium 2430.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

3. Решетки отсеивающие для переносного детектора, варианты исполнения: 3.3. Решетка отсеивающая вертикальная 44/8/130 для детектора SkyPlate Pixium 3543.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

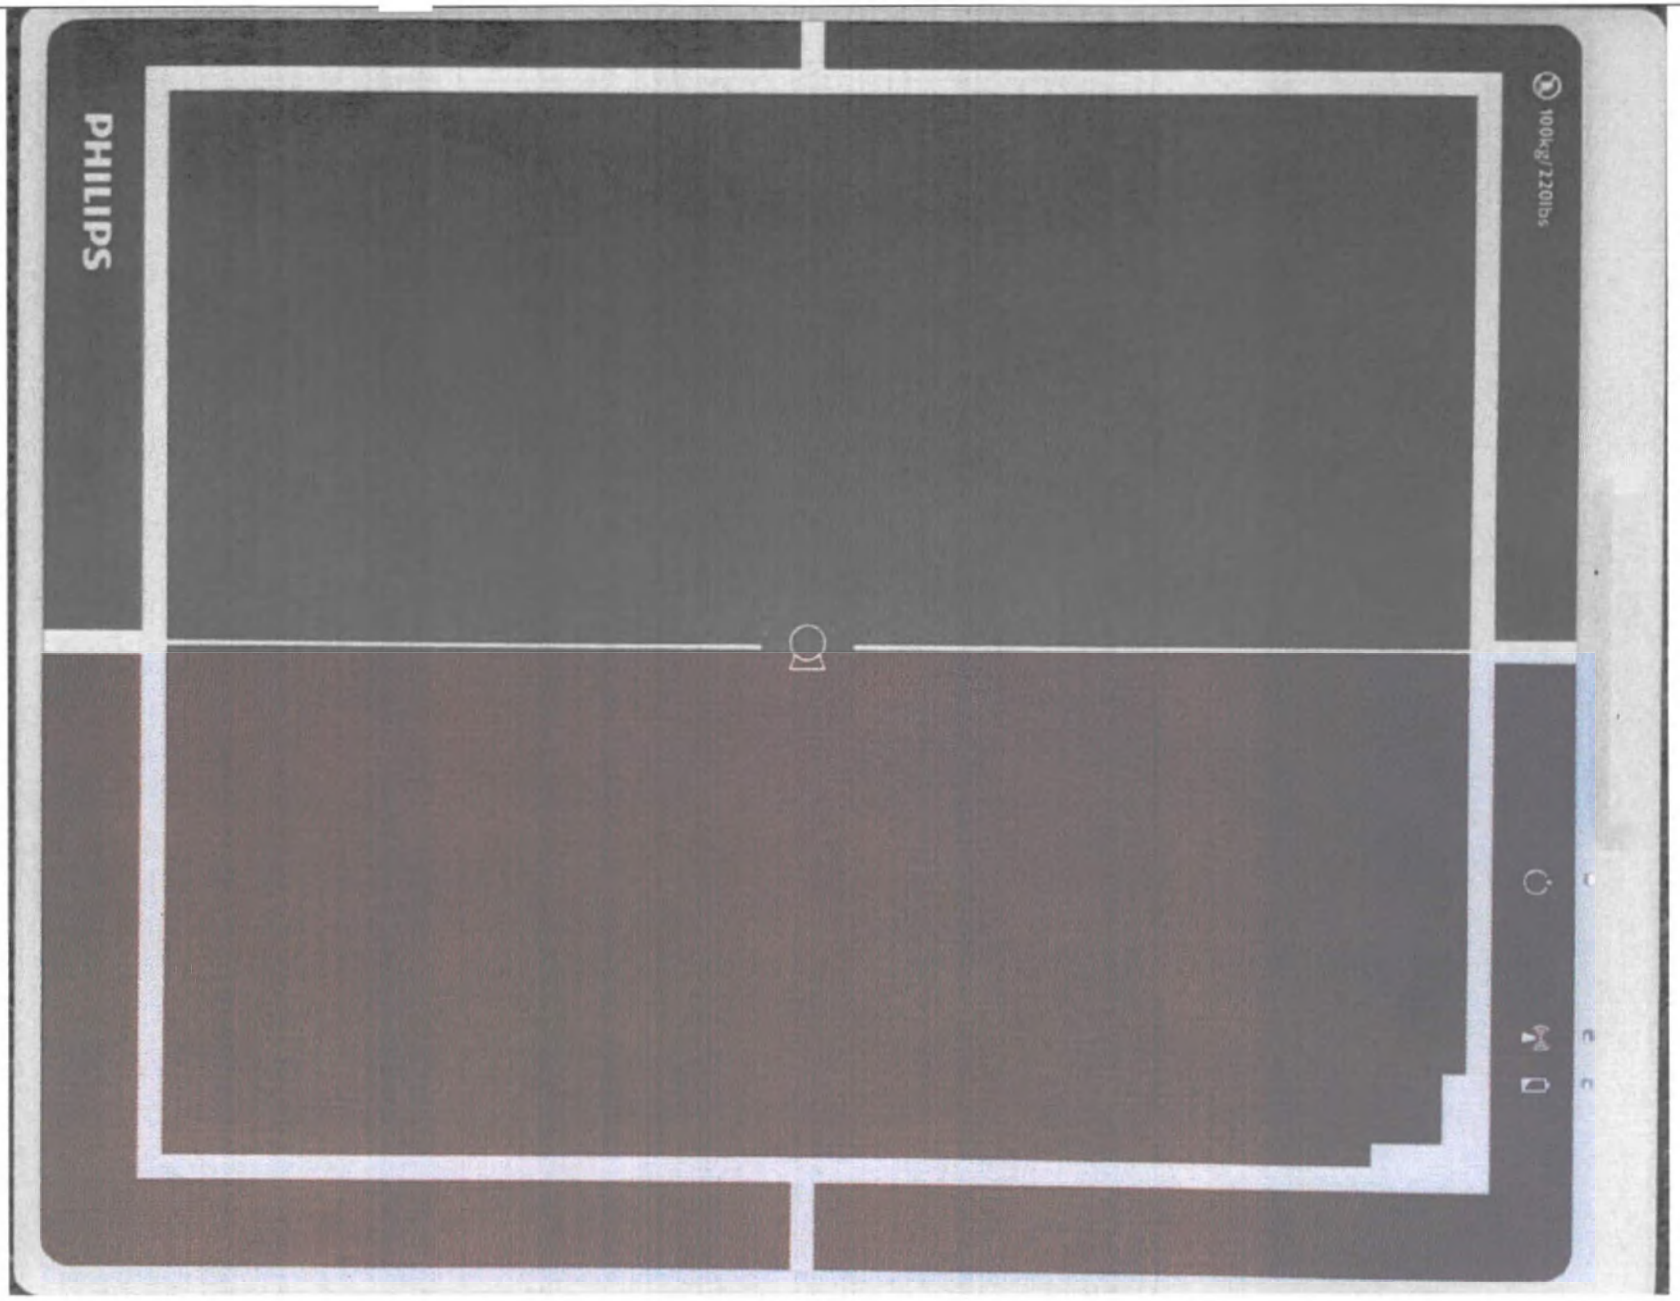

3. Решетки отсеивающие для переносного детектора, варианты исполнения: 3.4. Решетка отсеивающая вертикальная 40/8/130 для детектора SkyPlate E Pixium 3543.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

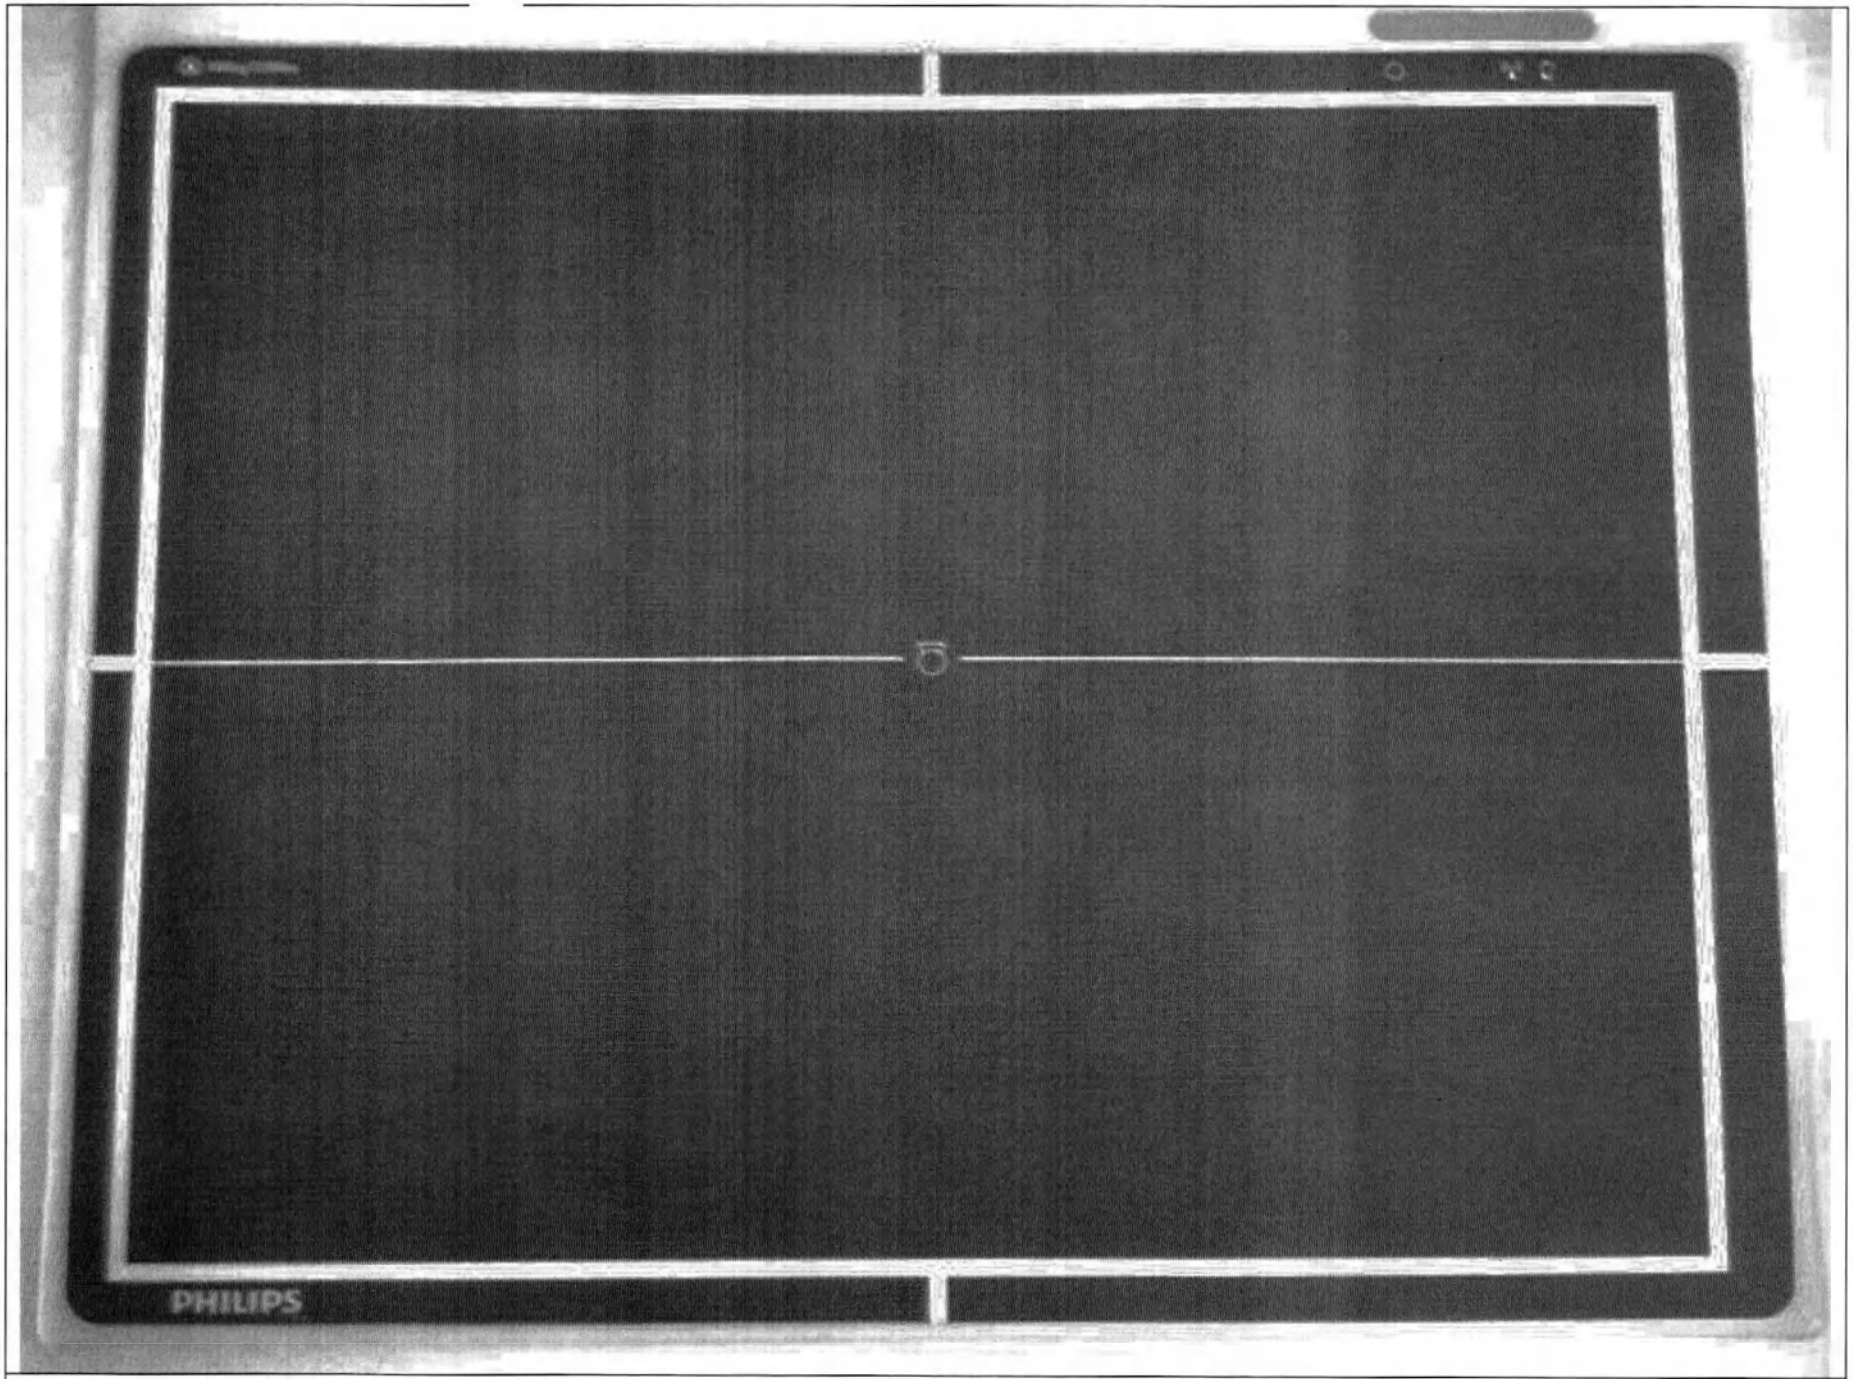

3. Решетки отсеивающие для переносного детектора, варианты исполнения: 3.5 Решетка отсеивающая горизонтальная 40/8/130 для детектора SkyPlate E Pixium 3543.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

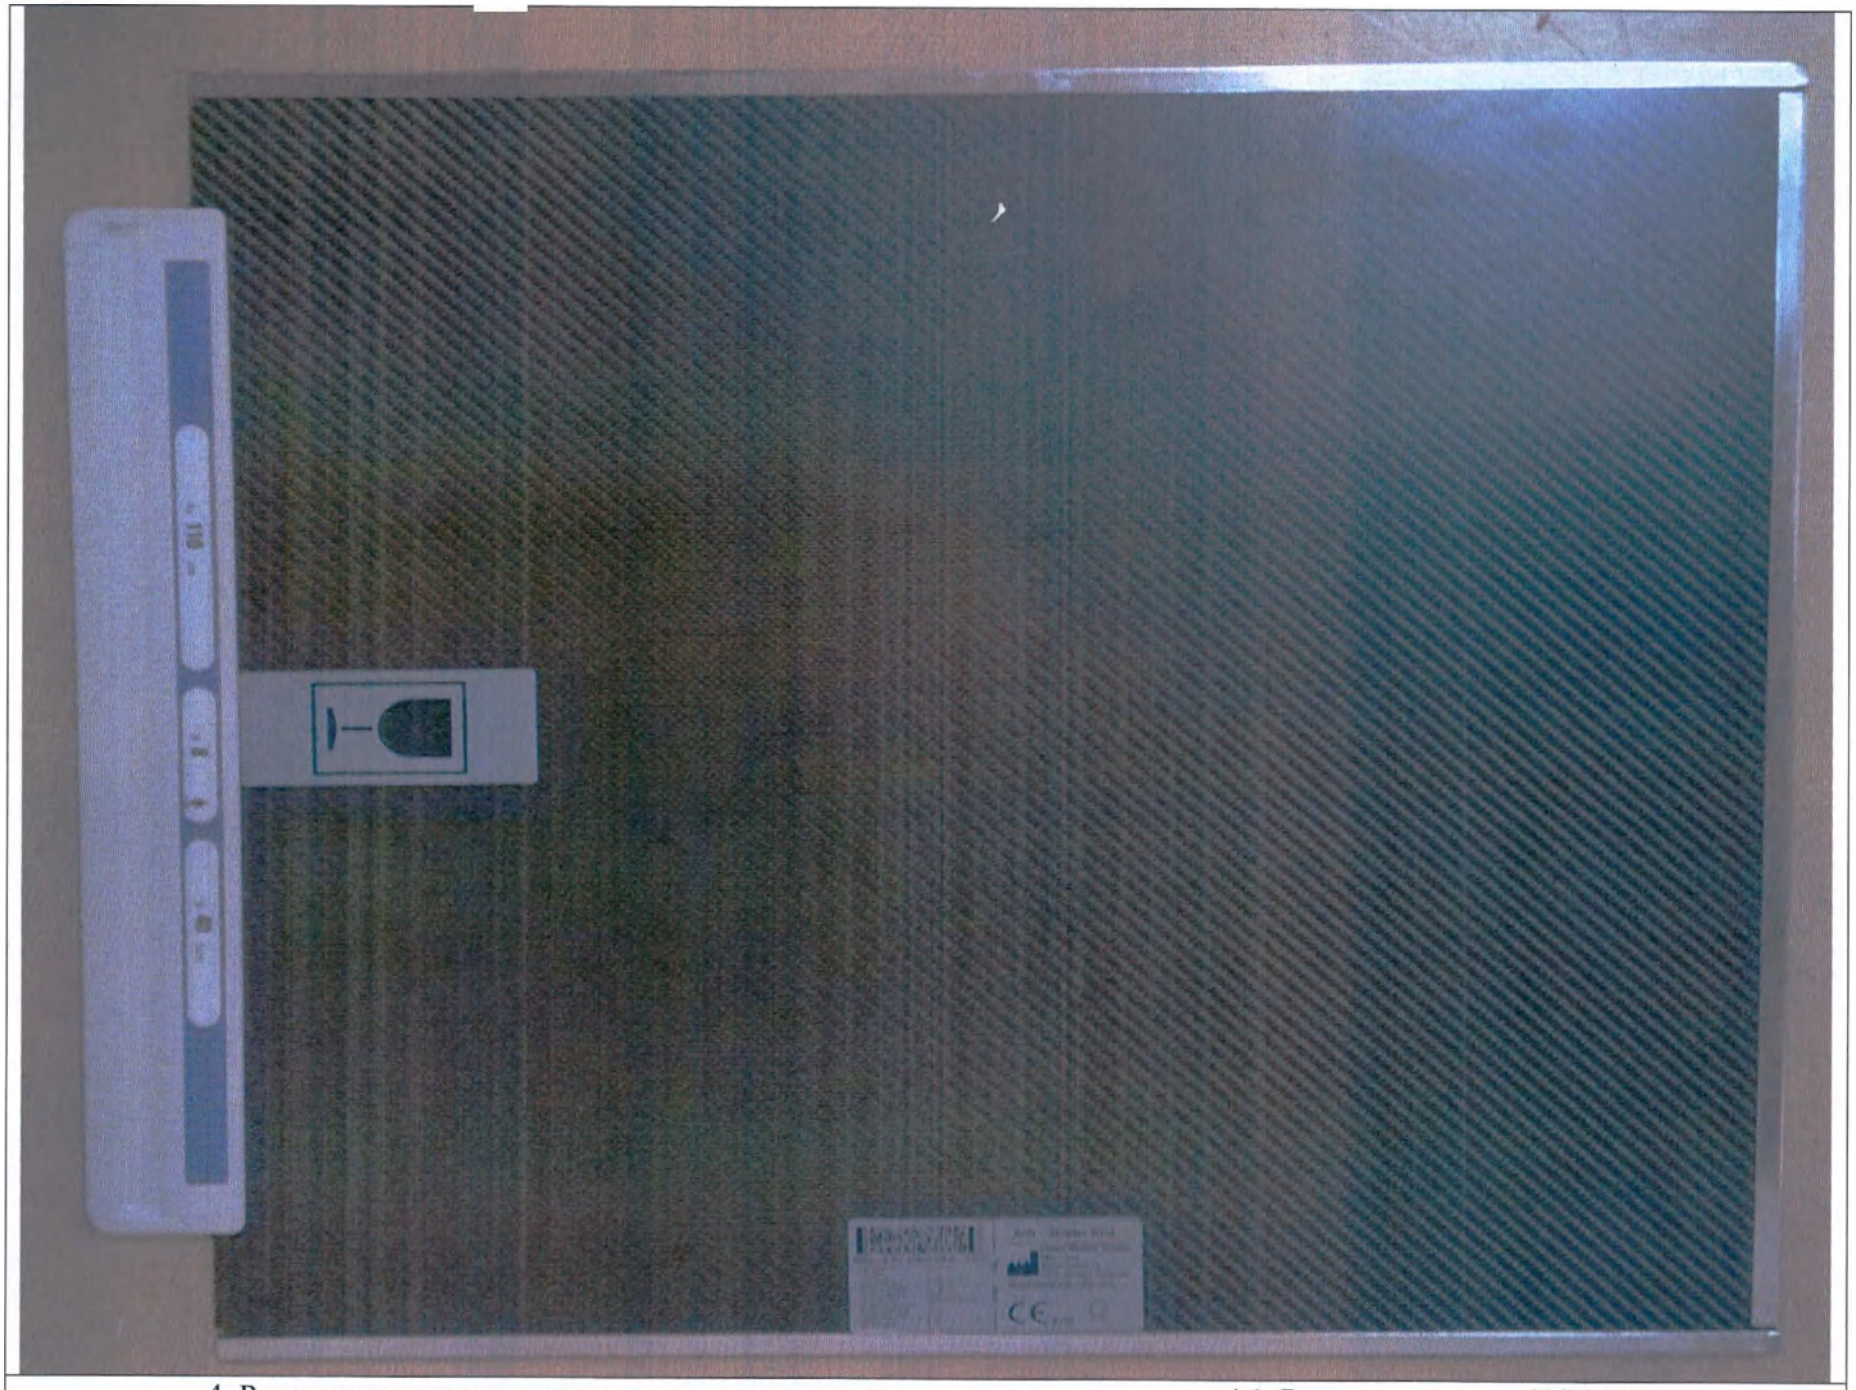

4. Решетки сменные универсальные для детектора, варианты исполнения: 4.1. Решетка сменная 40/8/110.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Решетки сменные универсальные для детектора, варианты исполнения: 4.2. Решетка сменная 40/8/140.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

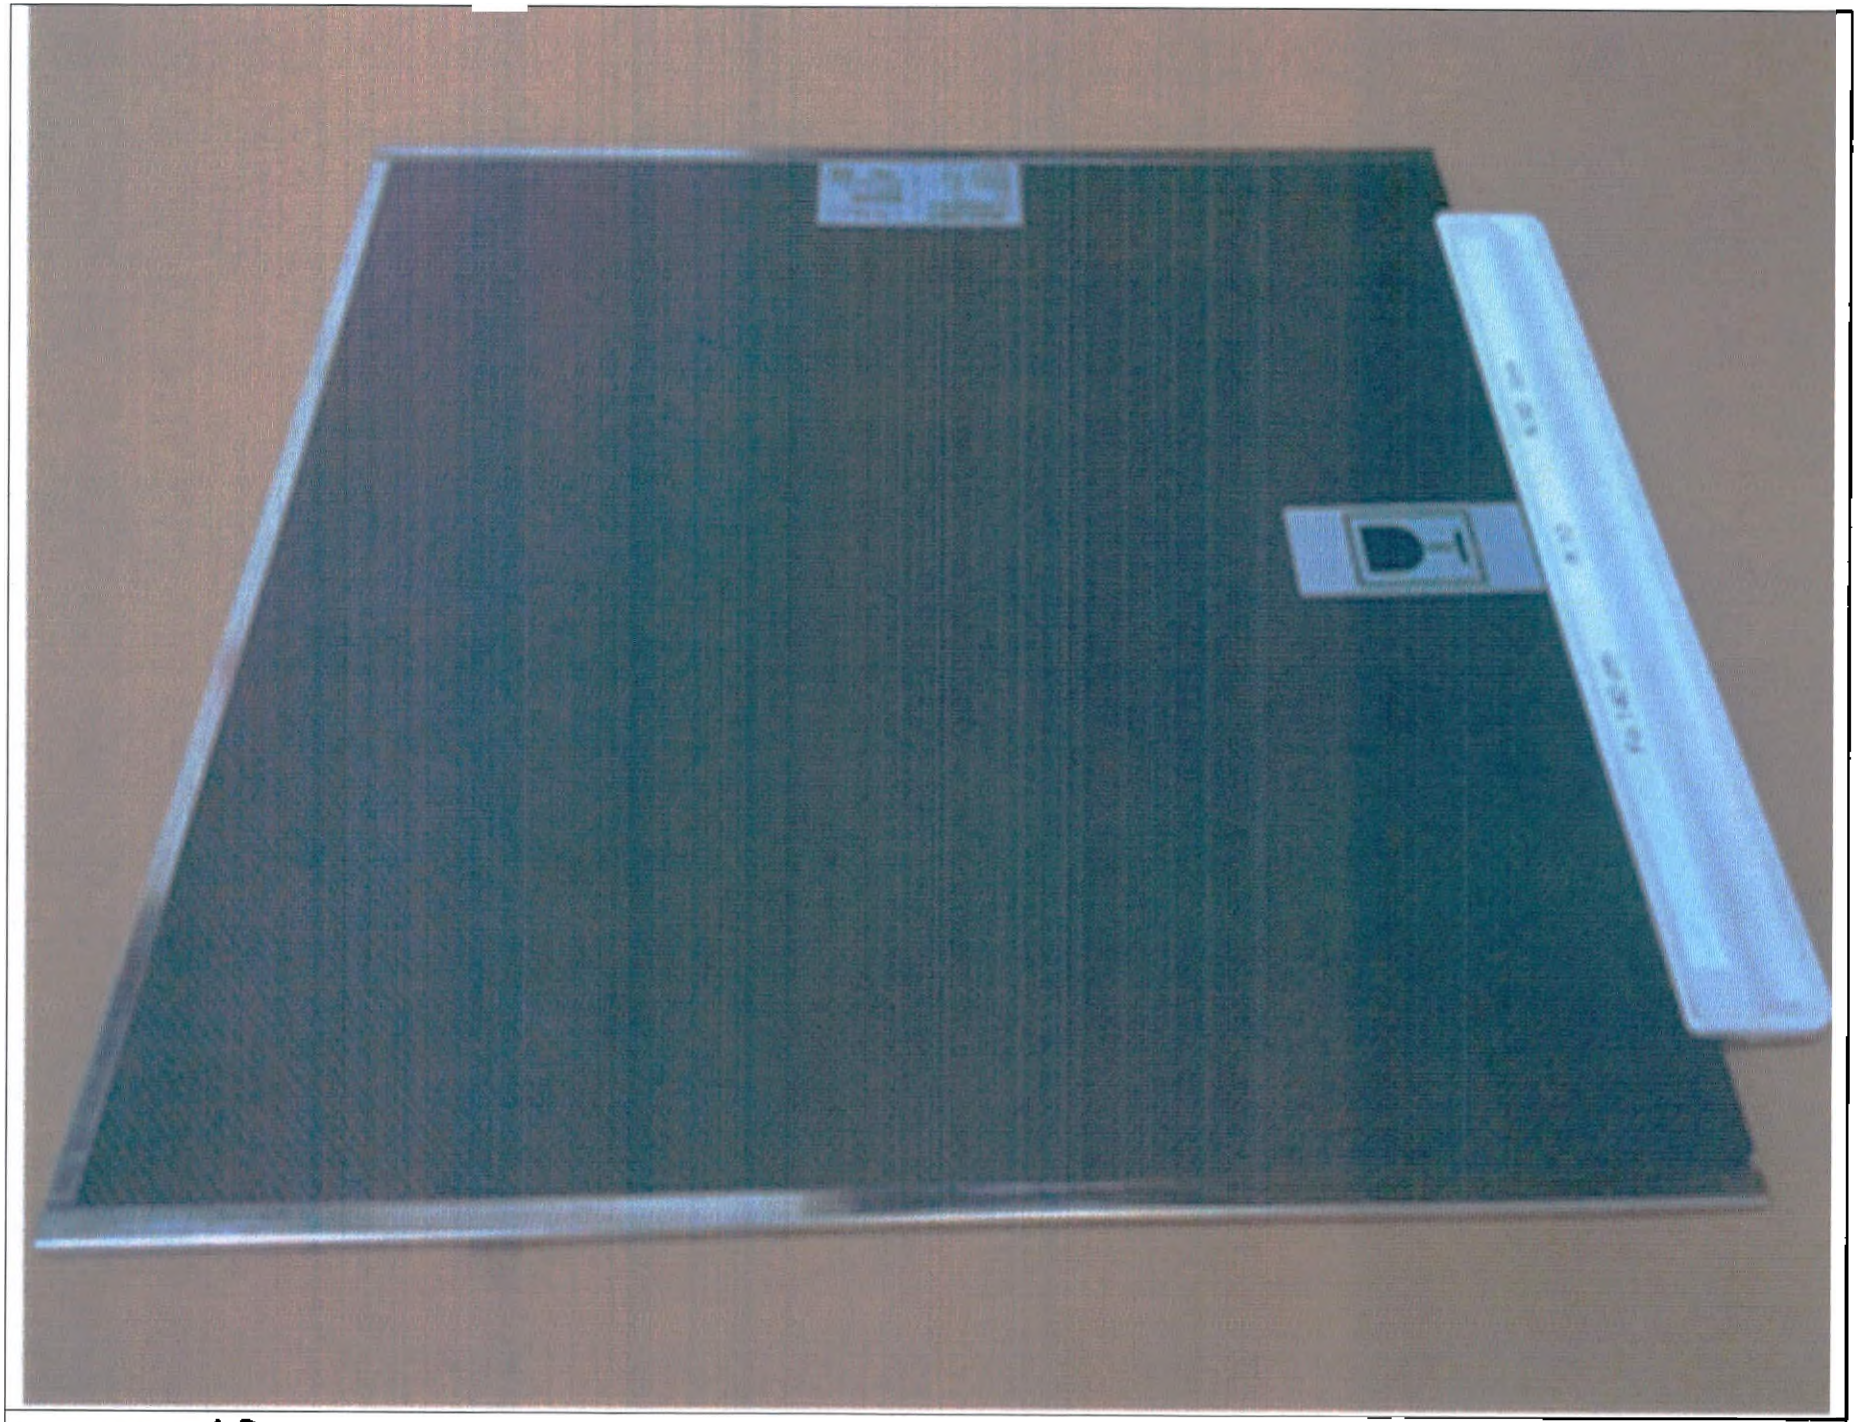

4. Решетки сменные универсальные для детектора, варианты исполнения: 4.3. Решетка сменная 40/8/180.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Решетки сменные универсальные для детектора, варианты исполнения: 4.4. Решетка сменная 40/12/110.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Решетки сменные универсальные для детектора, варианты исполнения: 4.5. Решетка сменная 40/12/140.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

4. Решетки сменные универсальные для детектора, варианты исполнения: 4.6 Решетка сменная 40/12/180.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. Комплект пультов дистанционного управления, в составе: 5.1. Пульт дистанционного управления потолочного подвеса CSM3.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. Комплект пультов дистанционного управления, в составе: 5.2. Пульт дистанционного управления стоек вертикальных VS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

5. Комплект пультов дистанционного управления, в составе: 5.3. Пульт дистанционного управления стойки универсальной VM моторизированной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6. Кабели резервные для детектора, варианты исполнения: 6.1. Кабель резервный для детектора короткий — 2 м.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

6. Кабели резервные для детектора, варианты исполнения: 6.2. Кабель резервный для детектора короткий — 7 м.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

7. Комплект рельсов для кабелепровода, в составе: 7.1. Рельс для кабелепровода потолочного подвеса CSM3.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

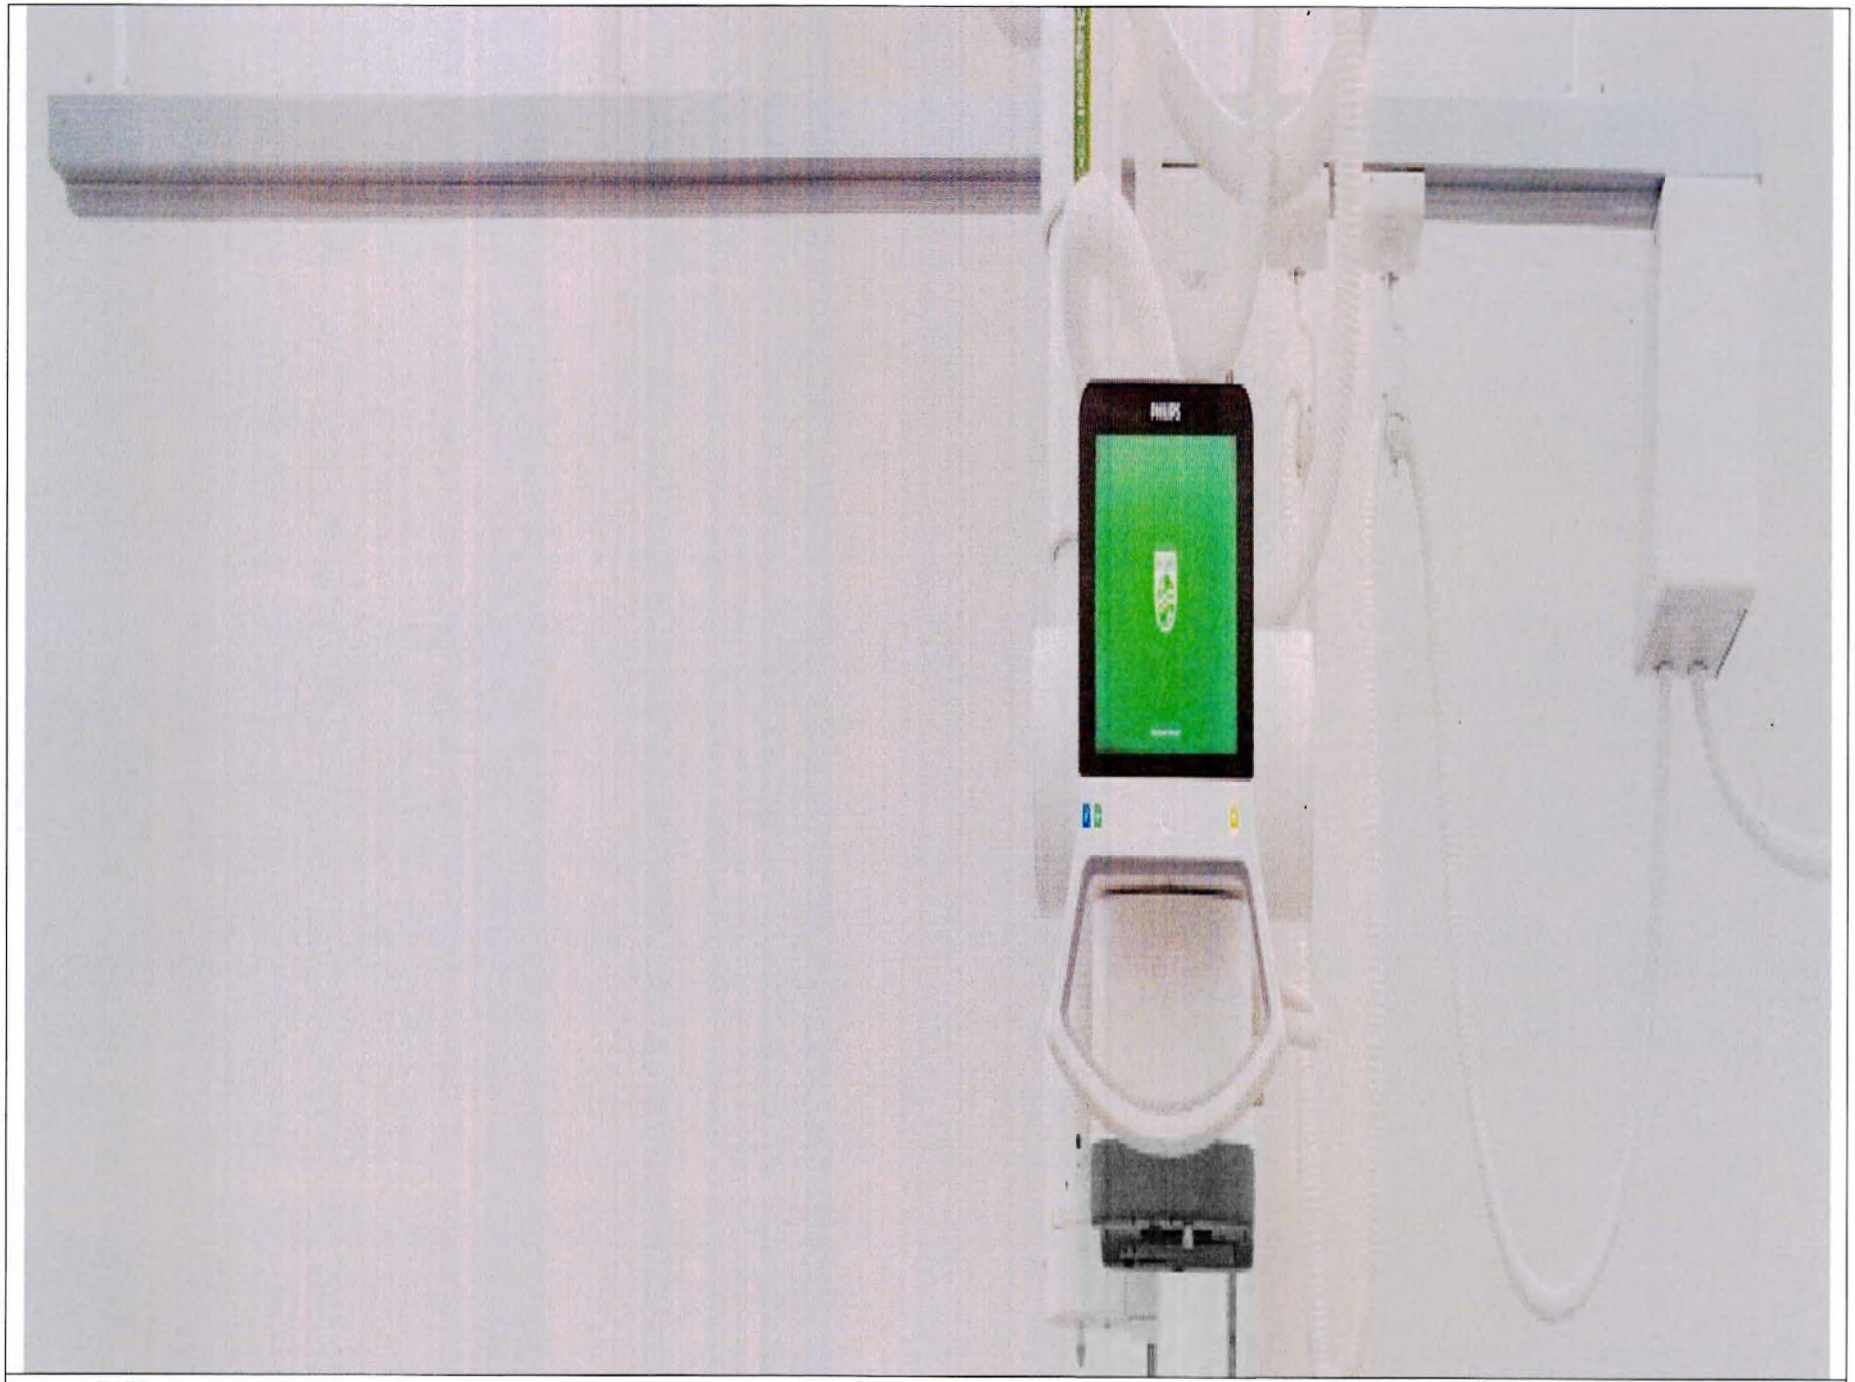

7. Комплект рельсов для кабелепровода, в составе: 7.2. Рельс для кабелепровода универсальной вертикальной стойки VM моторизированной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

8. Комплект кабелепроводов, в составе: 8.1. Кабелепровод для потолочного подвеса CSM3.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

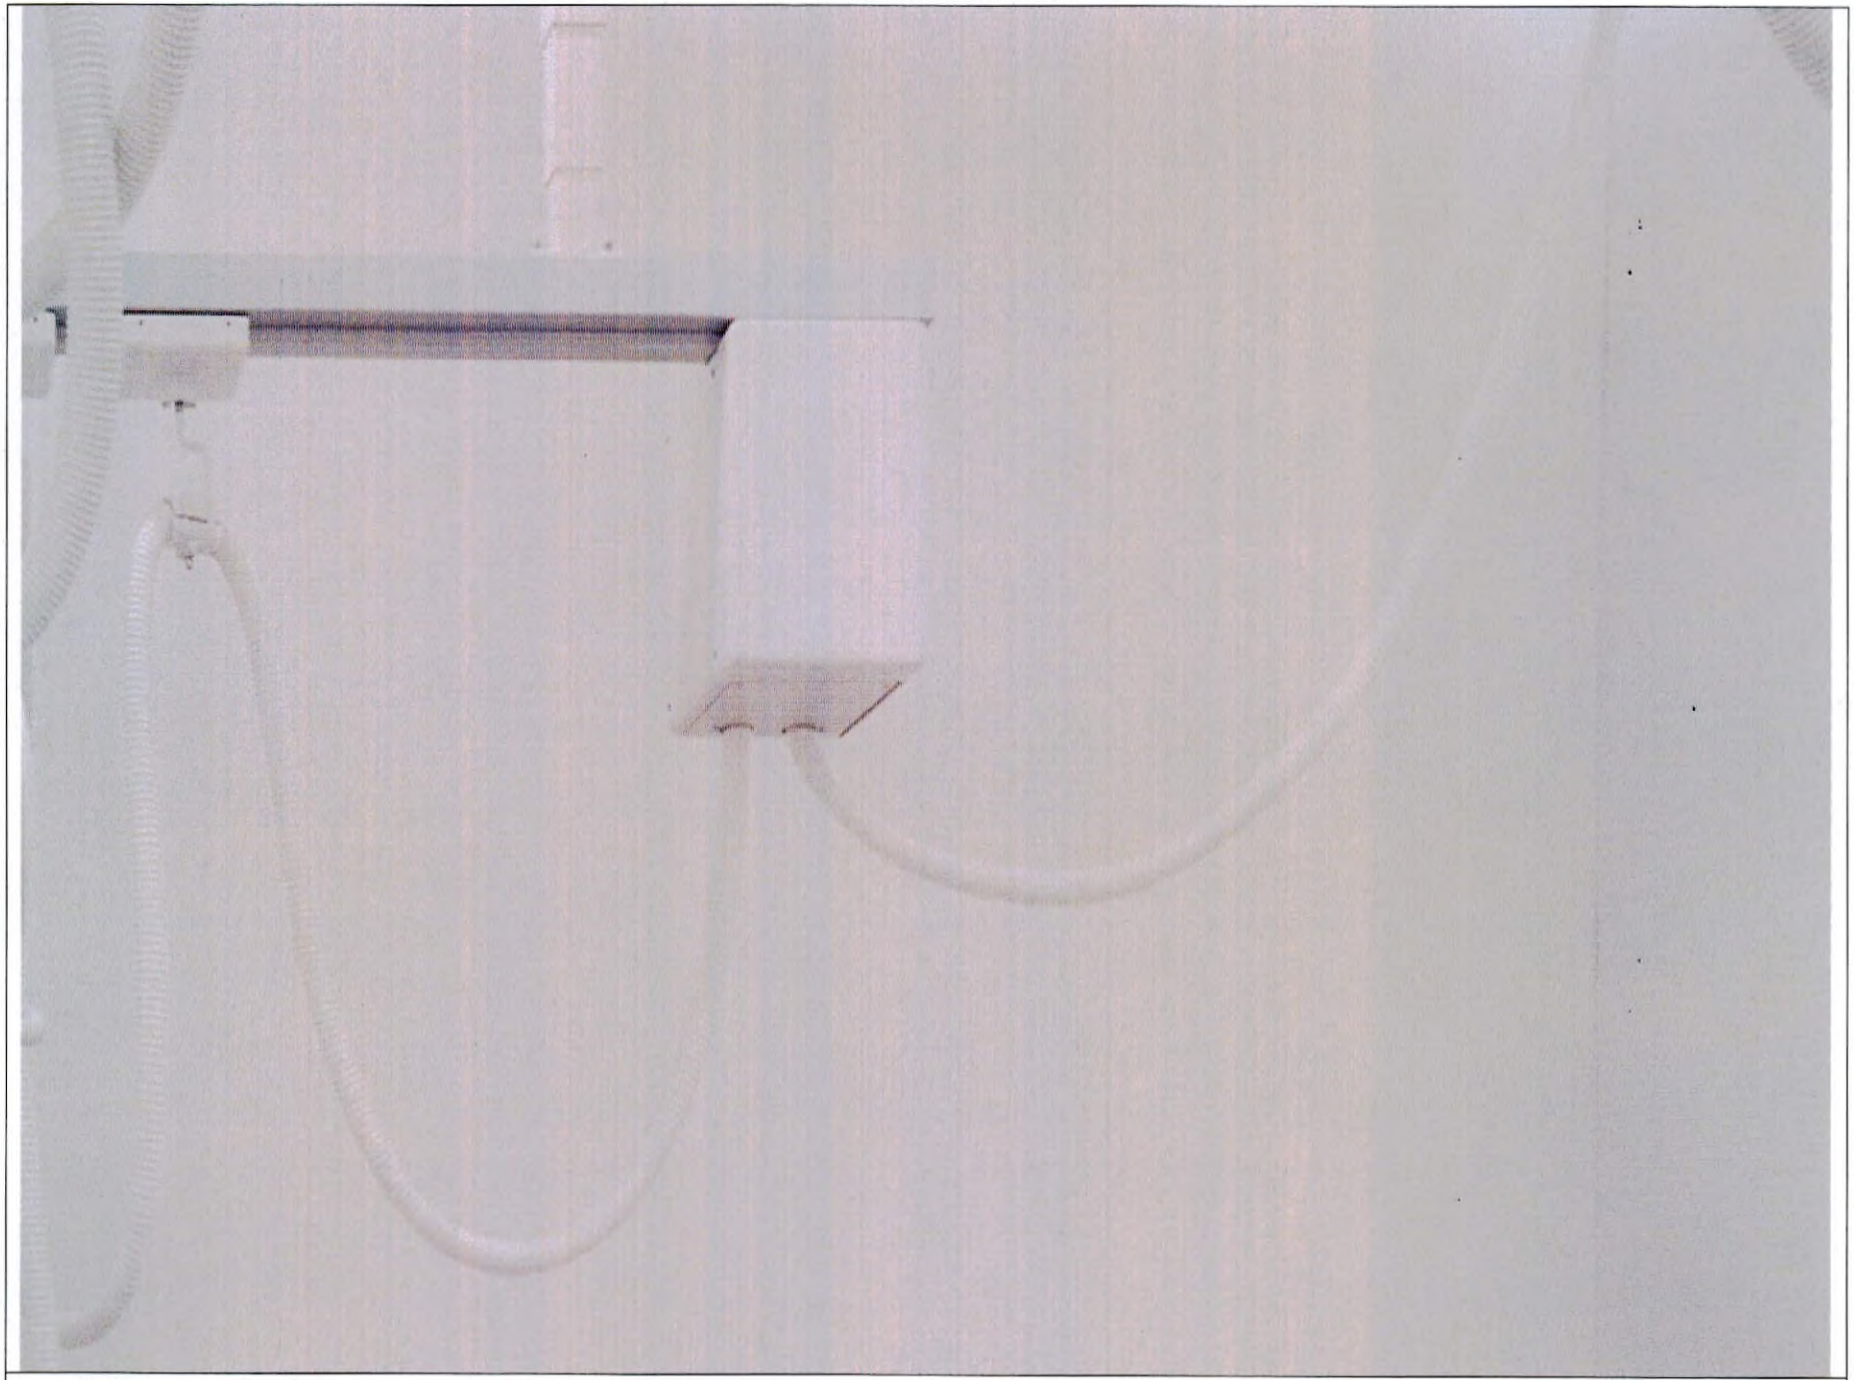

8. Комплект кабелепроводов, в составе: 8.2. Кабелепровод для универсальной вертикальной стойки VM моторизированной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

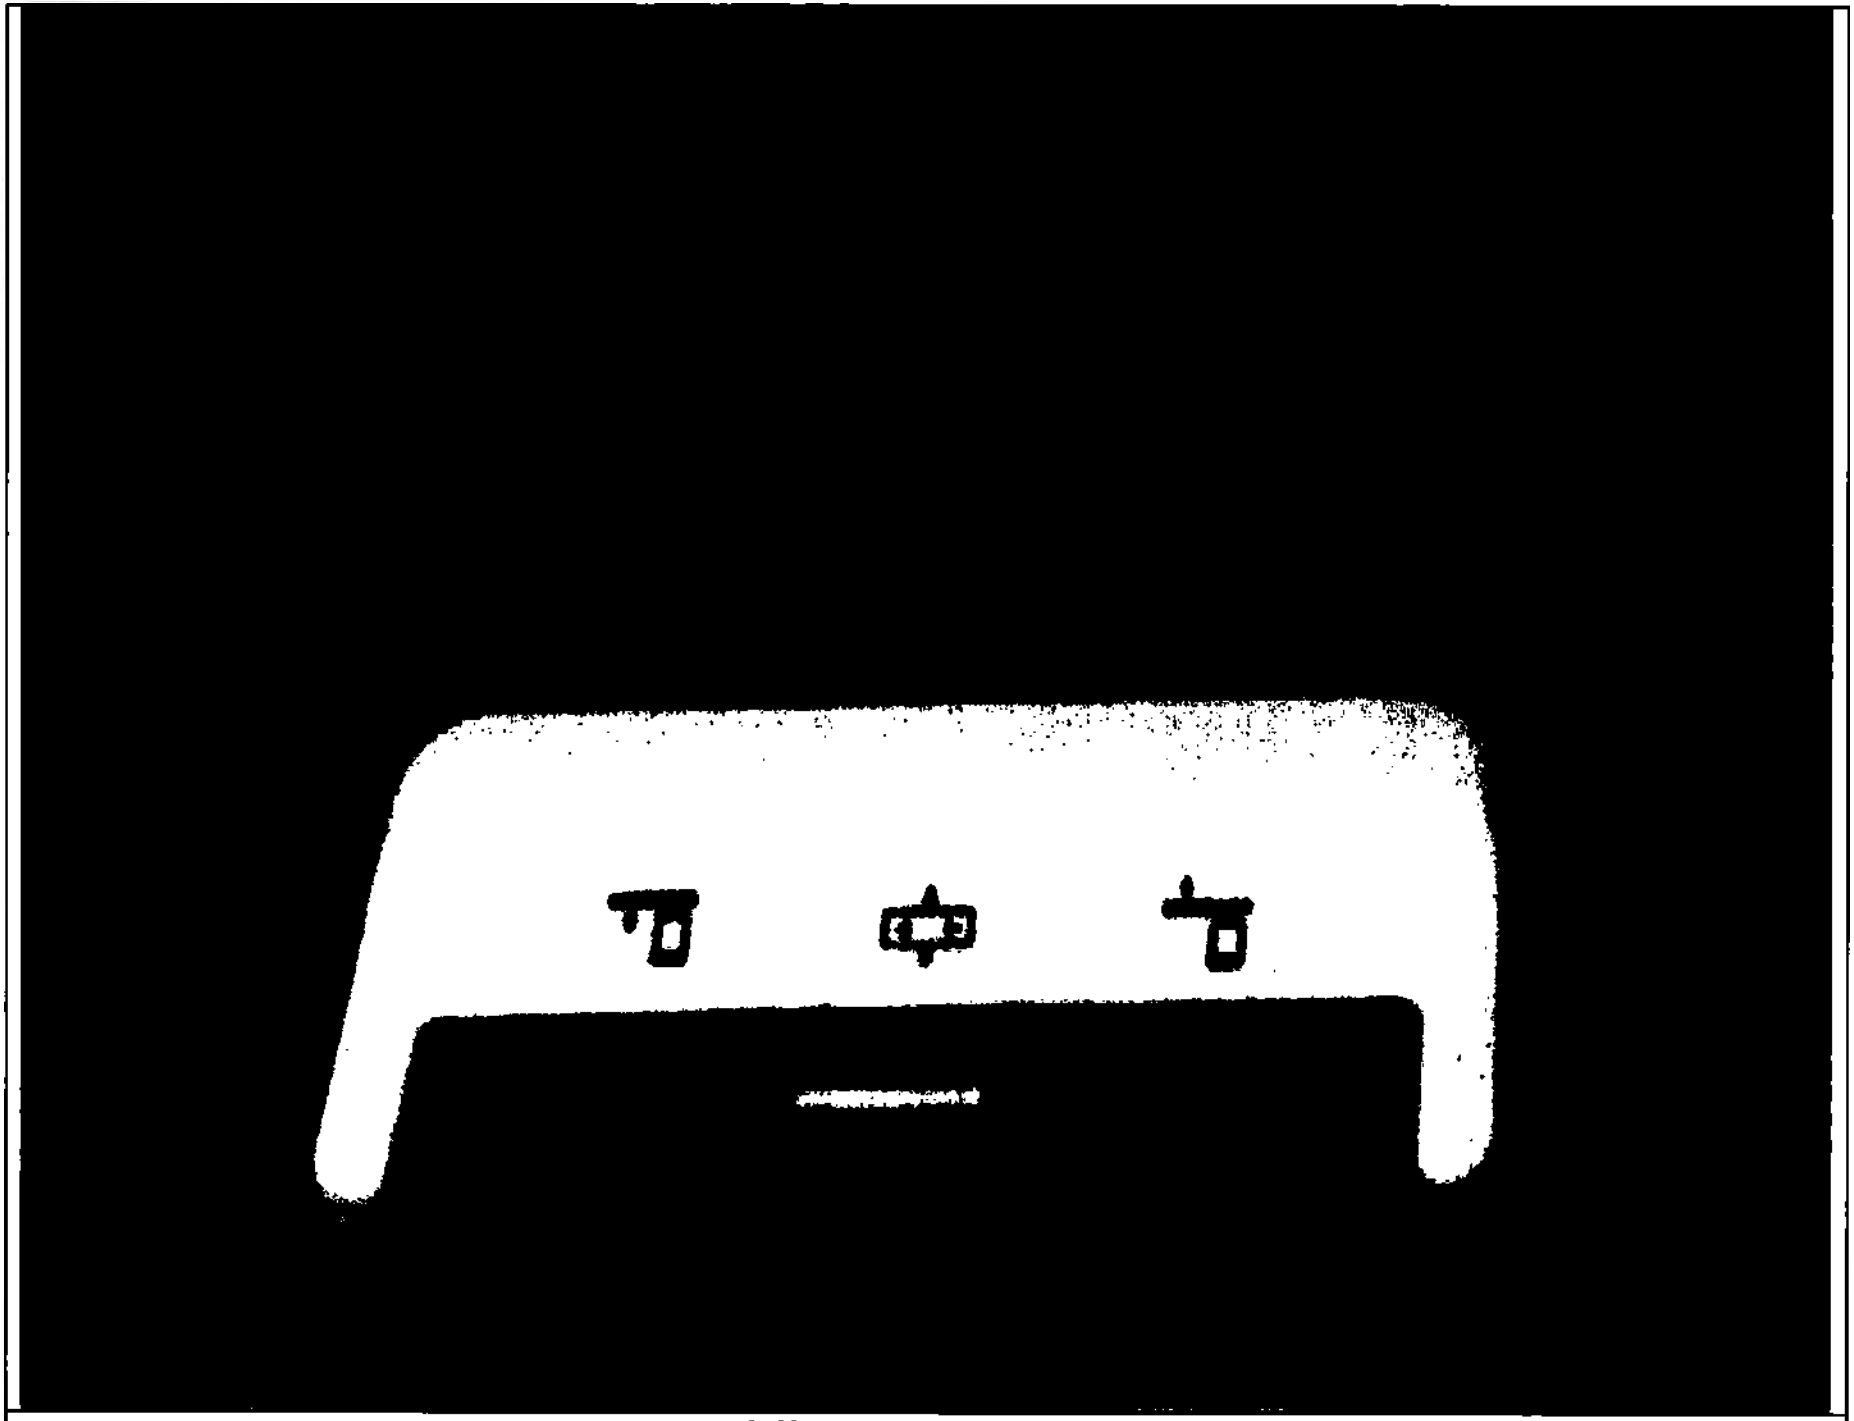

9. Ножной переключатель.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

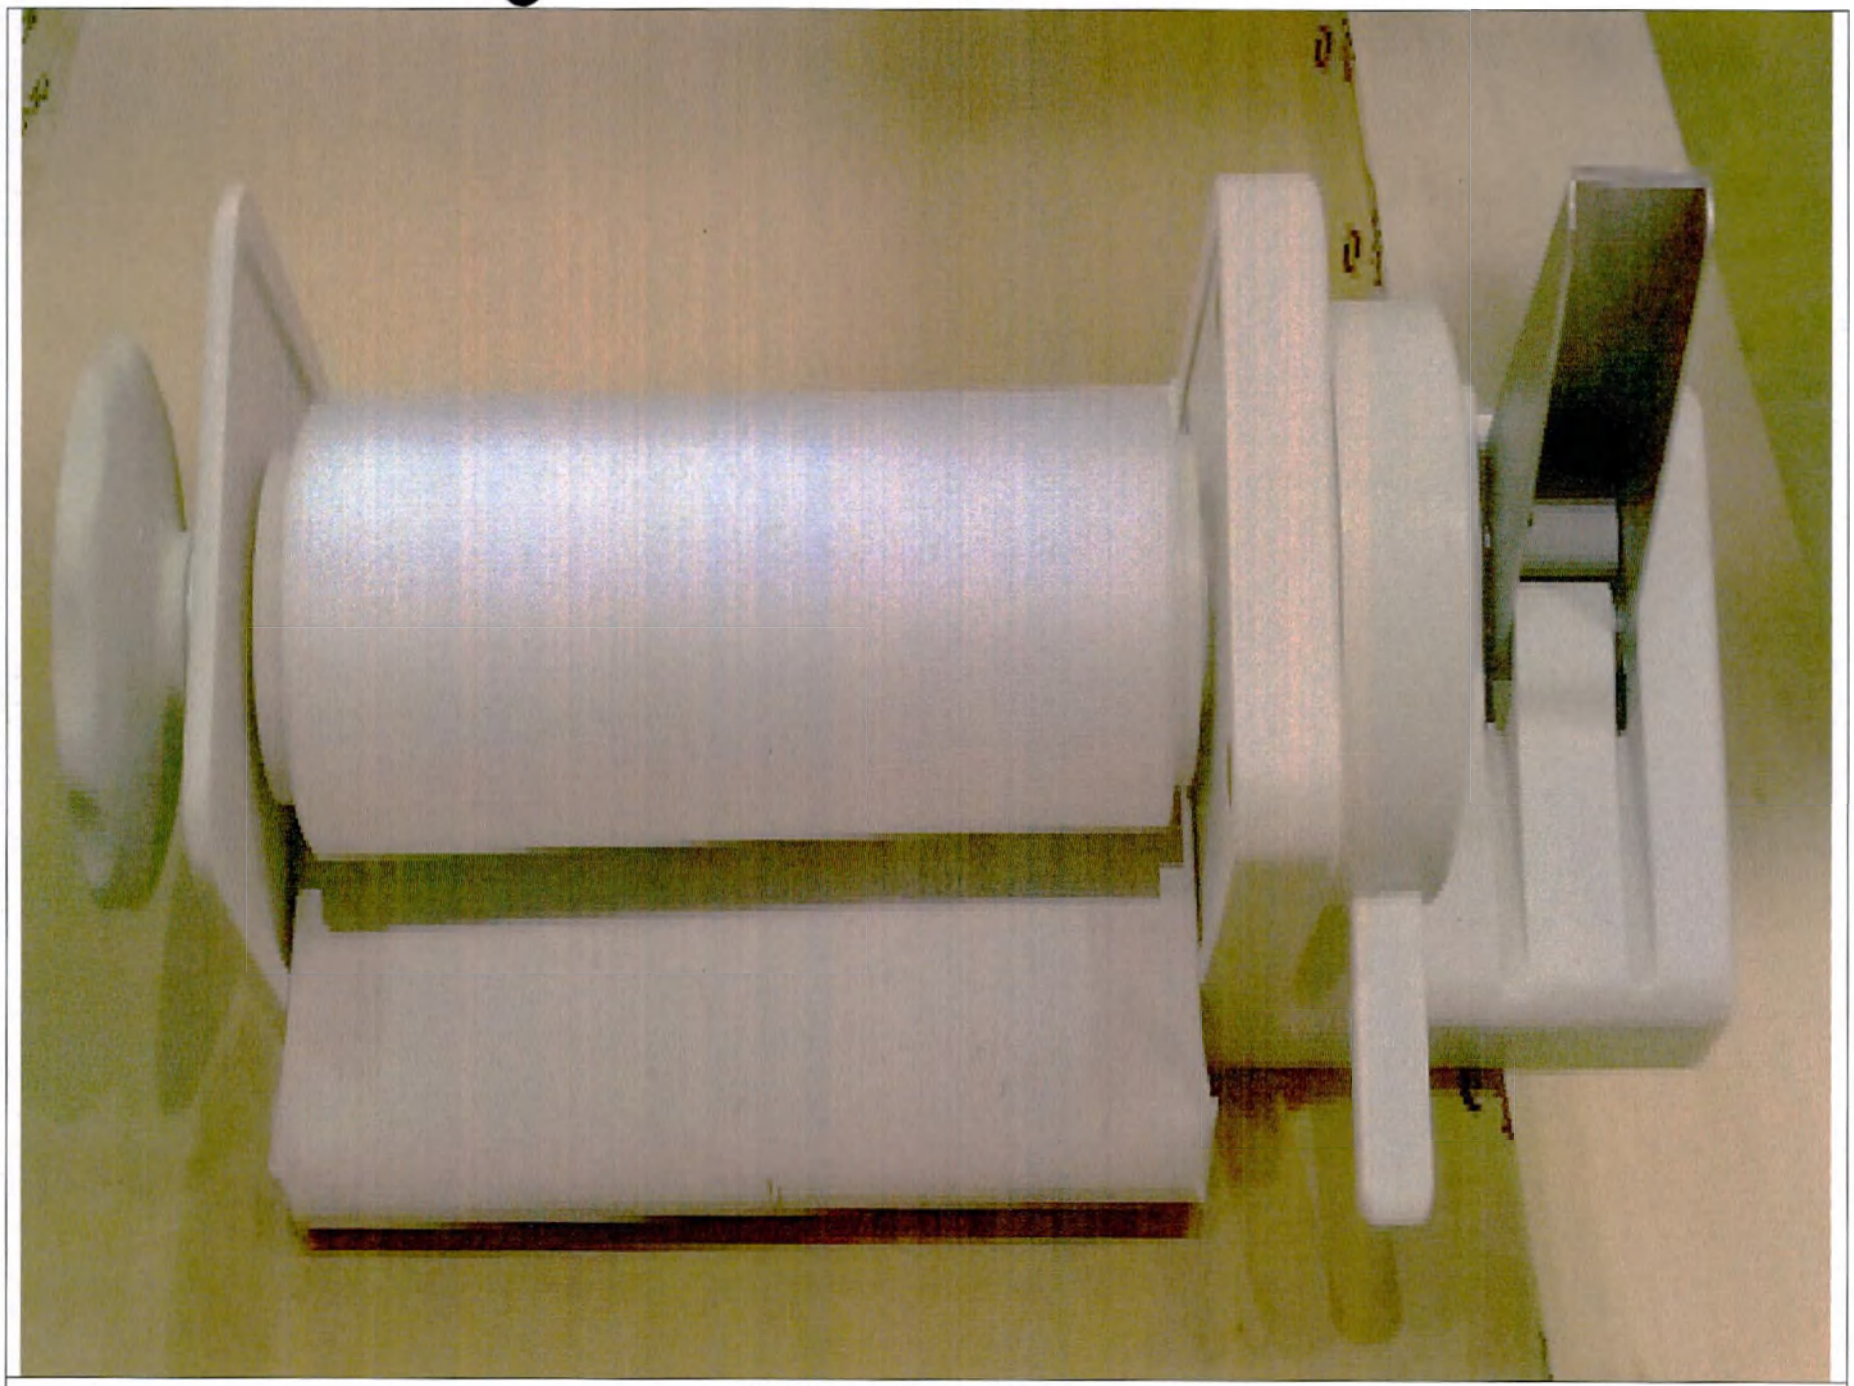

10. Компрессионная лента.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

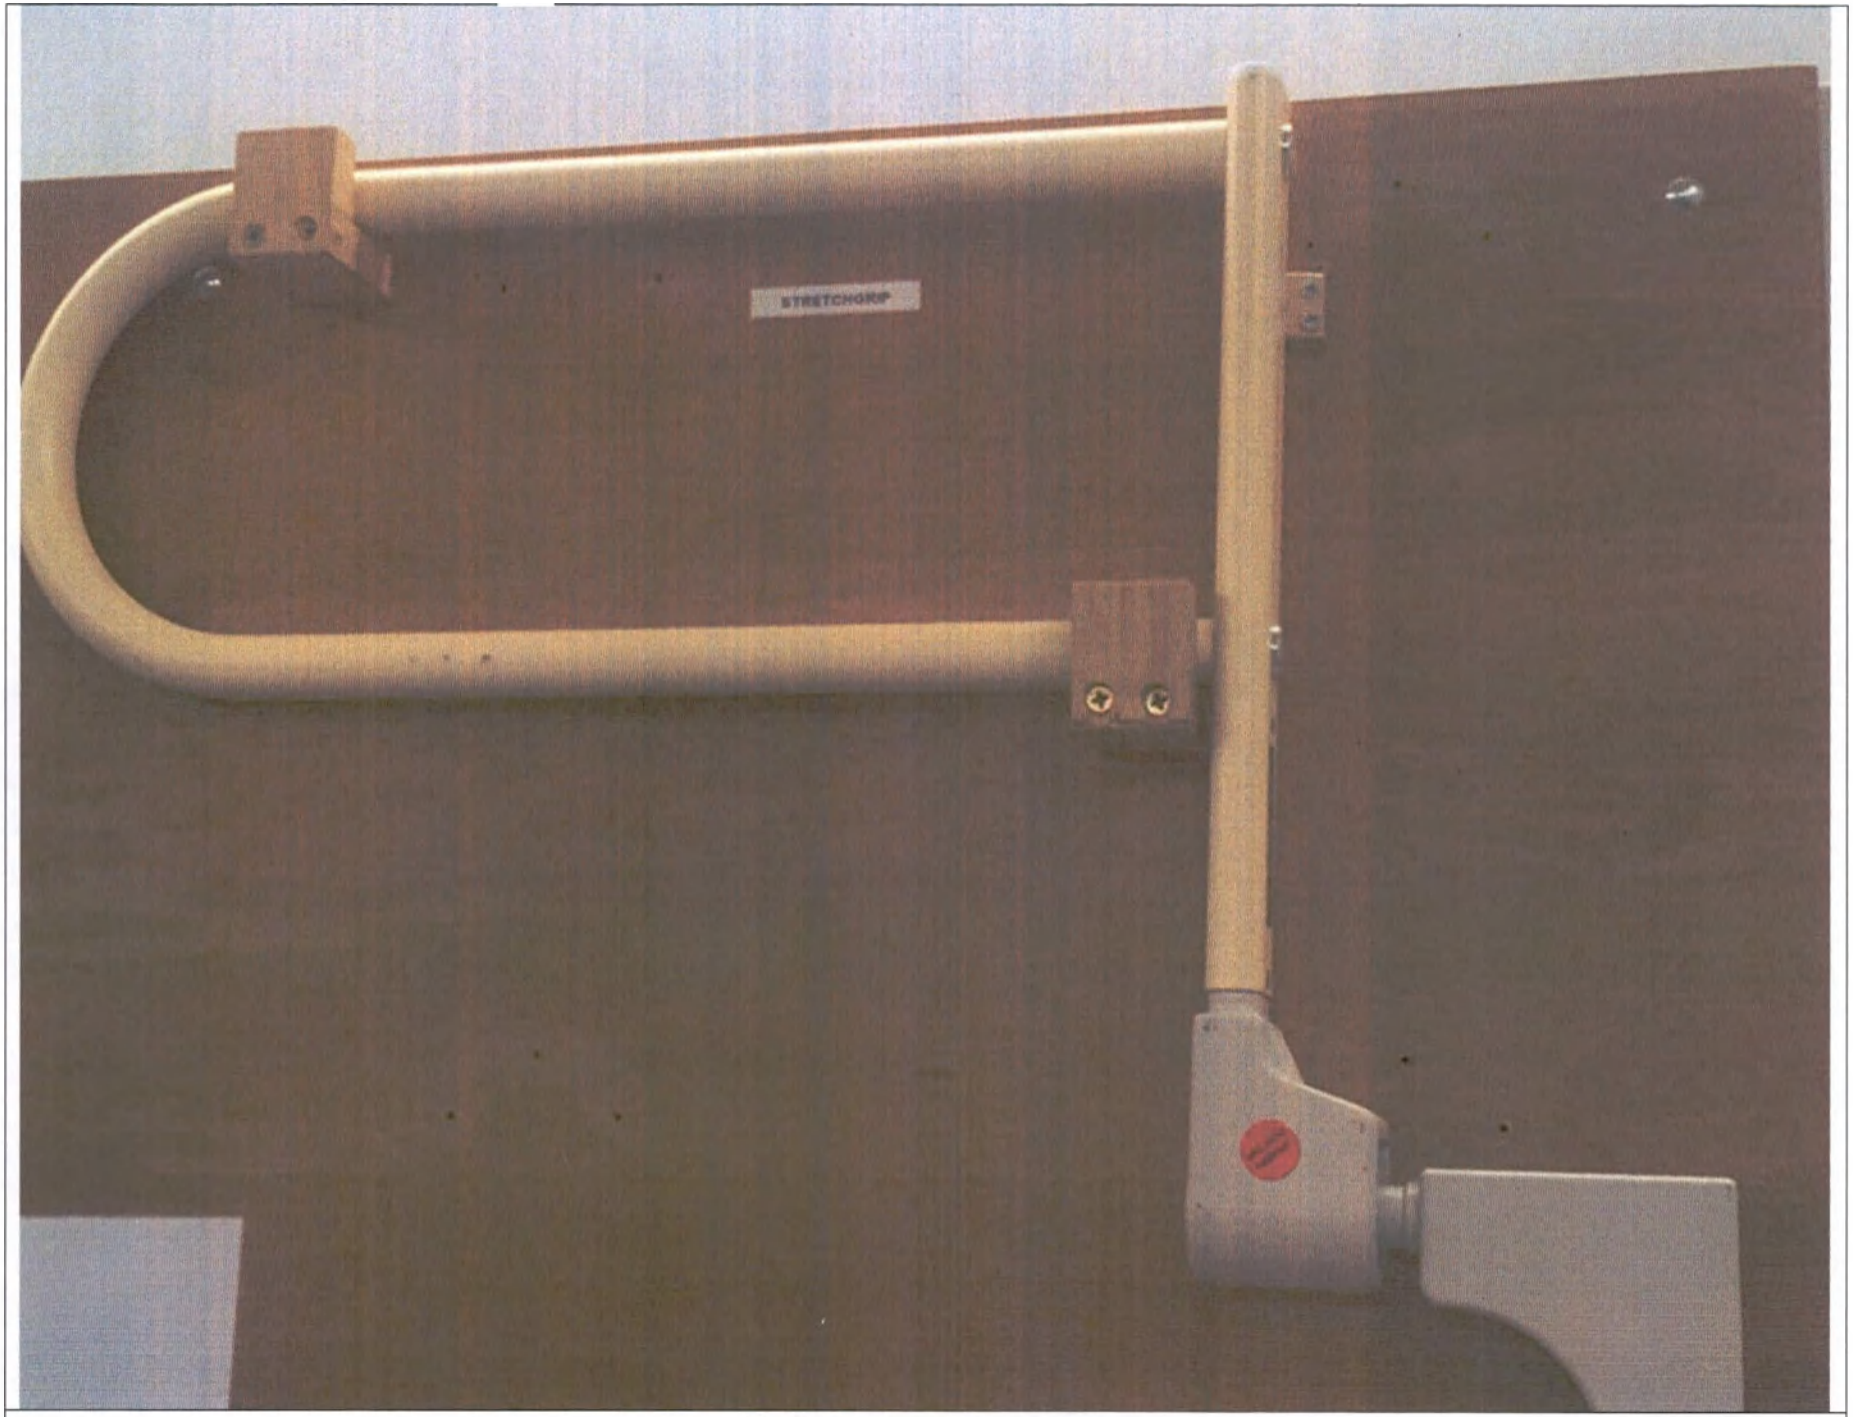

11. Рукоятки для растяжки.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

12. Ручки для фиксации пациента.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

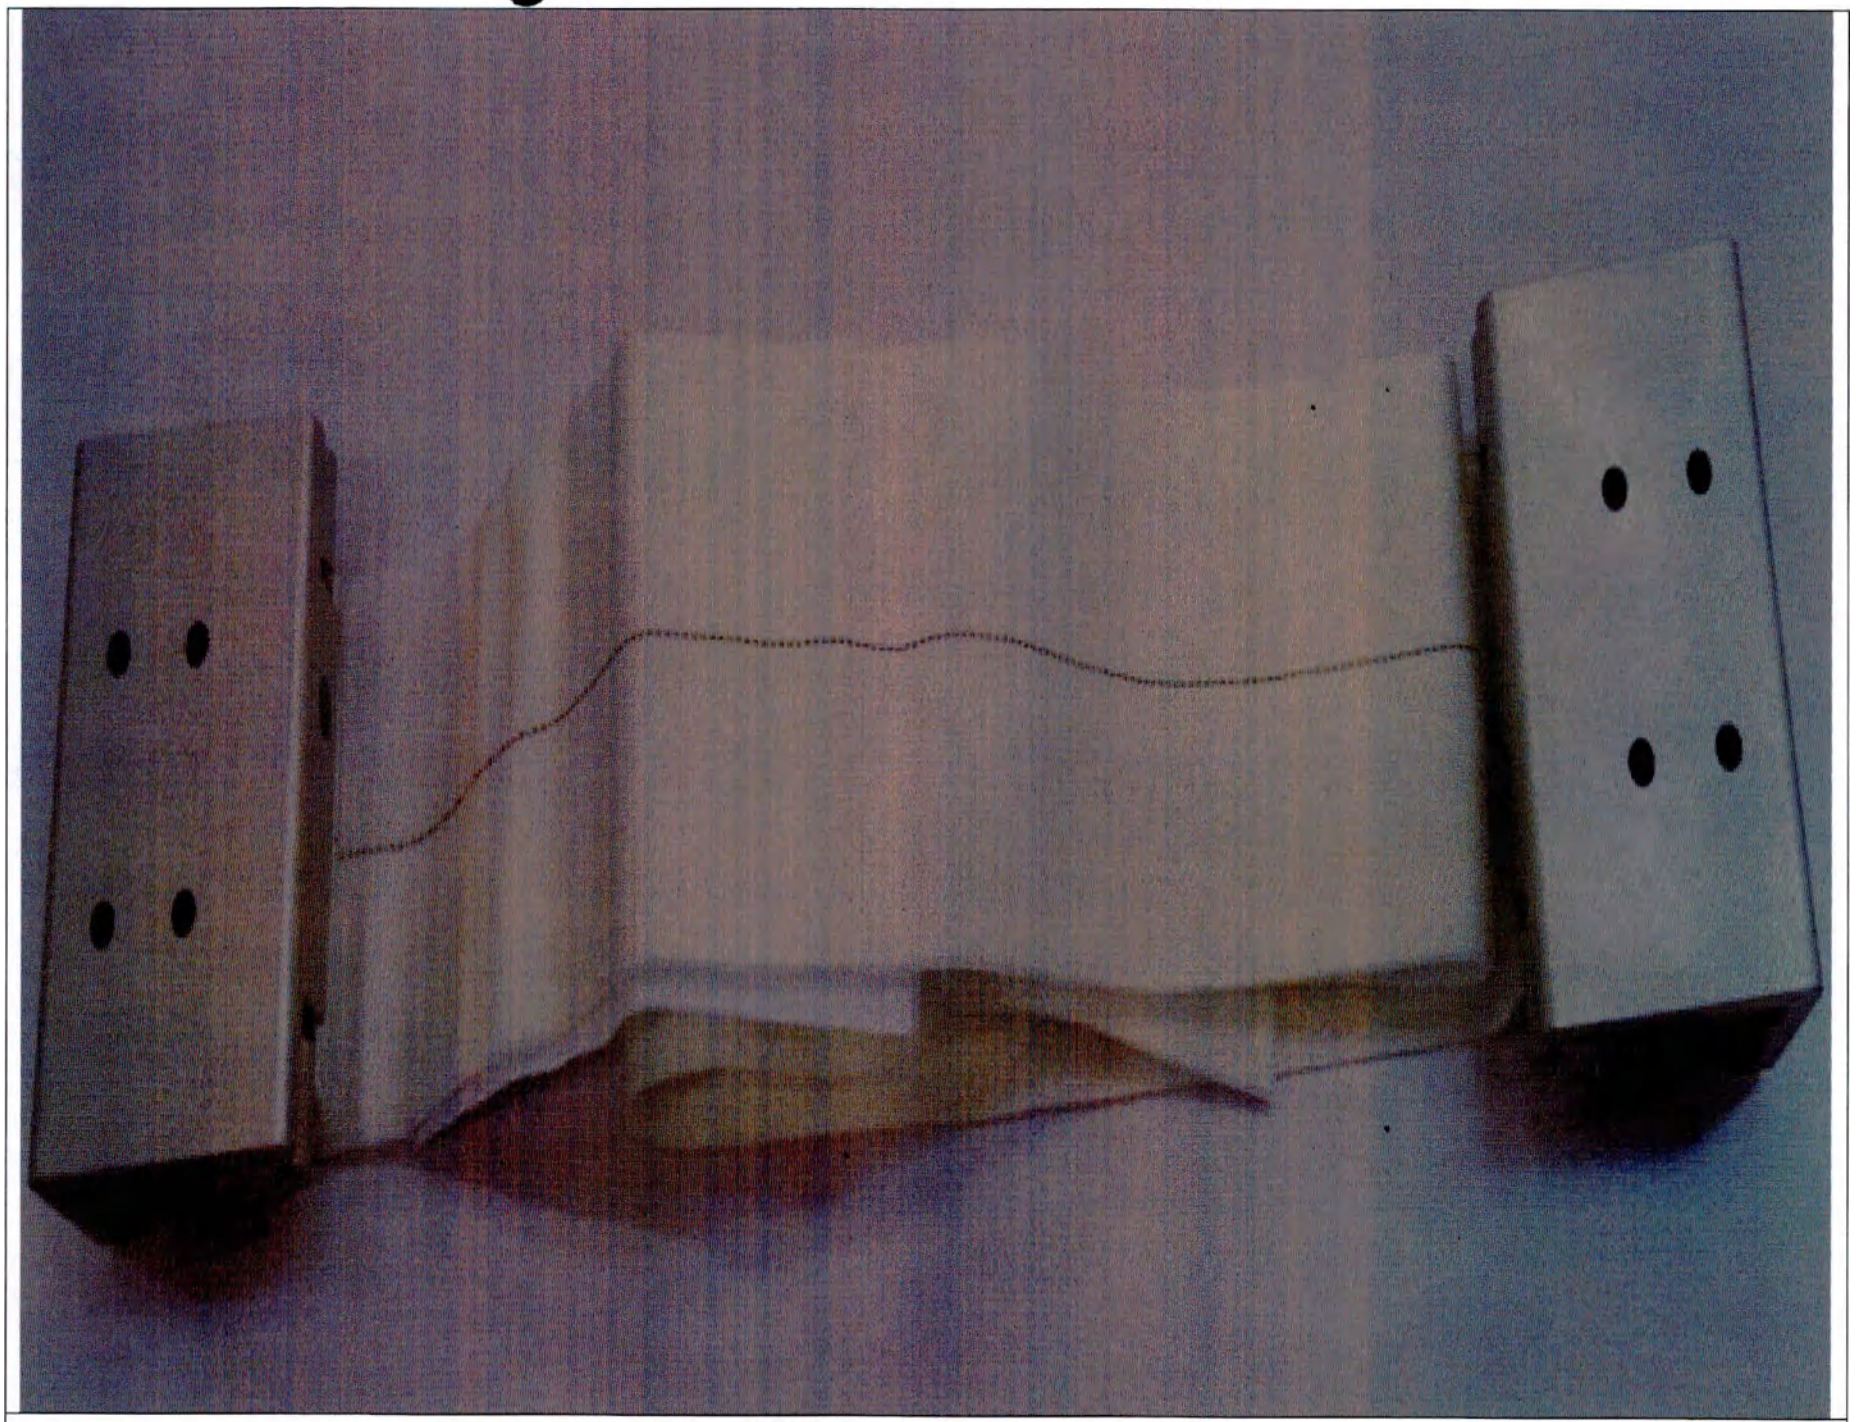

13. Регулируемые ремни.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

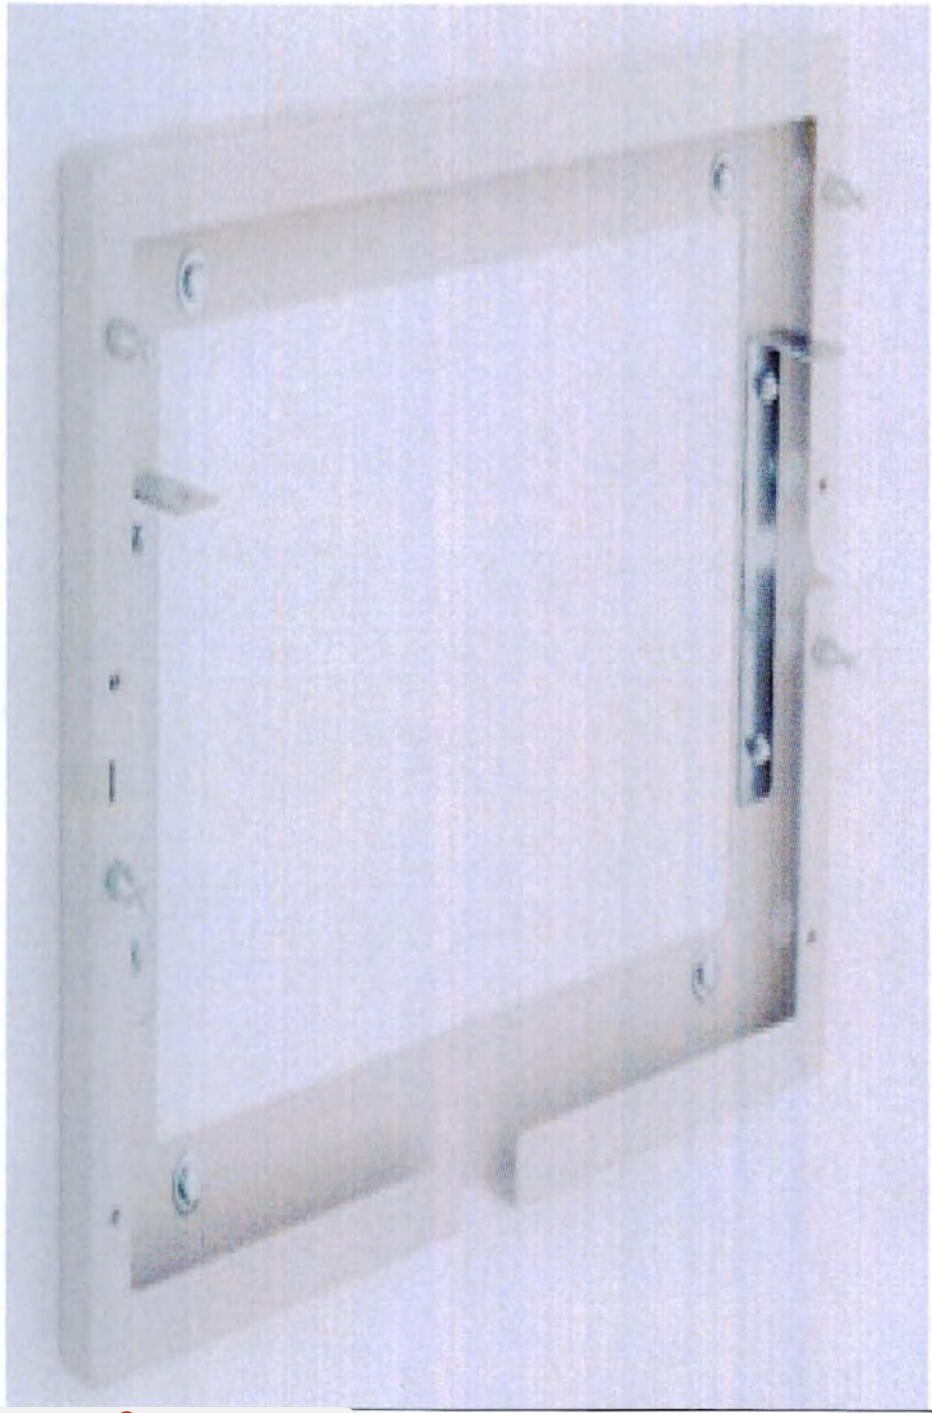

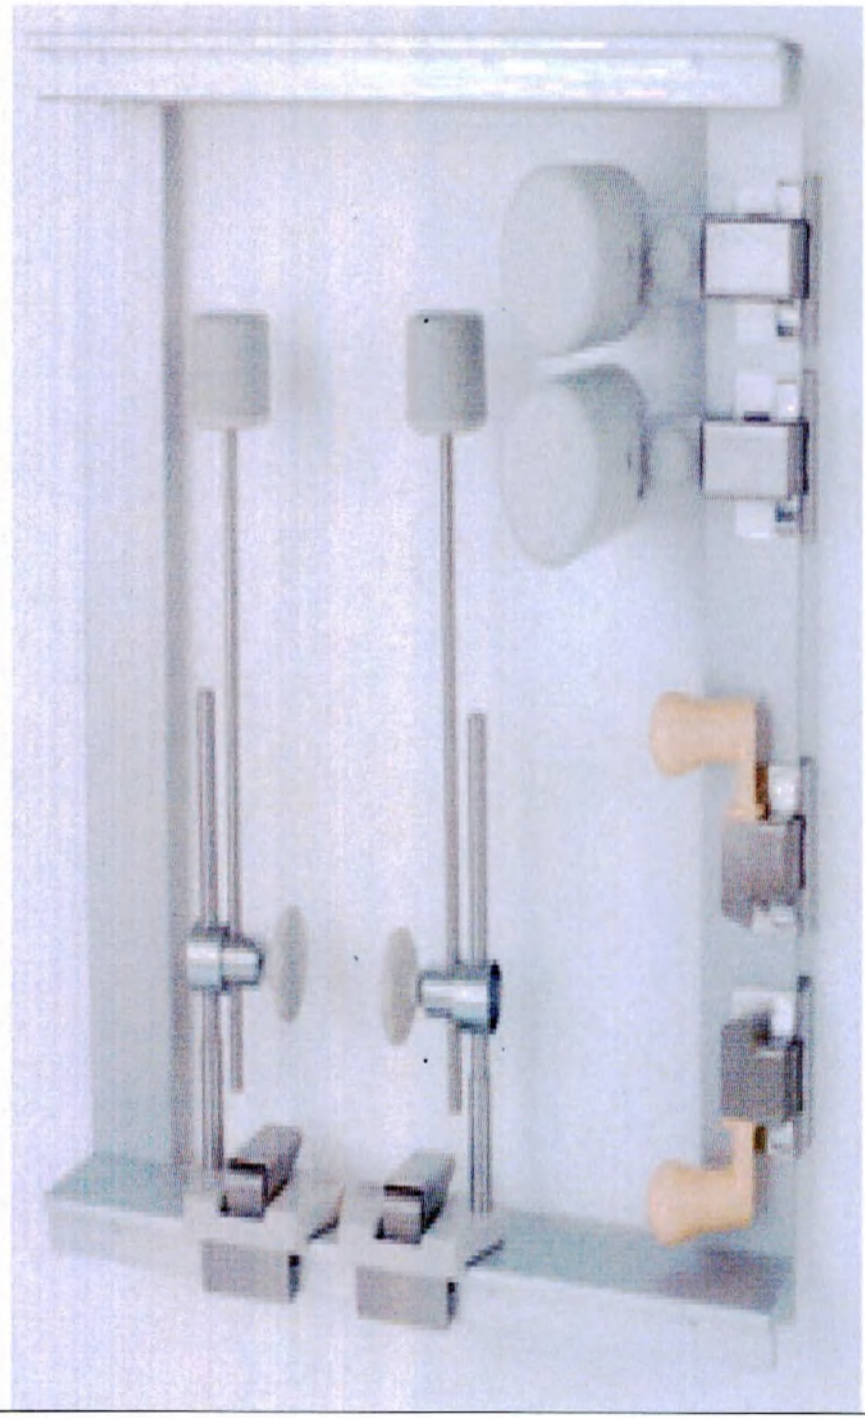

14. Подставка для хранения принадлежностей.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

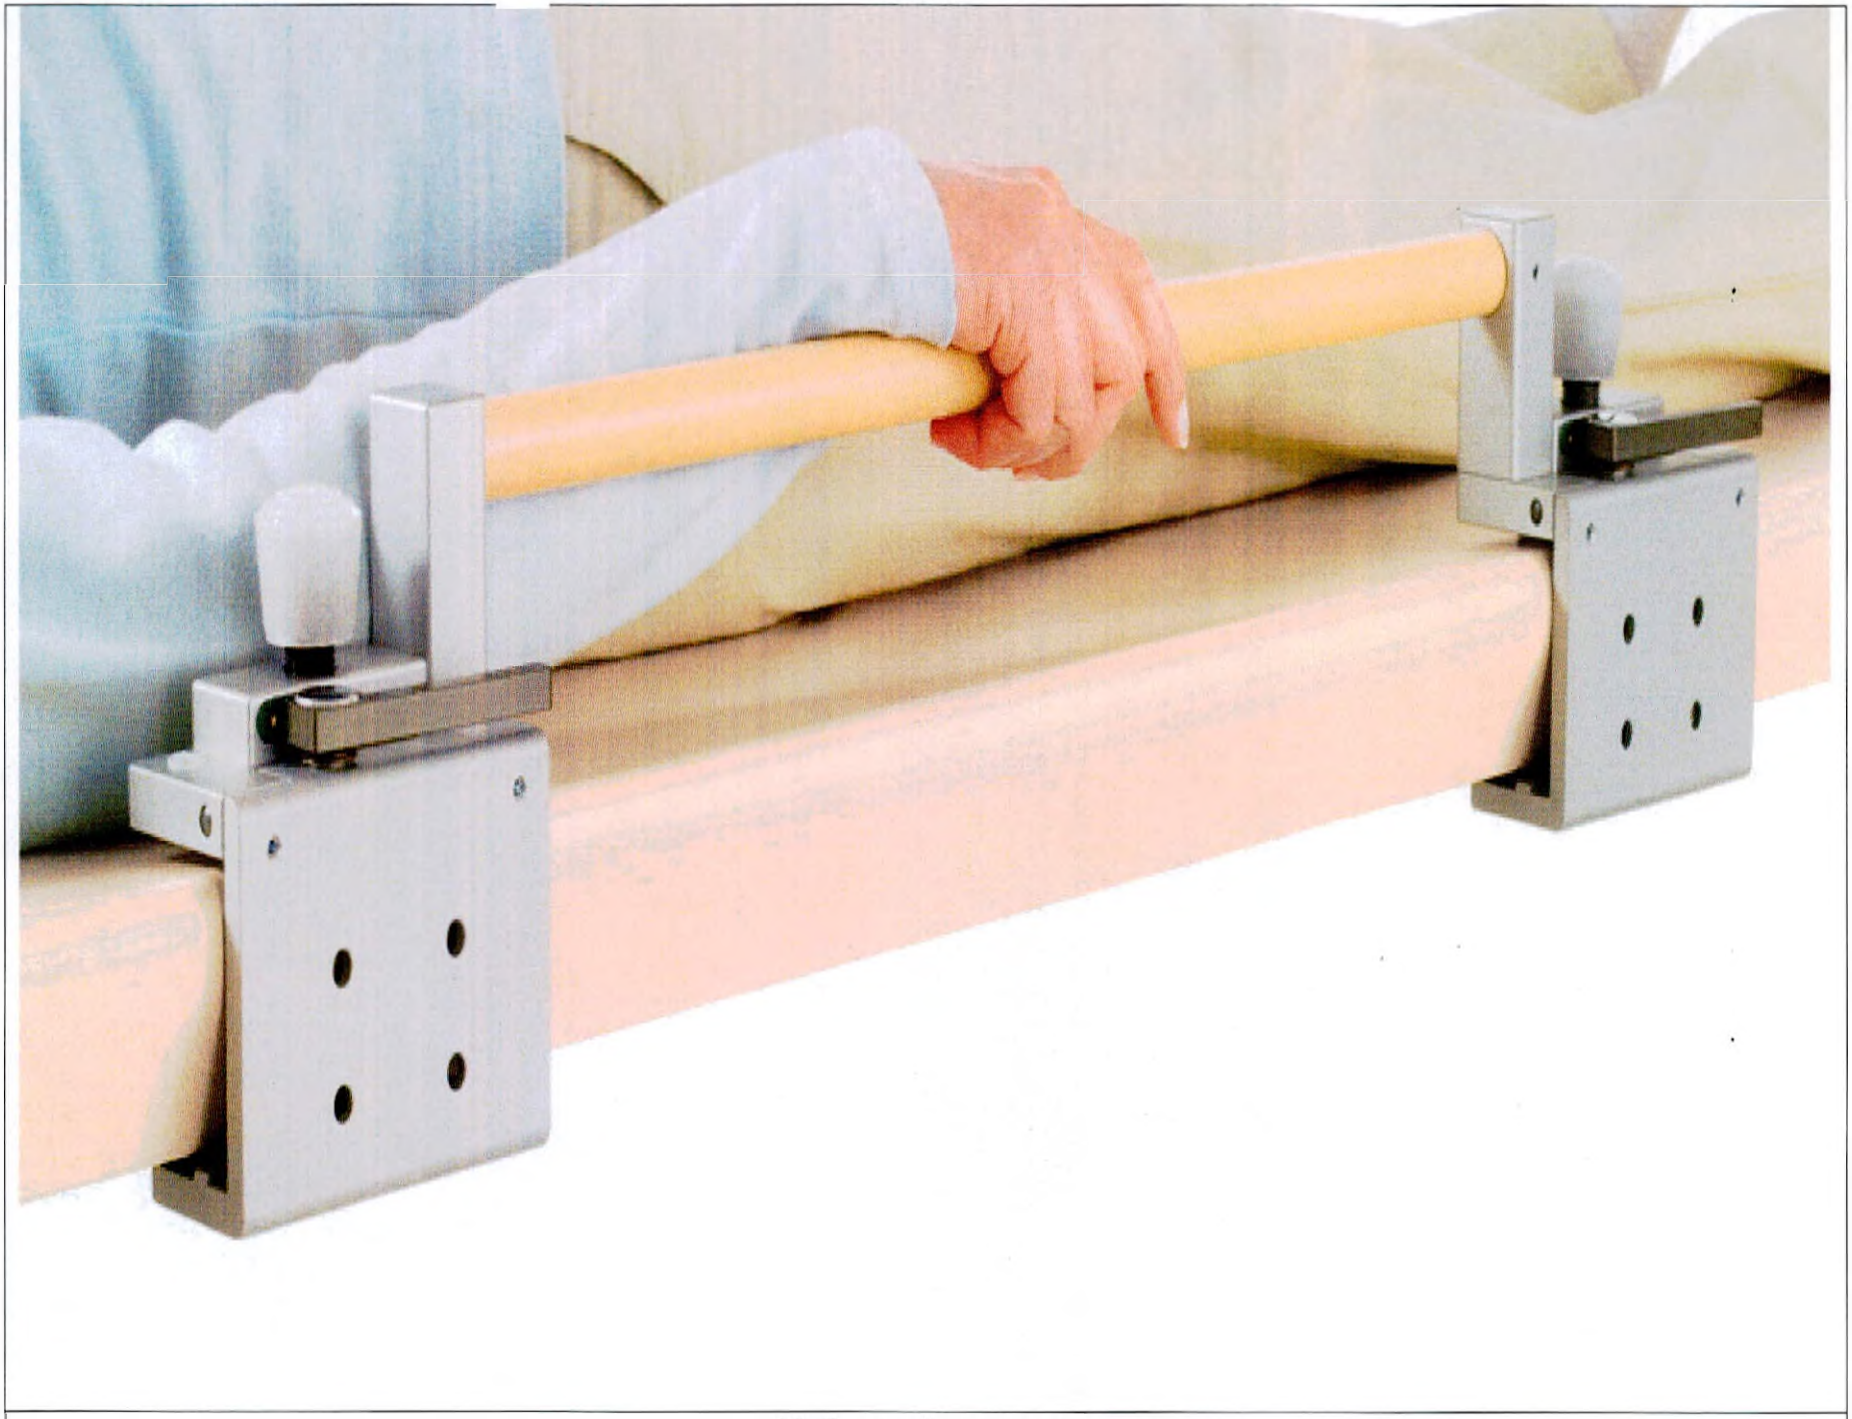

15. Боковой поручень.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

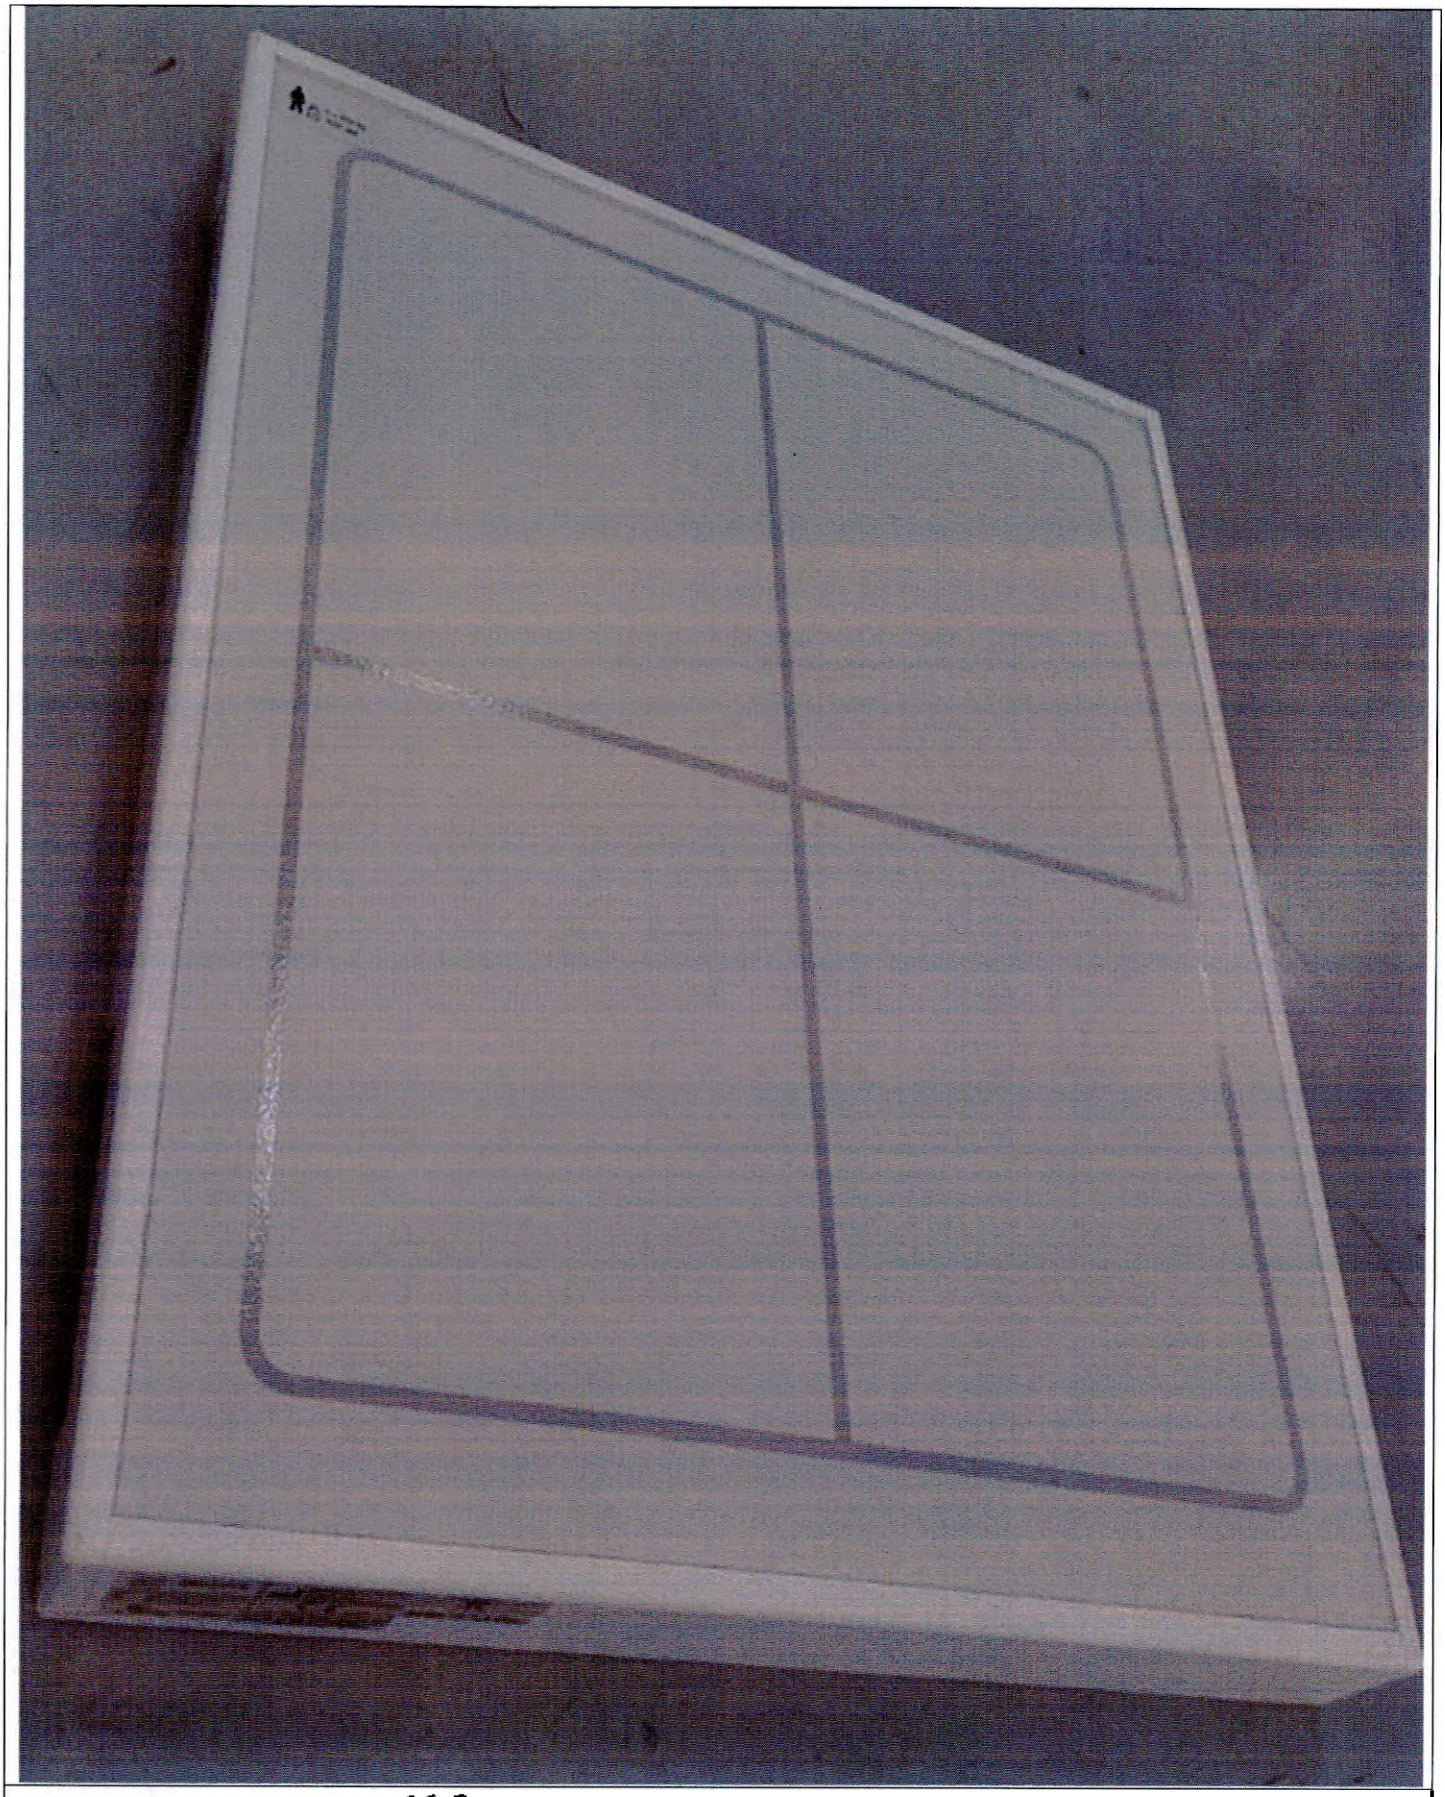

16. Защитная панель переносного детектора.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

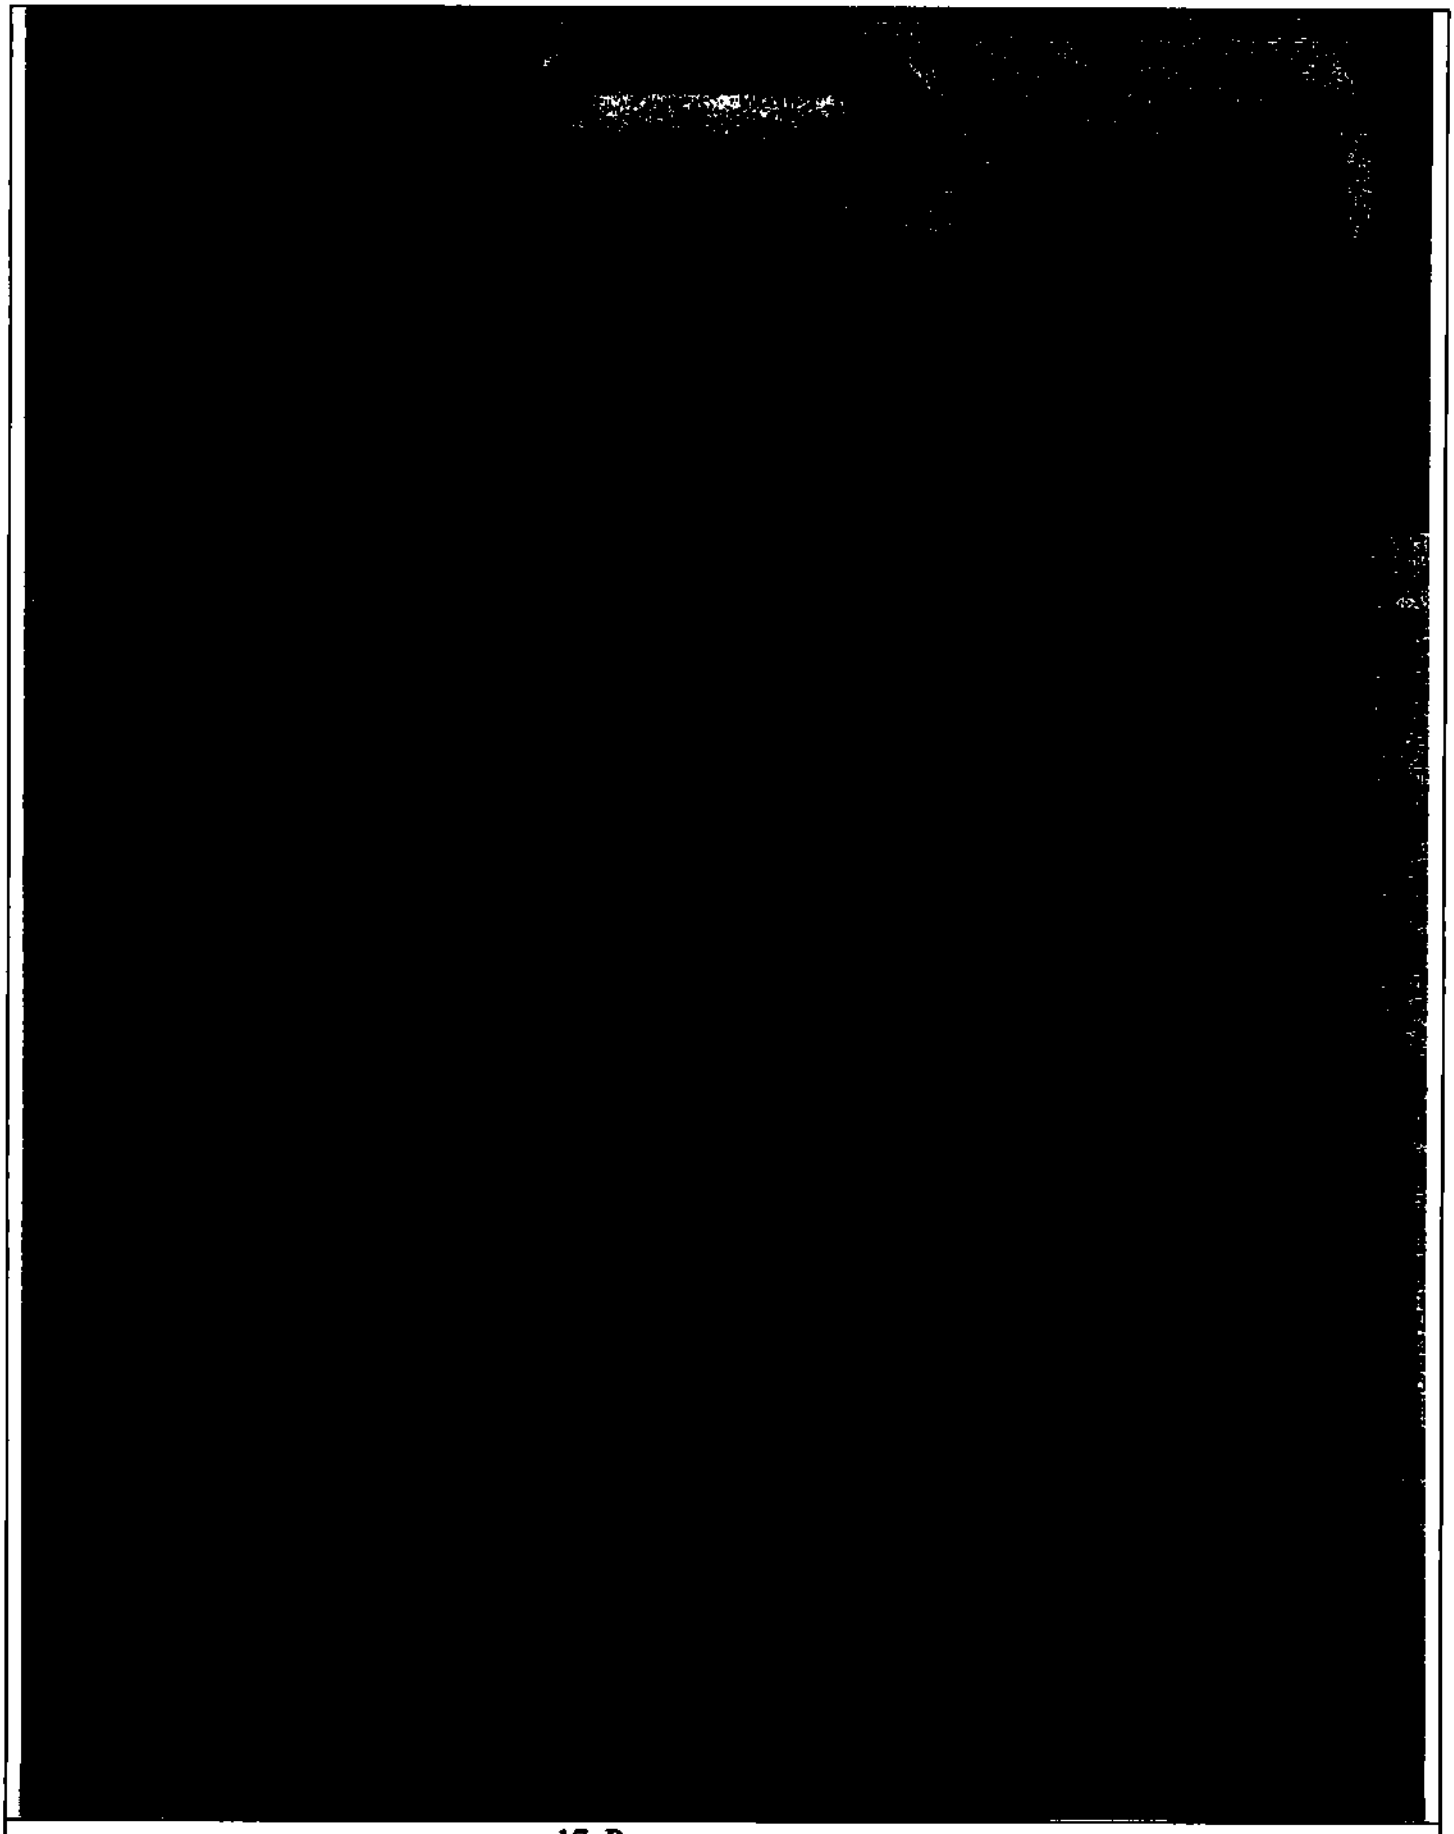

17. Рукоятка детектора.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

18. Мобильный держатель переносного детектора.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

19. Прикроватный держатель переносного детектора.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

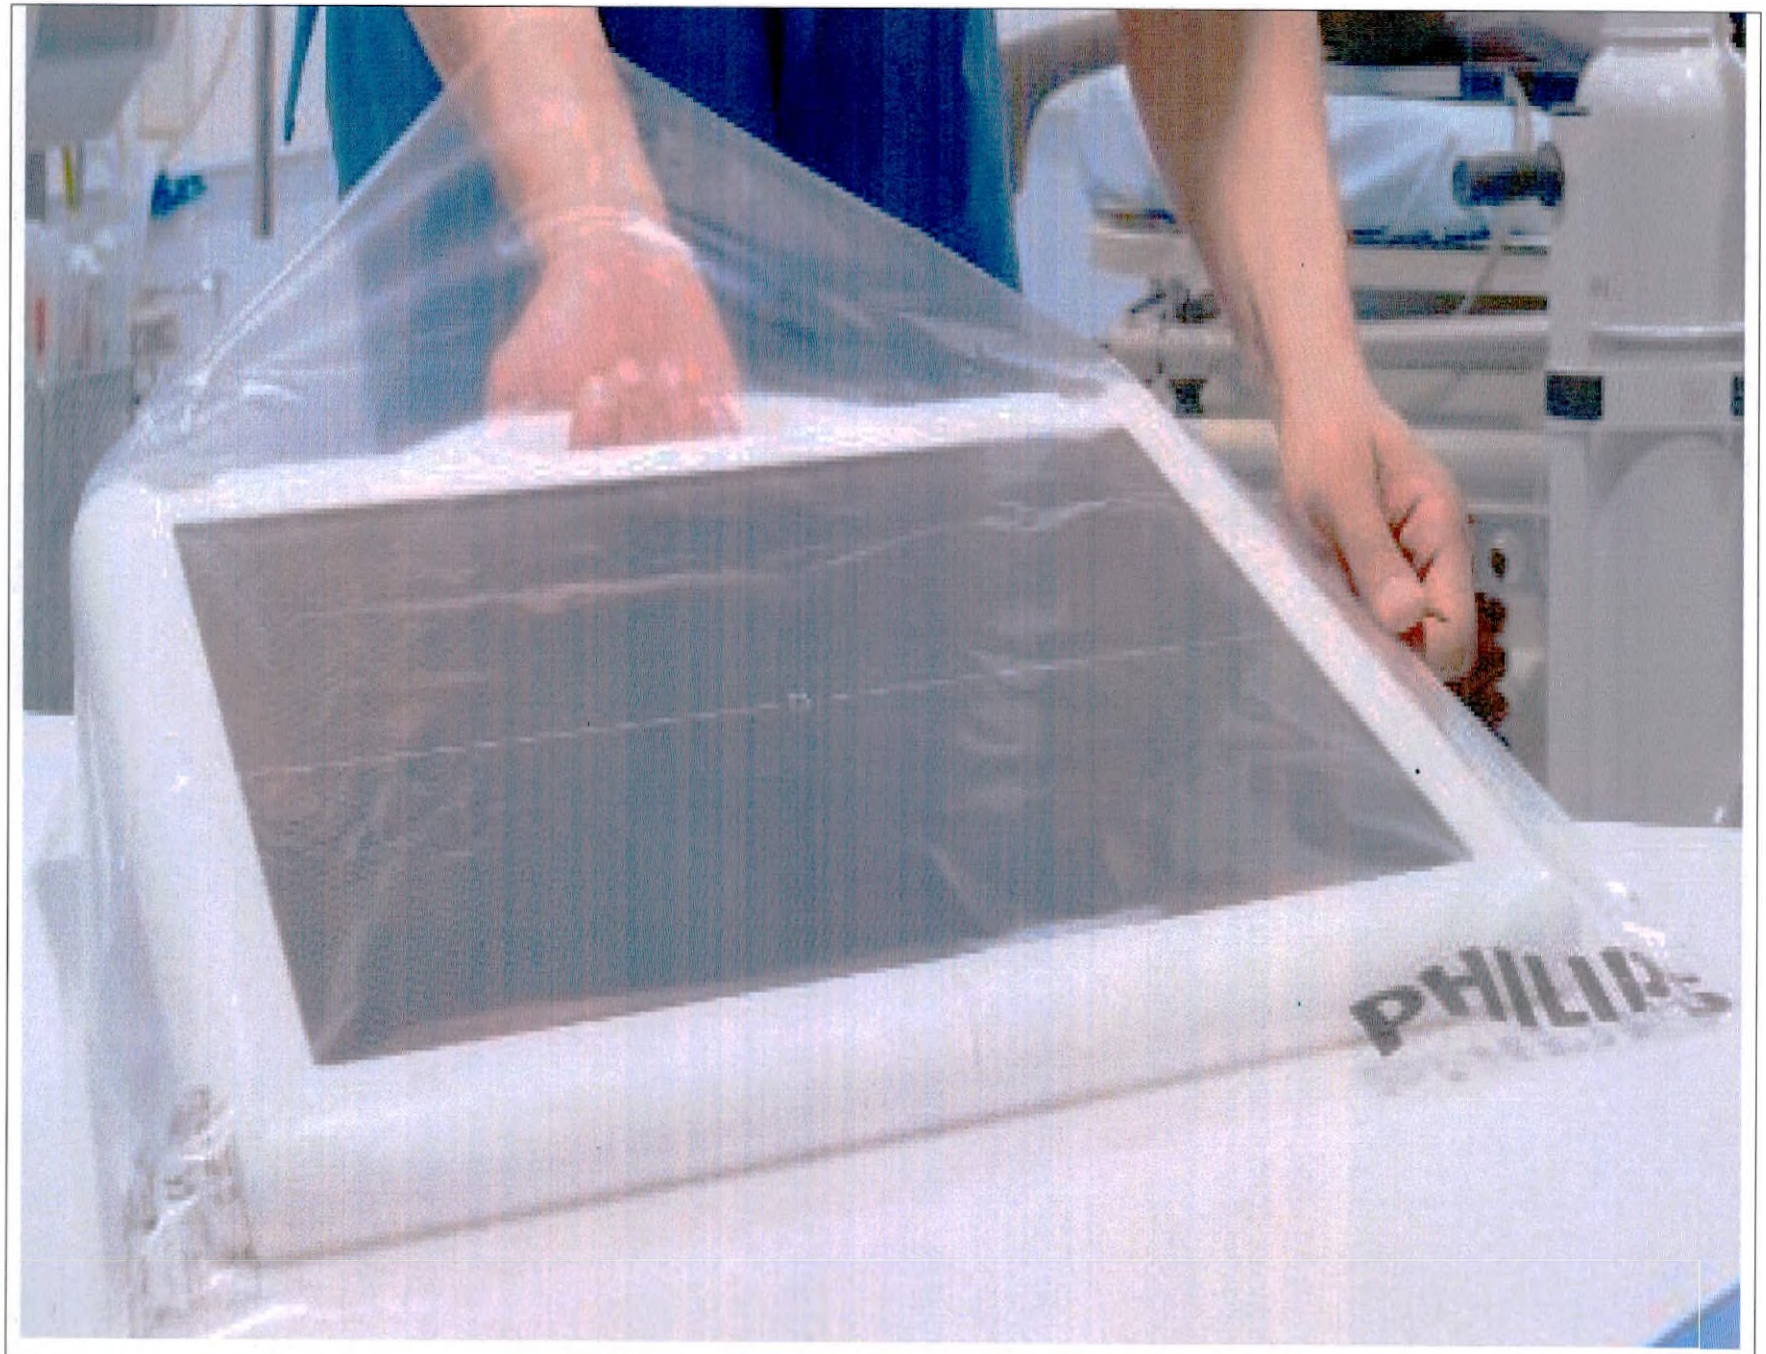

20. Мешки переносного детектора, варианты исполнения: 20.1. Большой гигиенический мешок для детектора 35 x 43 см.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

20. Мешки переносного детектора, варианты исполнения: 20.2. Небольшой гигиенический мешок для детектора 24 х 30 см.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

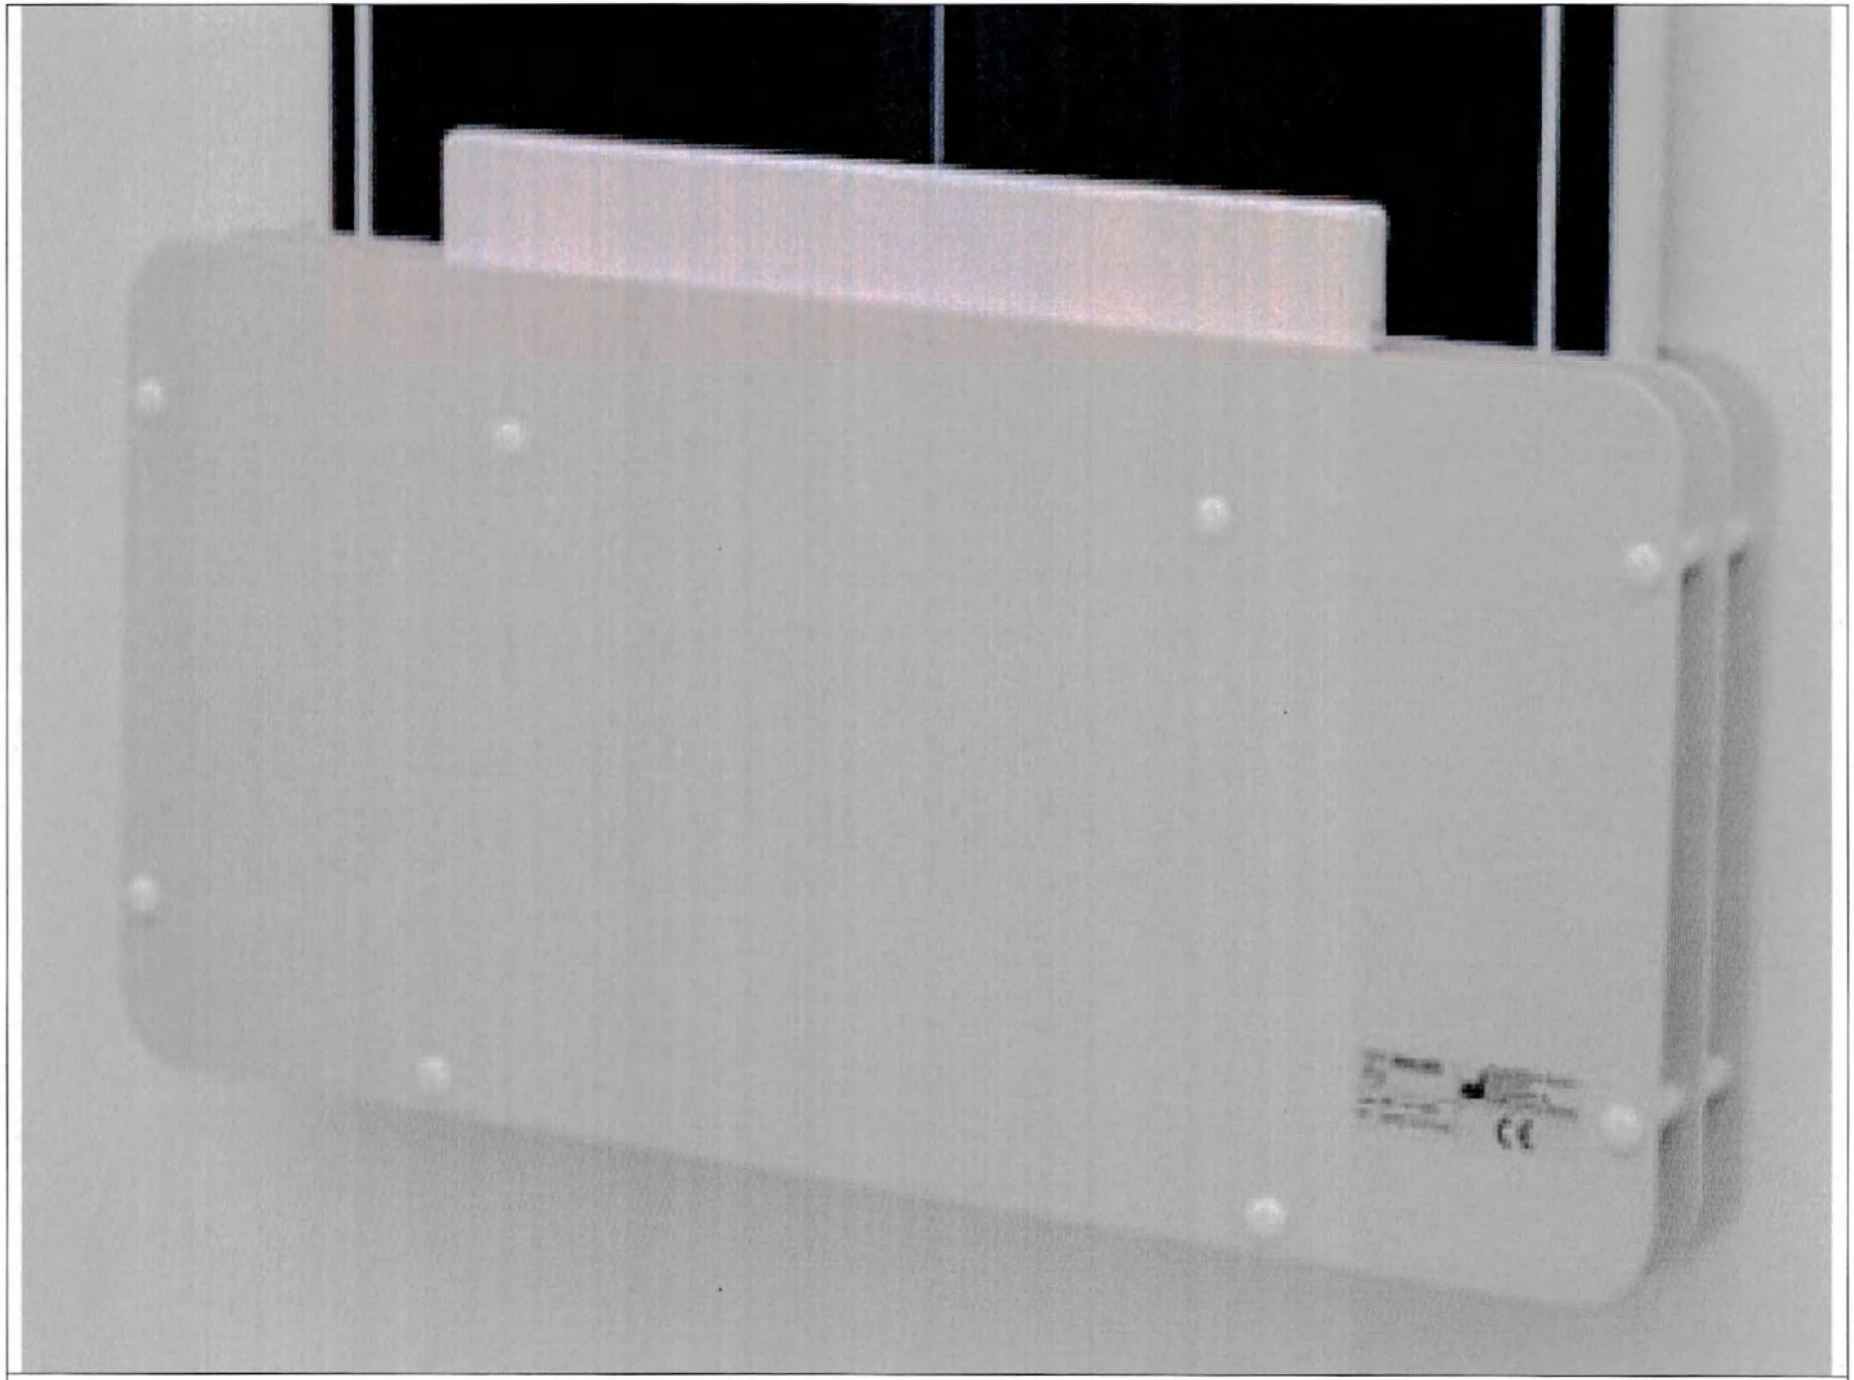

21. Блок хранения детекторов и отсеивающих решеток.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

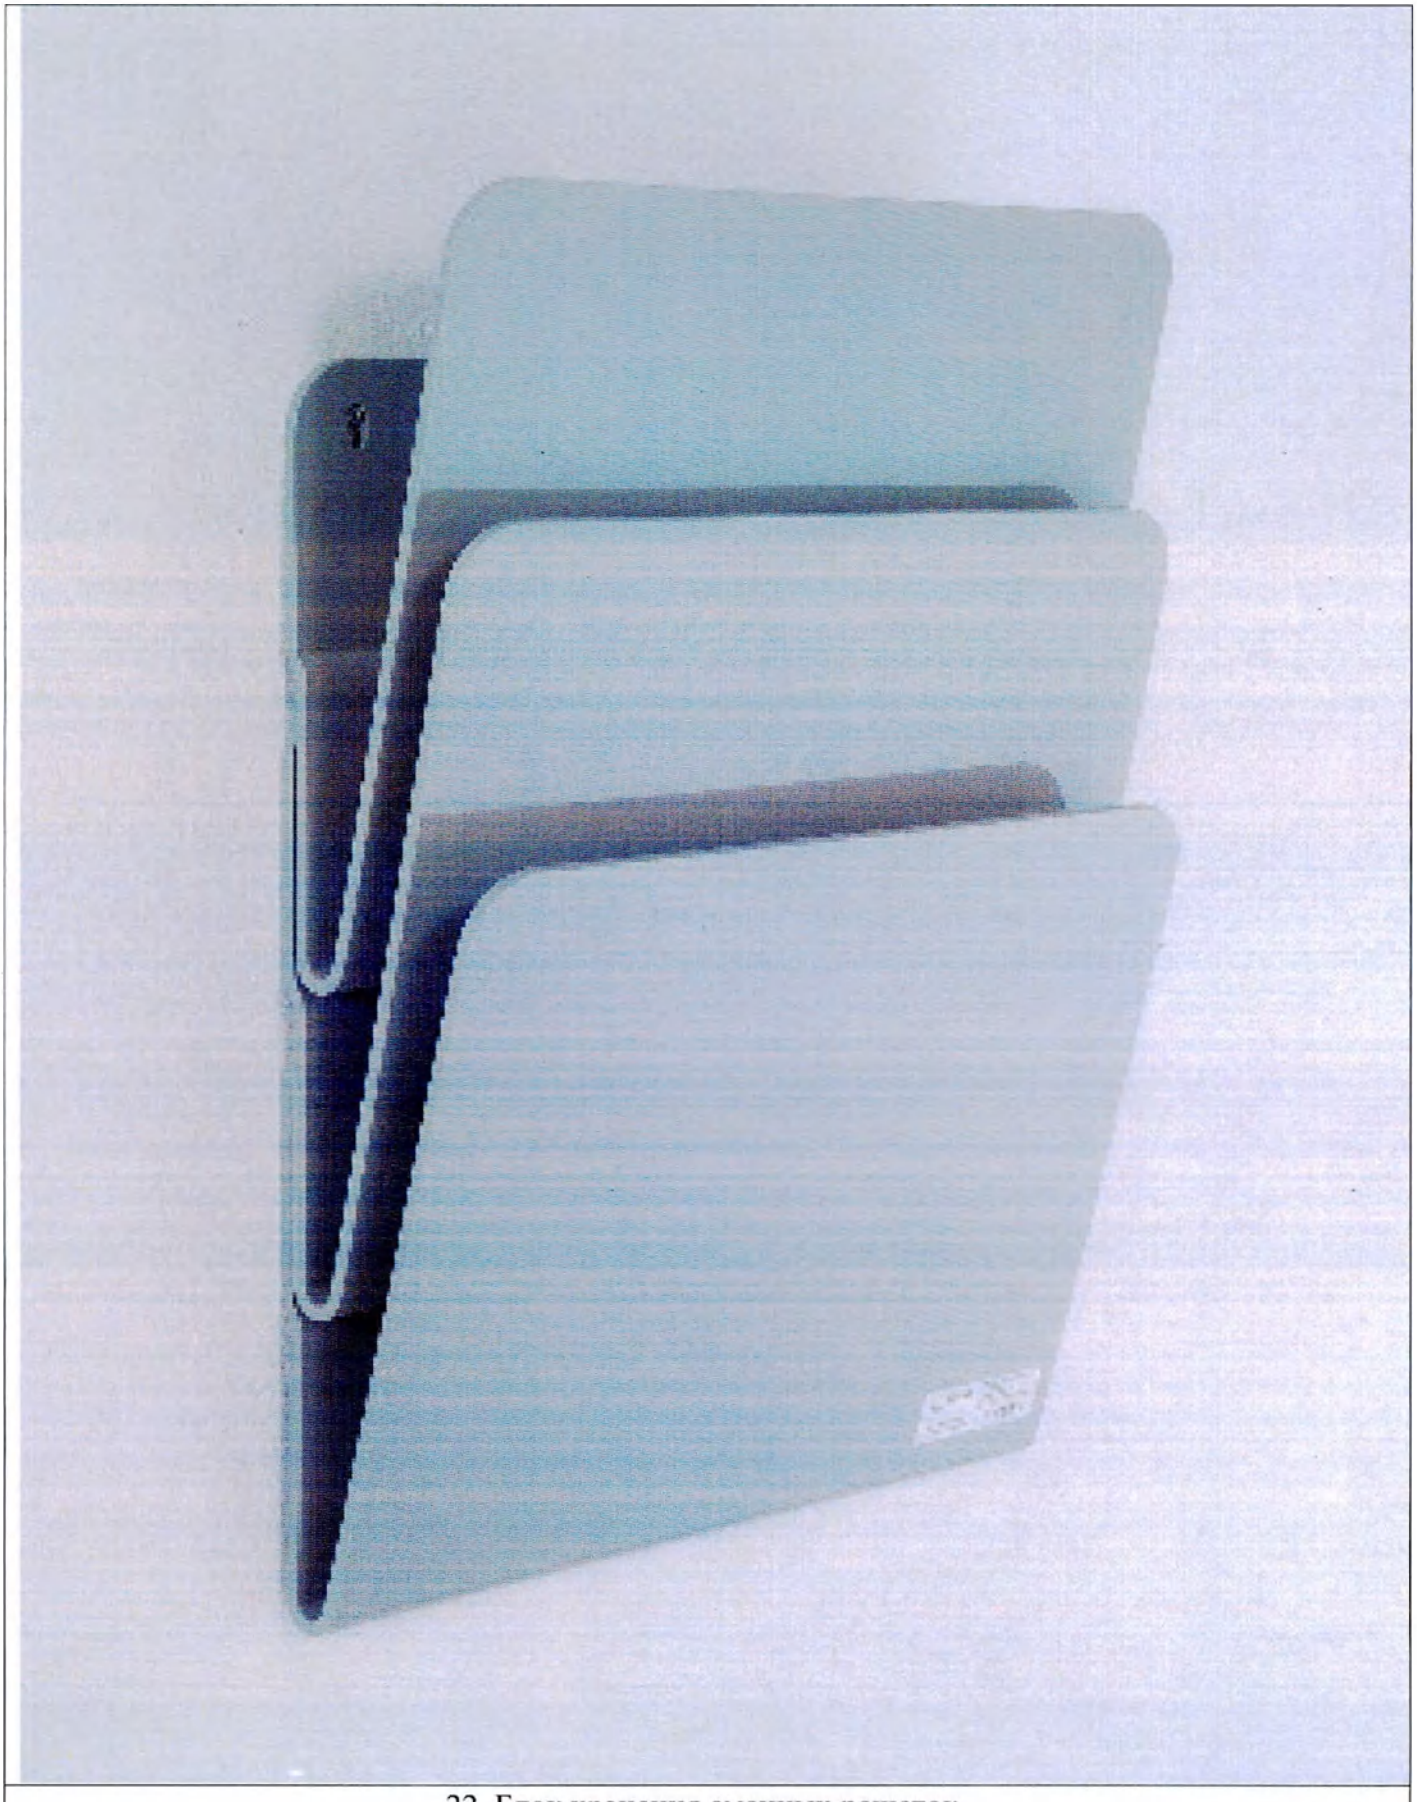

22. Блок хранения сменных решеток.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

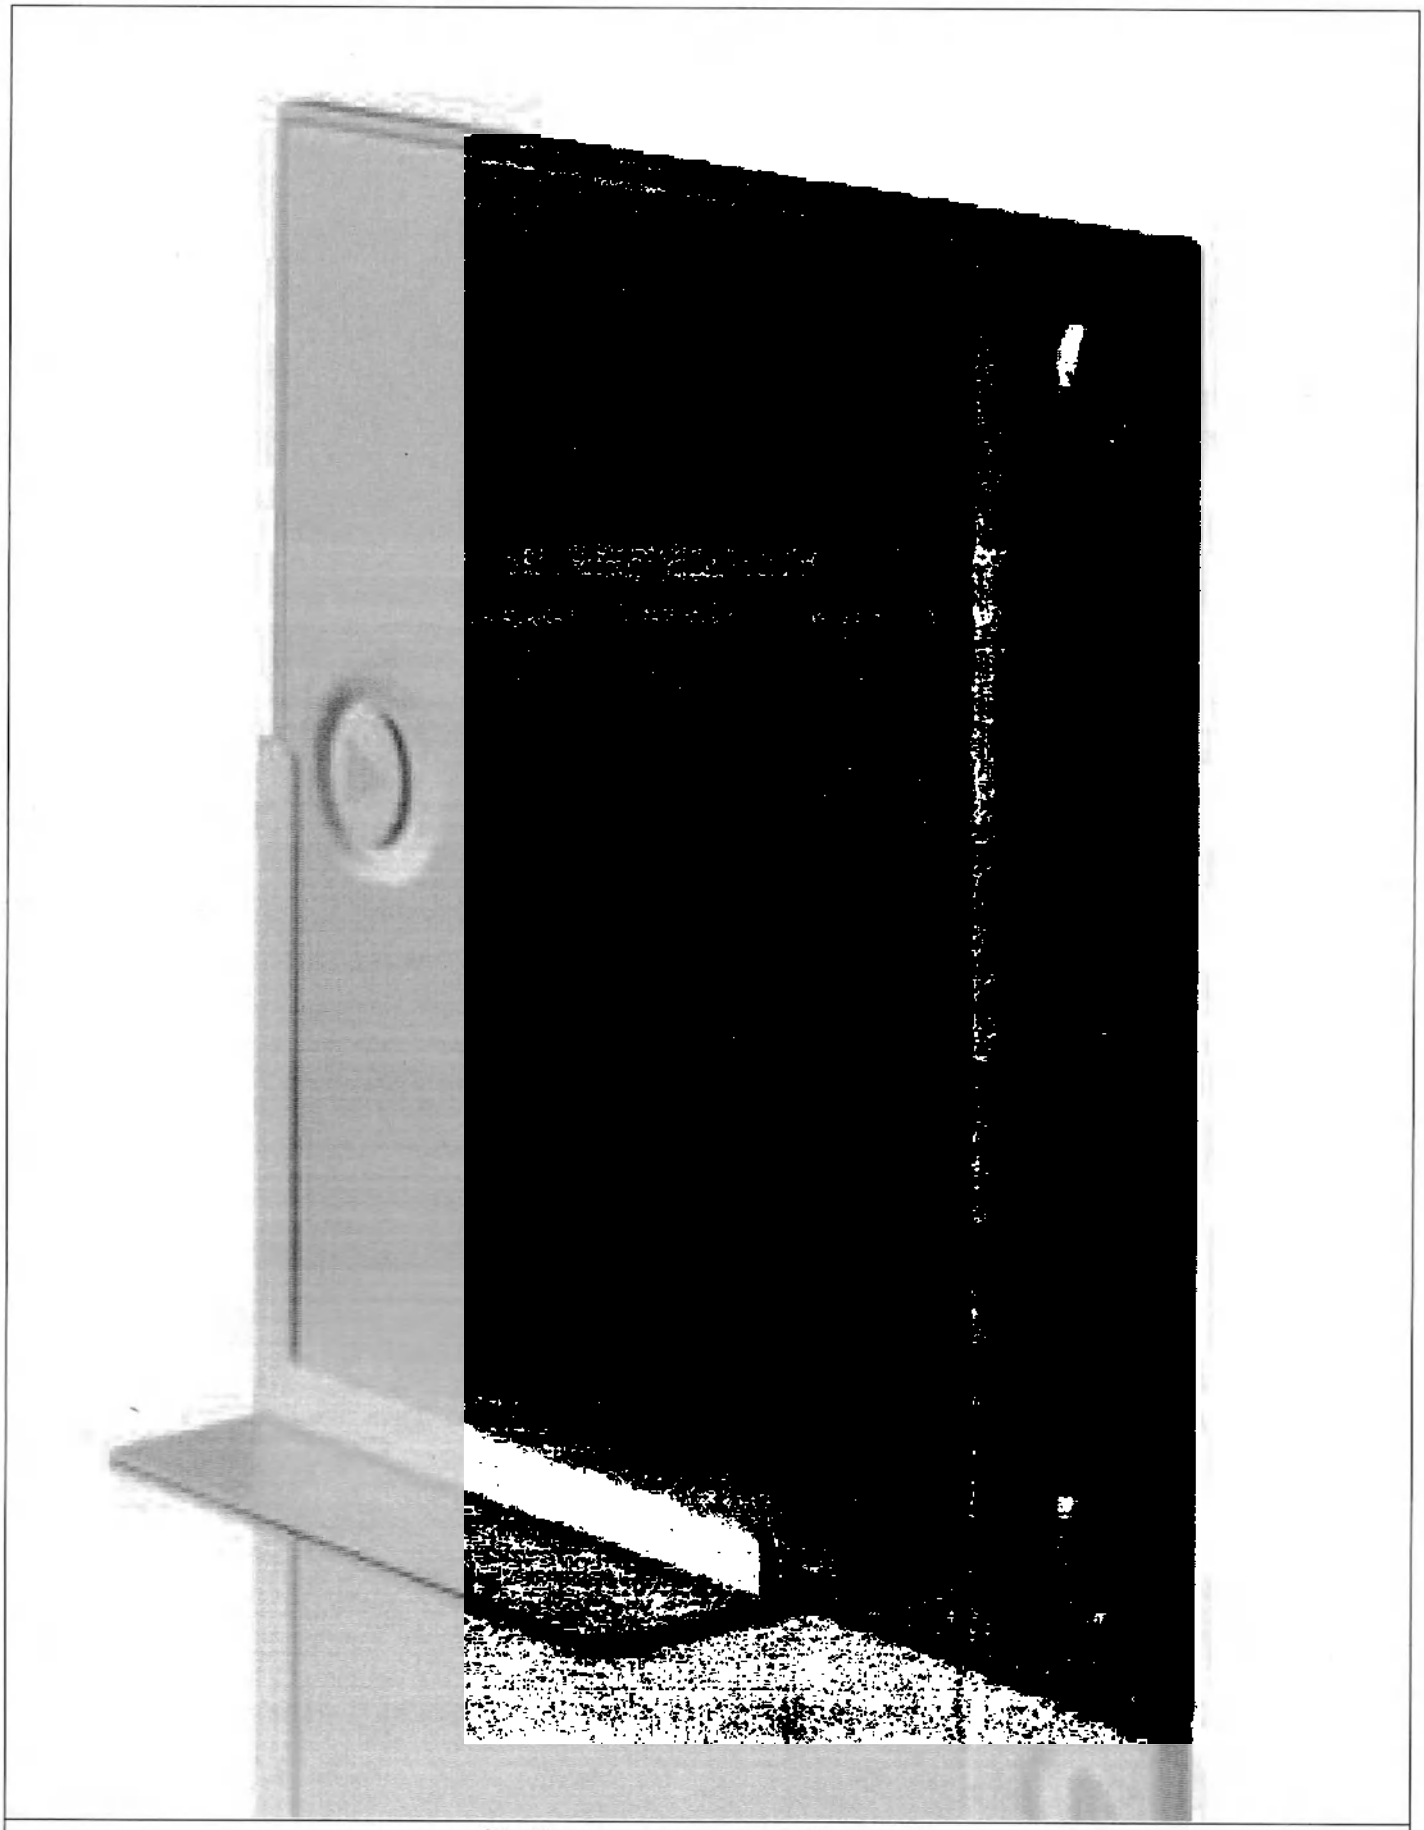

23. Держатель кассеты боковой.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

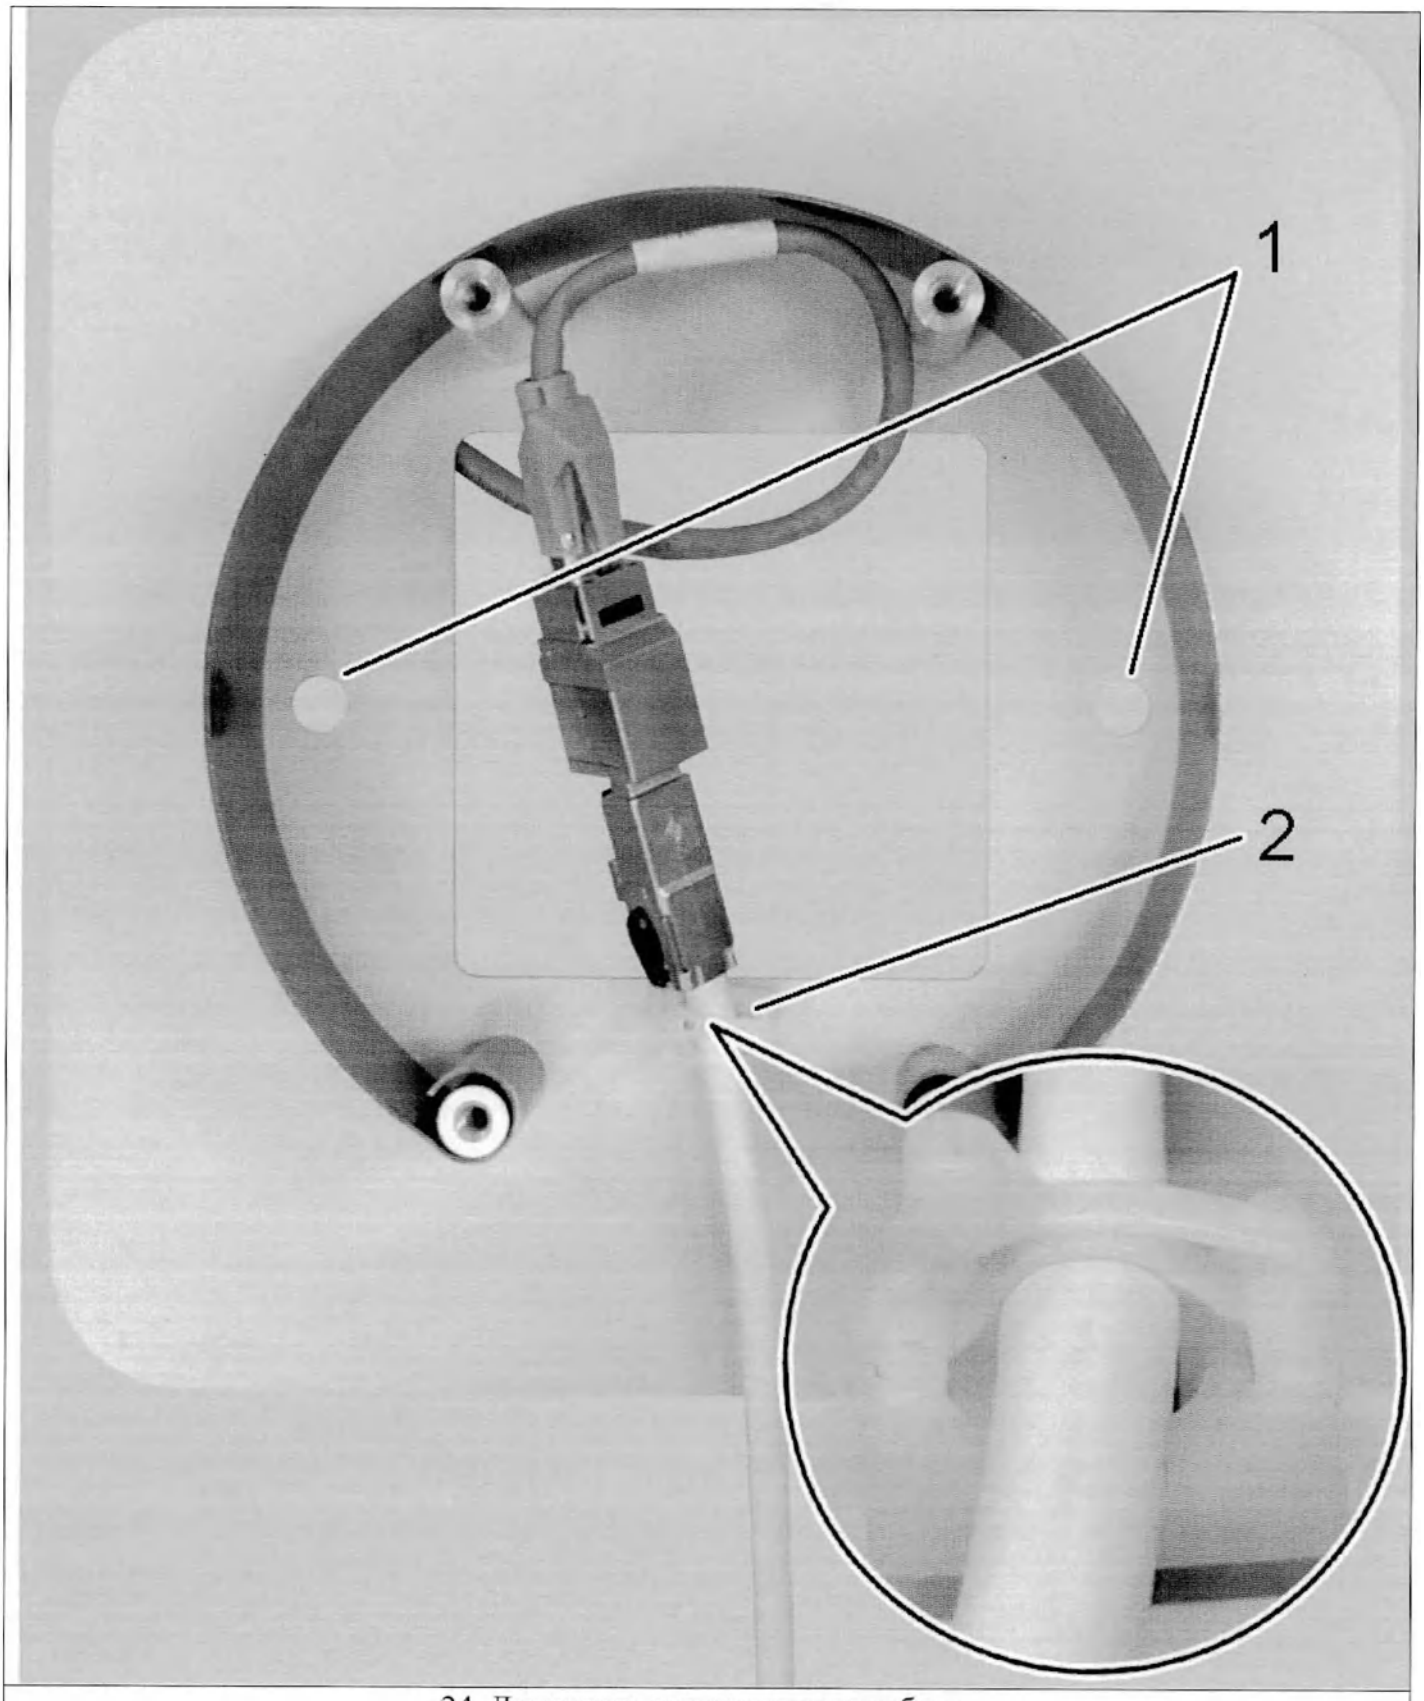

24. Держатель для резервного кабеля.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

25. Держатель пульта дистанционного управления.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

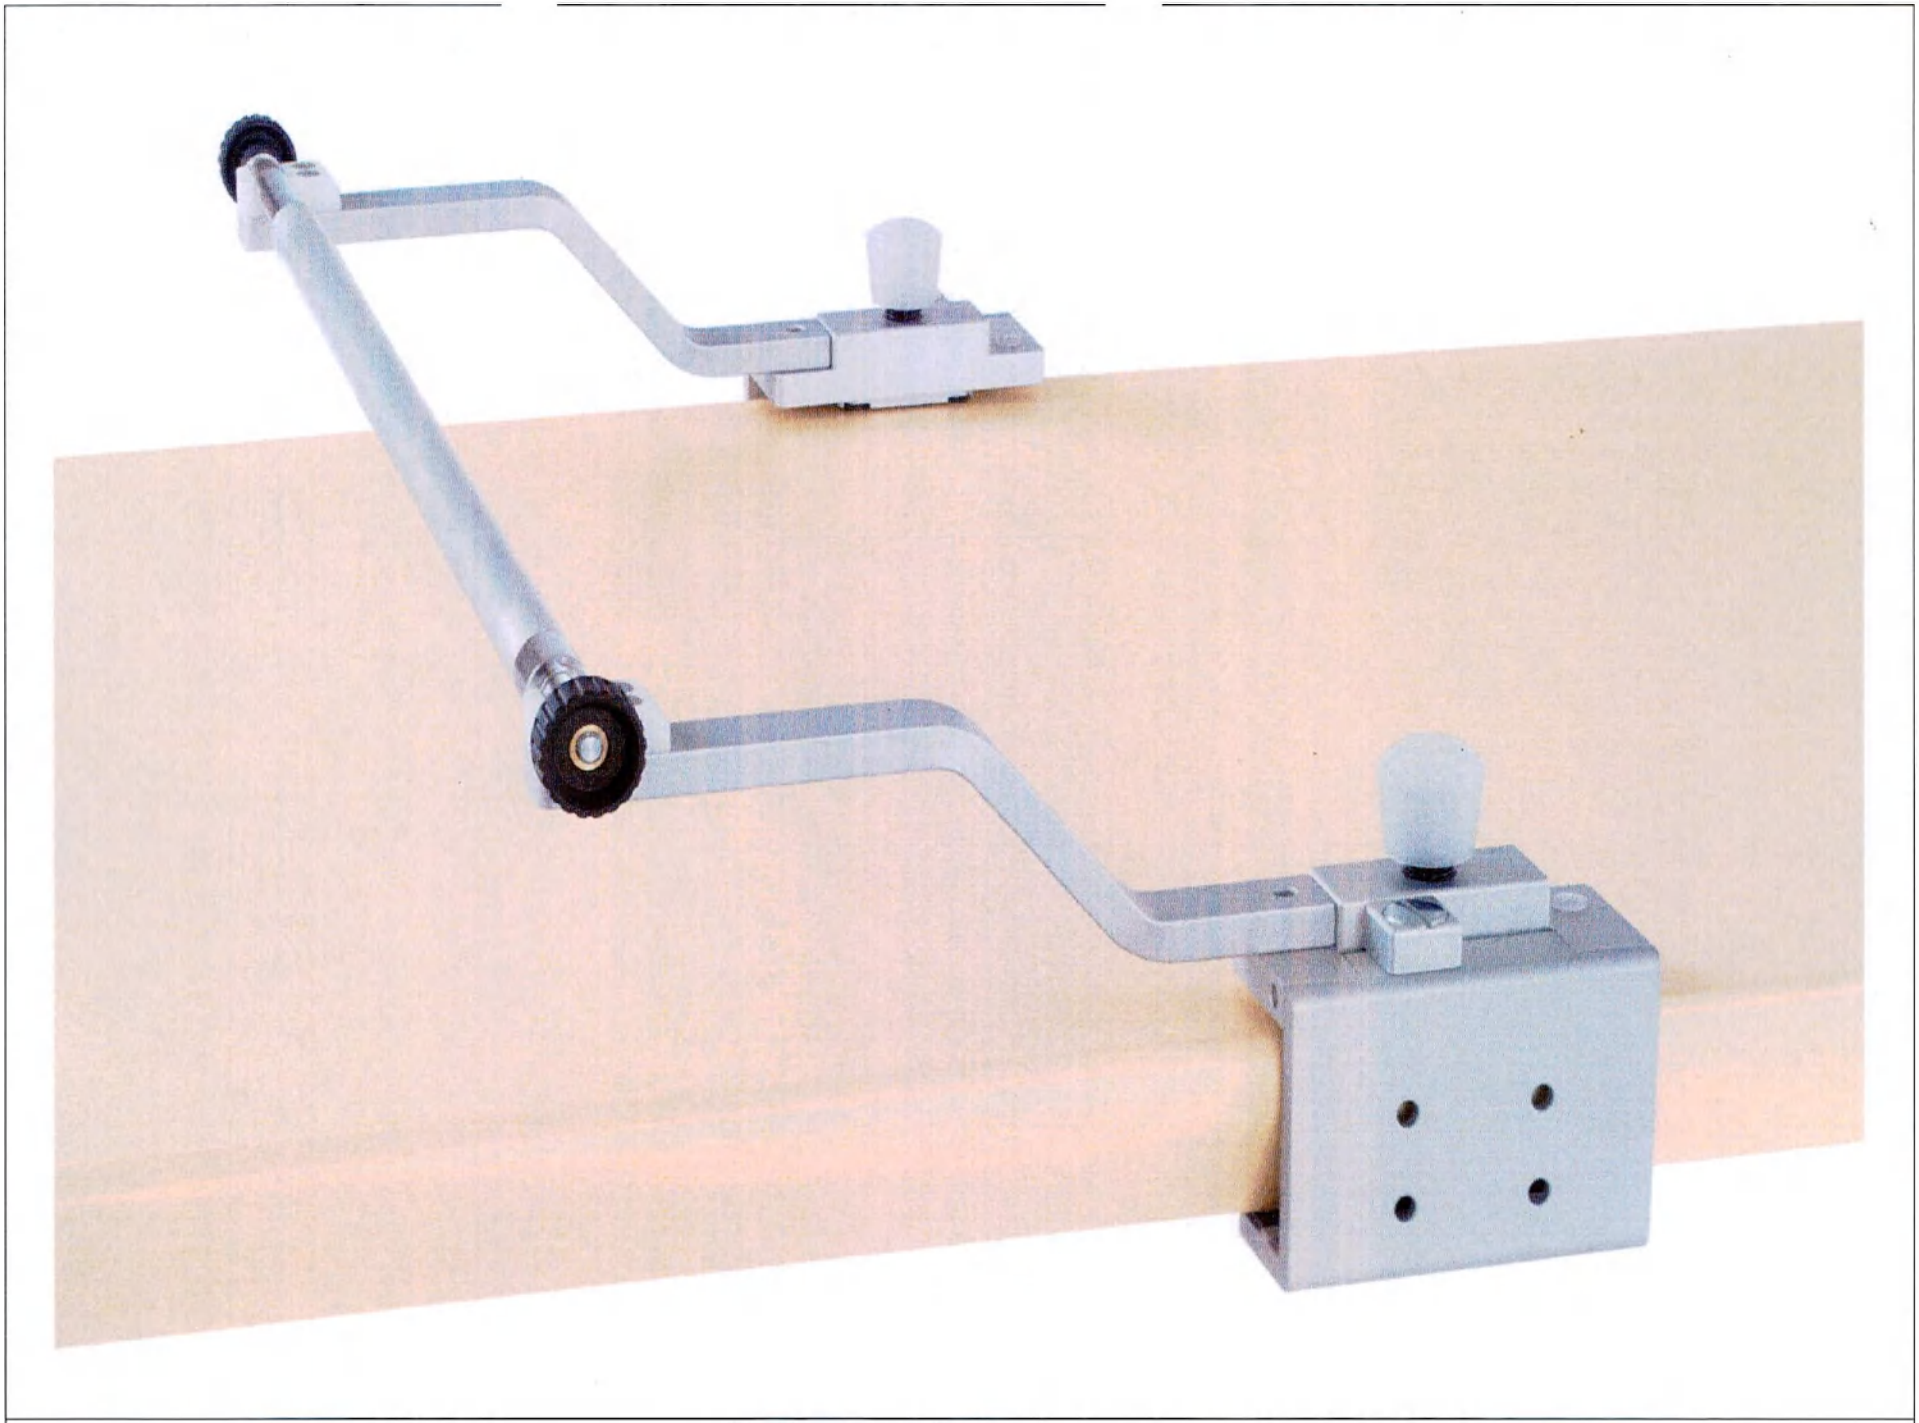

26. Держатель бумажного рулона.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

27. ИК-адаптер.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

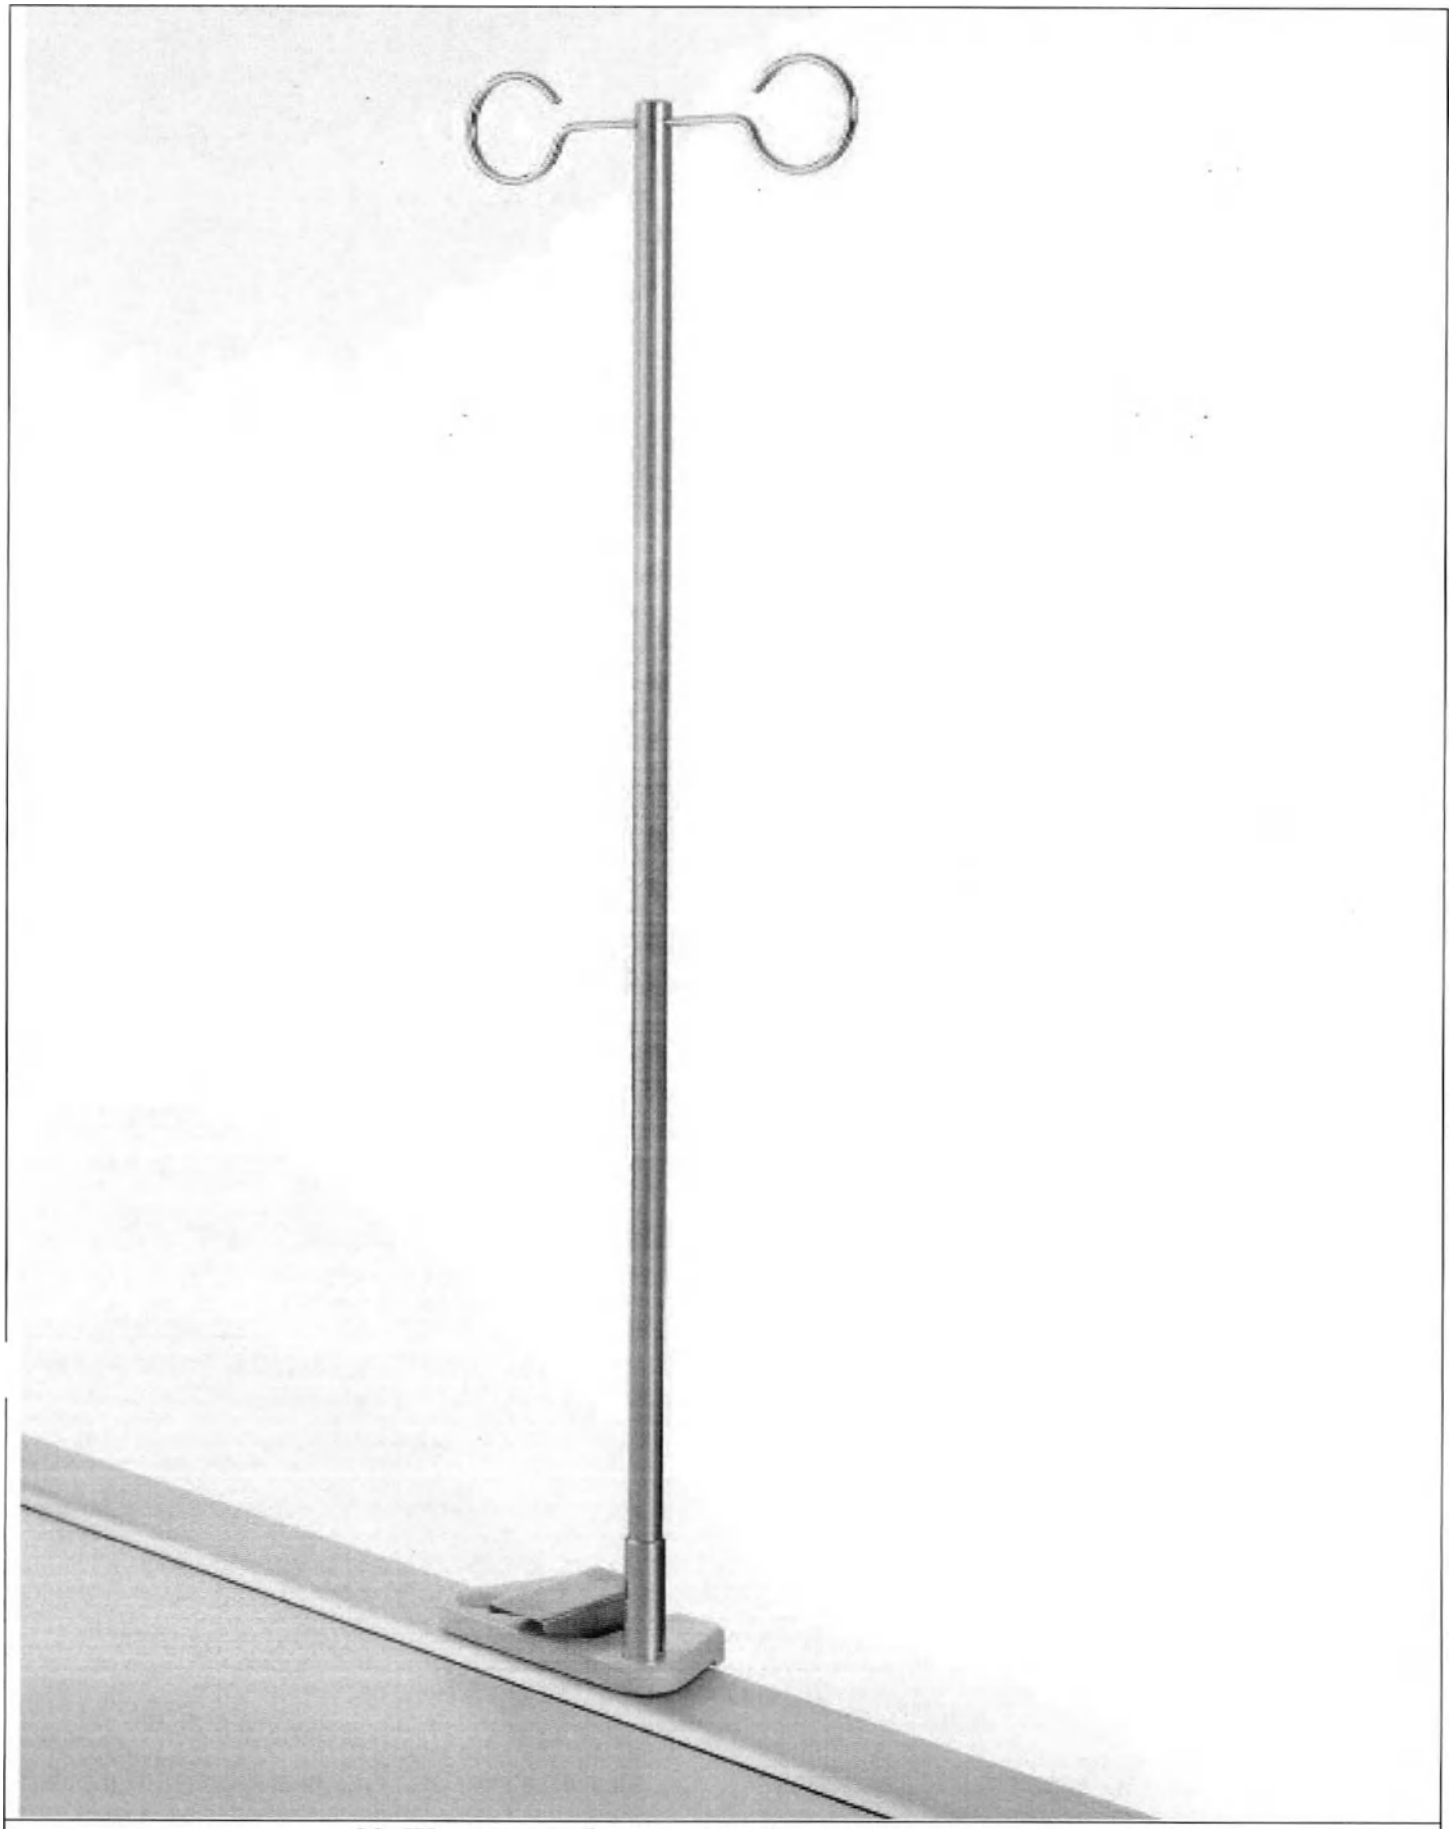

28. Штатив для бутылок с инфузионным раствором.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

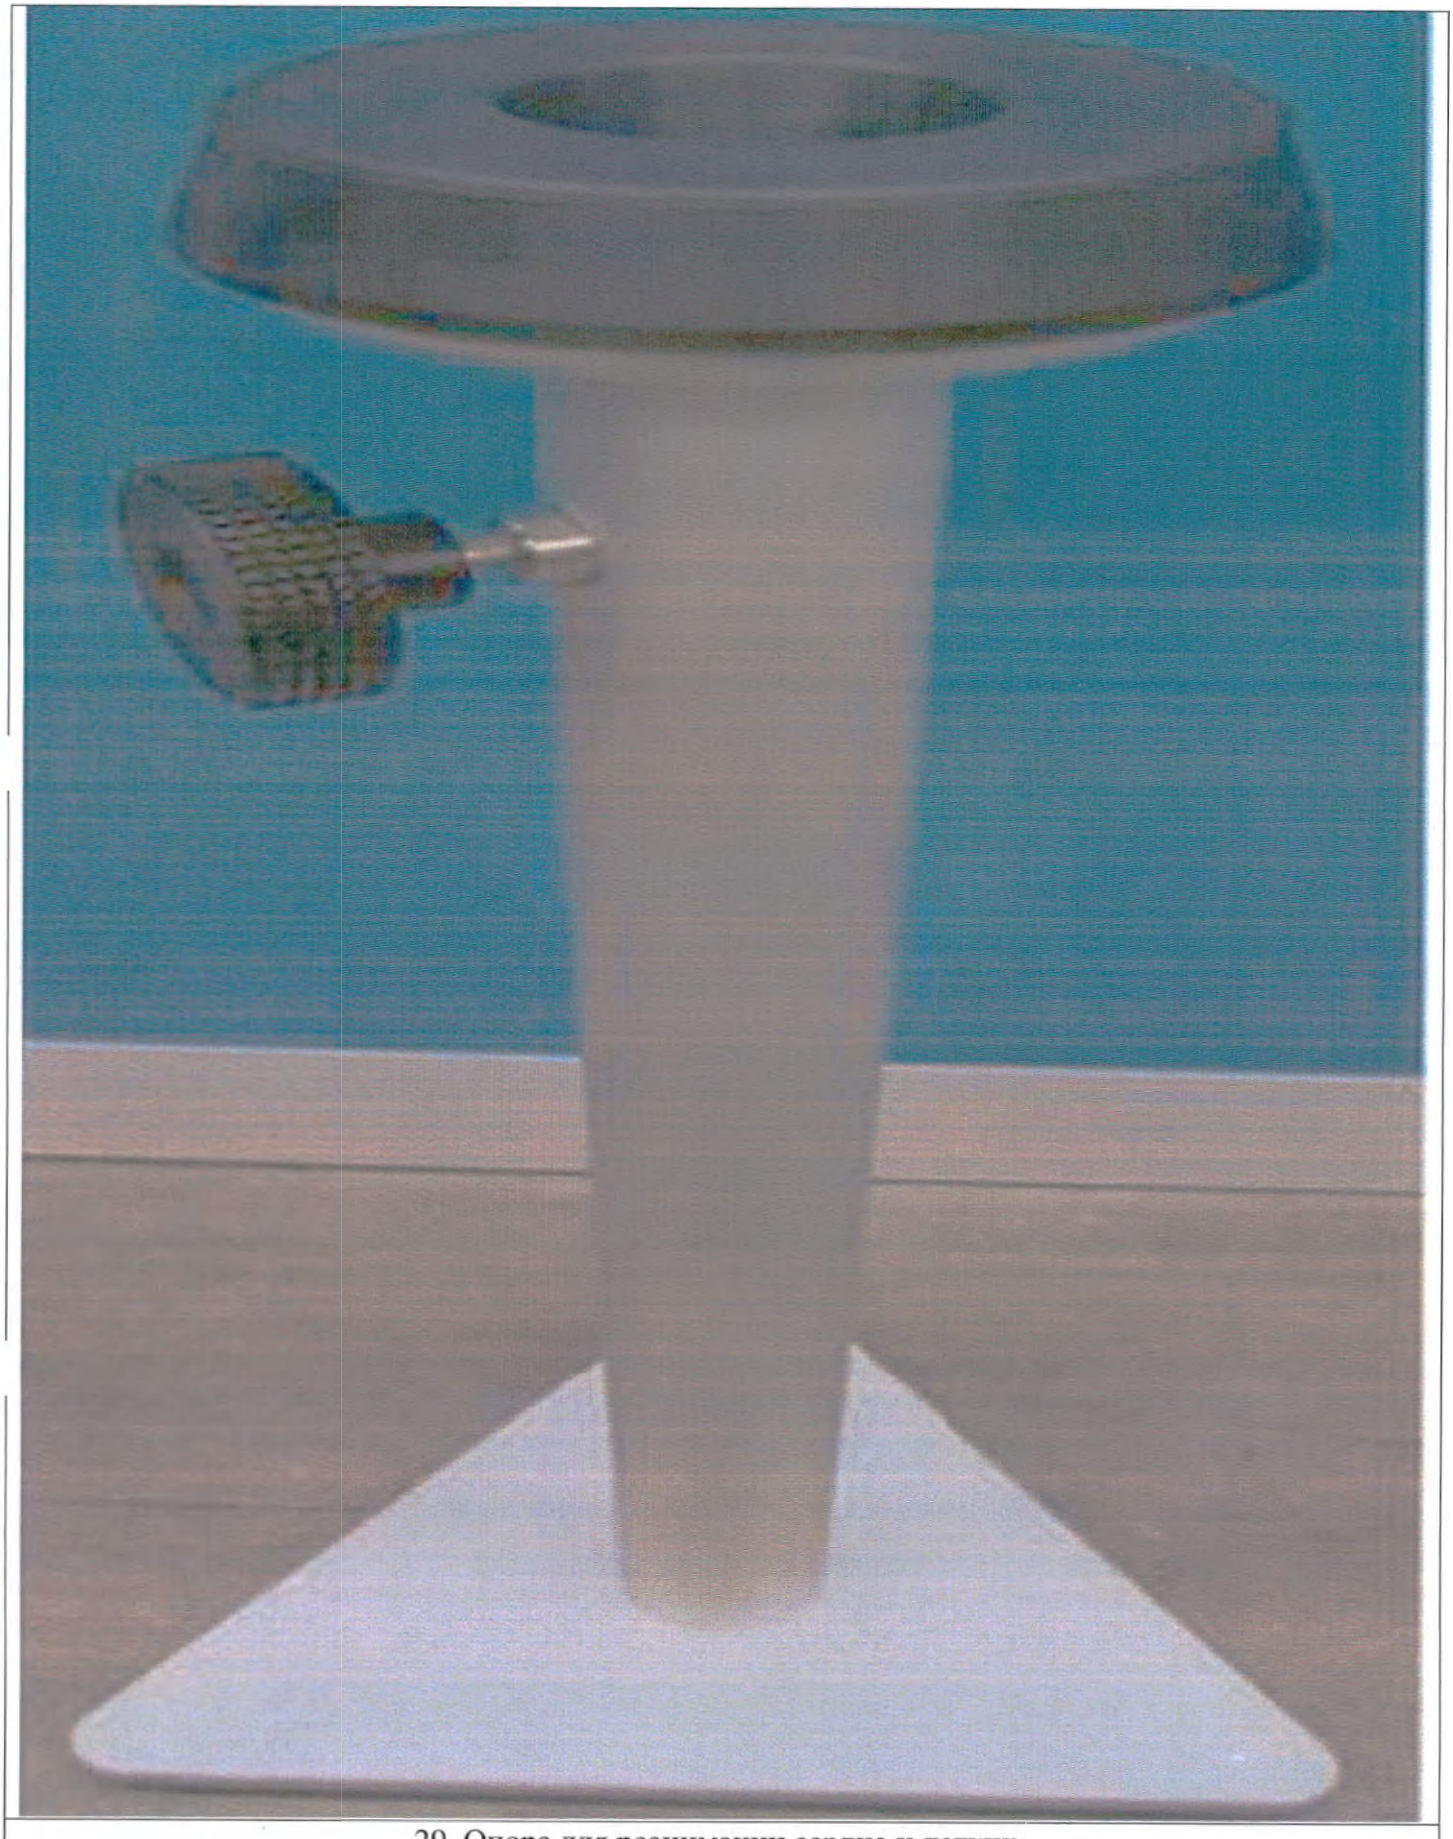

29. Опора для реанимации сердца и легких.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

30. Стенд для пациента для сшивки изображений.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

31. Линейки сшивки.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

32. Съемные рукоятки для пациента.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

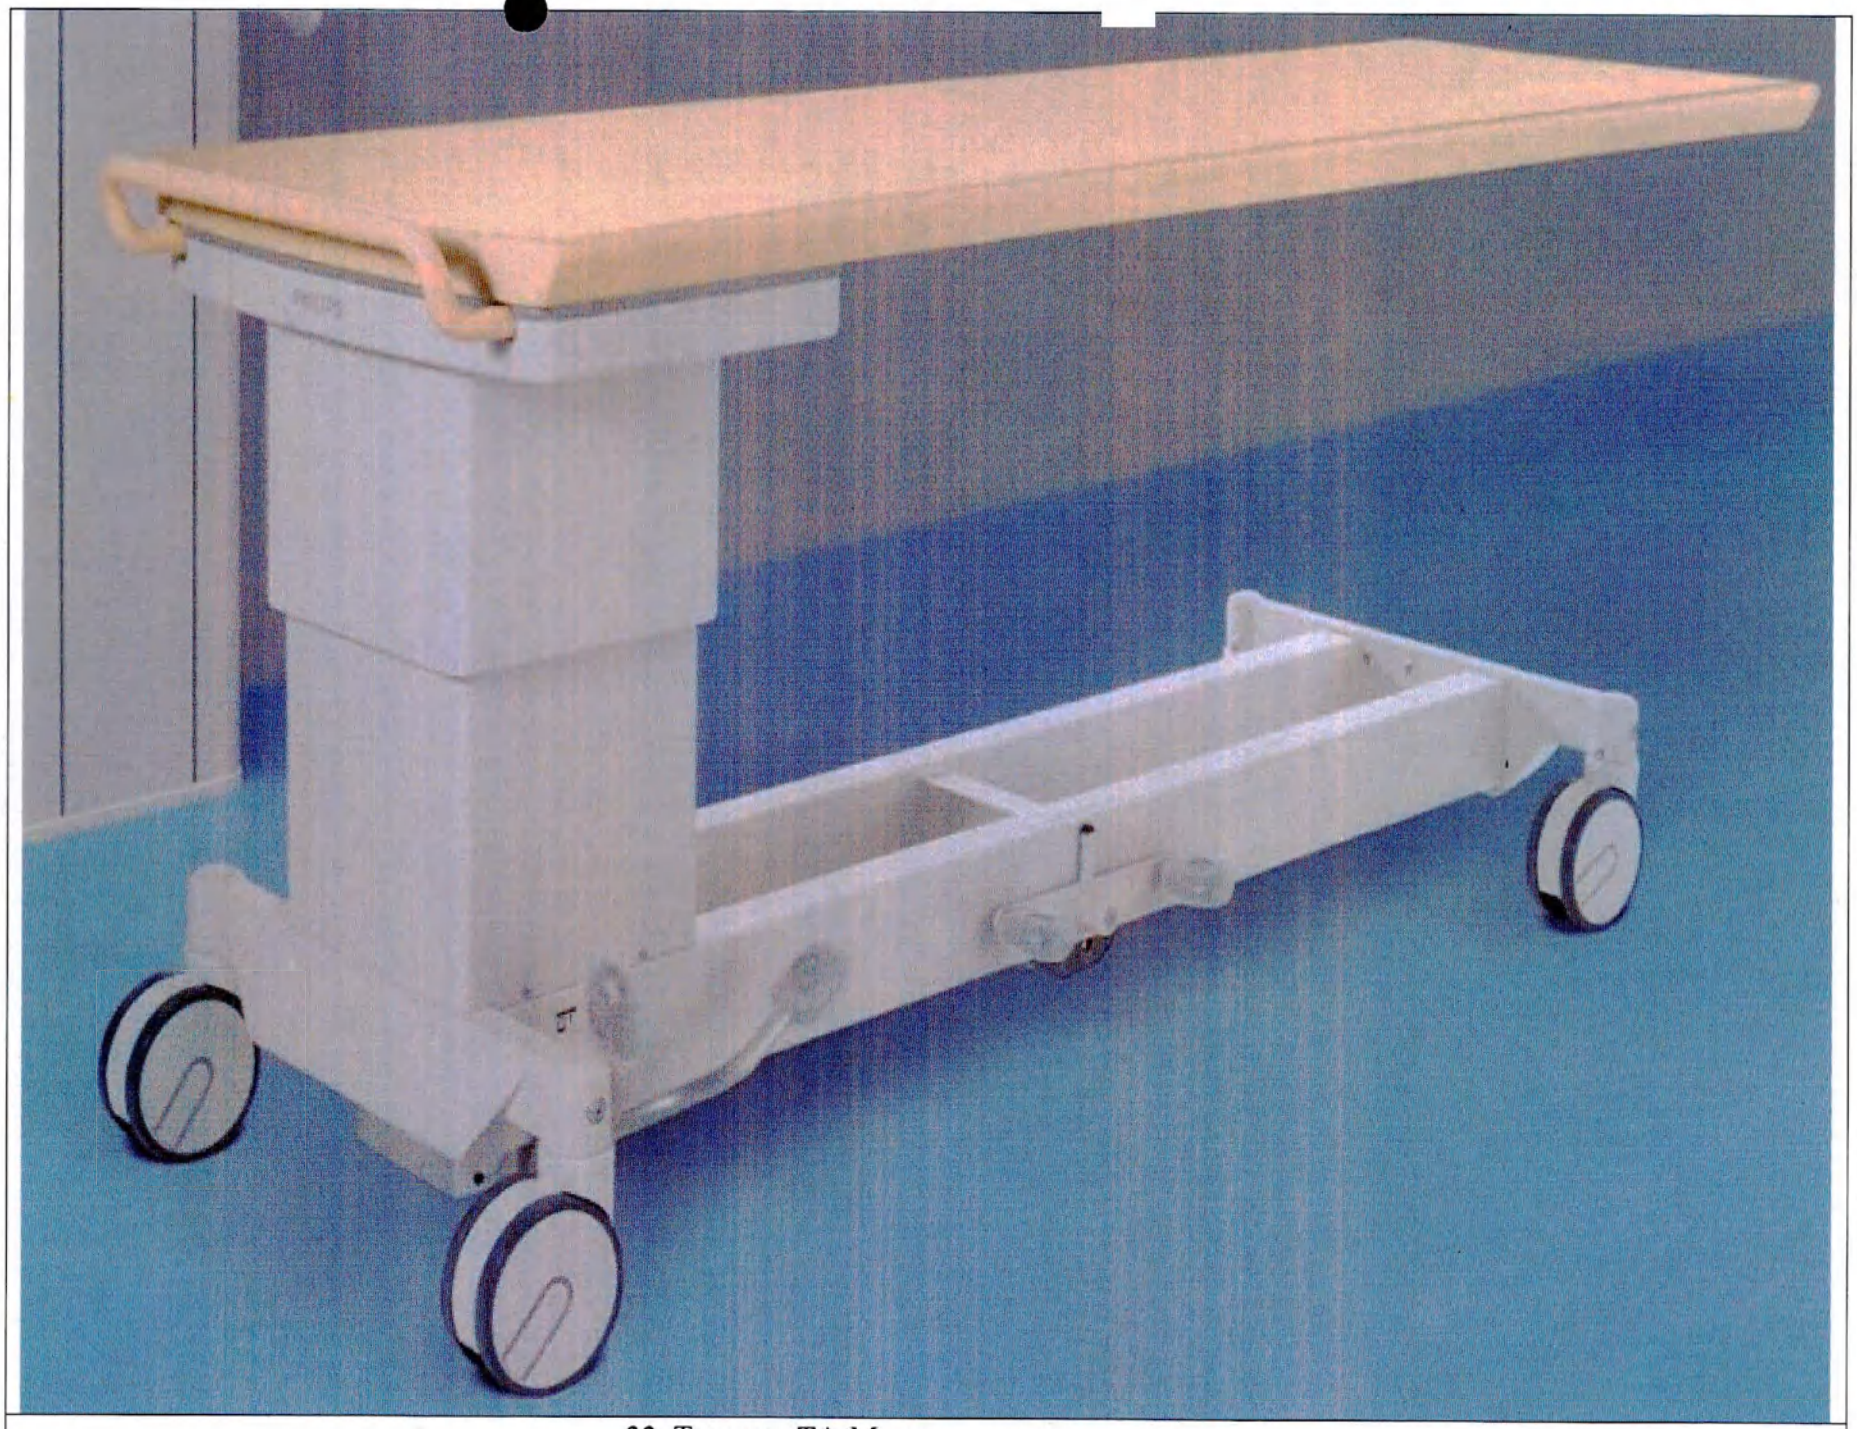

33. Тележка ТА-М регулируемая по высоте.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

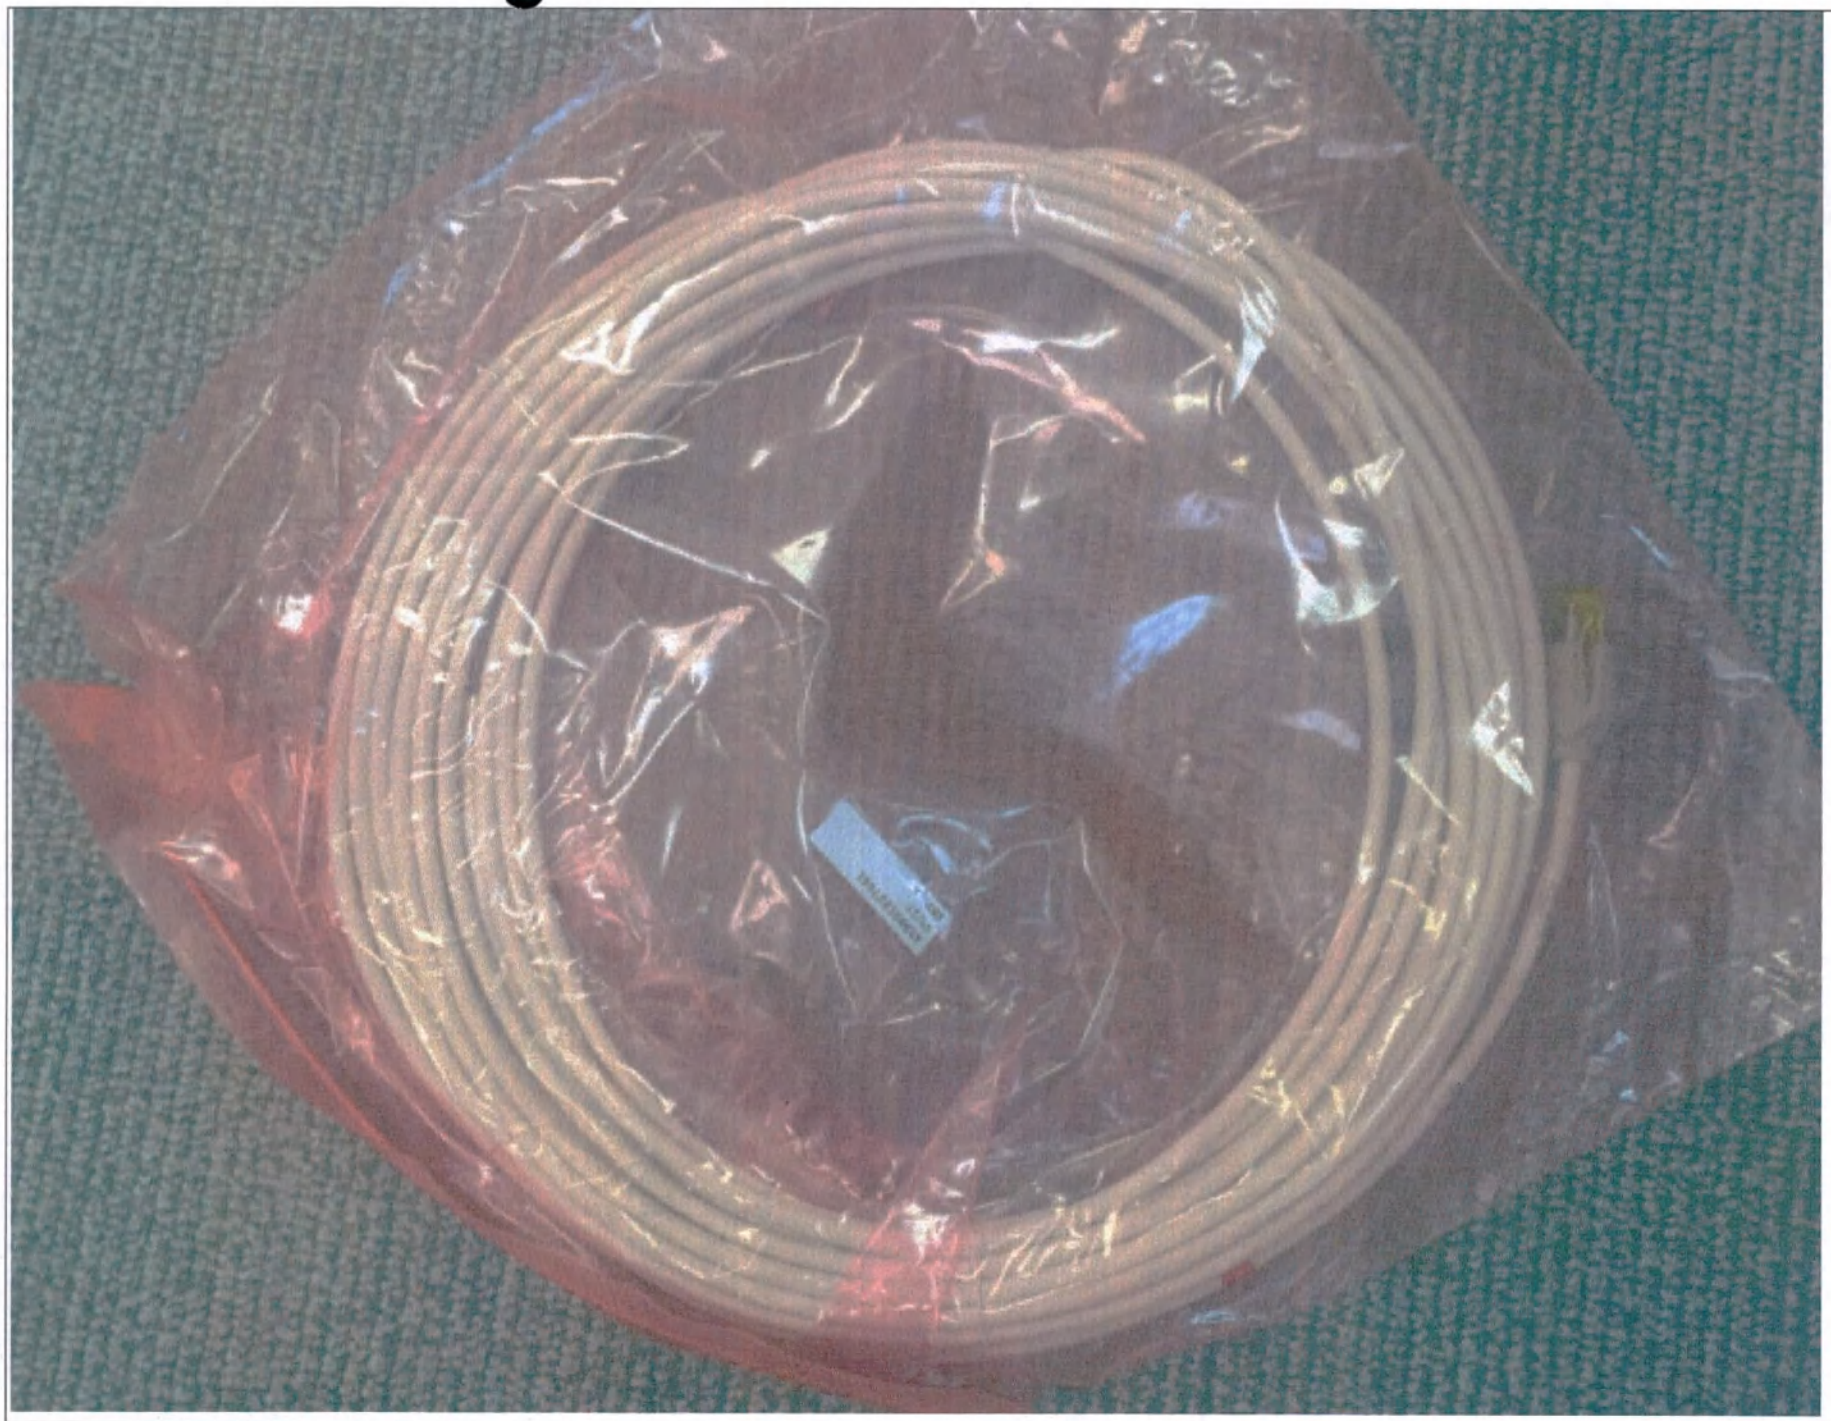

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

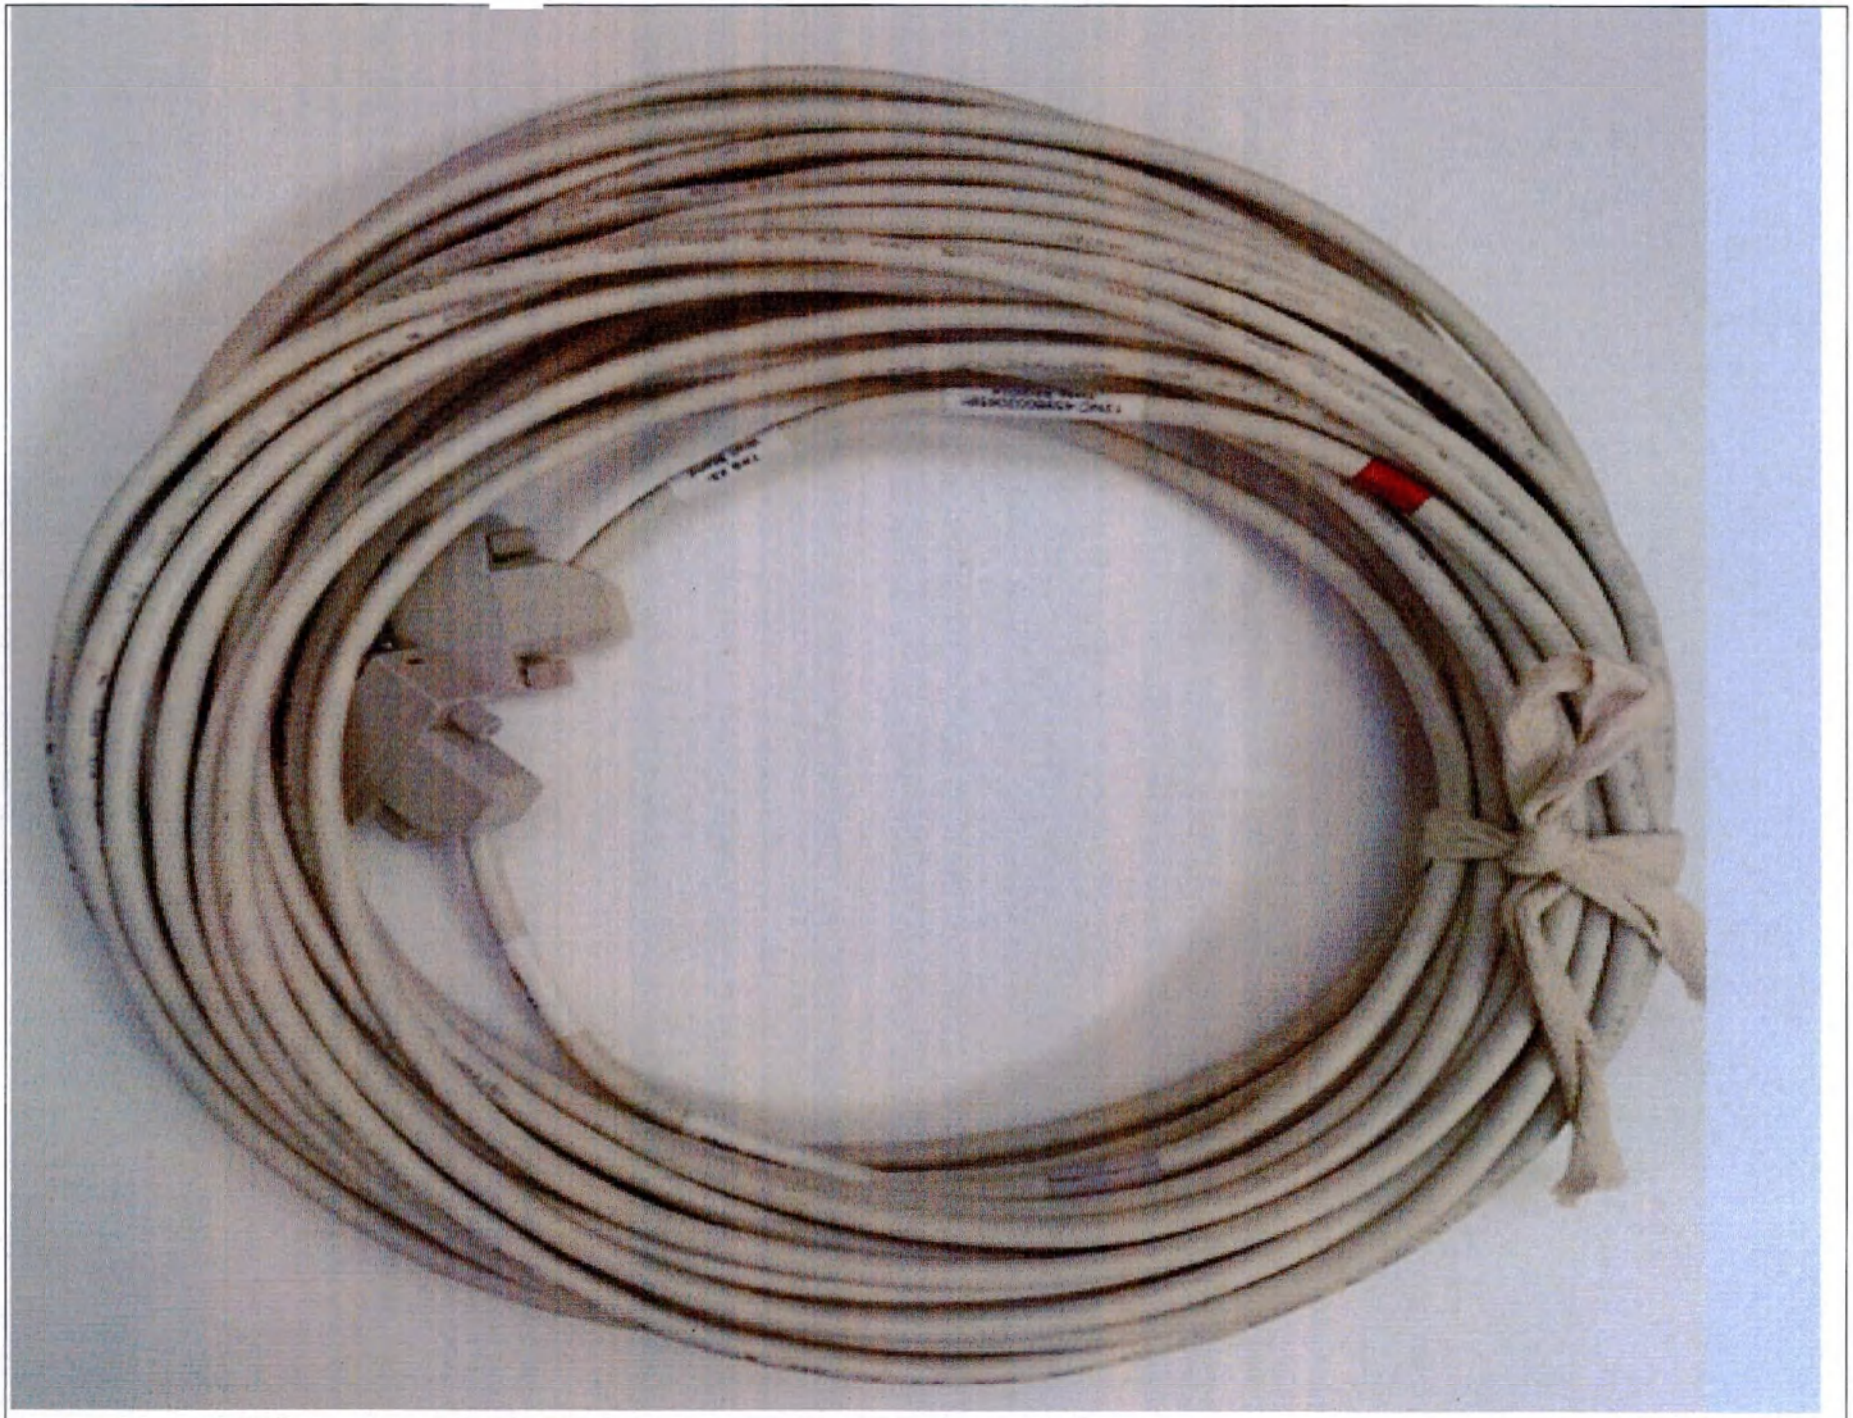

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

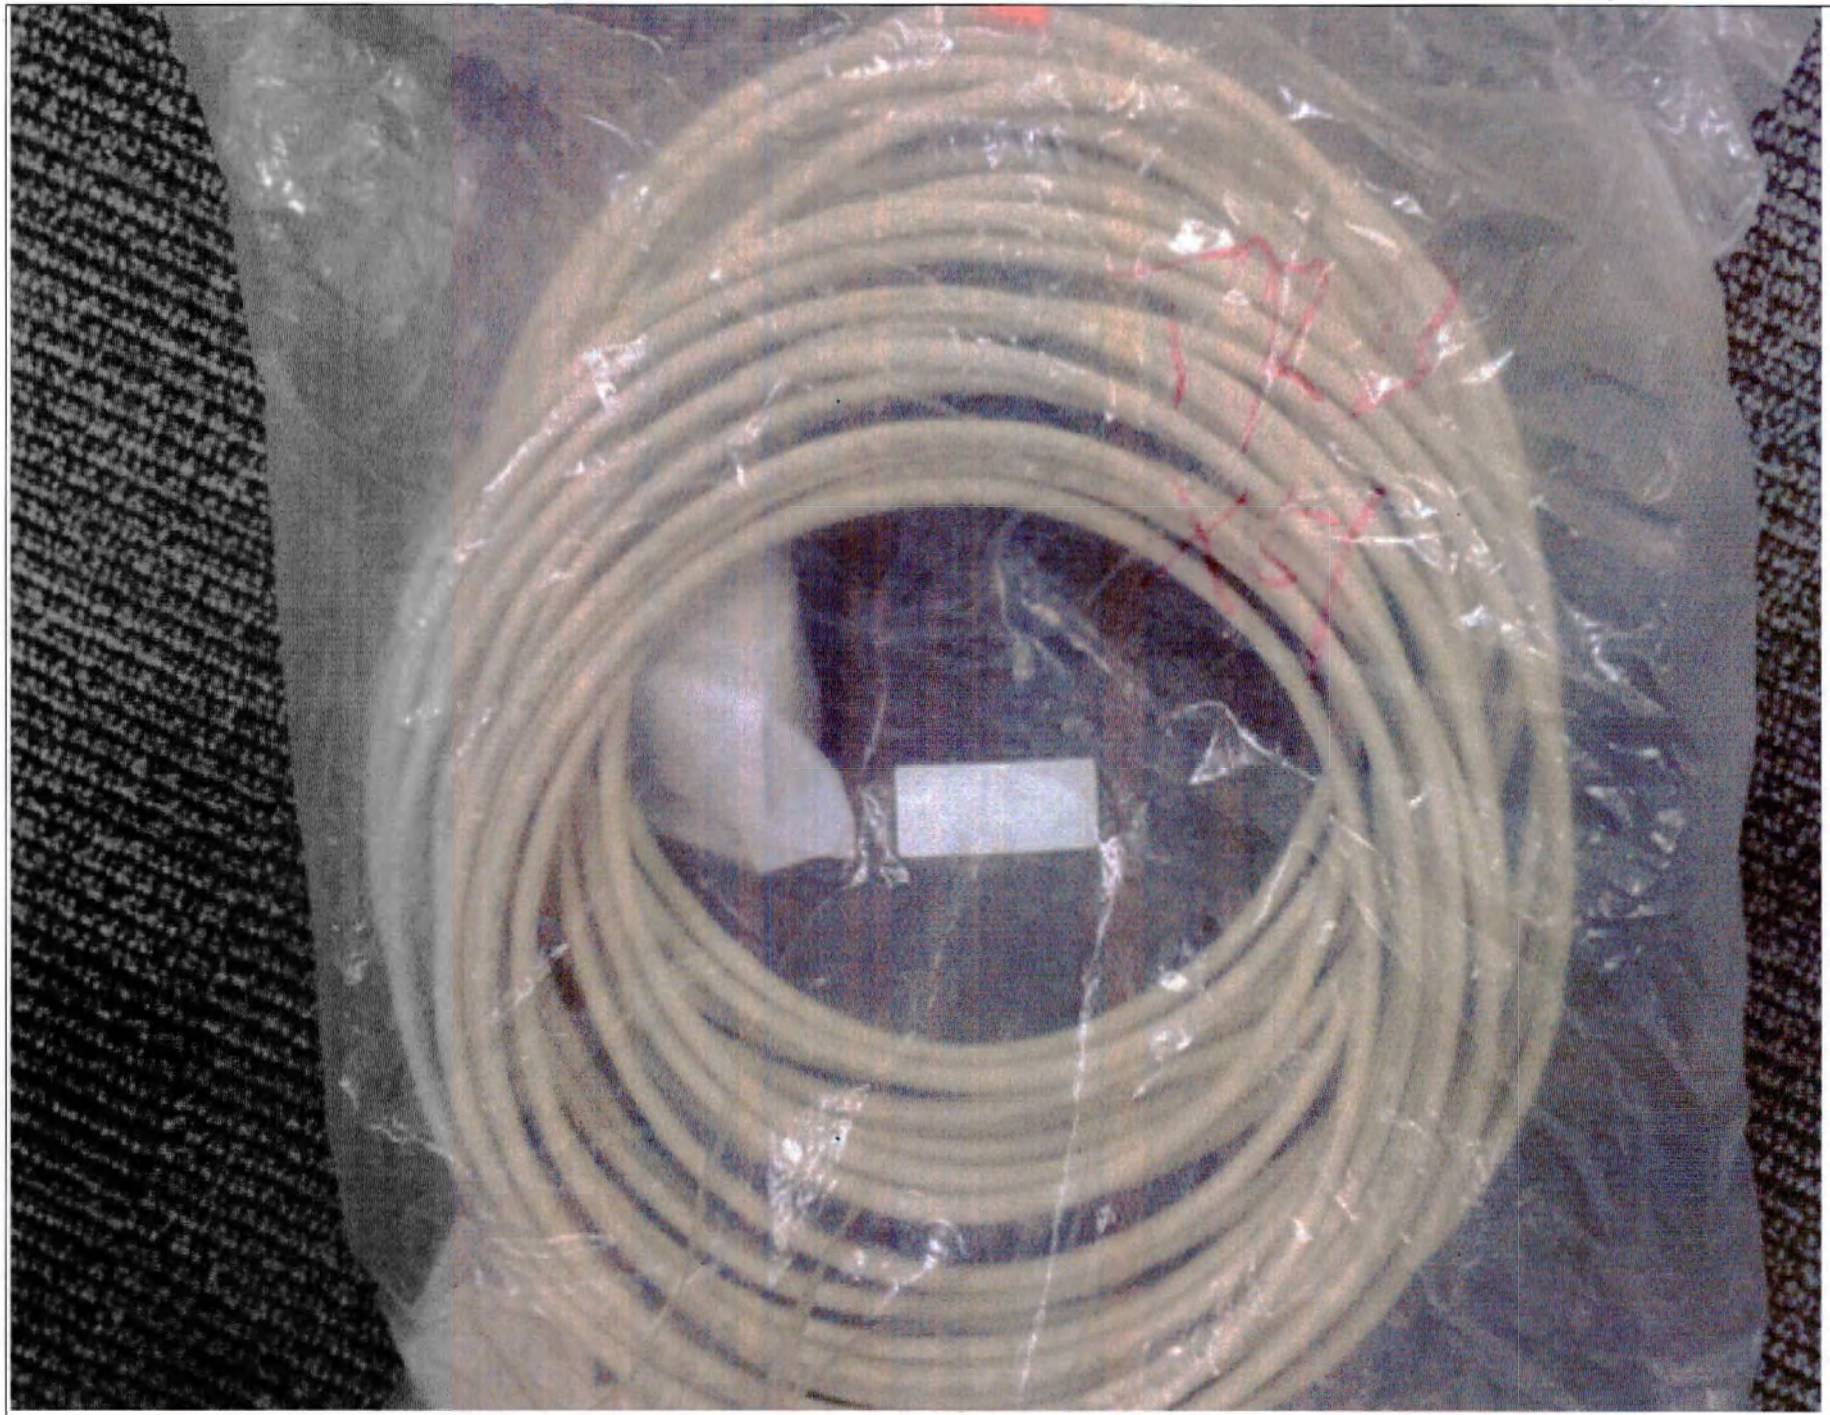

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

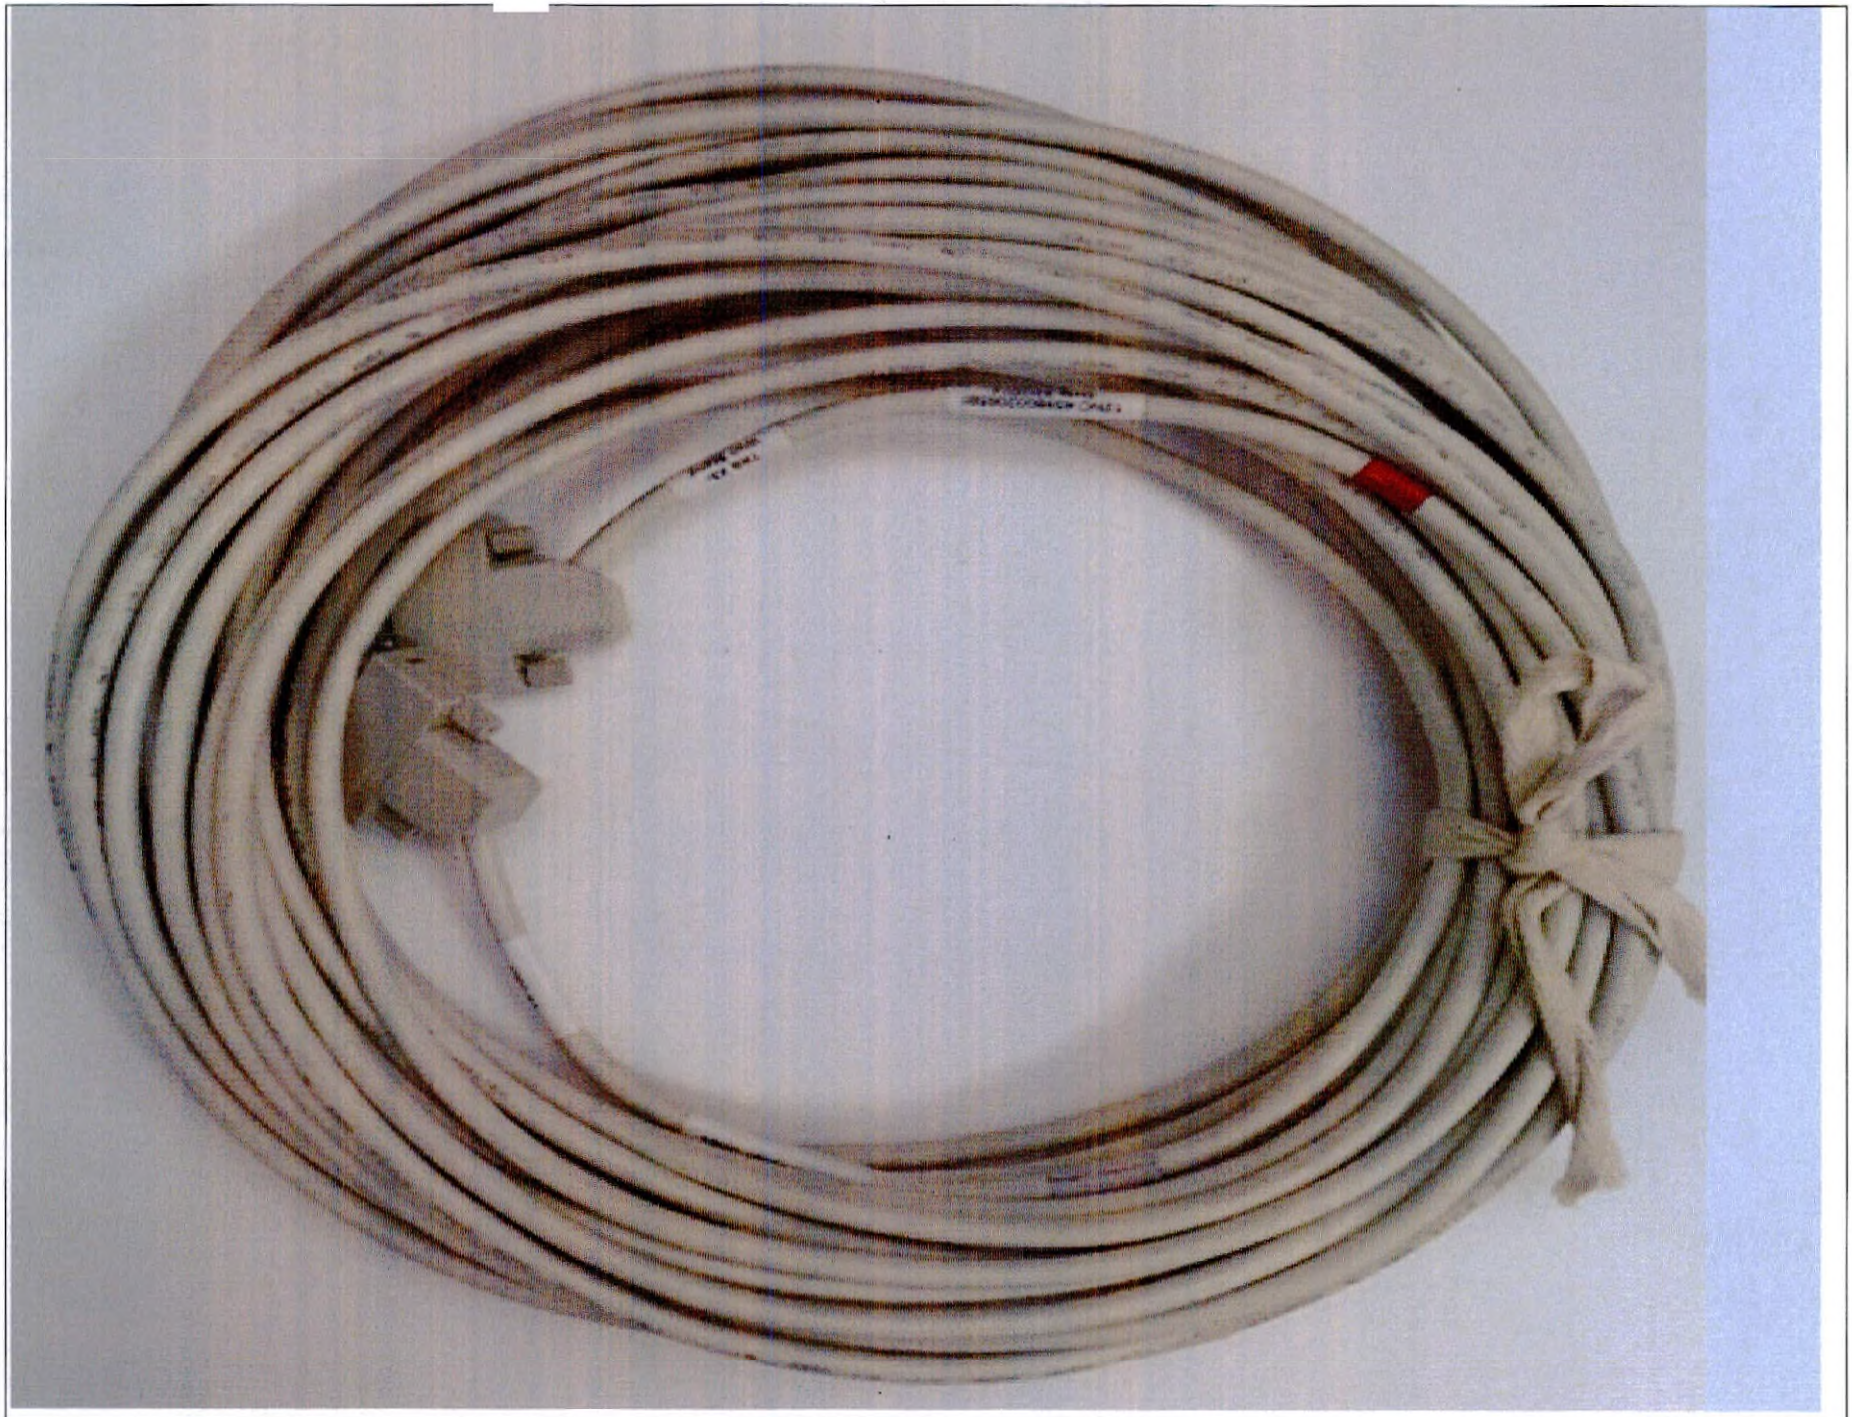

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

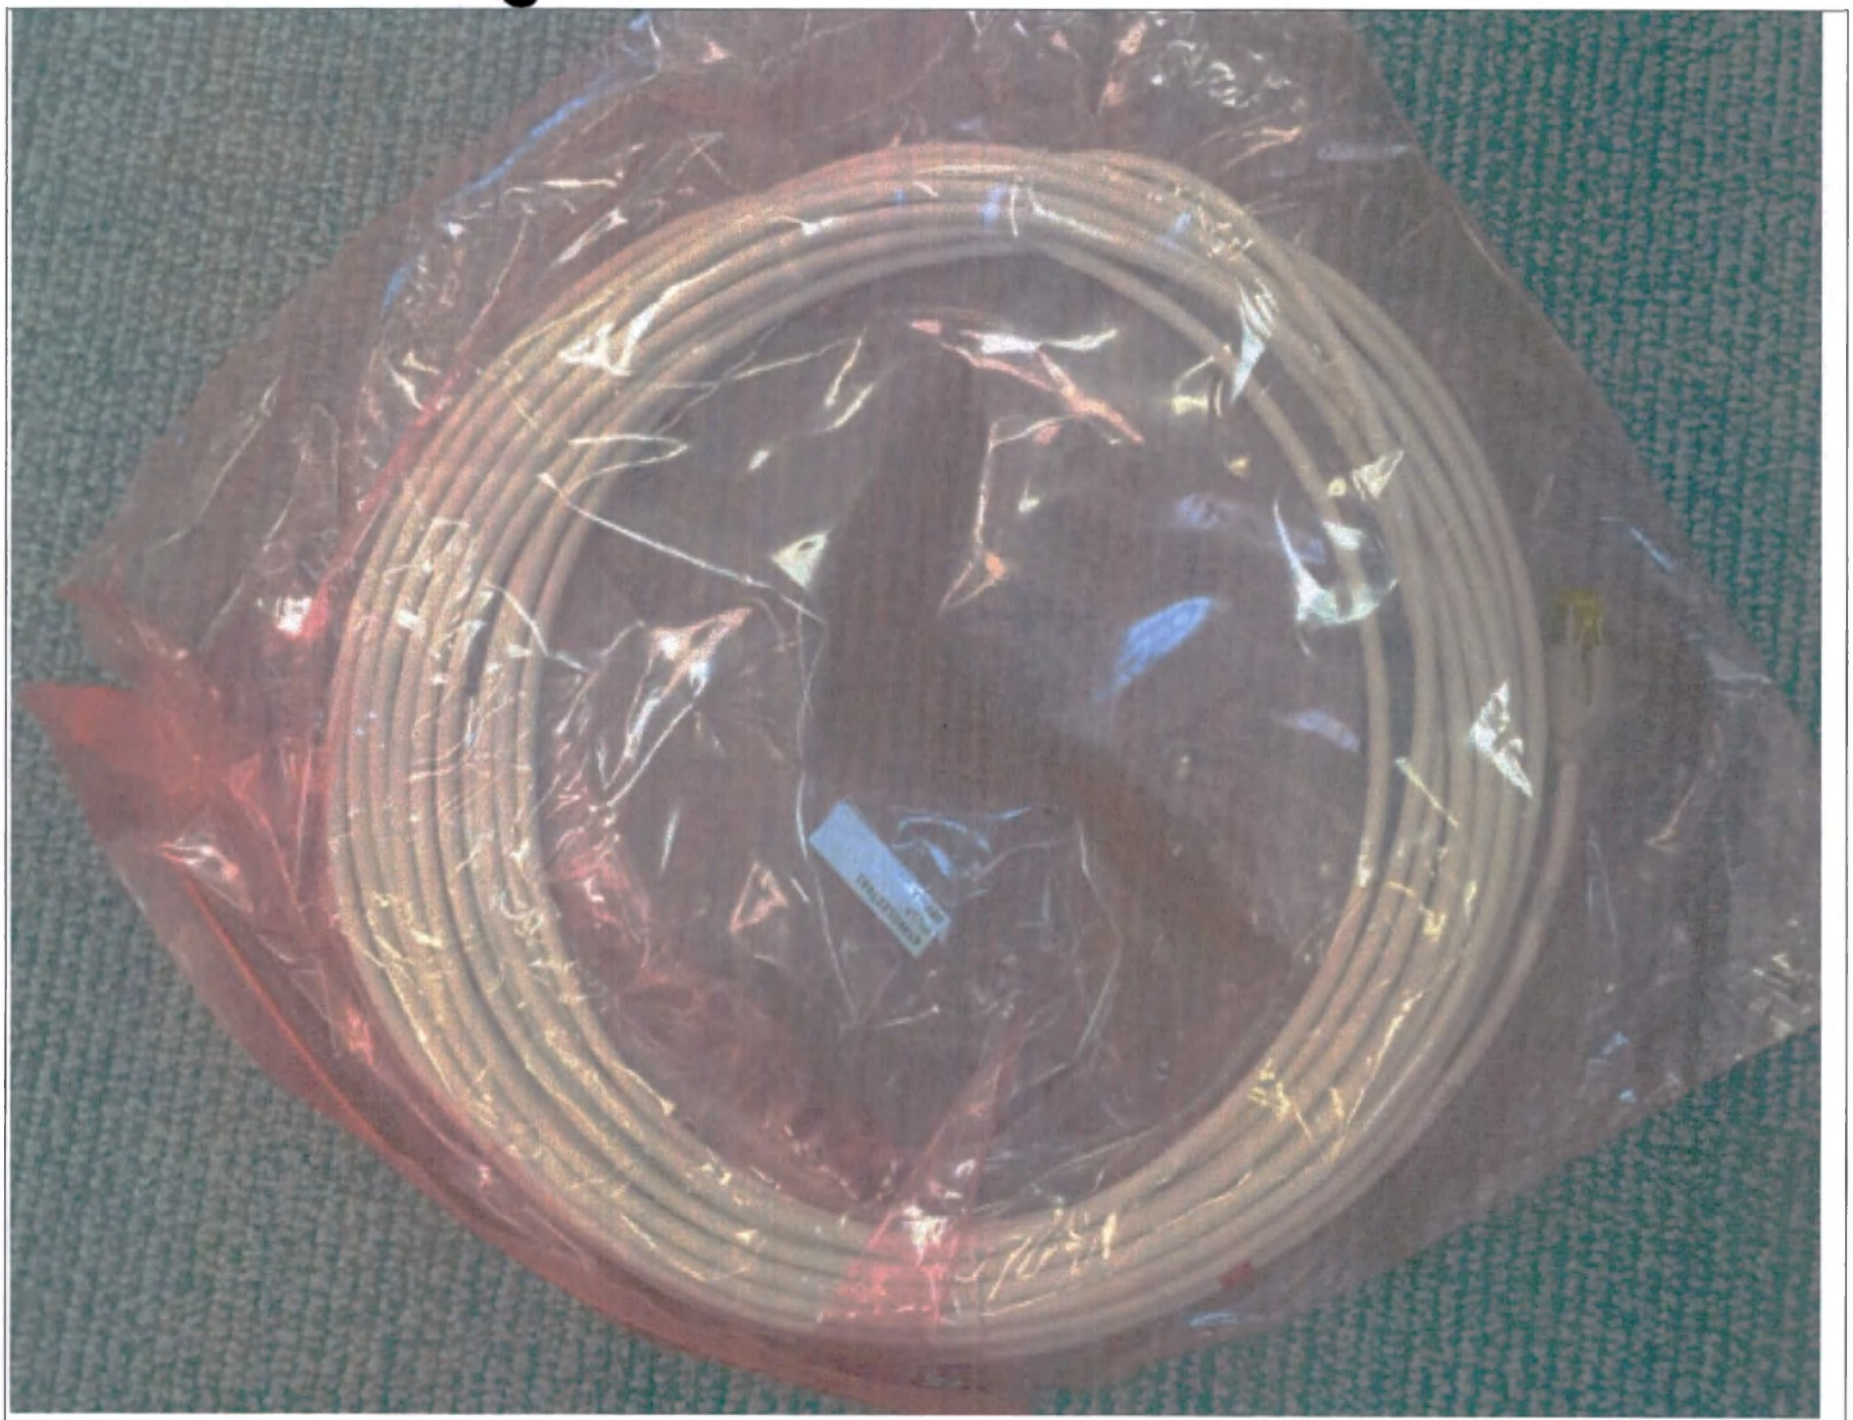

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

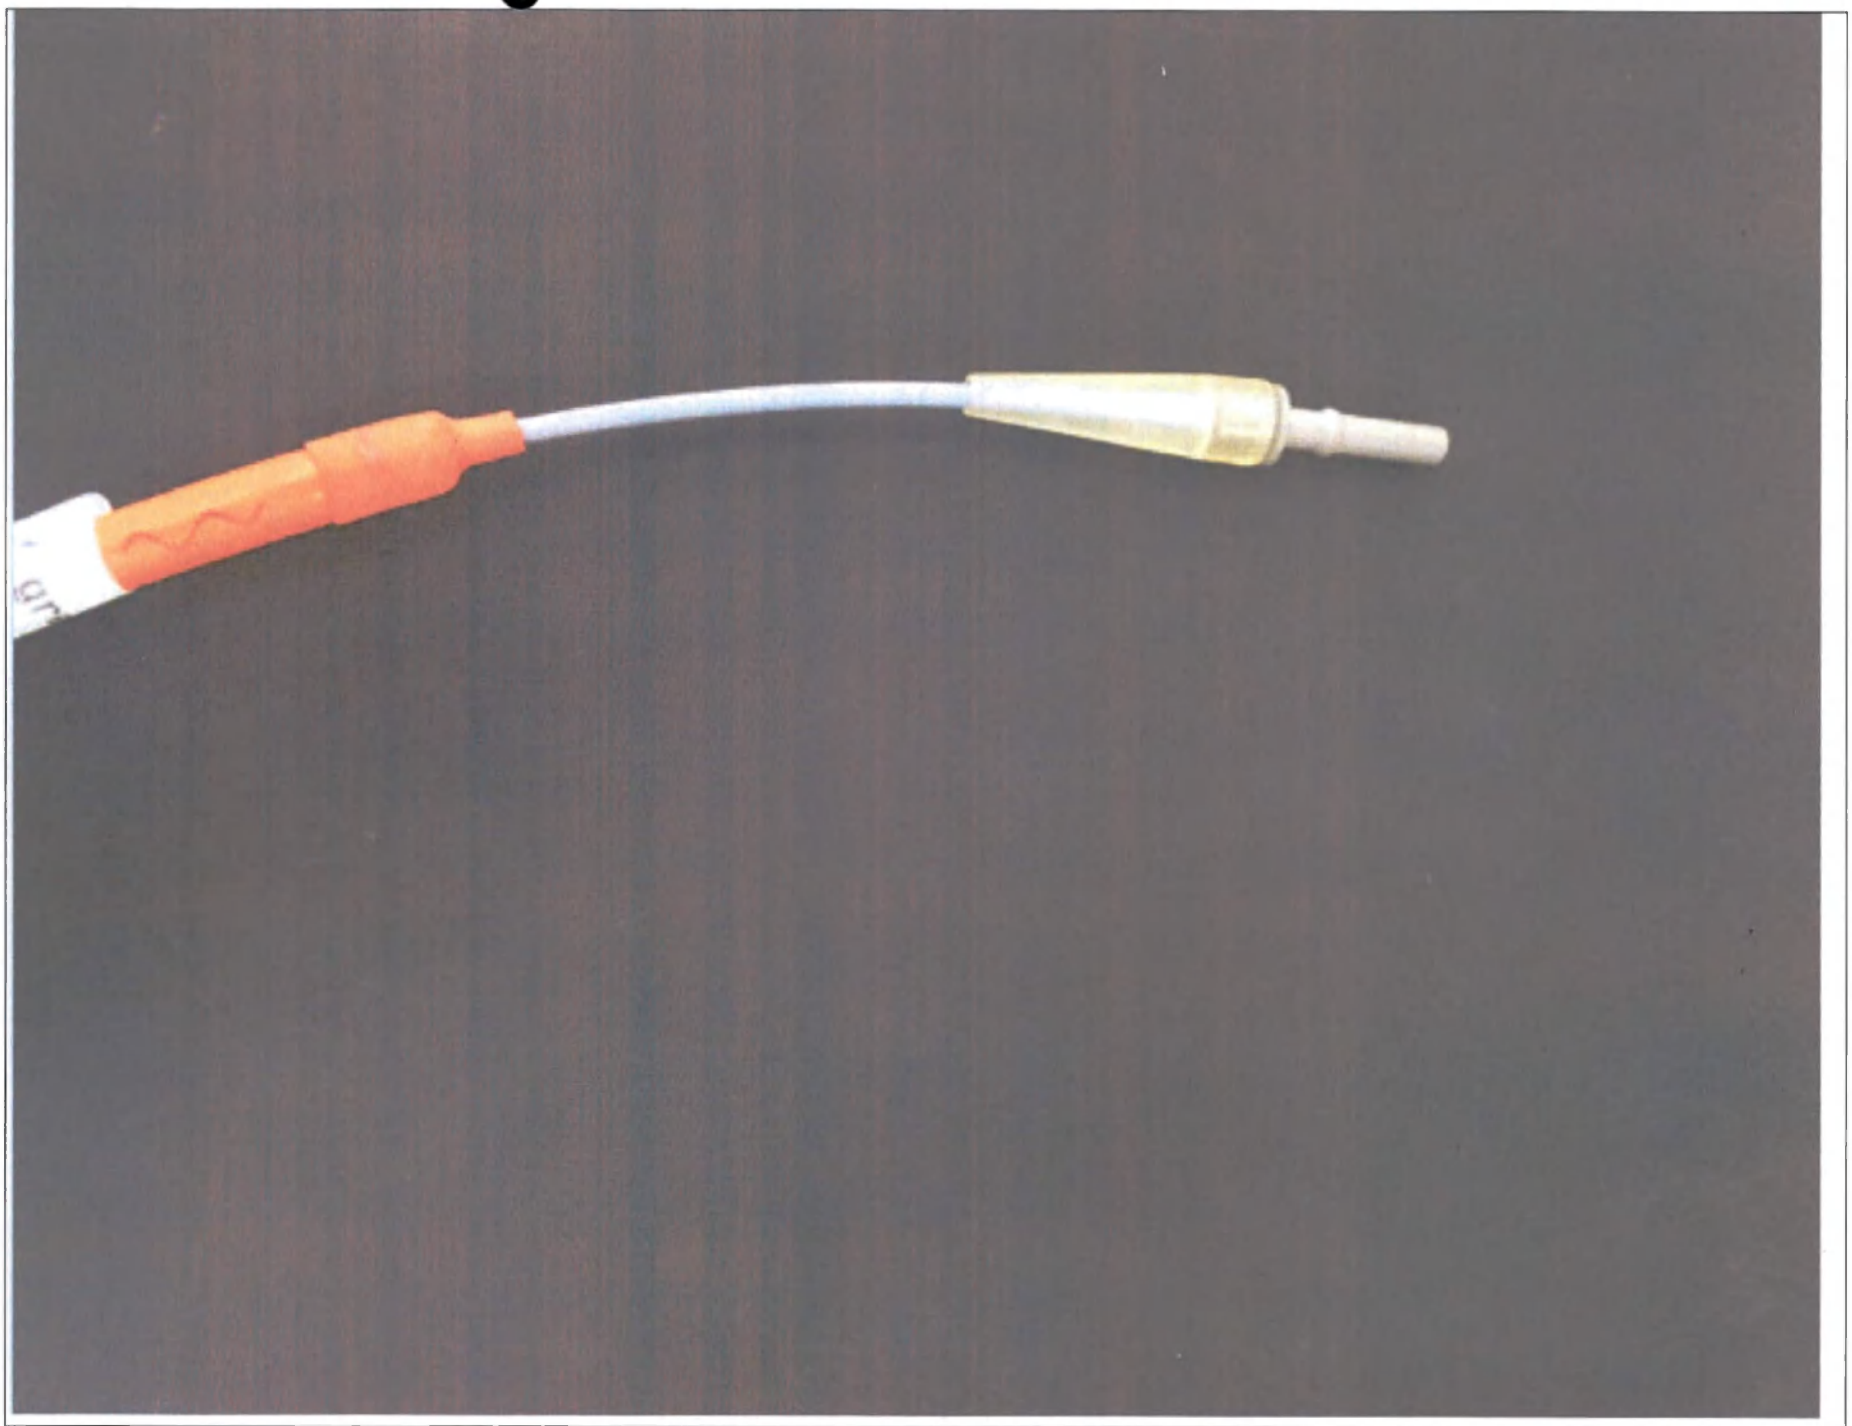

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

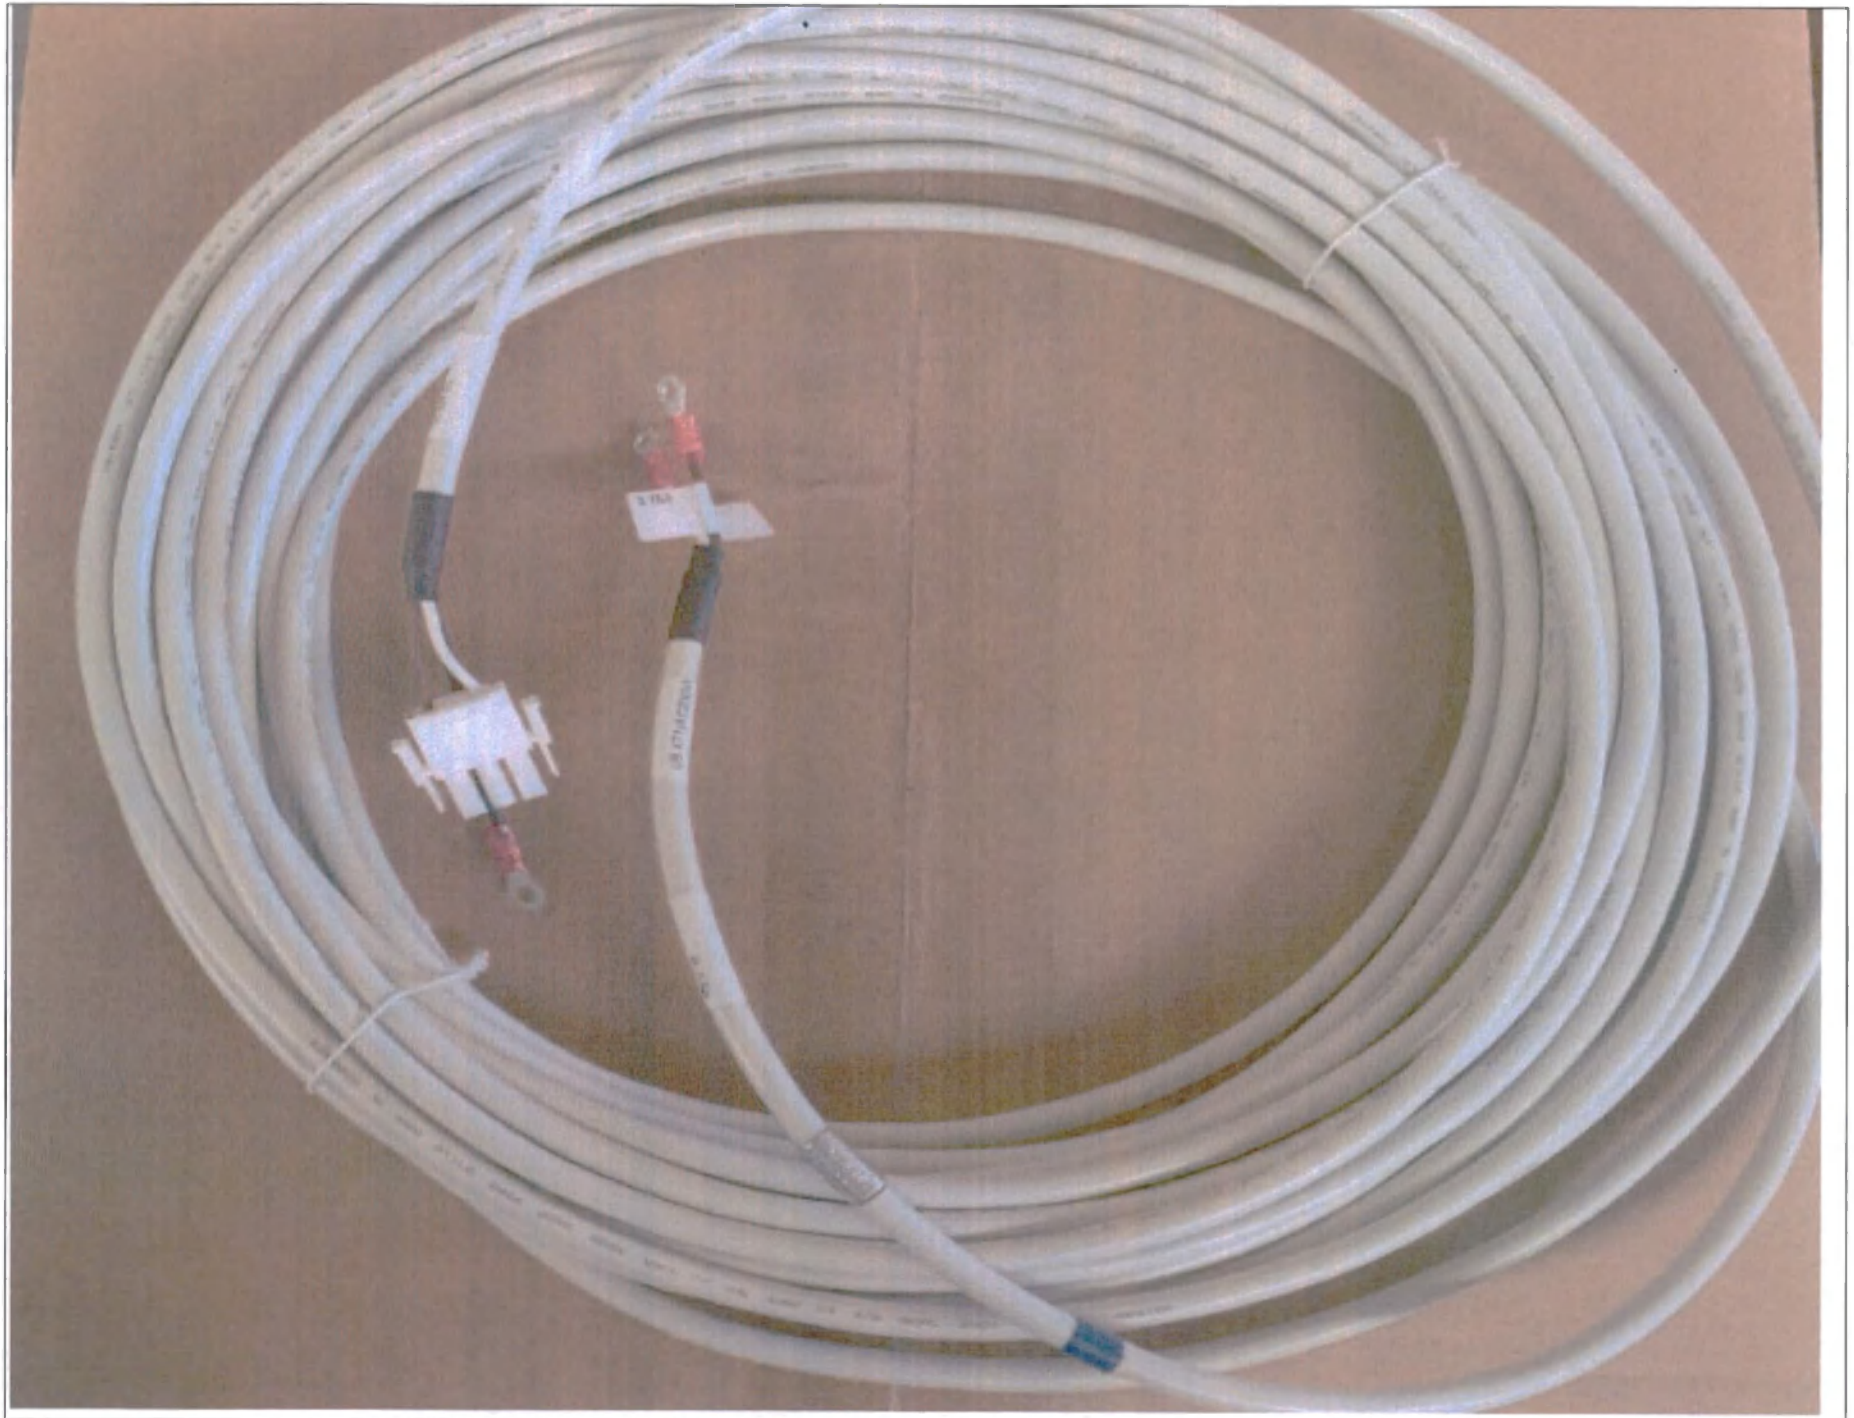

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

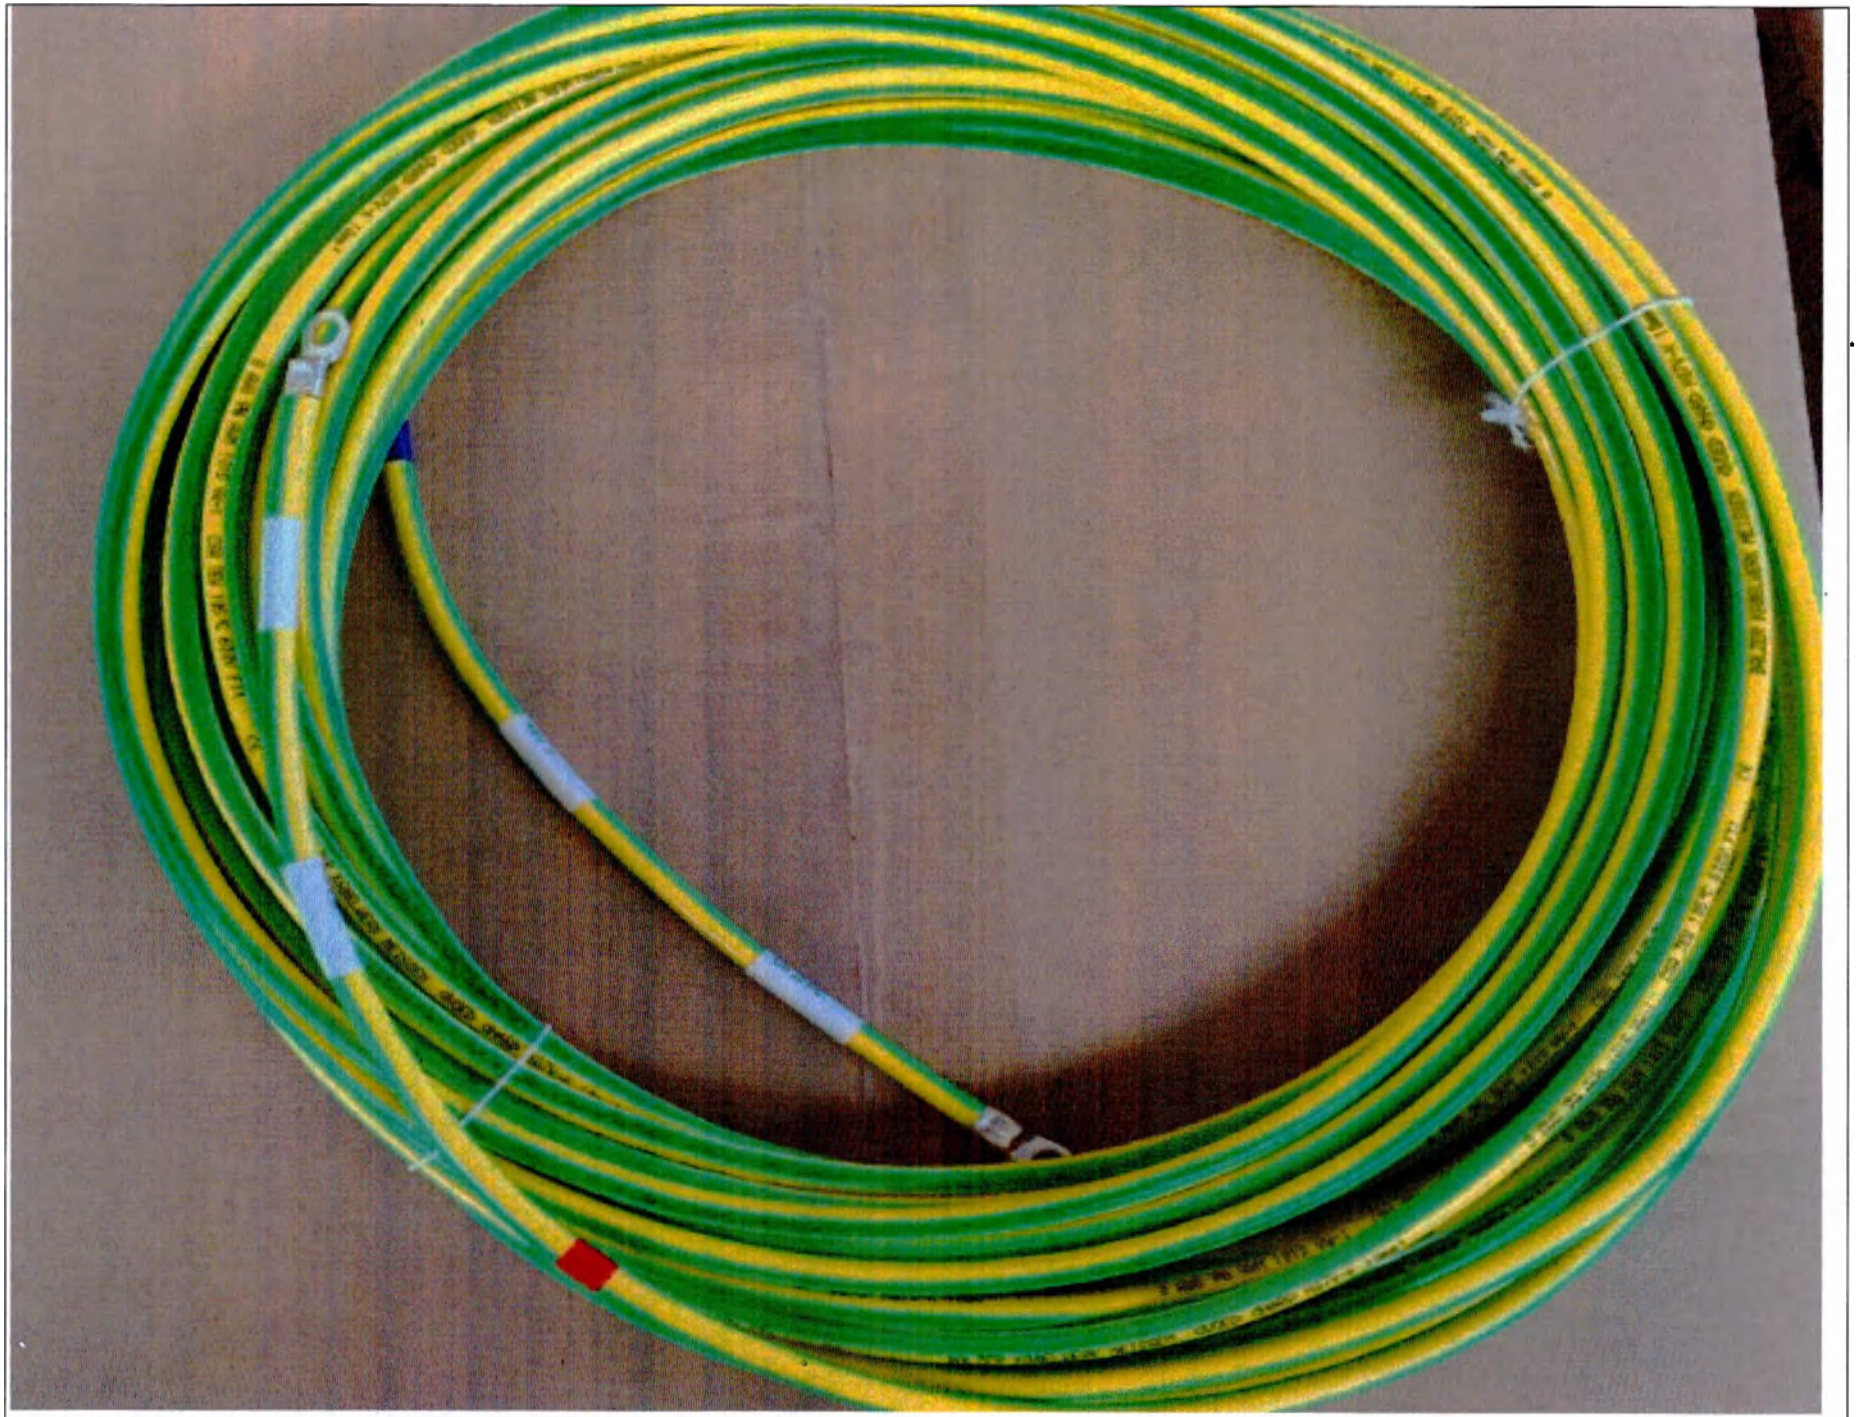

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

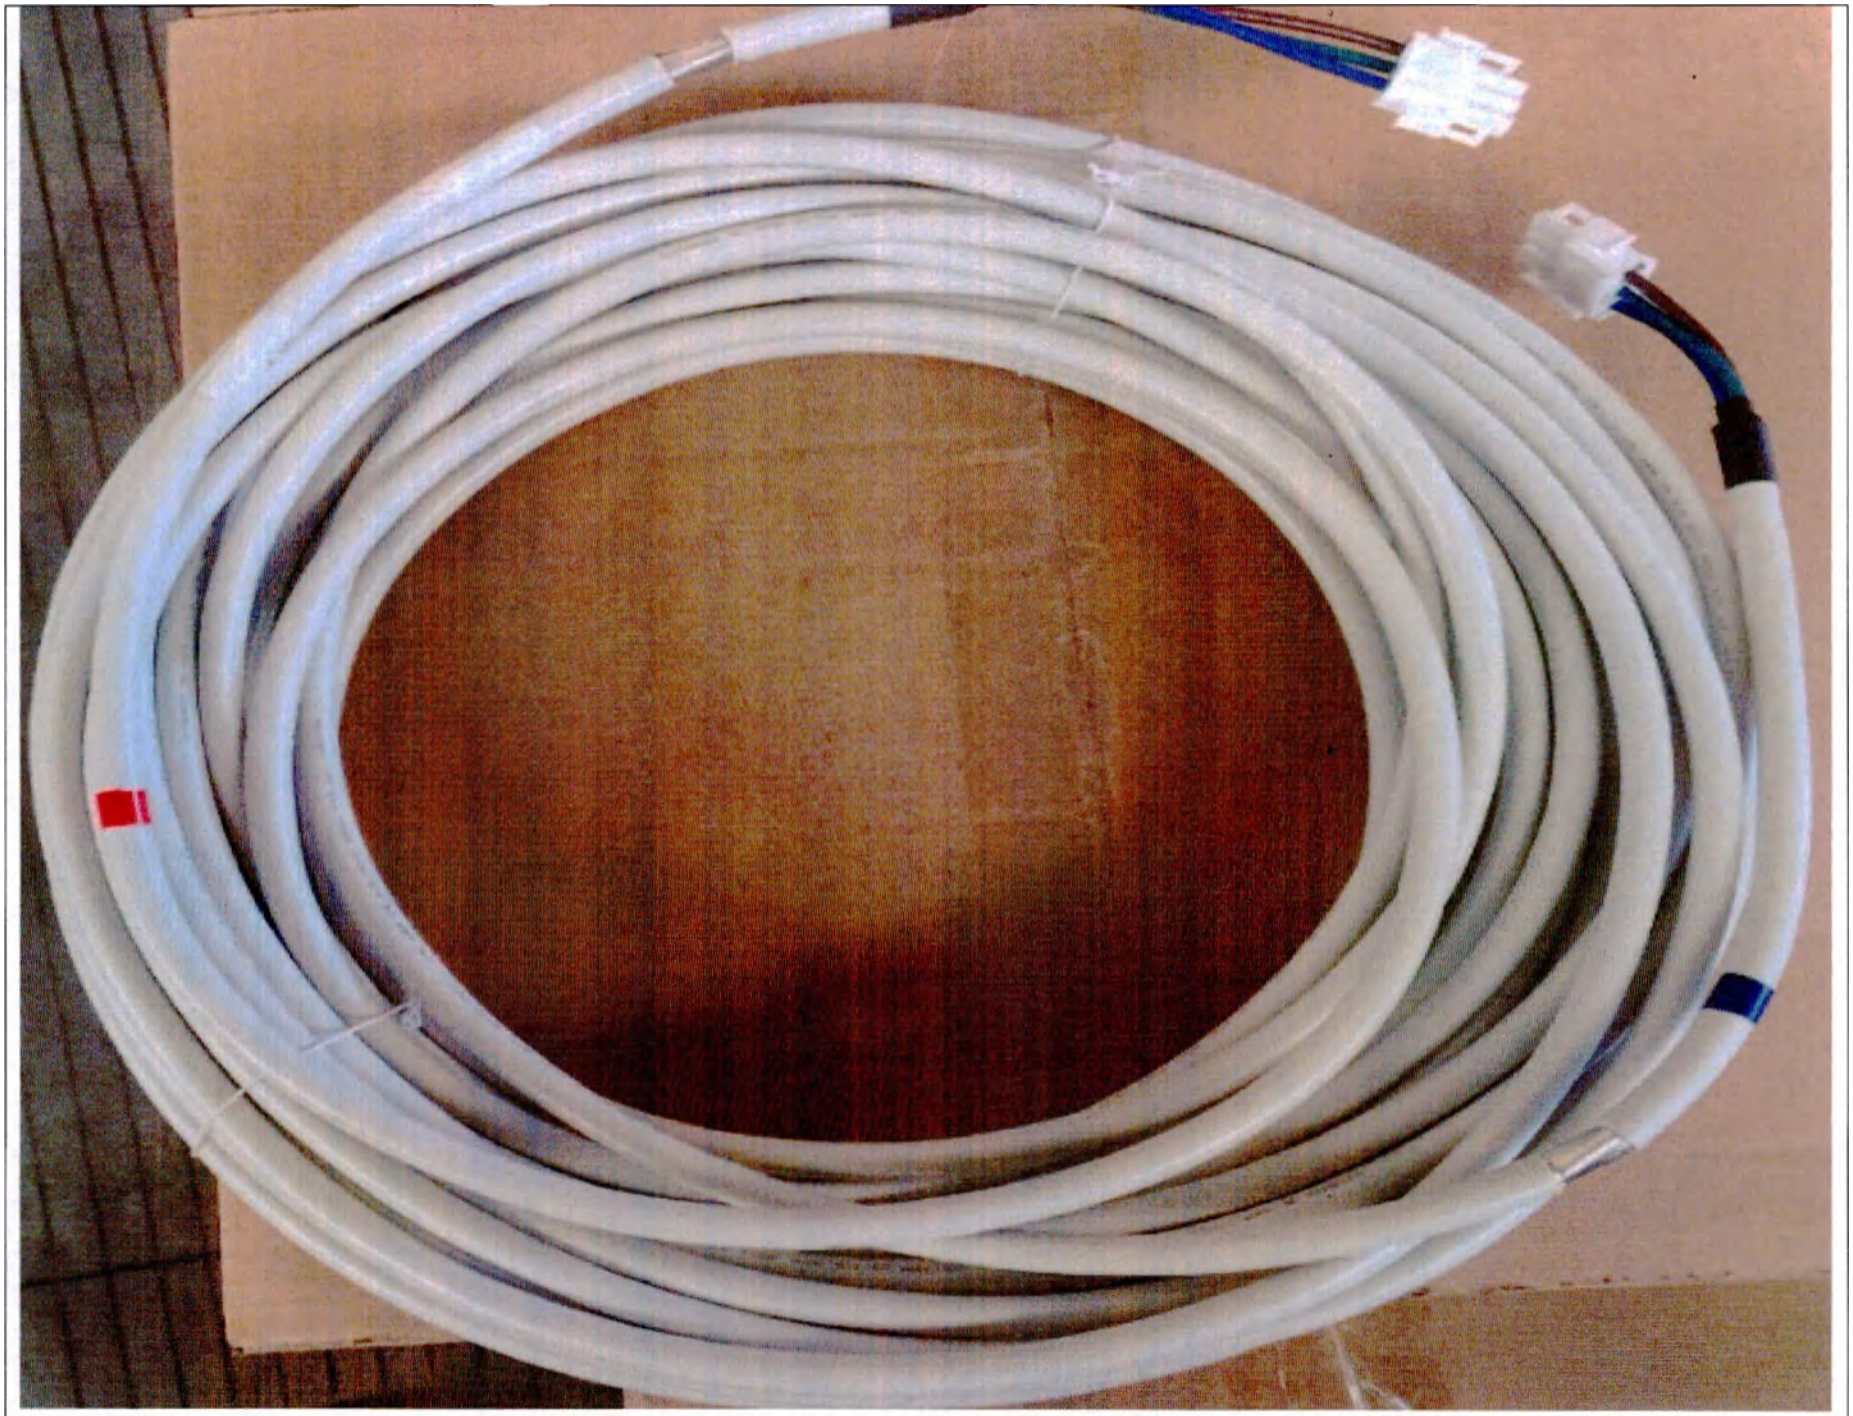

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

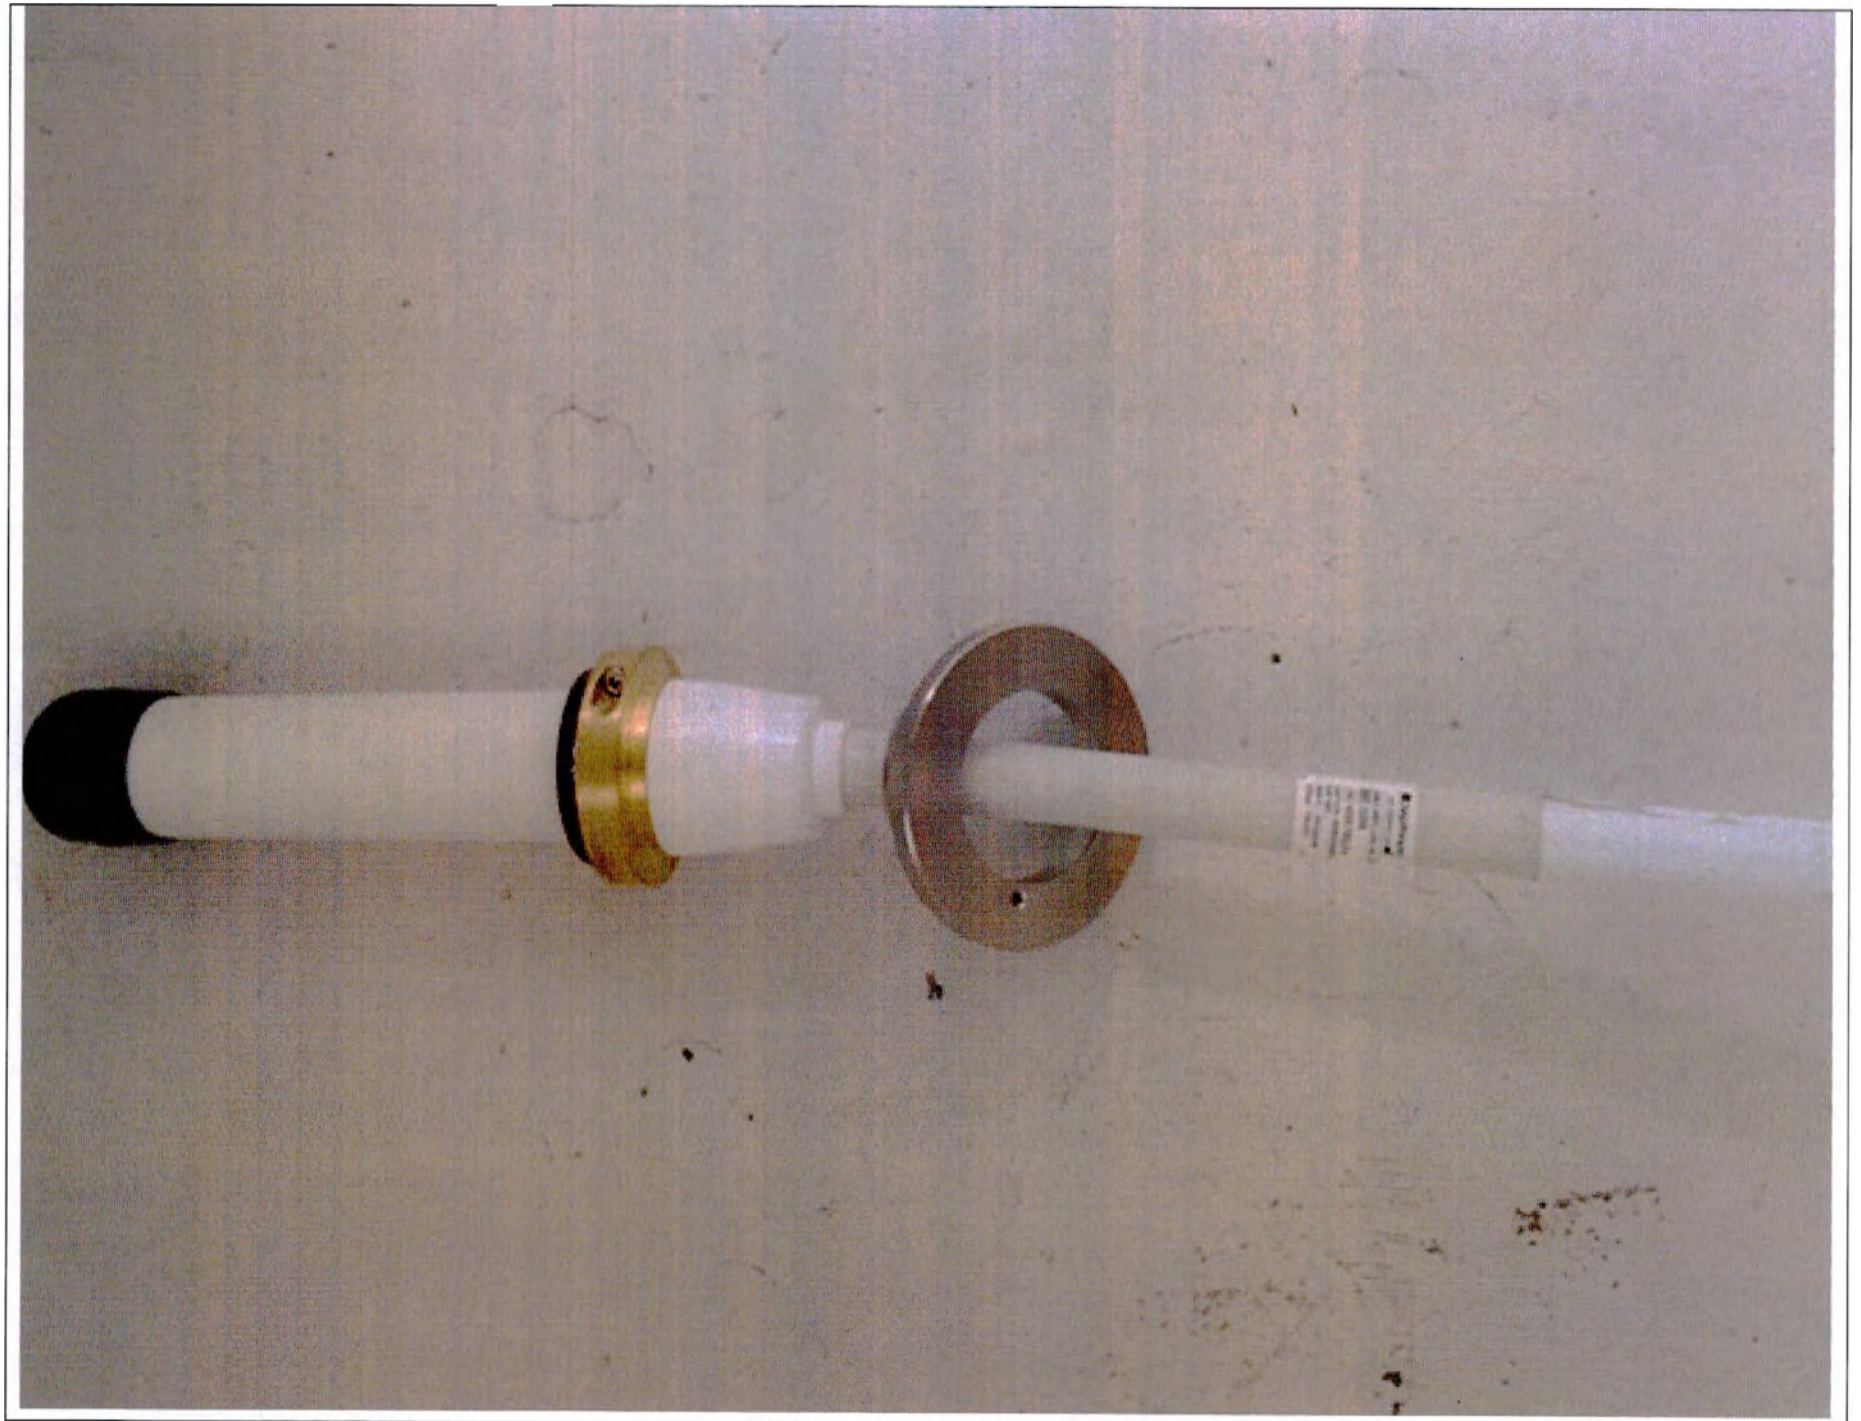

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

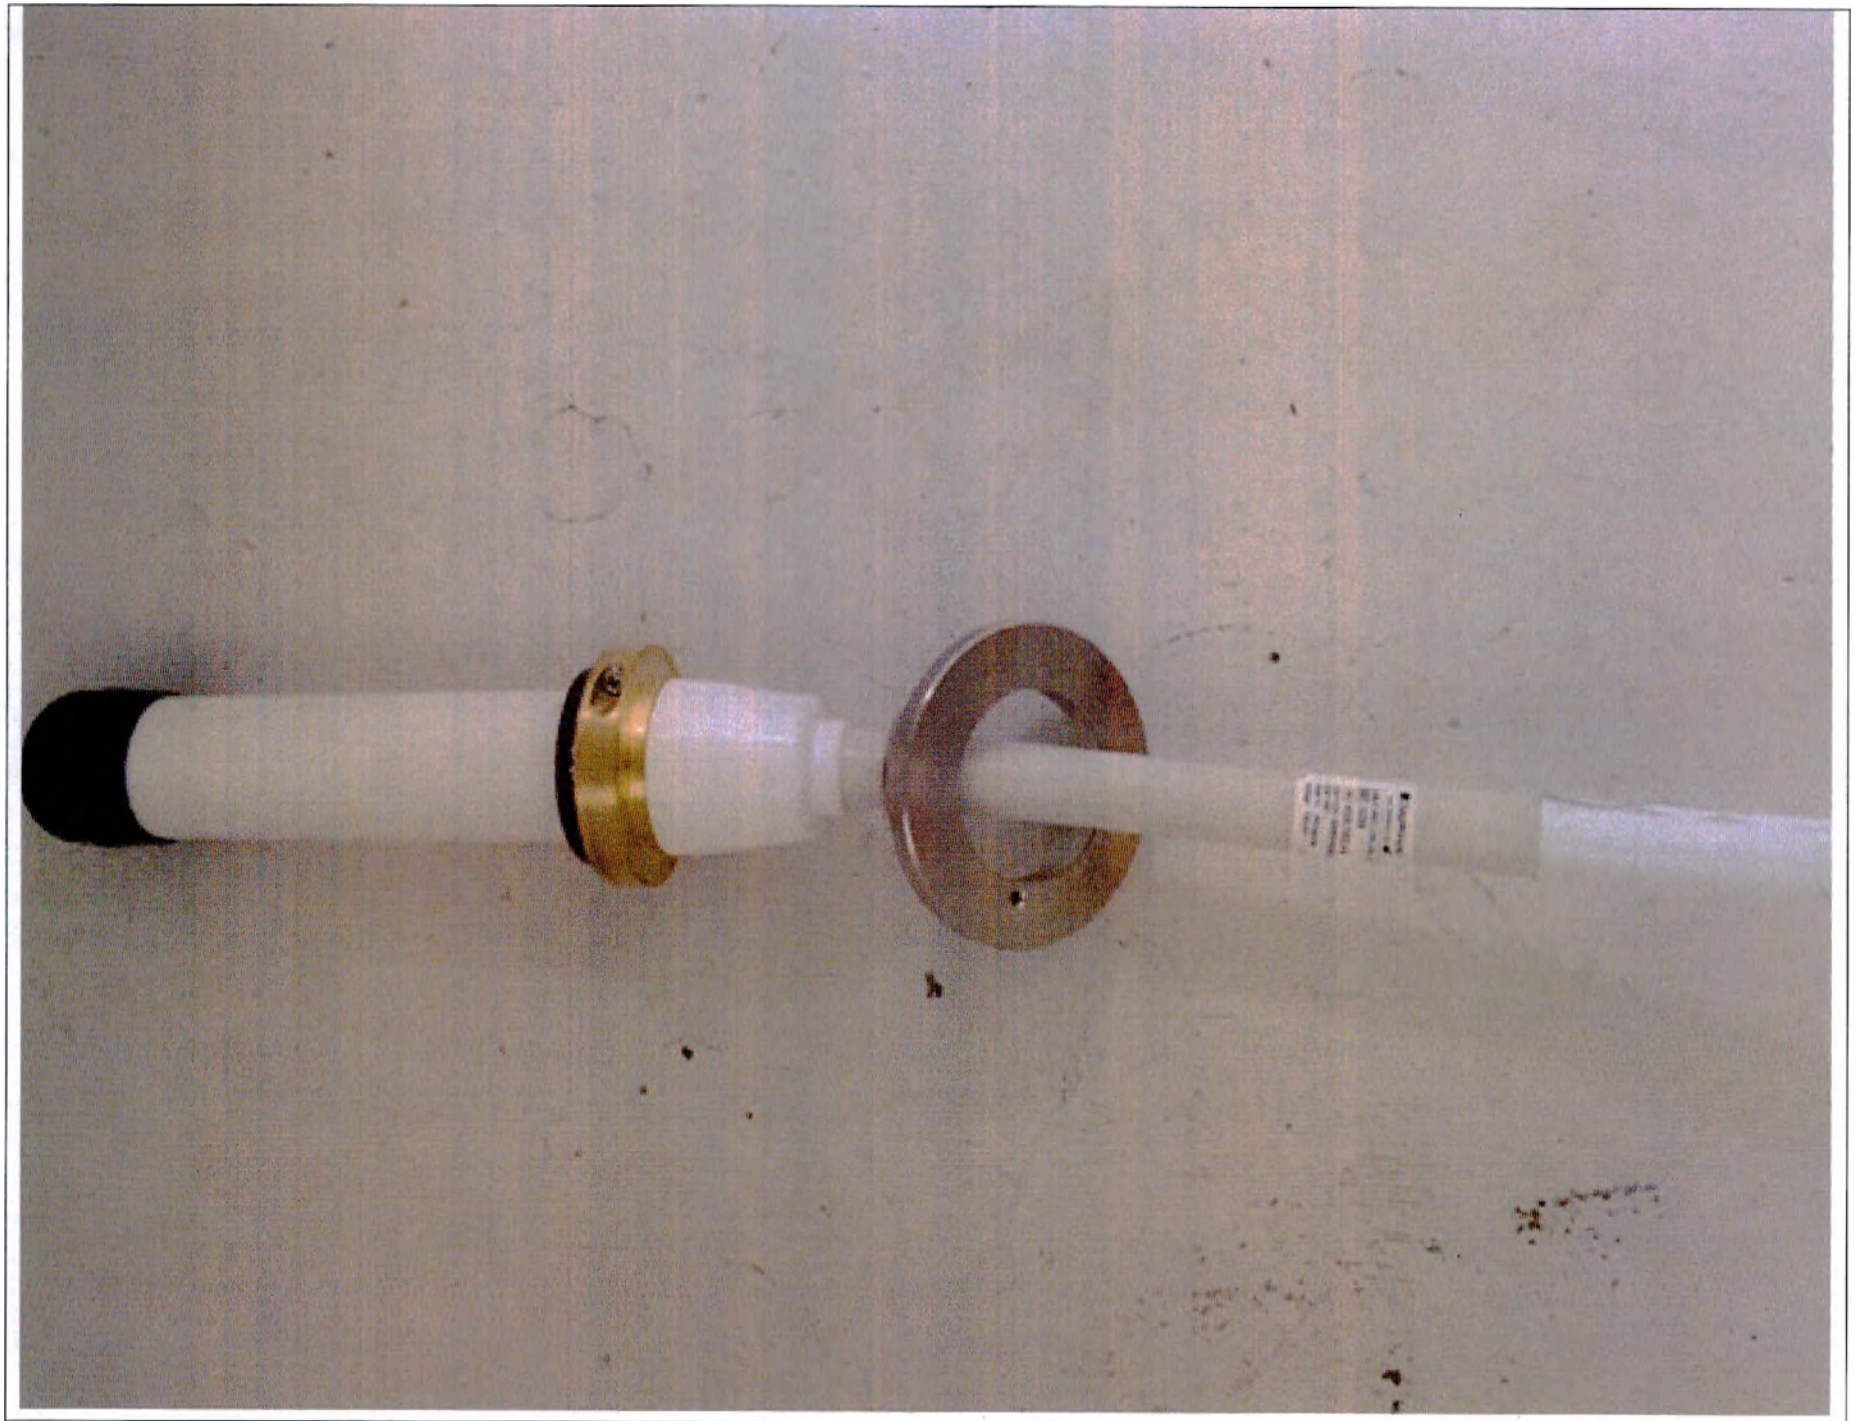

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

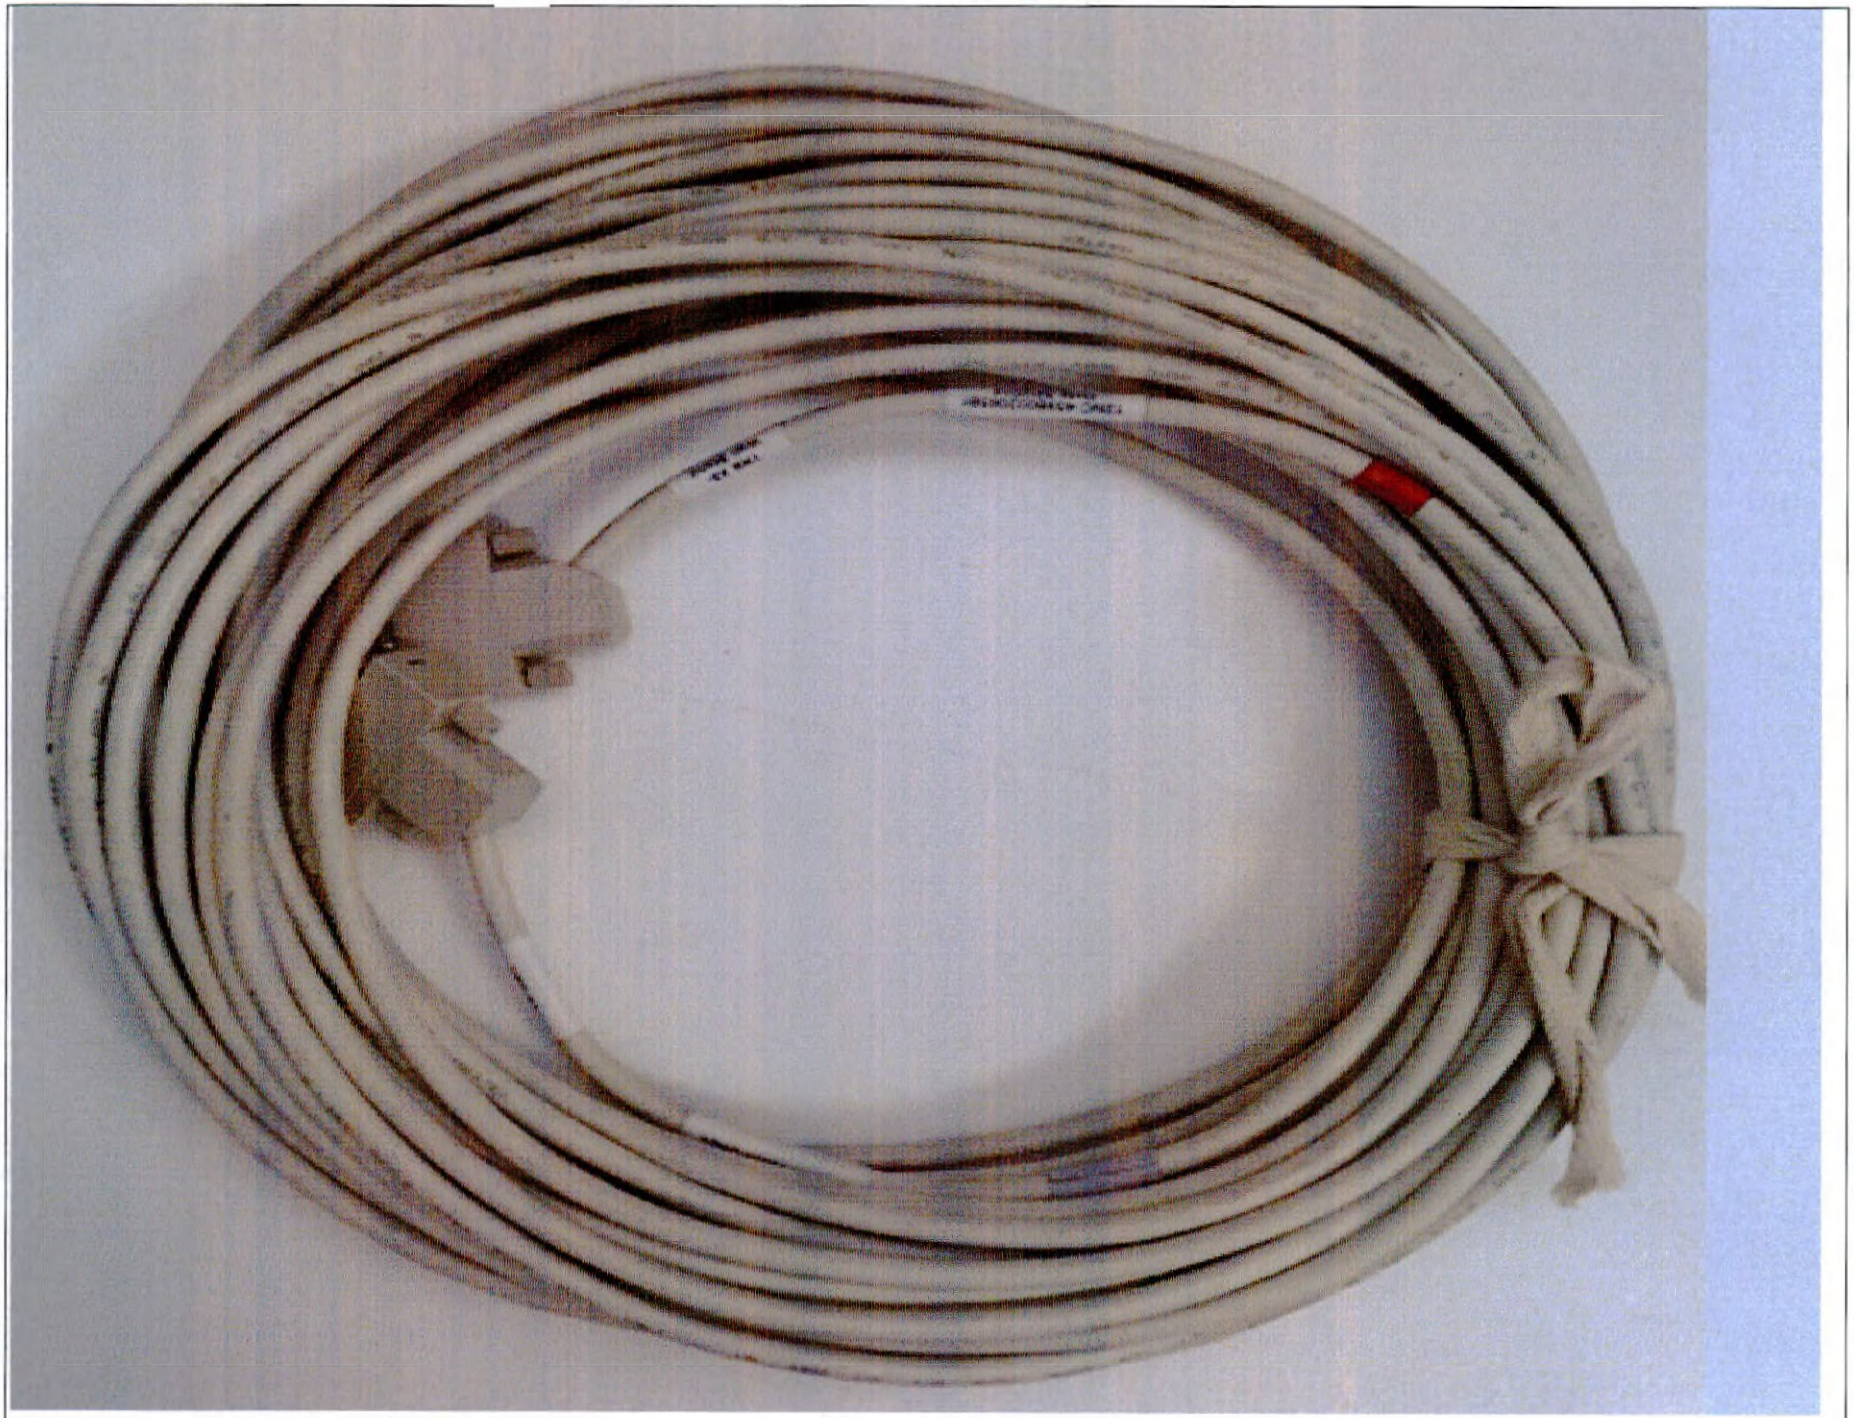

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

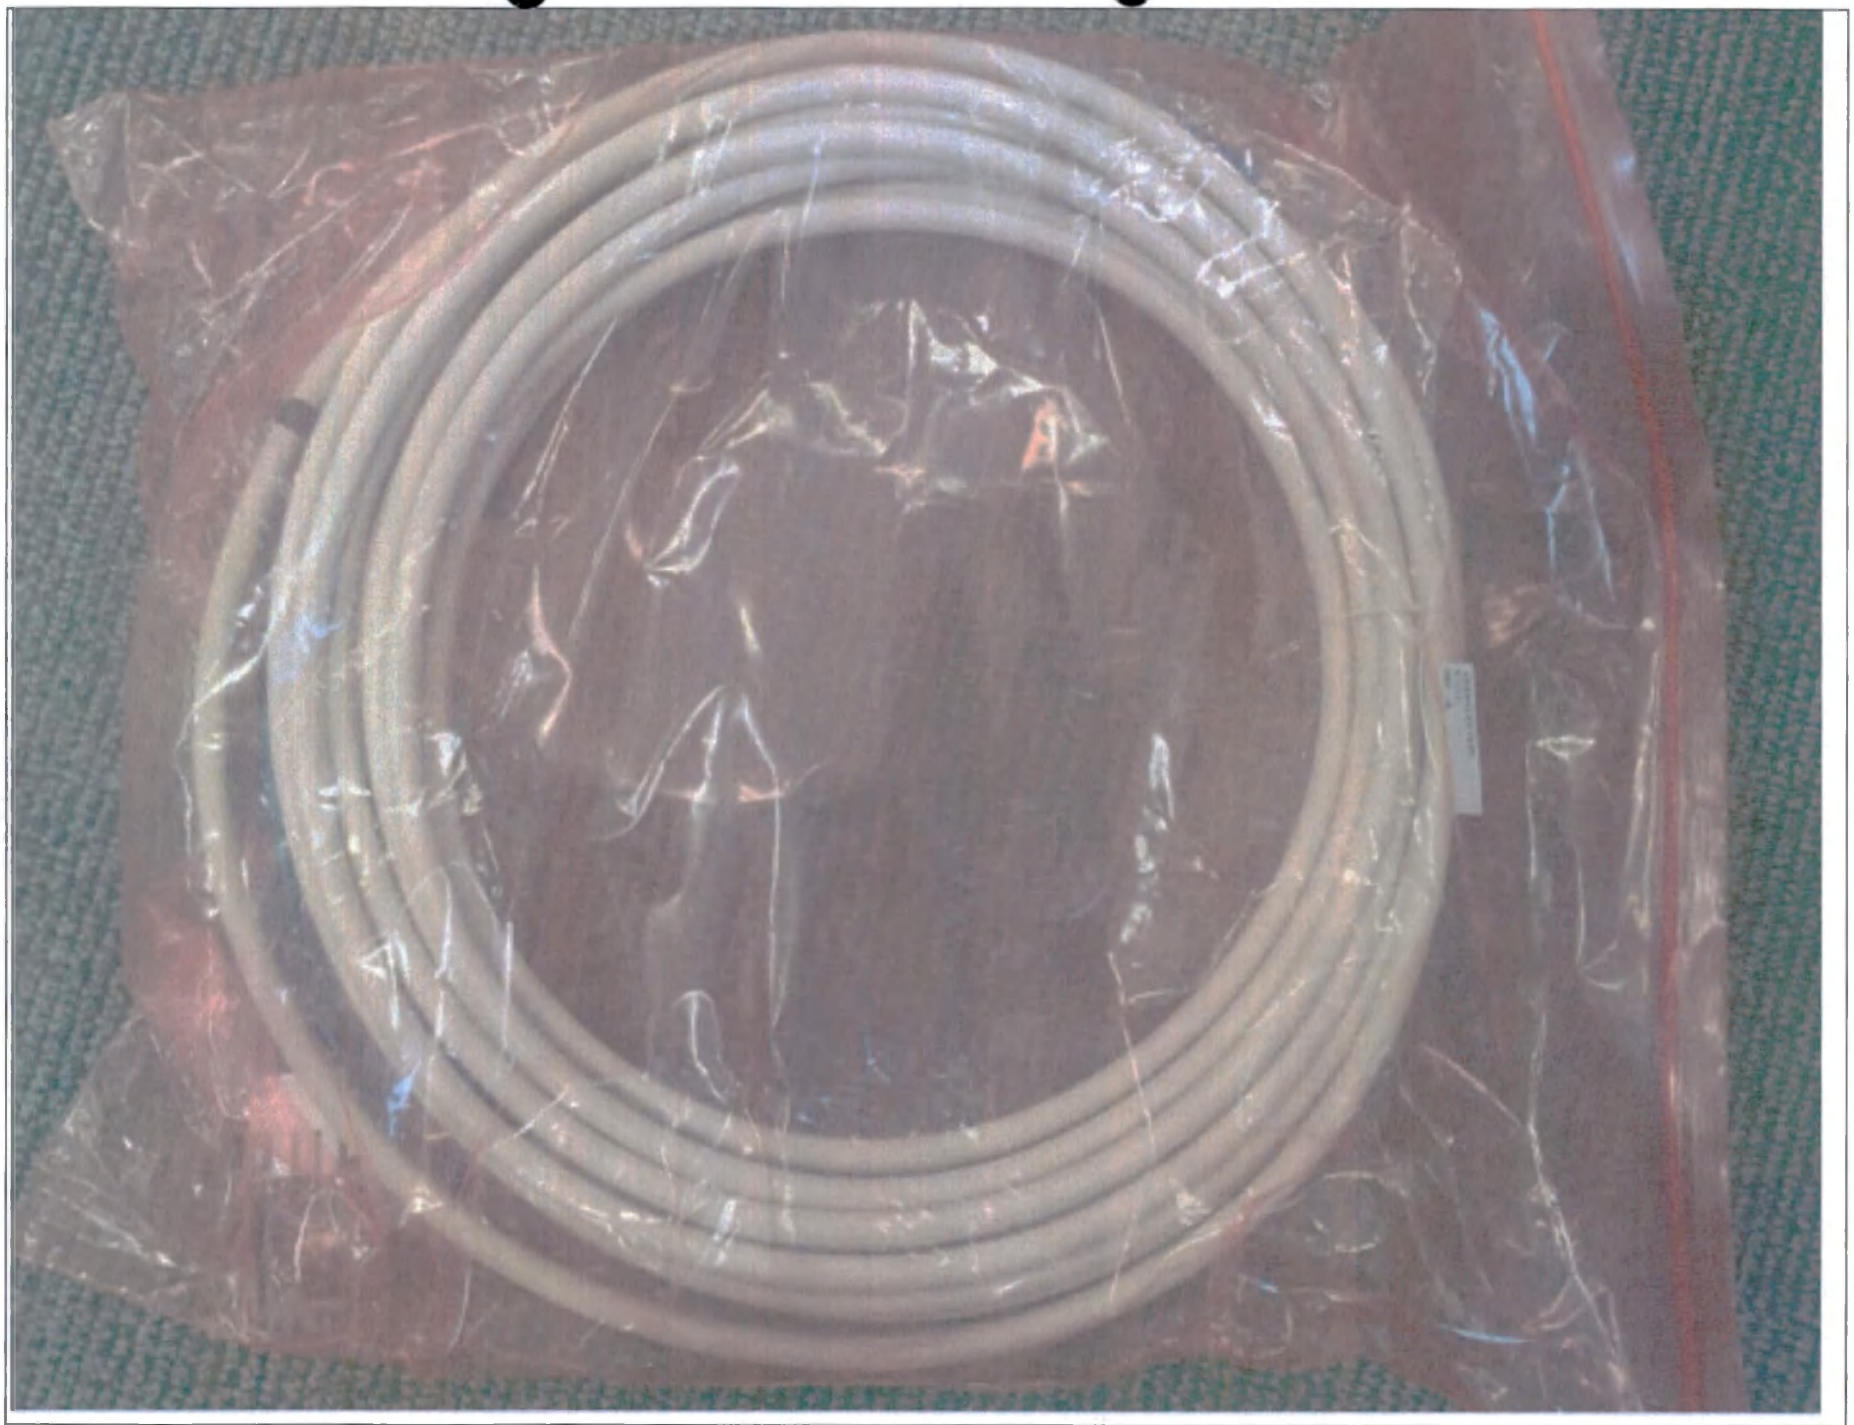

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

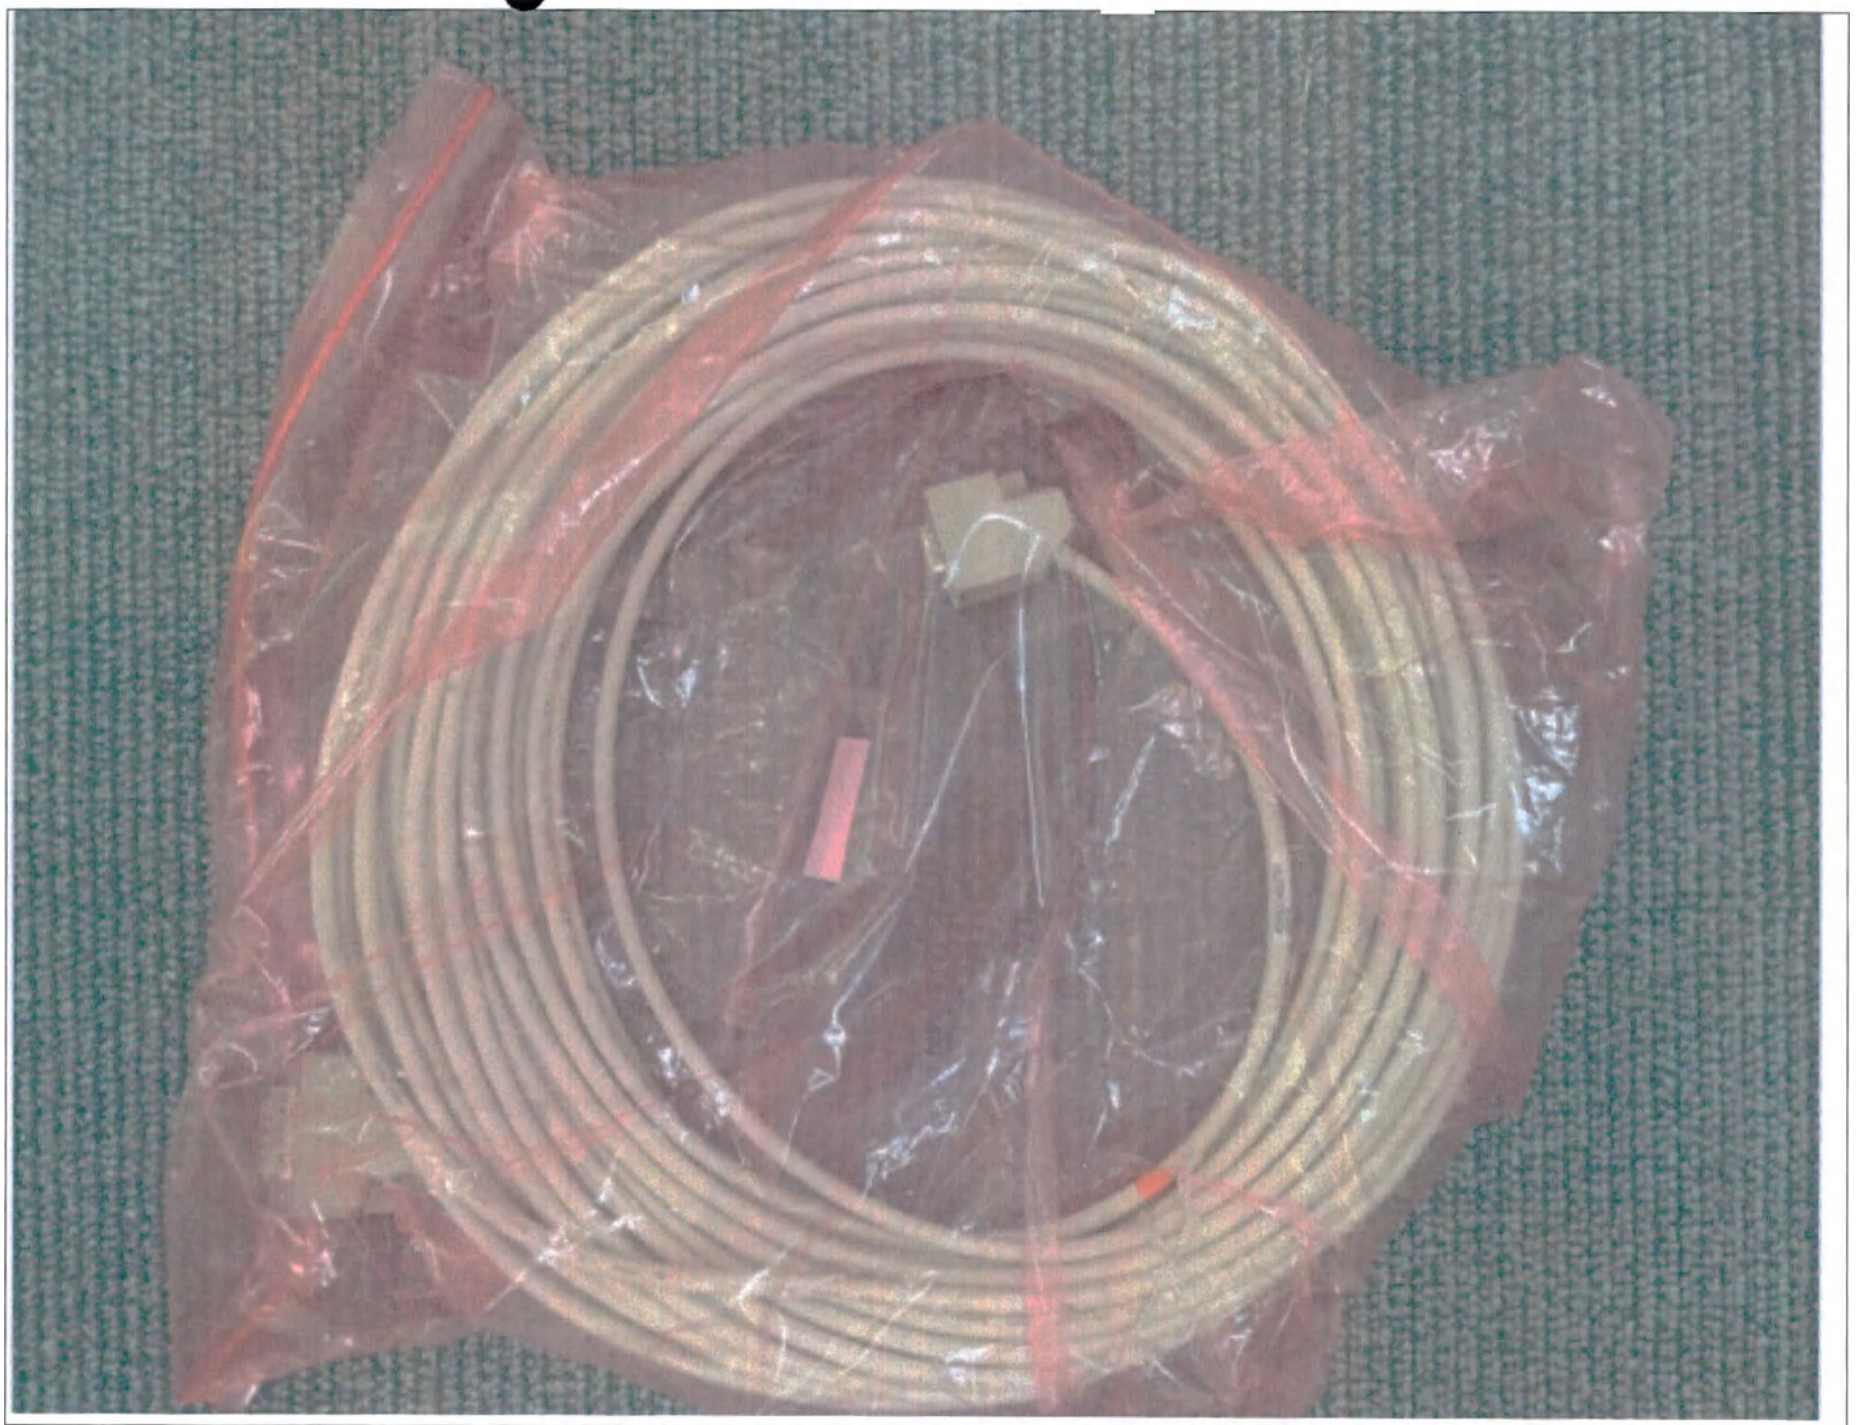

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

34. Кабели соединительные.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

35. Источник бесперебойного питания для системы.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

36. Рубильник включения электропитания.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

37. Устройство переговорное.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

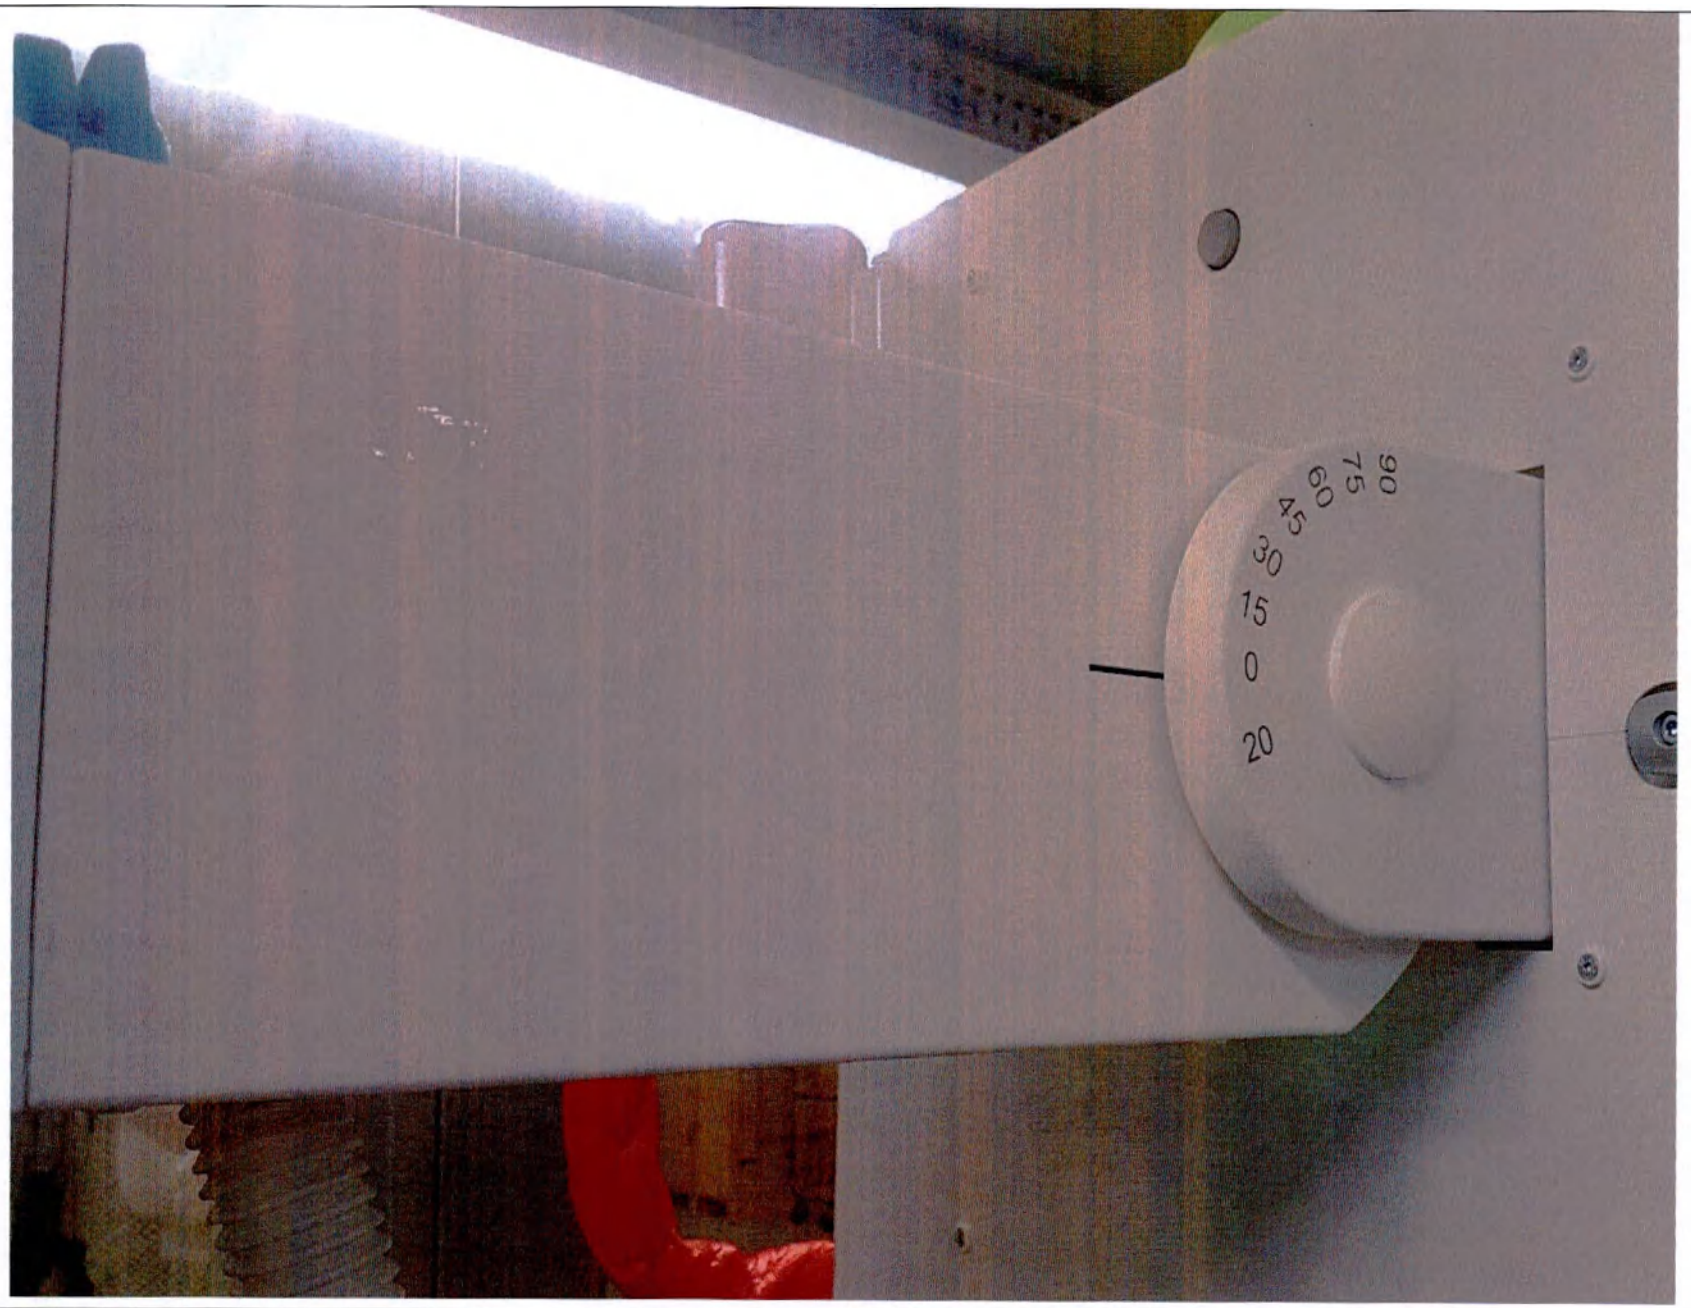

38. Спейсер.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

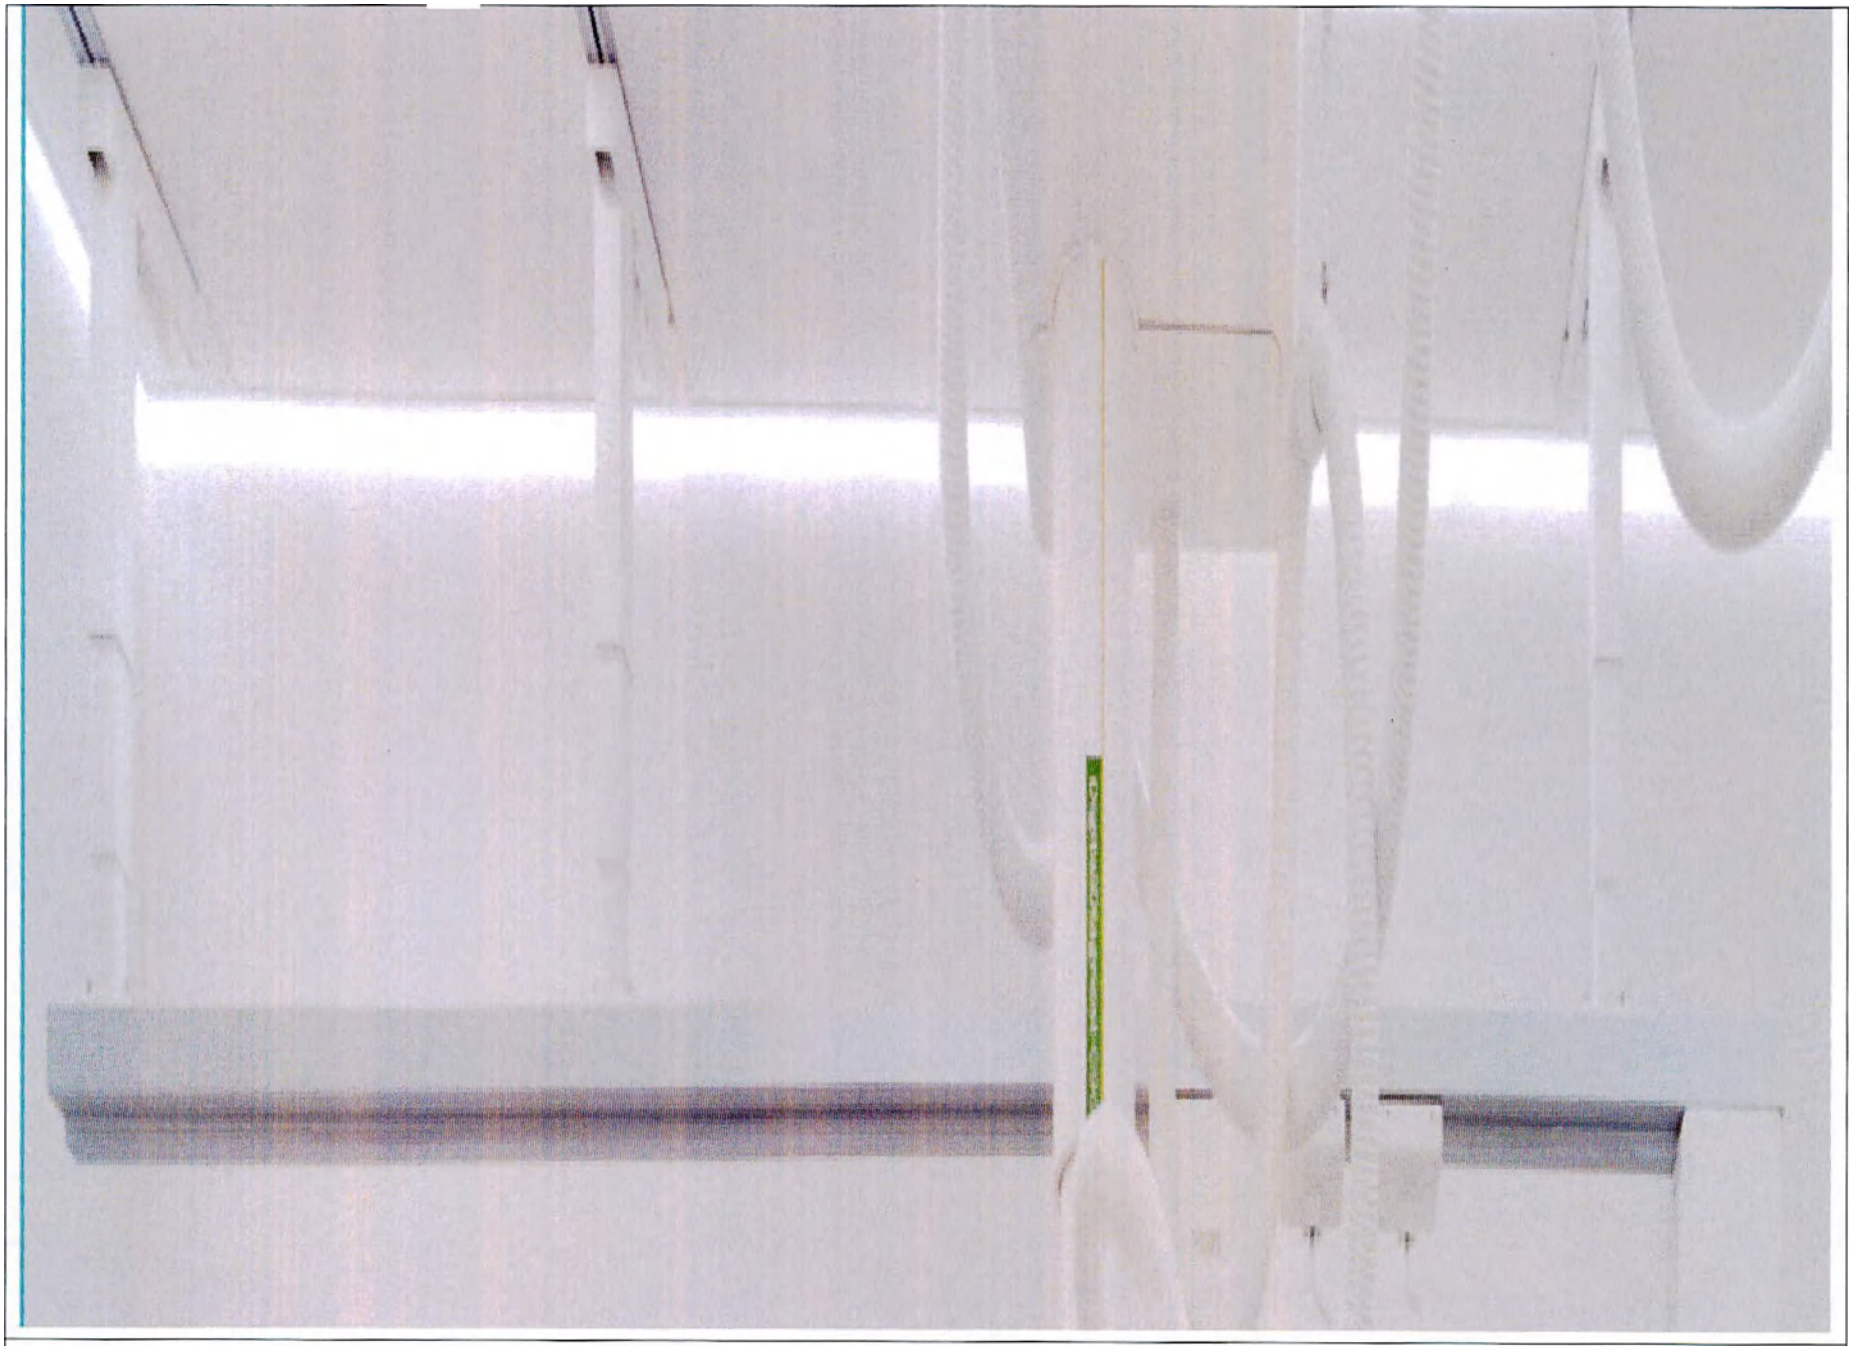

39. Комплект потолочных рельсов стандартный.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

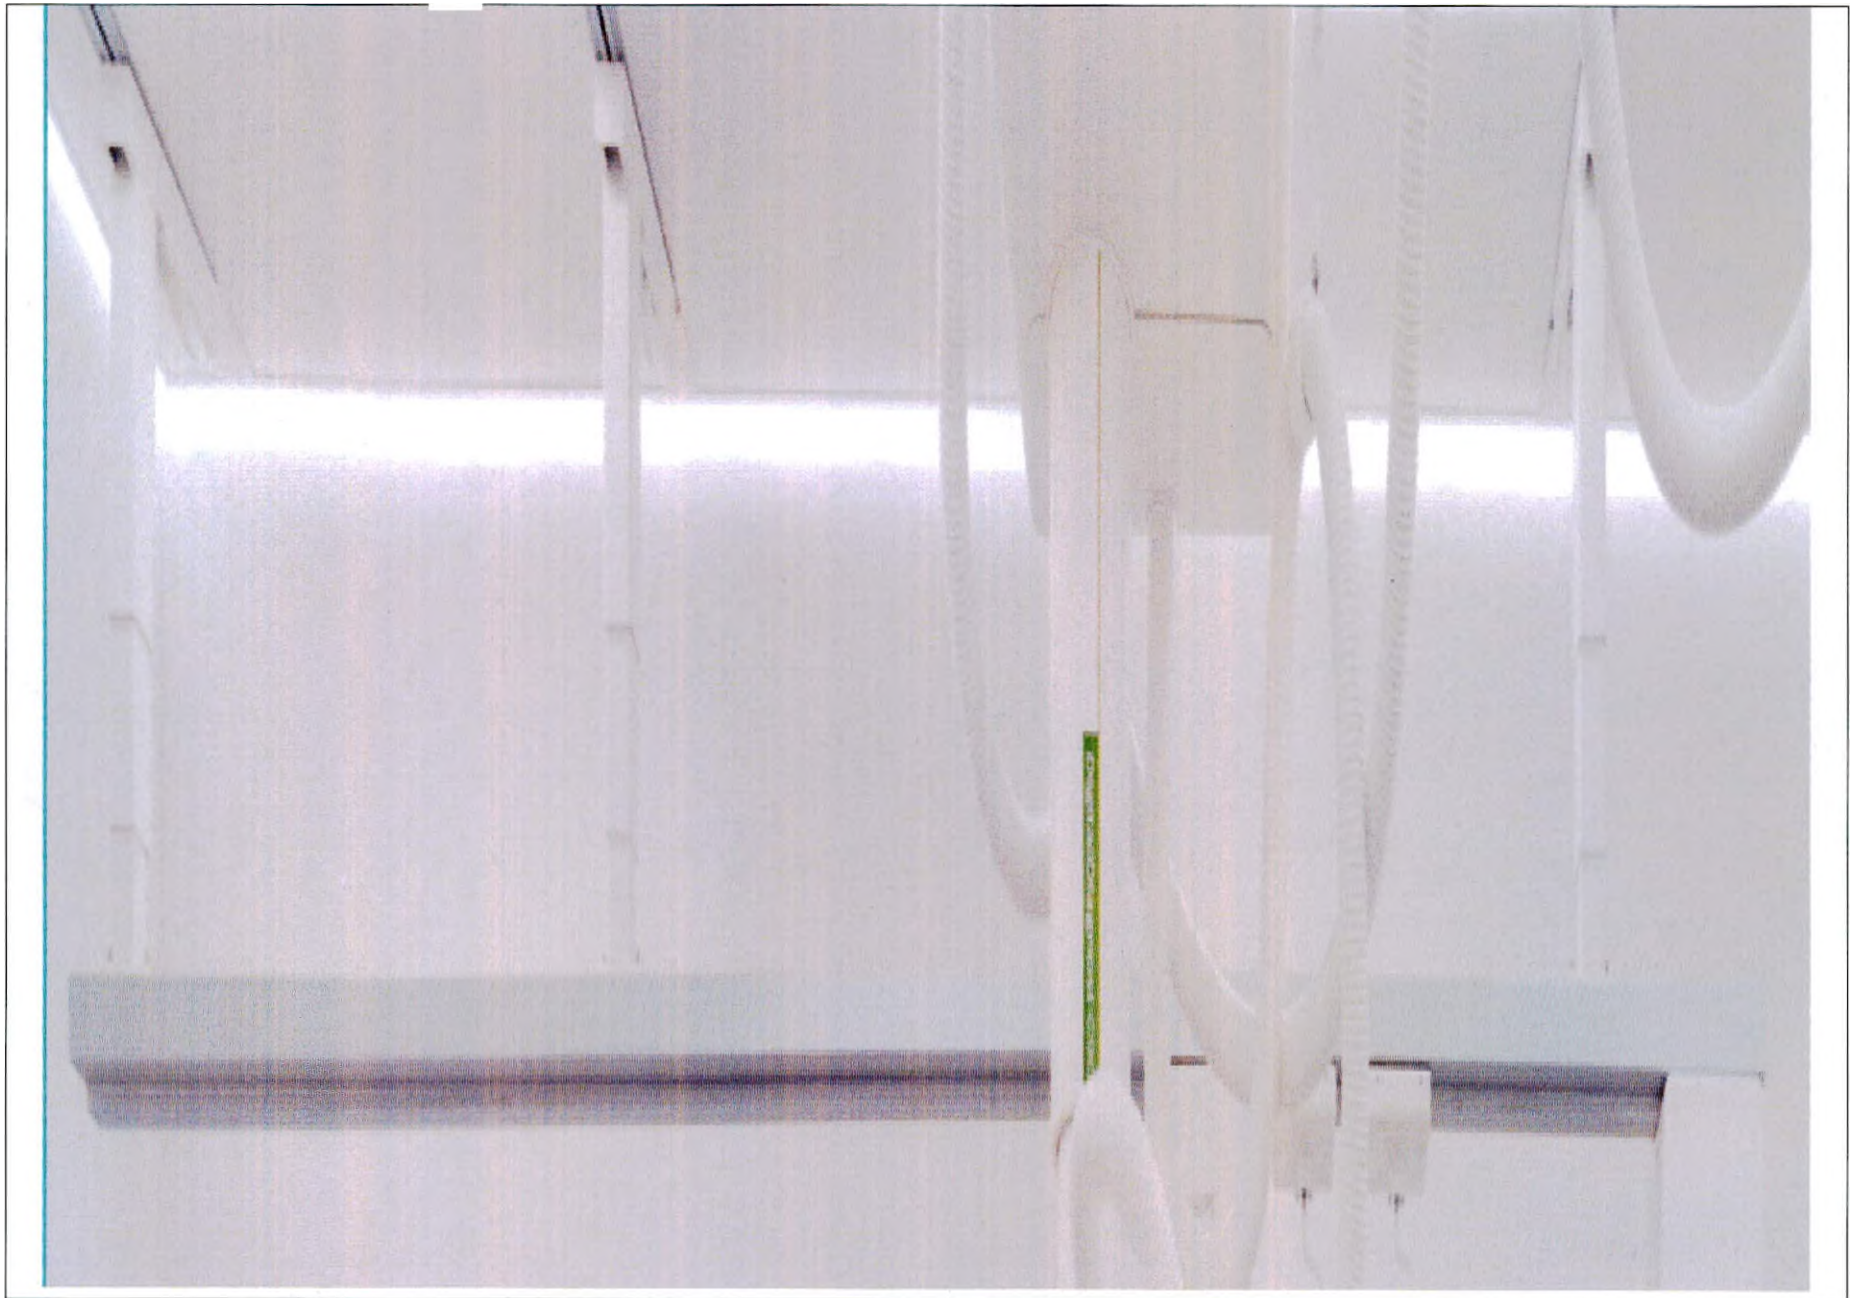

40. Комплект потолочных рельсов удлиненный.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

41. Напольные рельсы.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

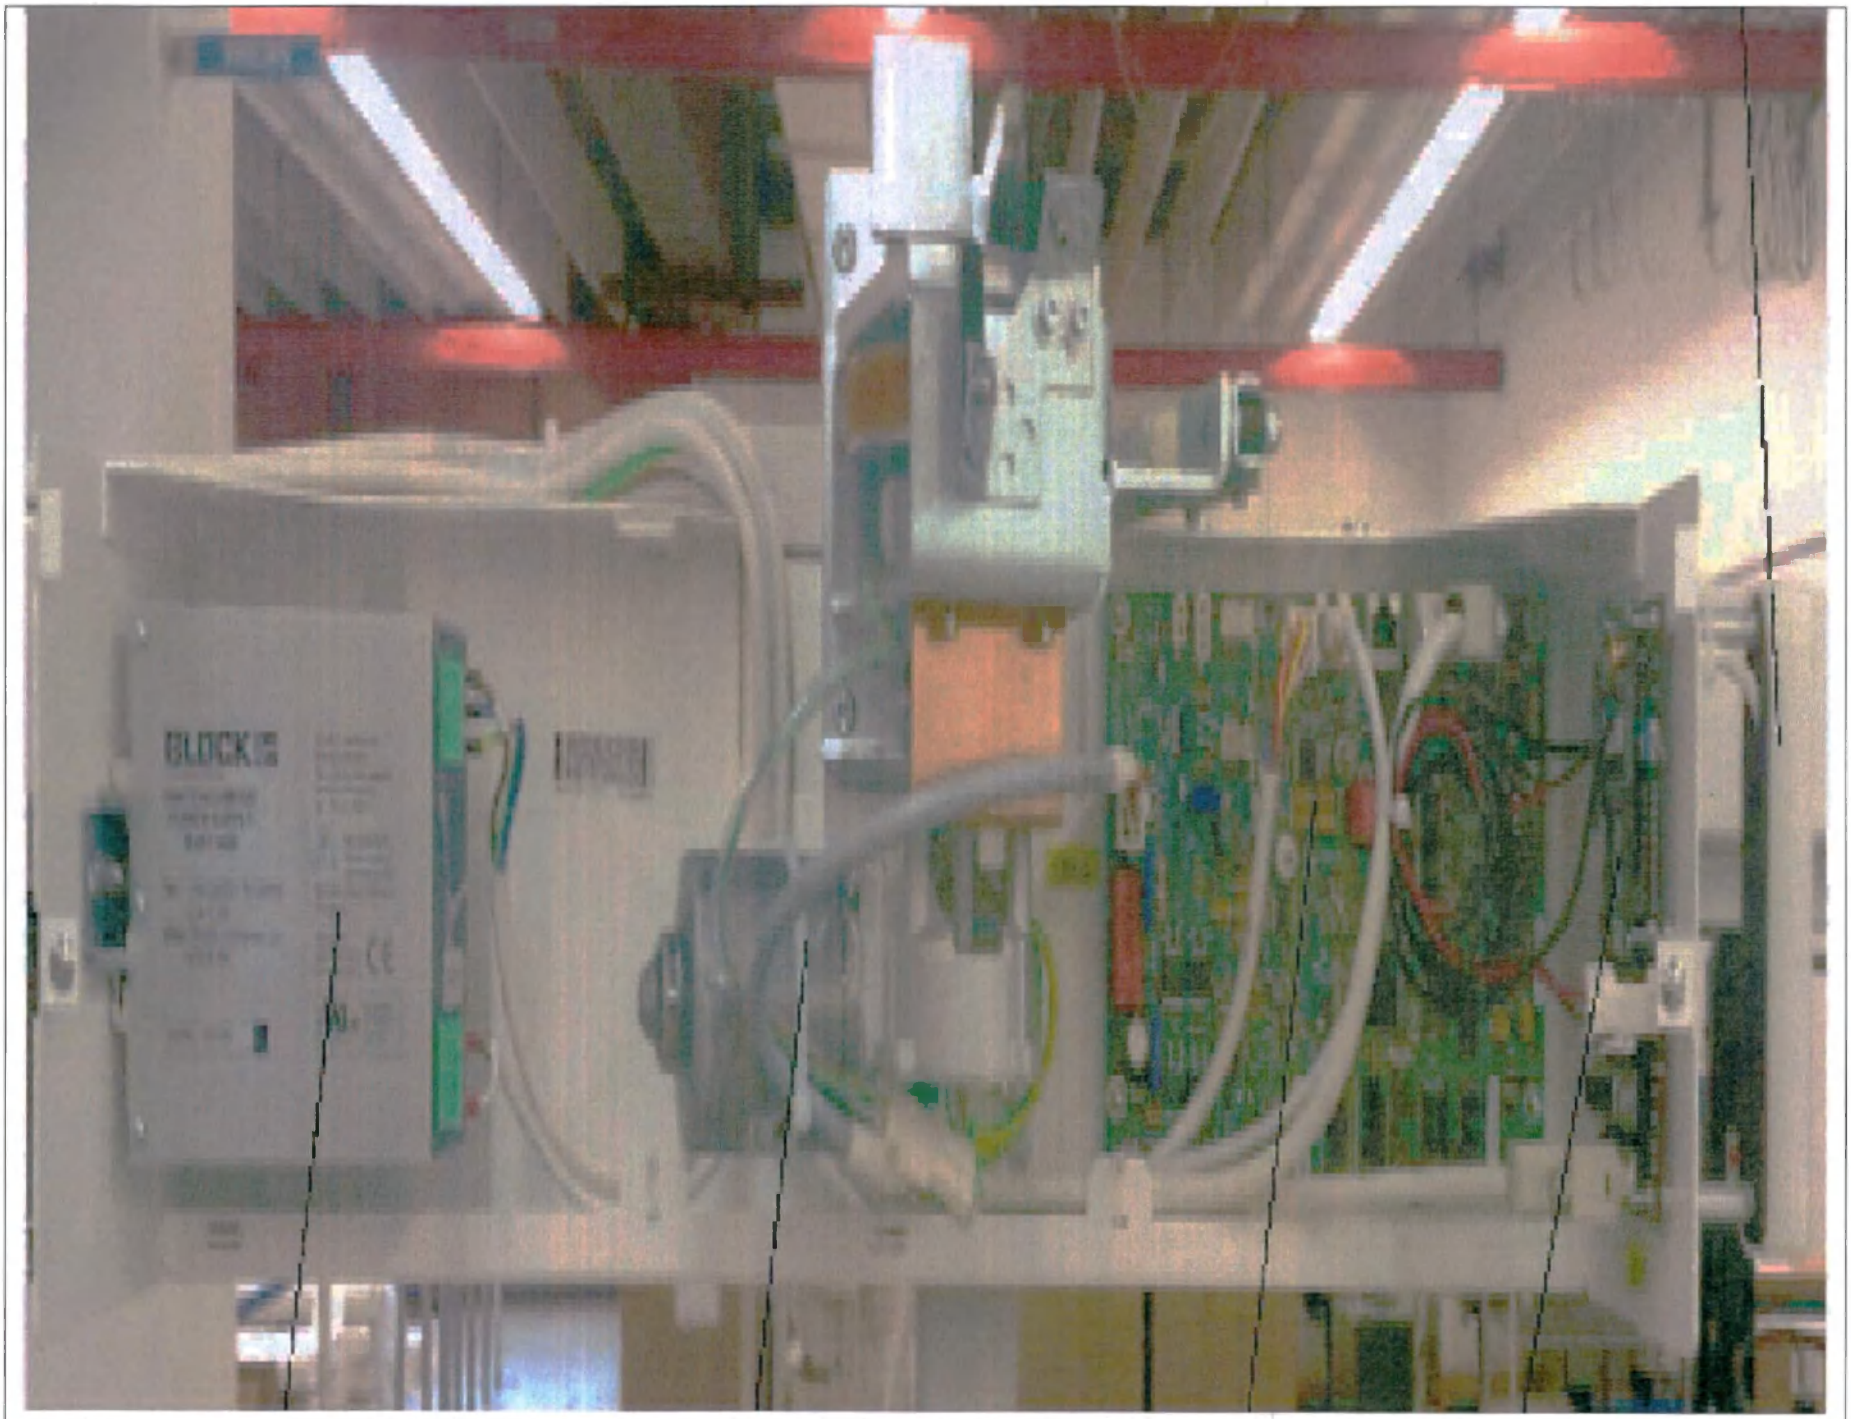

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

2. Электромоторы: 42.1. Моторизация рентгеноскопического стола TH или TH-S.

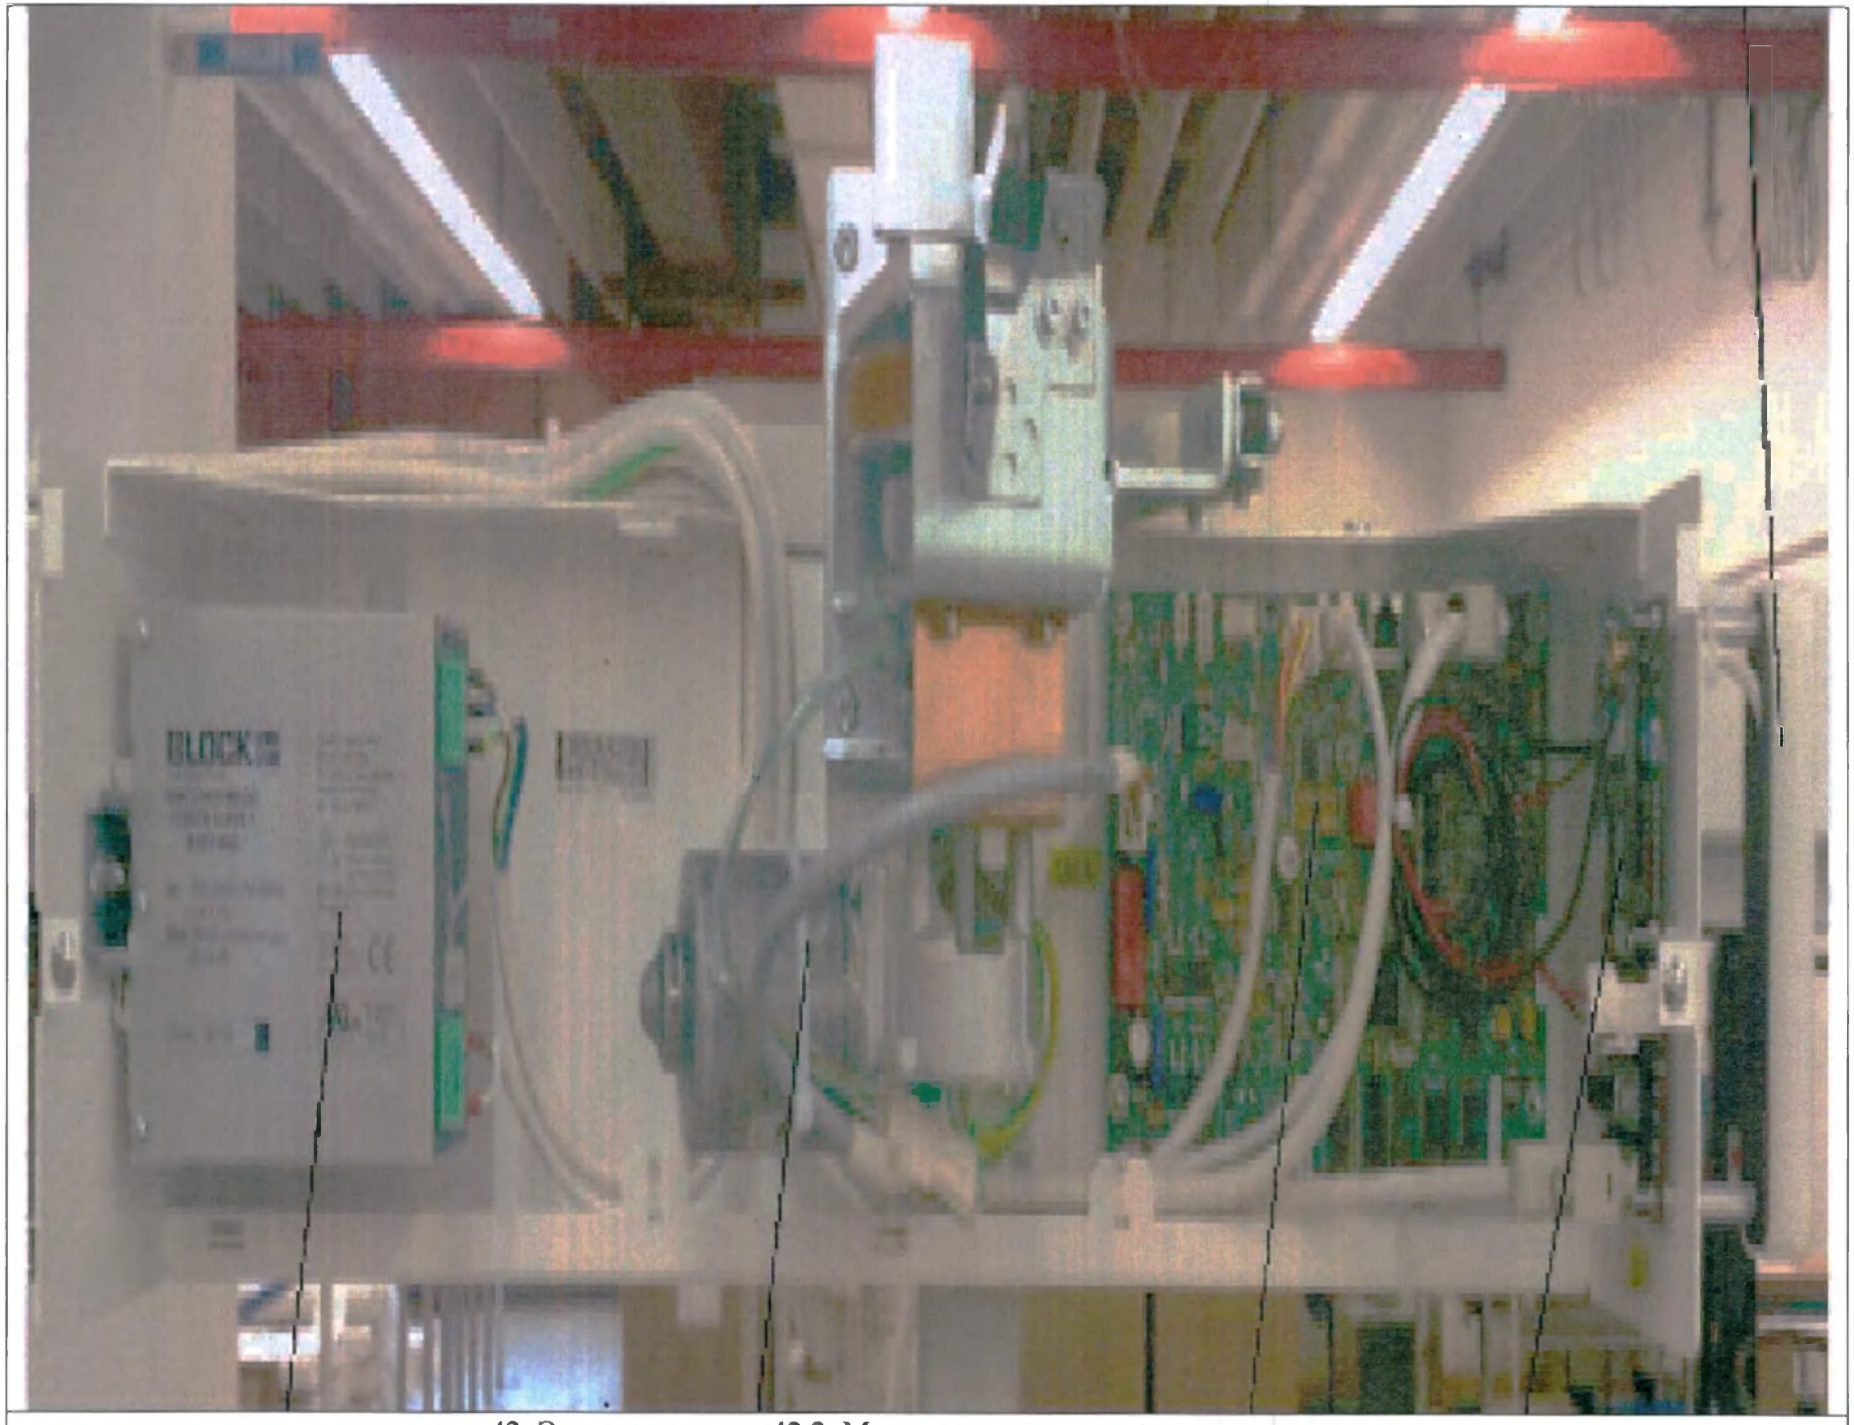

42. Электромоторы: 42.2. Моторизация лотка детектора в столе.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

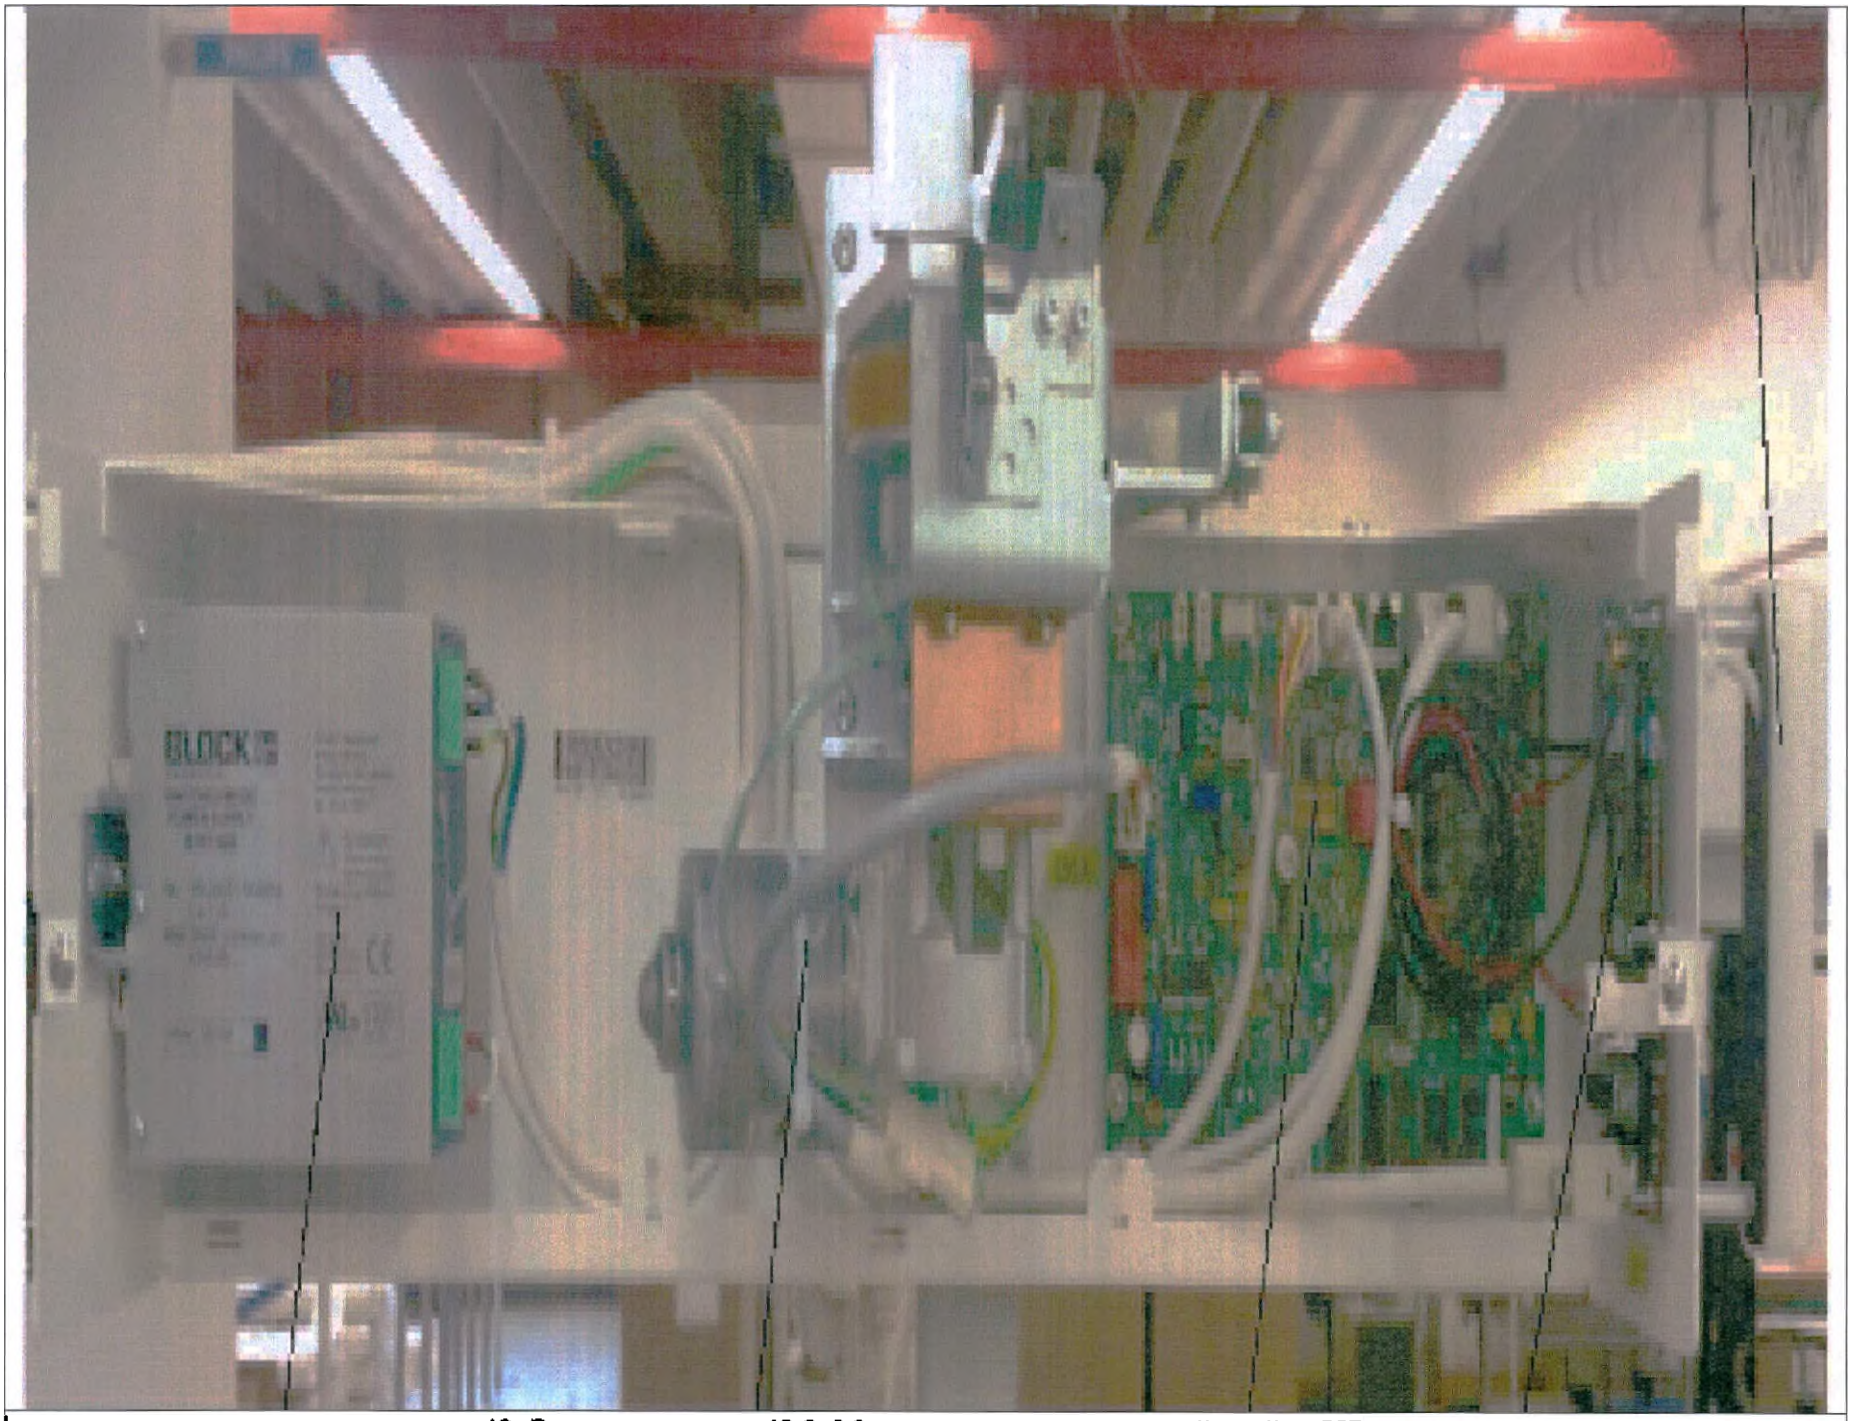

42. Электромоторы: 42.3. Моторизация вертикальной стойки VS.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

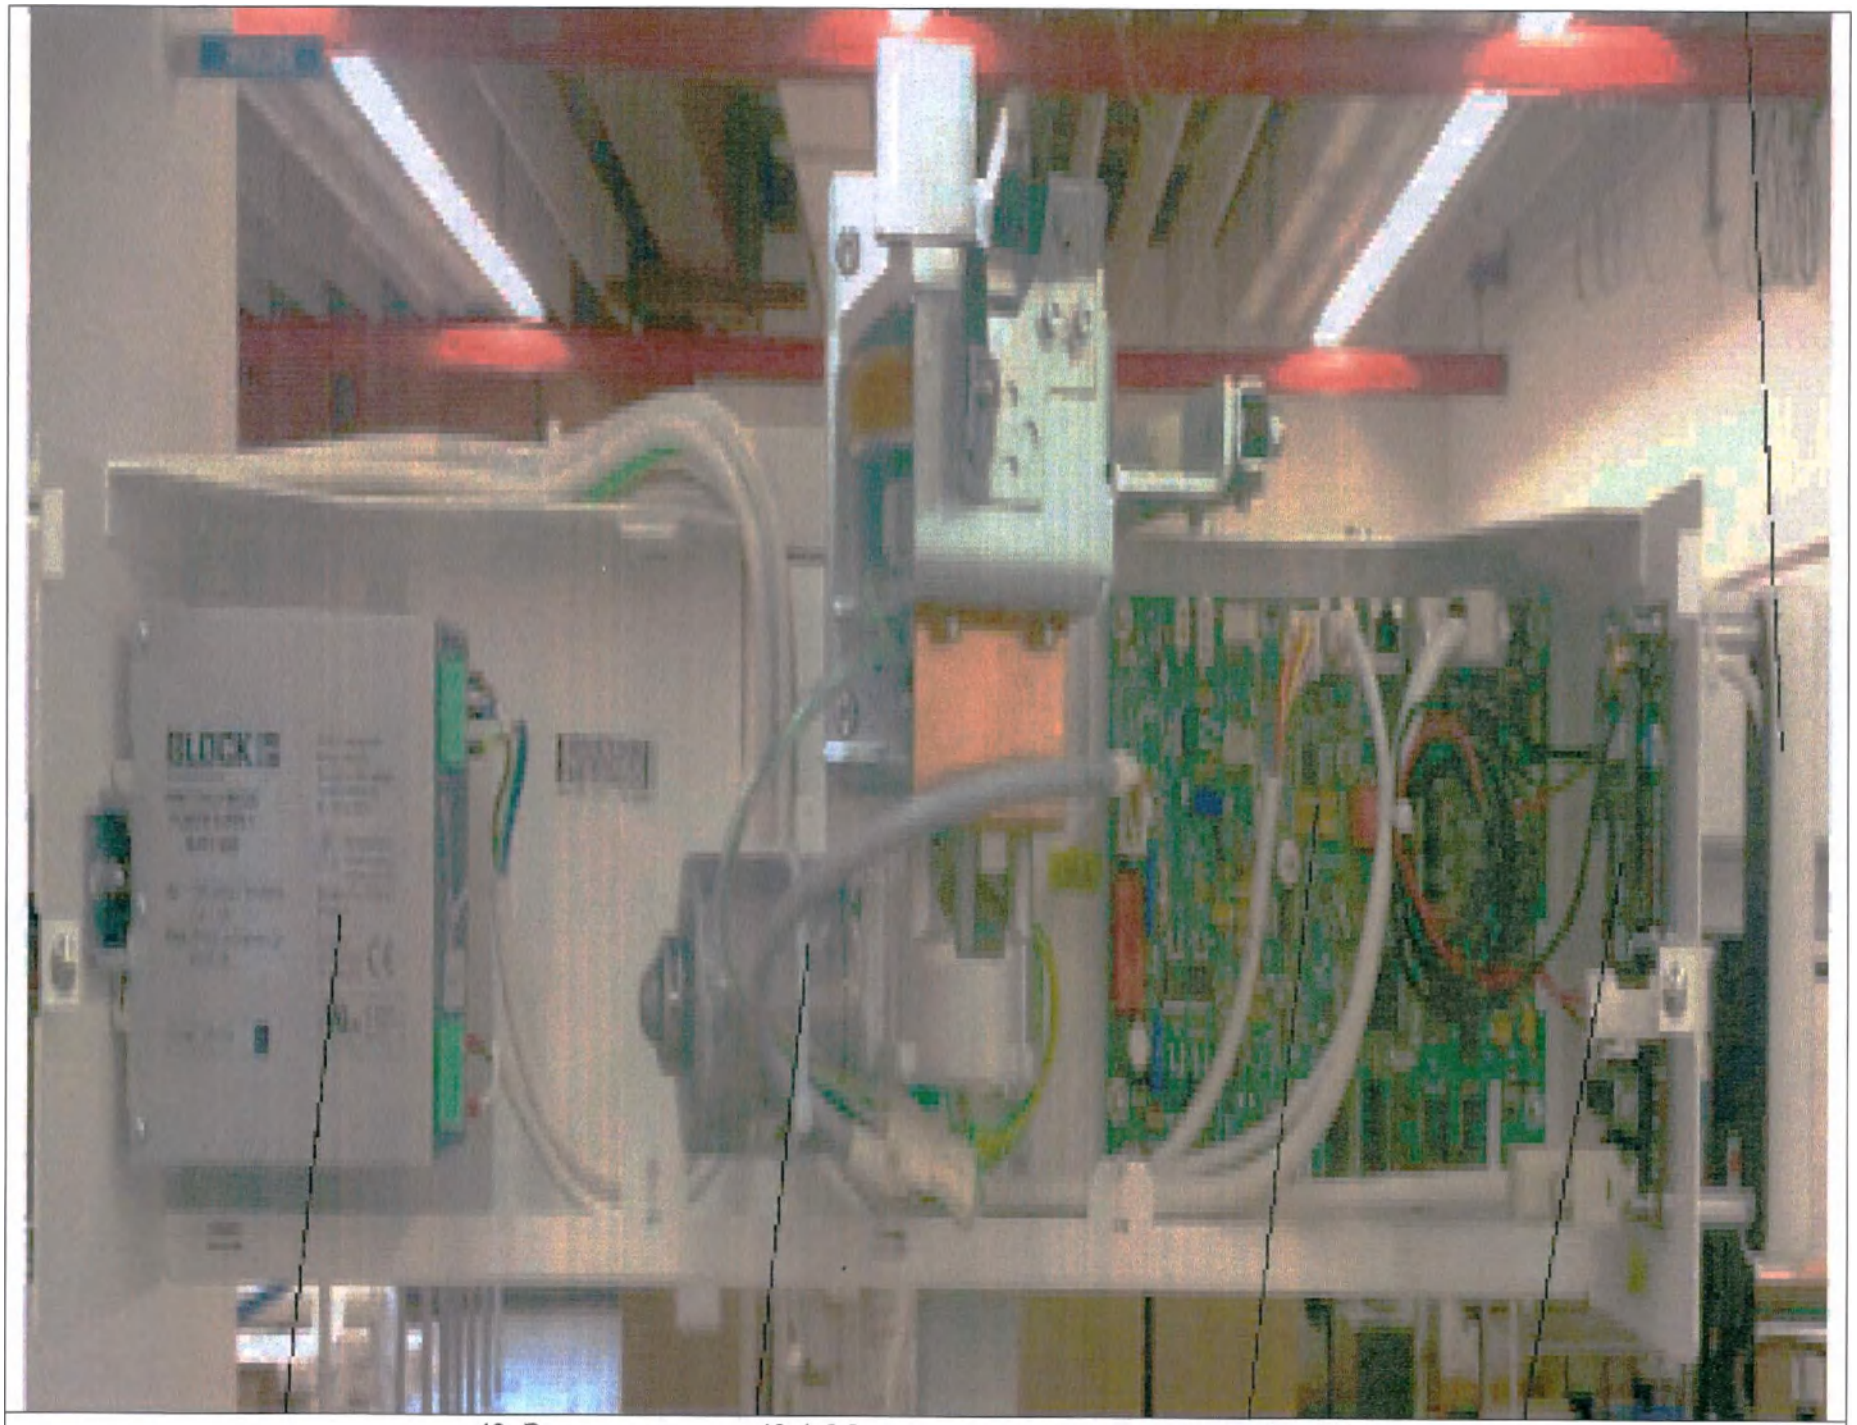

42. Электромоторы: 42.4. Моторизация вертикальной стойки VM.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

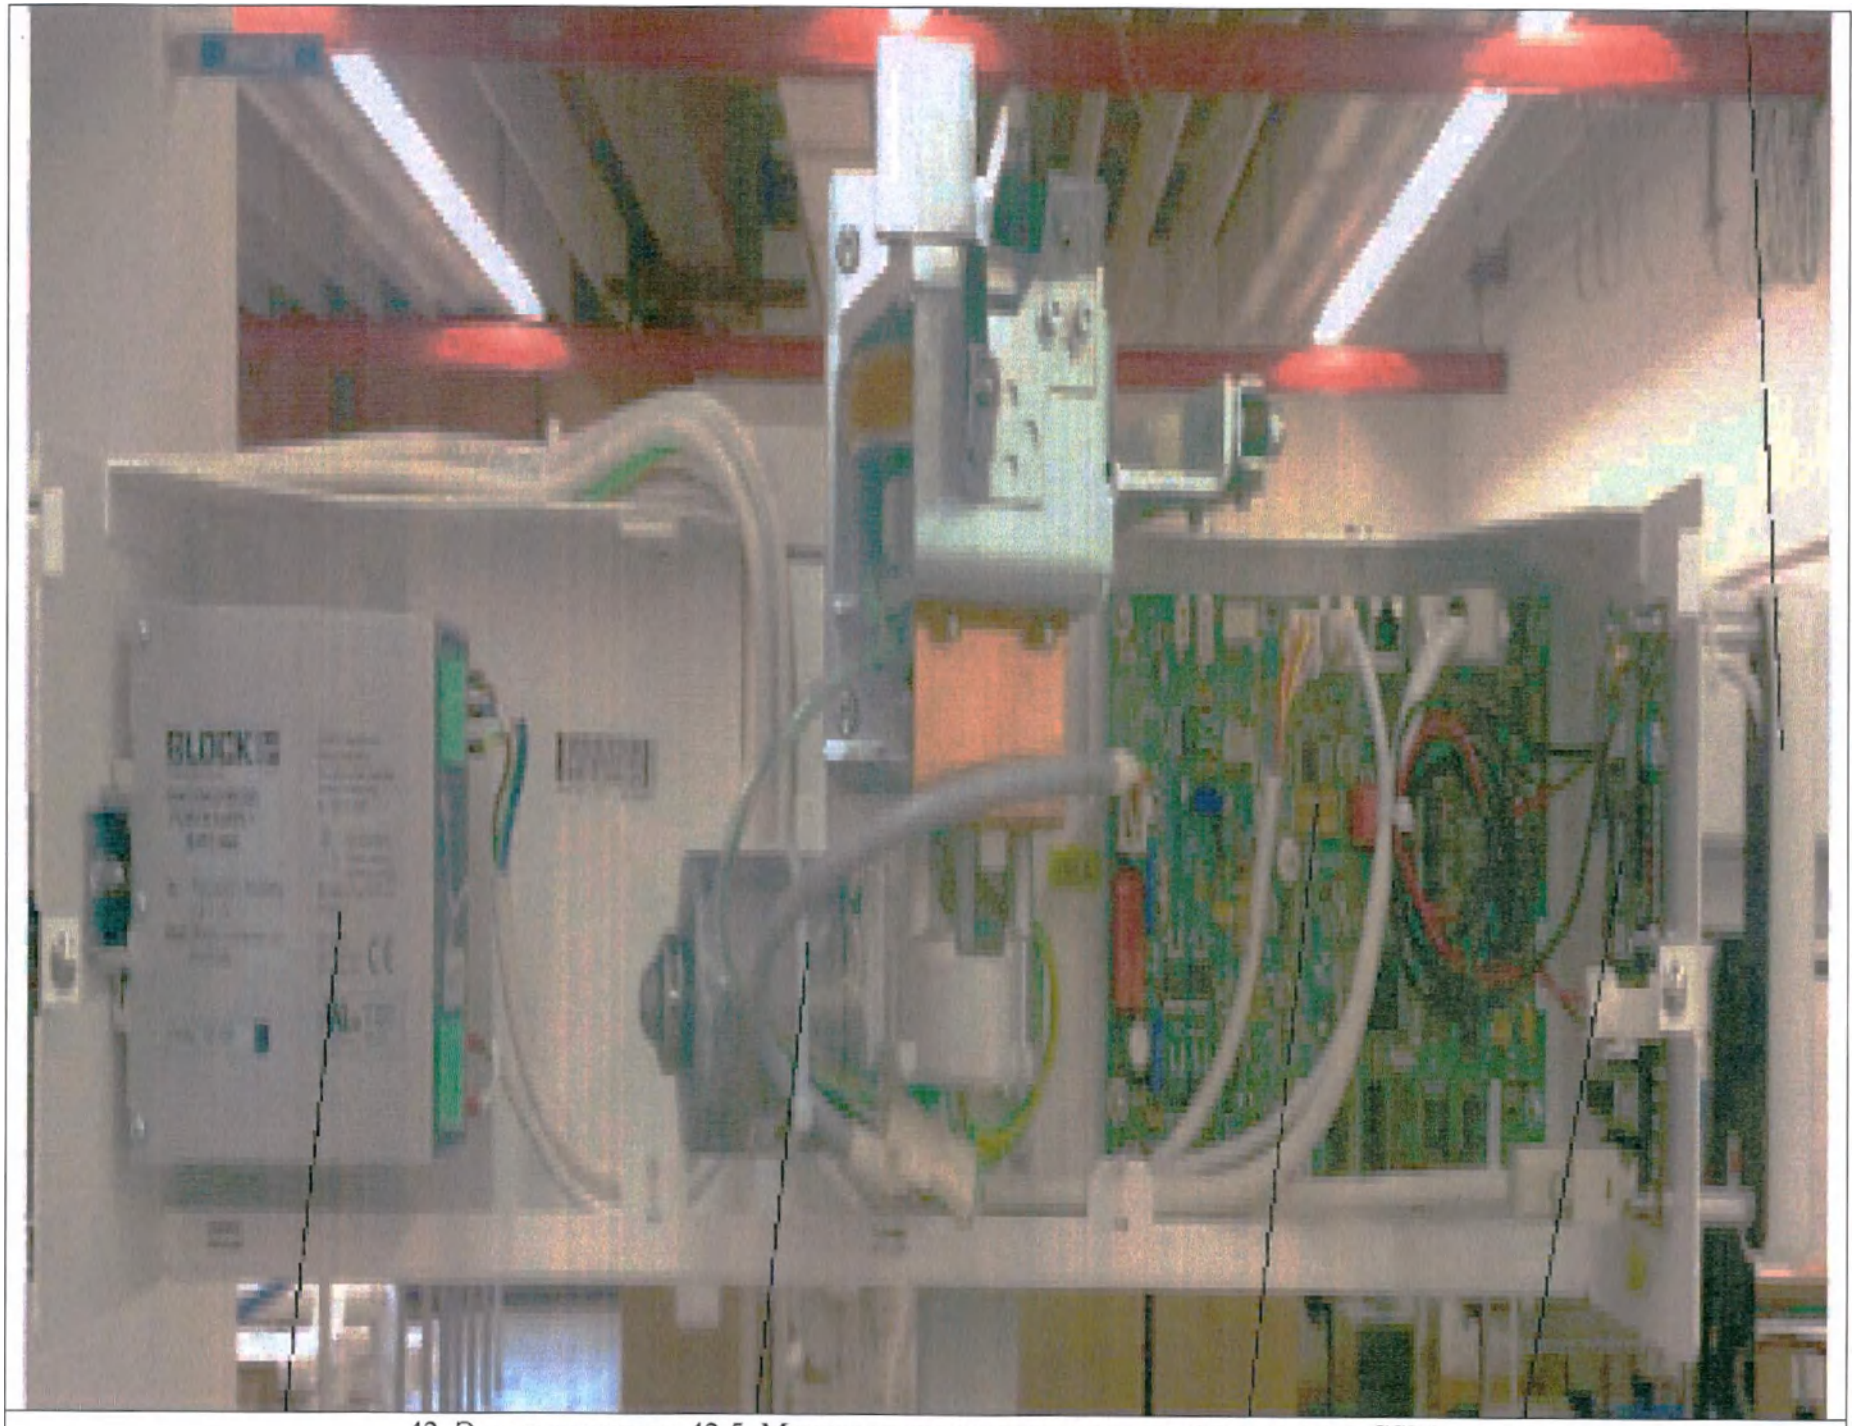

42. Электромоторы: 42.5. Моторизация штатива потолочного подвеса CSM.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

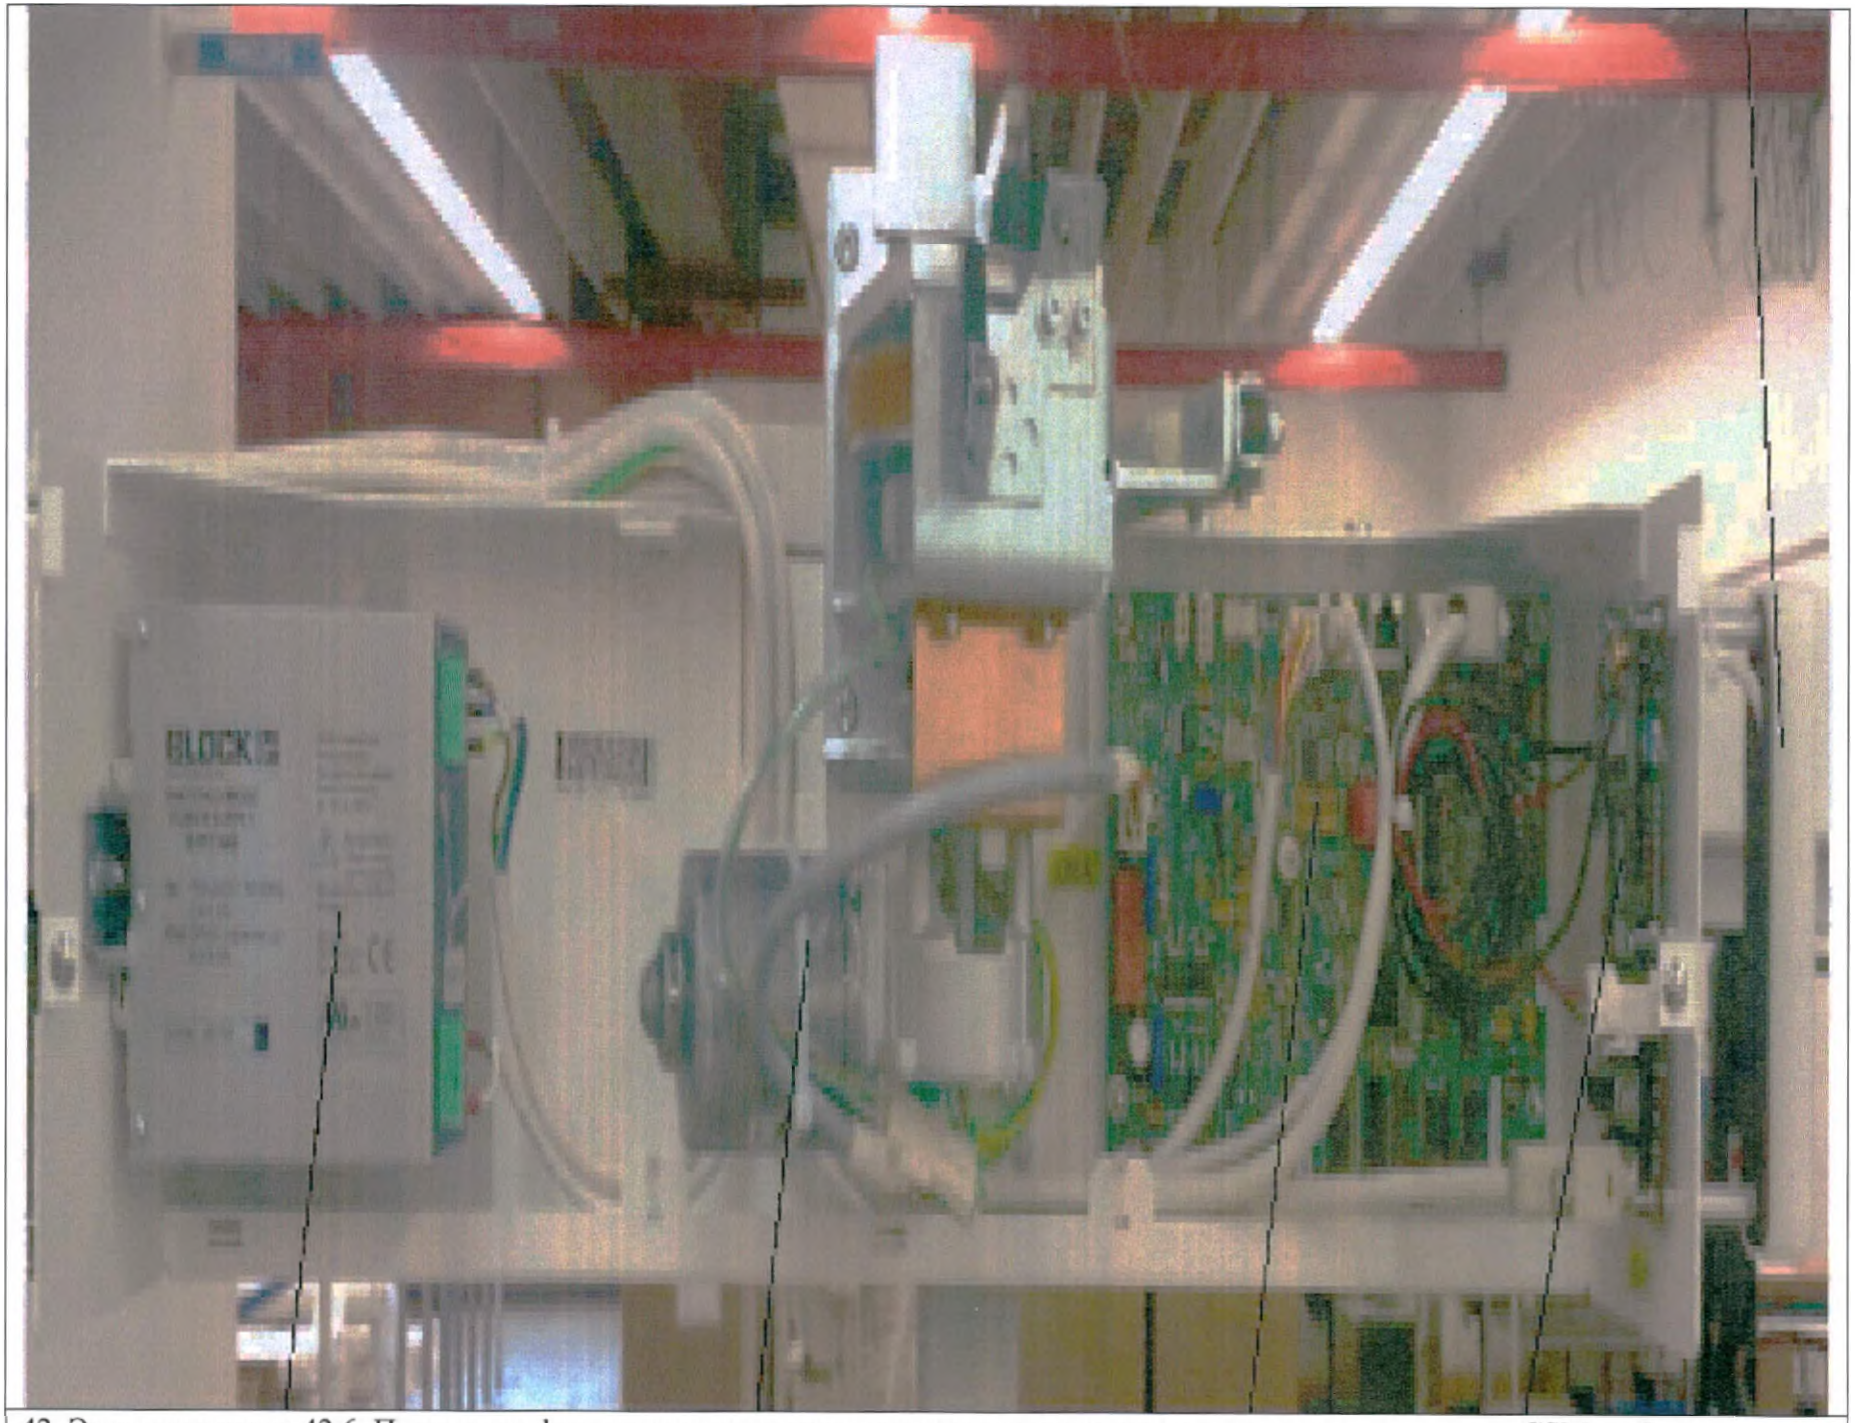

42. Электромоторы 42.6. Полностью функциональное моторизированное перемещение потолочного подвеса CSM по 5 осям.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

43. Точка доступа.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

44. Камера прямой трансляции.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Упаковка:

Пример транспортной упаковки (вариант 1).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пример транспортной упаковки (вариант 2).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пример транспортной упаковки (вариант 3).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

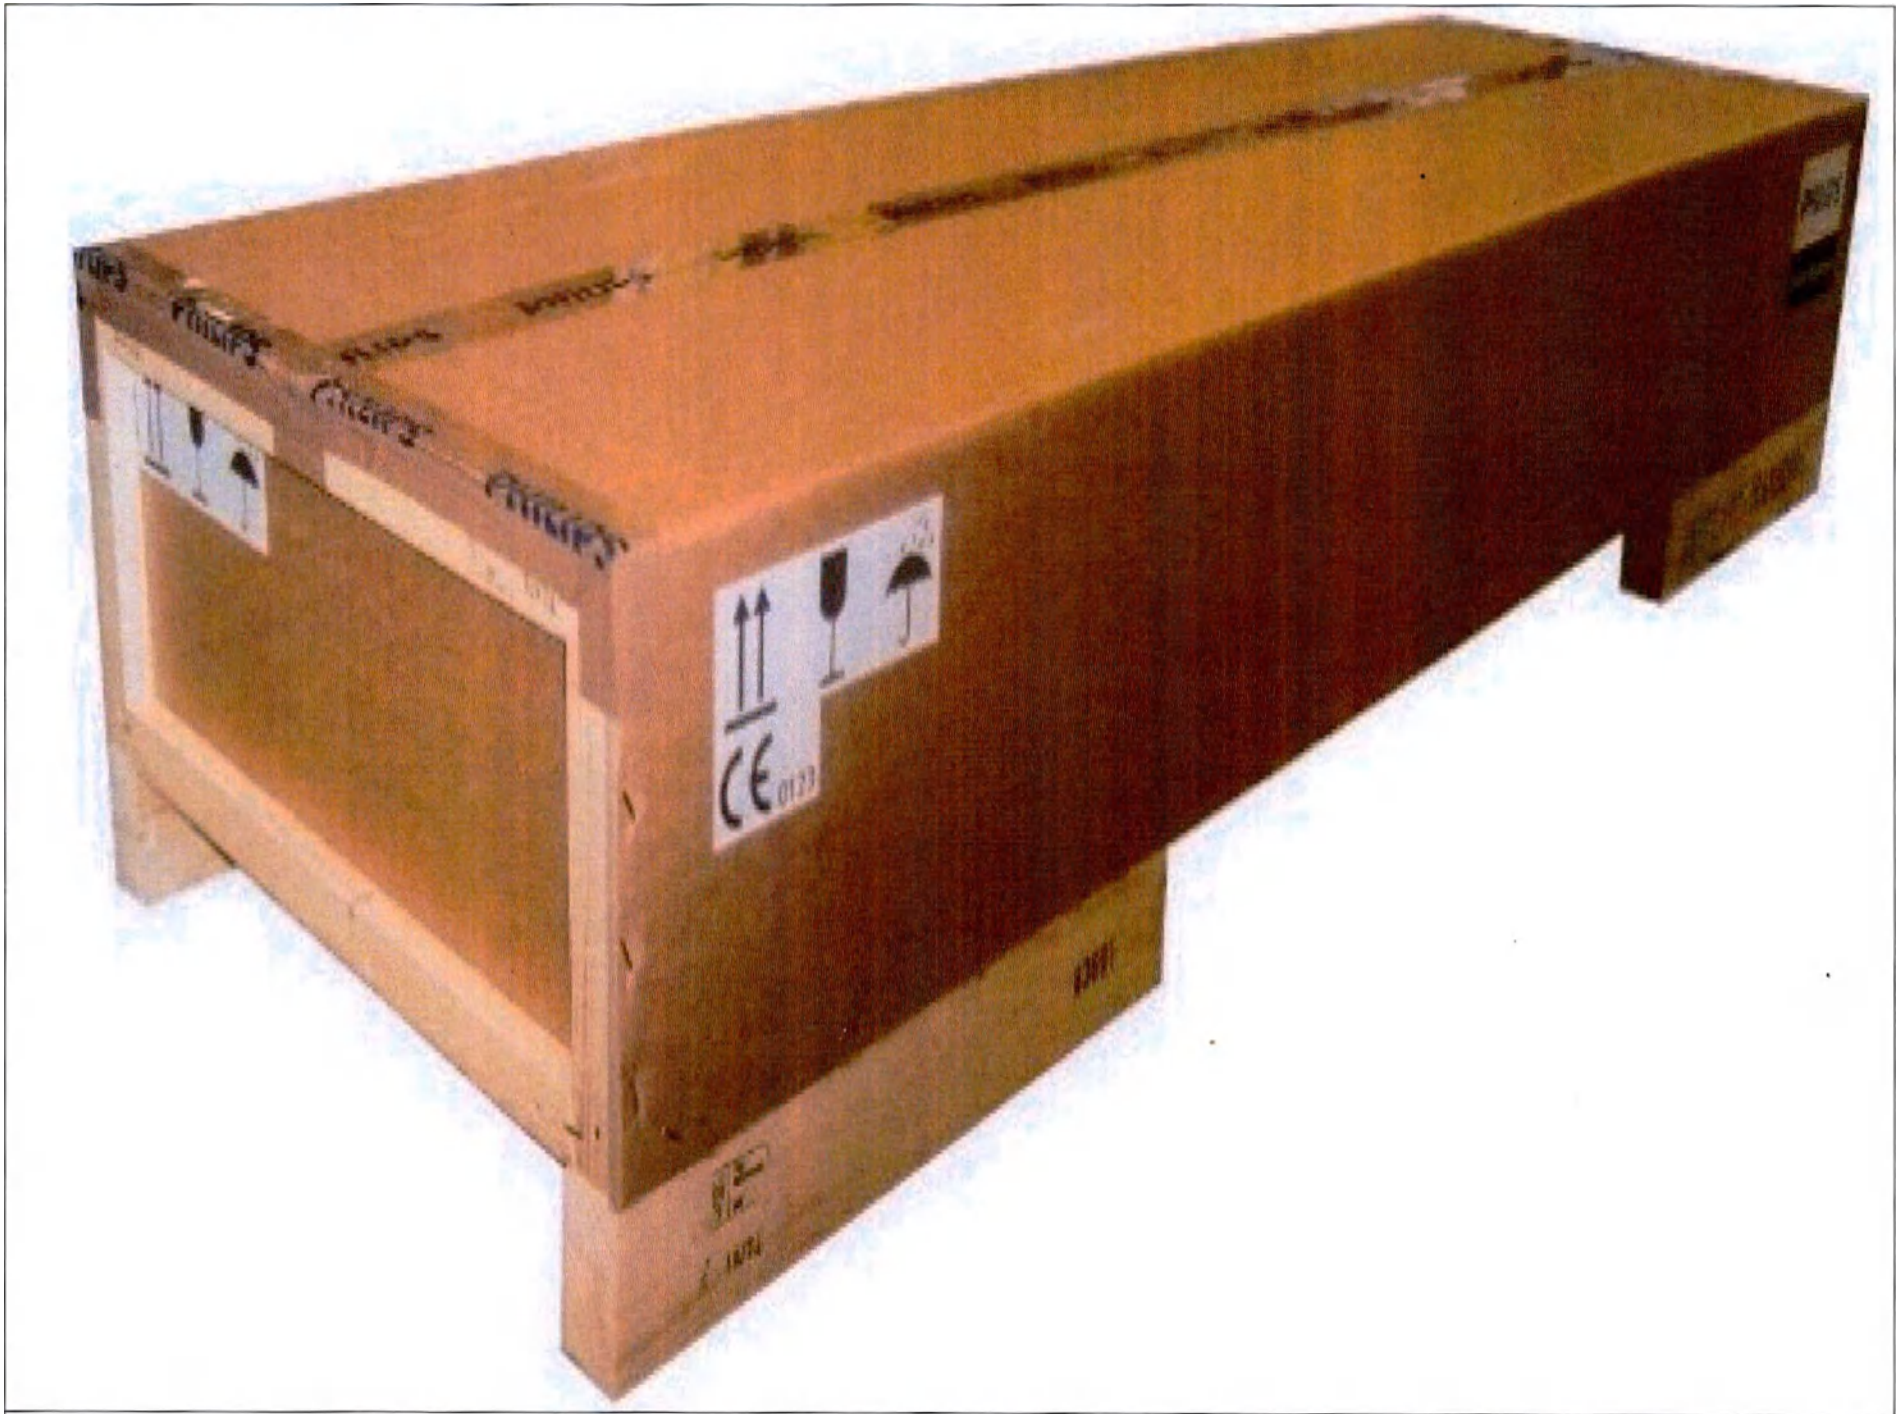

Пример транспортной упаковки (вариант 4).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка:

Производитель: [по РУ]
Место производства: [по РУ]

Медицинское Изделие:
[Наименование по РУ]

Вариант исполнения/Модель: [по РУ]

Серийный номер/номер партии:
см. на основной маркировке

Дата изготовления: см. на основной маркировке

Номинальный режим работы: см. *или* см. на основной маркировке *или* [указываем параметры]

Предупреждения и знаки опасности: см.

Регистрационное удостоверение: № РЗН/ФСЗ

EAC

Макет маркировки на русском языке для системы DigitalDiagnost C90.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 117 листа (ов)

ООО «Филипс»

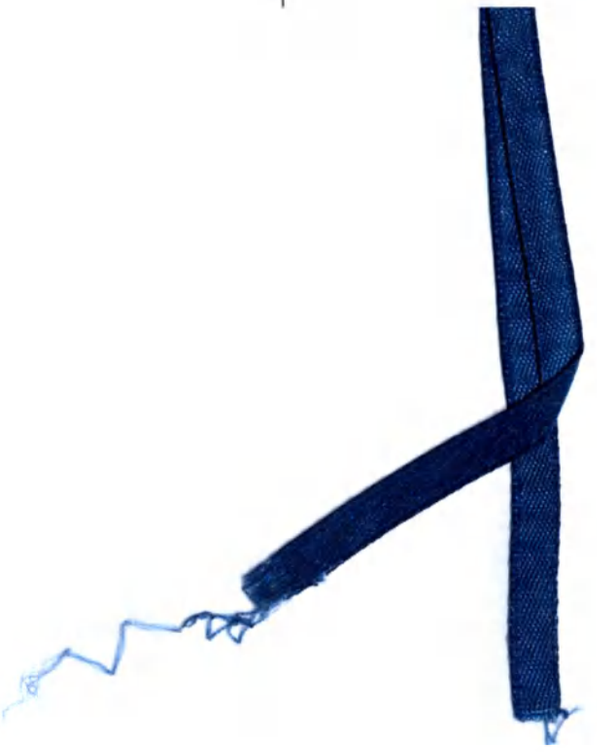

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU