

Менеджер по регистрации

и контролю качества

ООО «Страйкер»


А. В. Моисеева

«26» мая 2023 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

«Система роботизированная МАКО для реконструктивных операций»

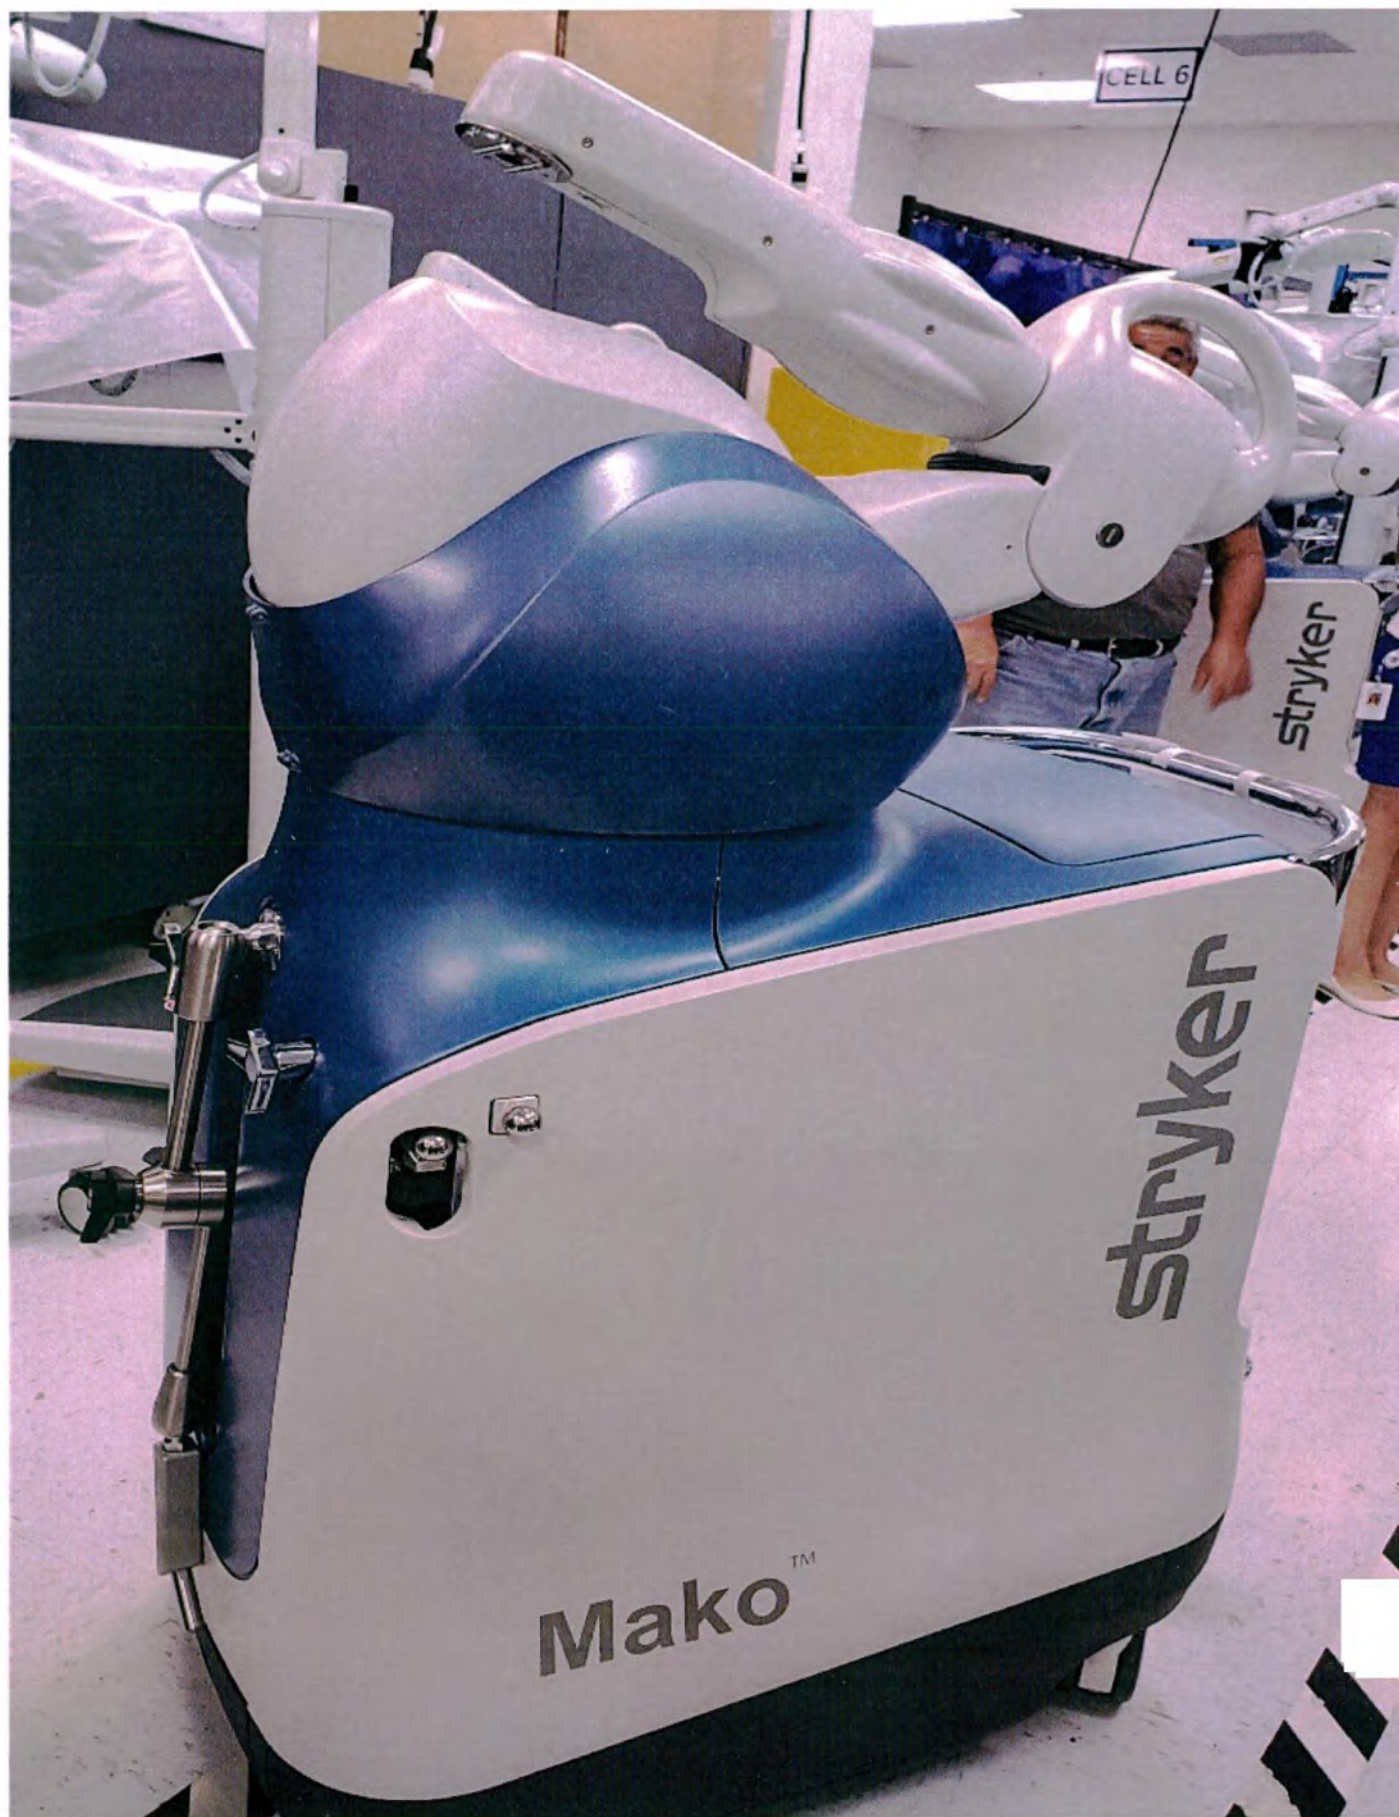

Манипулятор роботизированной системы MAKO 3.1



Модуль управления MAKO



Стойка камеры МАКО, в составе: а. Стойка; б.Камера



Кабель питания



Силовой модуль MICS



Переключатель ножной



Программное обеспечение МАКО для одномошечкового эндопротезирования коленного сустава (РКА, версия 3.0.2), эндопротезирования тазобедренного сустава (ТНА, версия 3.1.3), тотального эндопротезирования коленного сустава (ТКА, версия 1.0.1) на электронном носителе (CD/DVD диск)

stryker

MAKO®
TKA 1.0.3 + THA 4.0.2 + PKA 3.0.4 +
MGO 1.2.1.1

Trademarks registered in the United States.
Trademark registrations pending
in other jurisdictions.



MAKO Surgical Corp.
3365 Enterprise Ave
Weston, FL 33331 USA

Manufactured in USA



REF 700002149814
rev AB


LOT 1000814

Software Revisions:
TKA 1.0.3
THA 4.0.2
PKA 3.0.4
MGO 1.2.1.1
Arm Software (CRISIS) 3.0

EC REP

Stryker European Operations Limited Anngrove, IDA Business
& Technology Park Carrigtwohill, Co Cork, T45 HX08 Ireland

CE 2797




Keep Dry

R_x ONLY



consult instructions
for use



CONFIDENTIAL STRYKER PROPERTY

Disc 1 of 1

Программное обеспечение МАКО для одномышелкового эндопротезирования коленного сустава (РКА, версия 3.0.4), тотального эндопротезирования тазобедренного сустава (ТНА, версия 4.0.2), тотального эндопротезирования коленного сустава (ТКА, версия 1.0.3) на электронном носителе (CD/DVD диск)

MAKO

stryker

Руководство пользователя системы



Руководство пользователя системы MAKO (модель 3.1)



Компьютер MPS



Привод CD/DVD и внешних USB устройств



Позиционер коленного сустава в составе: Кронштейн позиционера коленного сустава IMP DeMayo



Позиционер коленного сустава в составе: Подкладка настольная для кронштейна IMP




Позиционер коленного сустава в составе: Подкладка настольная IMP



Позиционер коленного сустава в составе: Комплект фиксирующий для позиционера DeMayo для нижних конечностей стерильный)



Позиционер коленного сустава в составе: Комплект фиксации для позиционера DeMayo для нижних конечностей (стерильный)

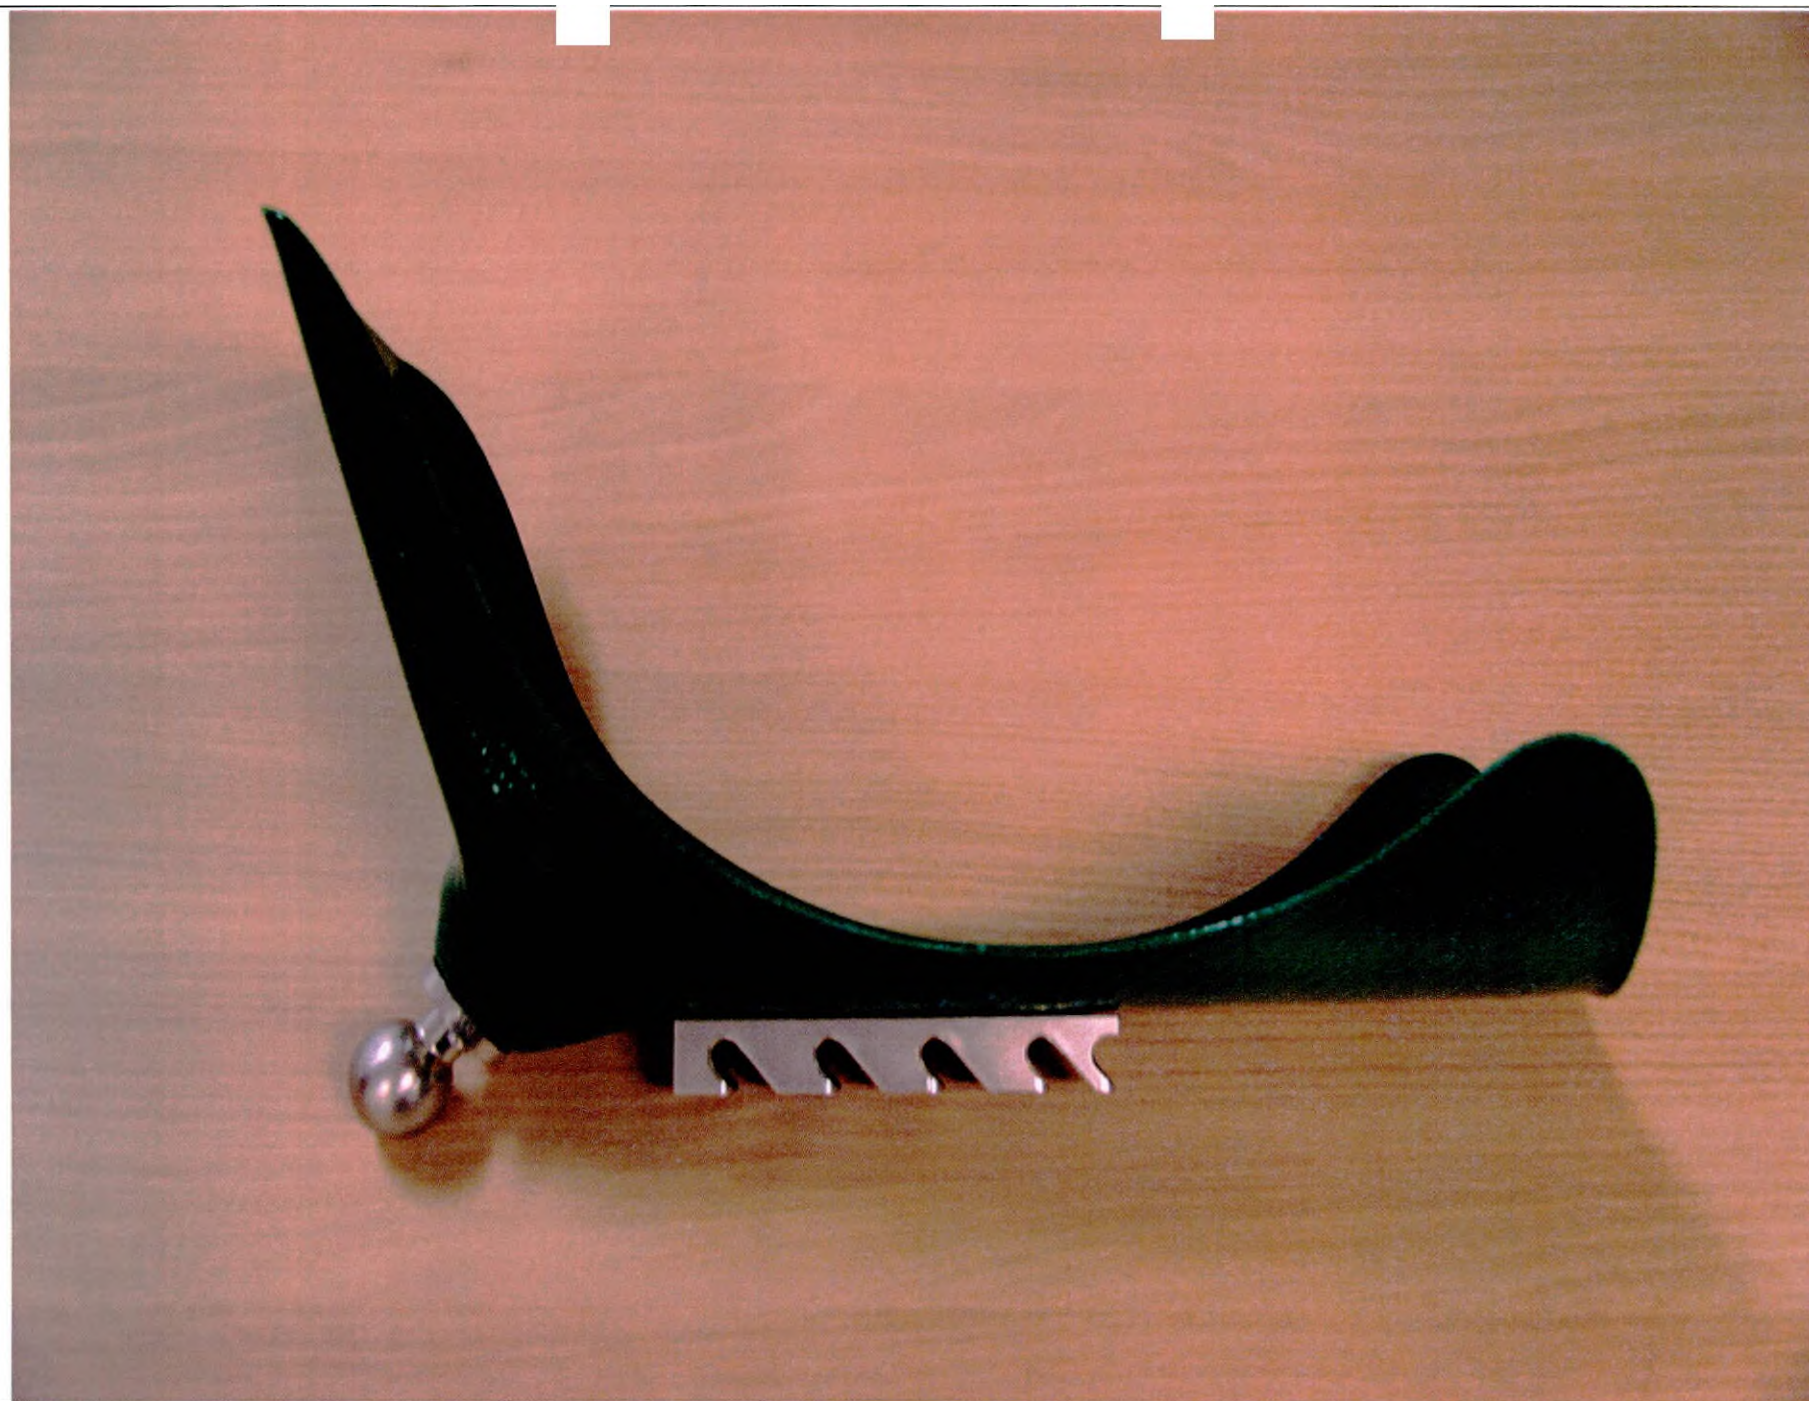


Позиционер коленного сустава в составе: Позиционер коленного сустава IMP DeMayo 25"



Позиционер коленного сустава в составе: Позиционер коленного сустава IMP DeMayo 30"




Позиционер коленного сустава в составе: Позиционер коленного сустава IMP DeMayo 30"

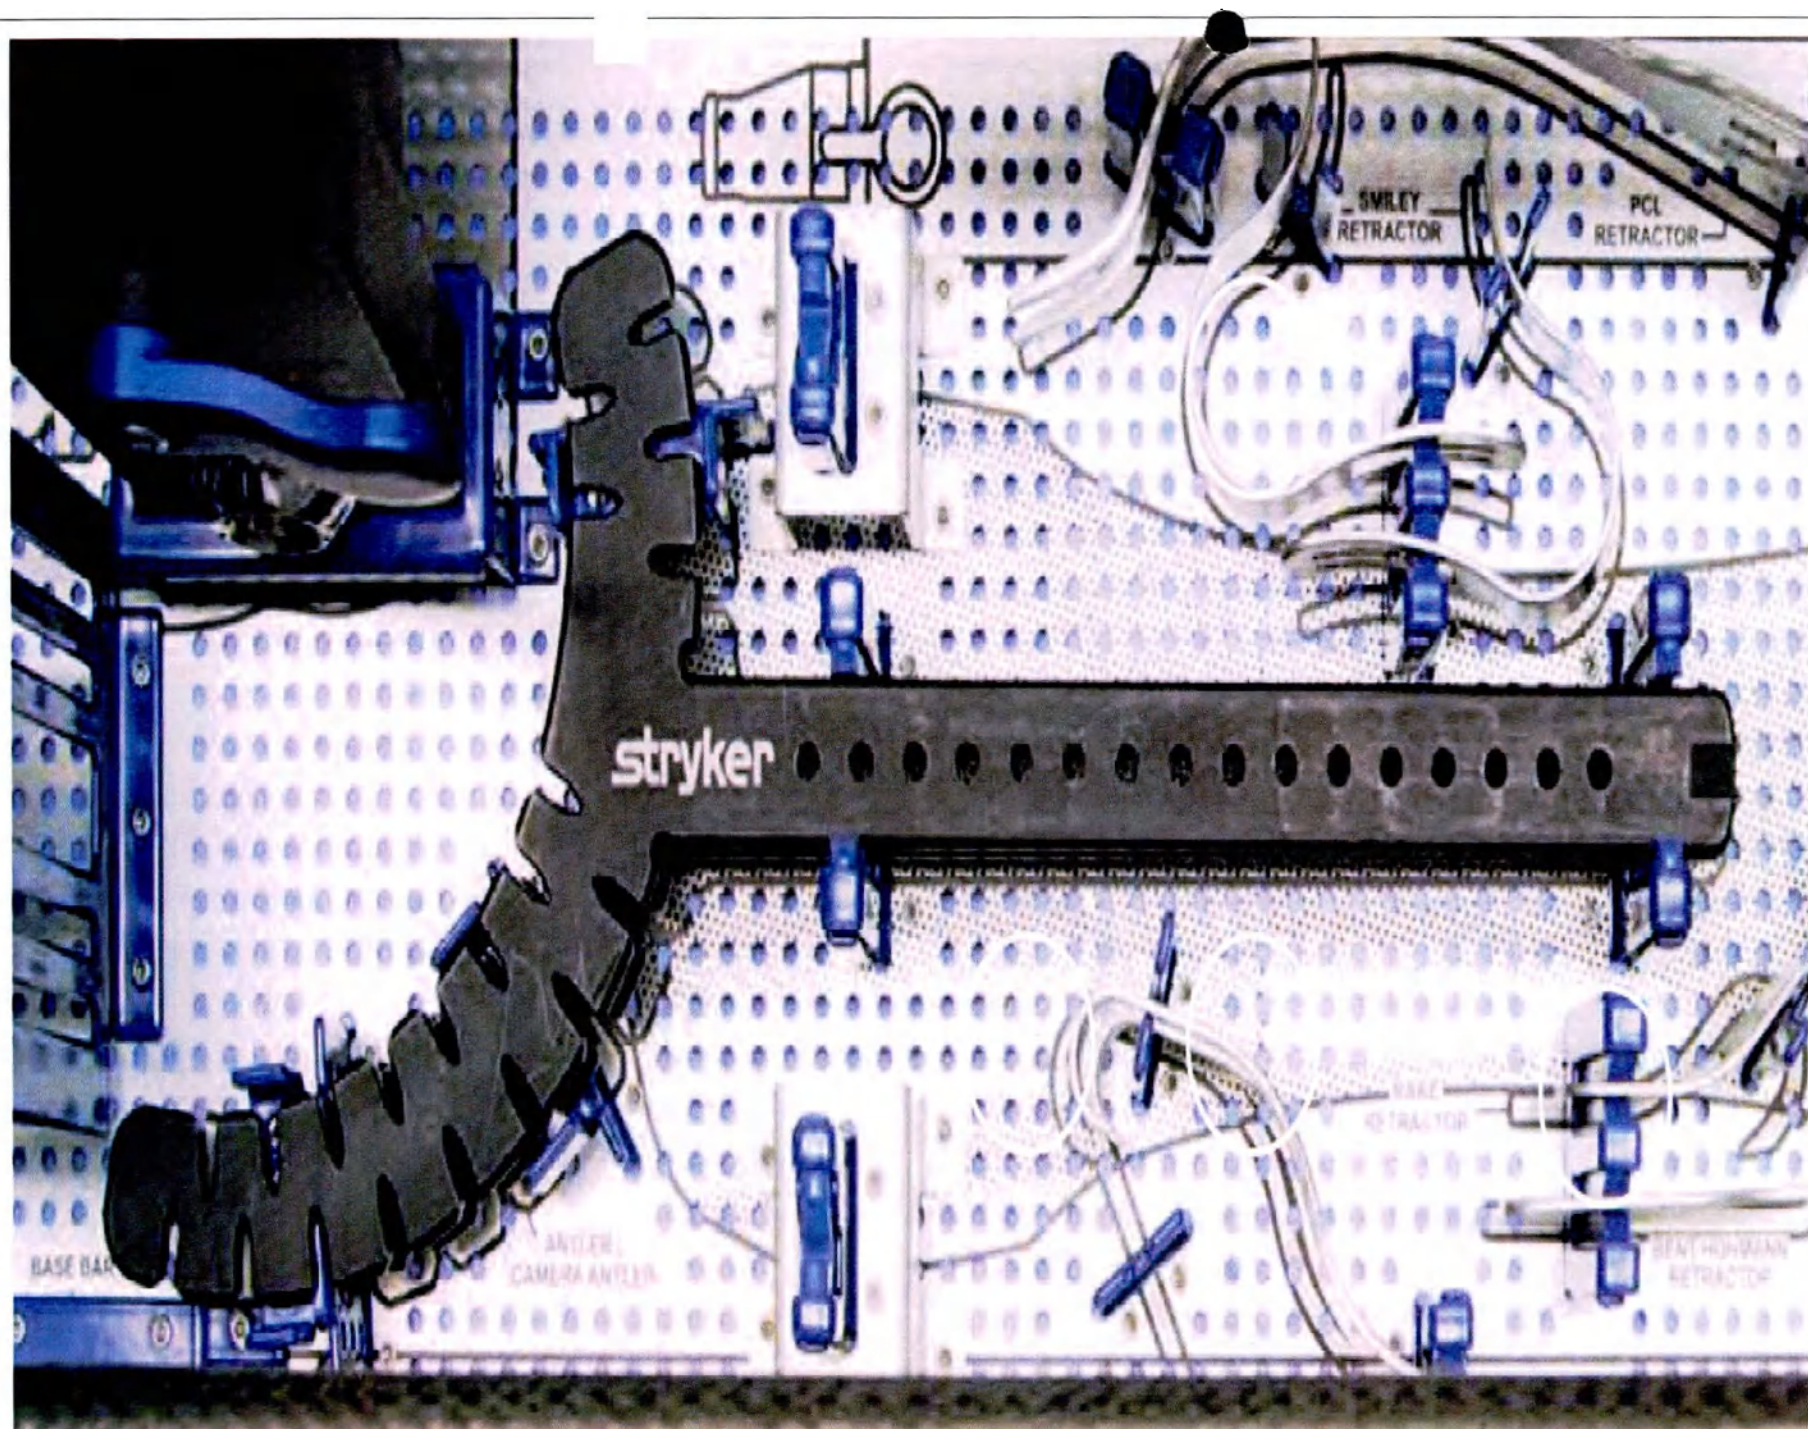


Позиционер ноги: Рейка большая




Позиционер ноги: Рейка малая

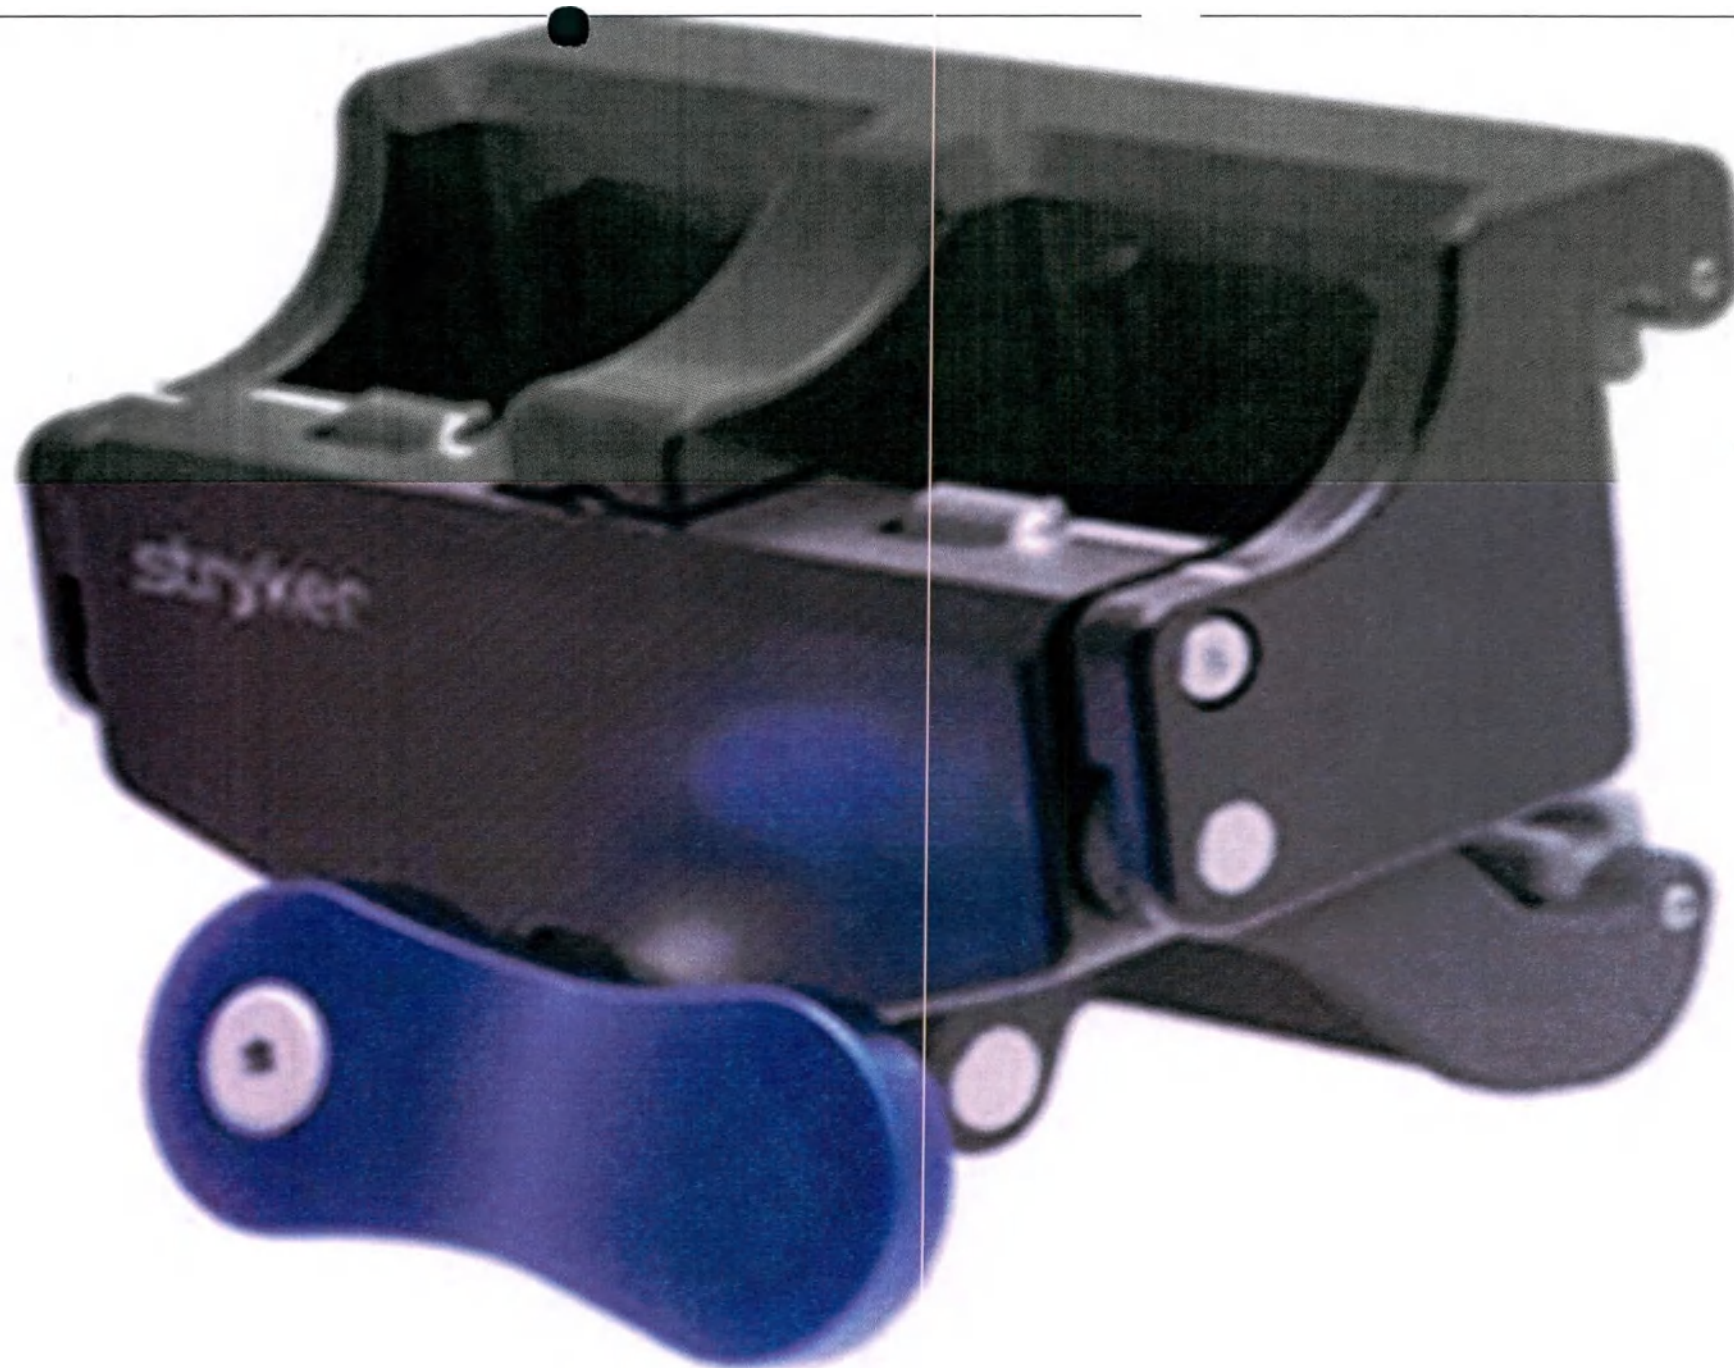


Позиционер ноги: Струбцина

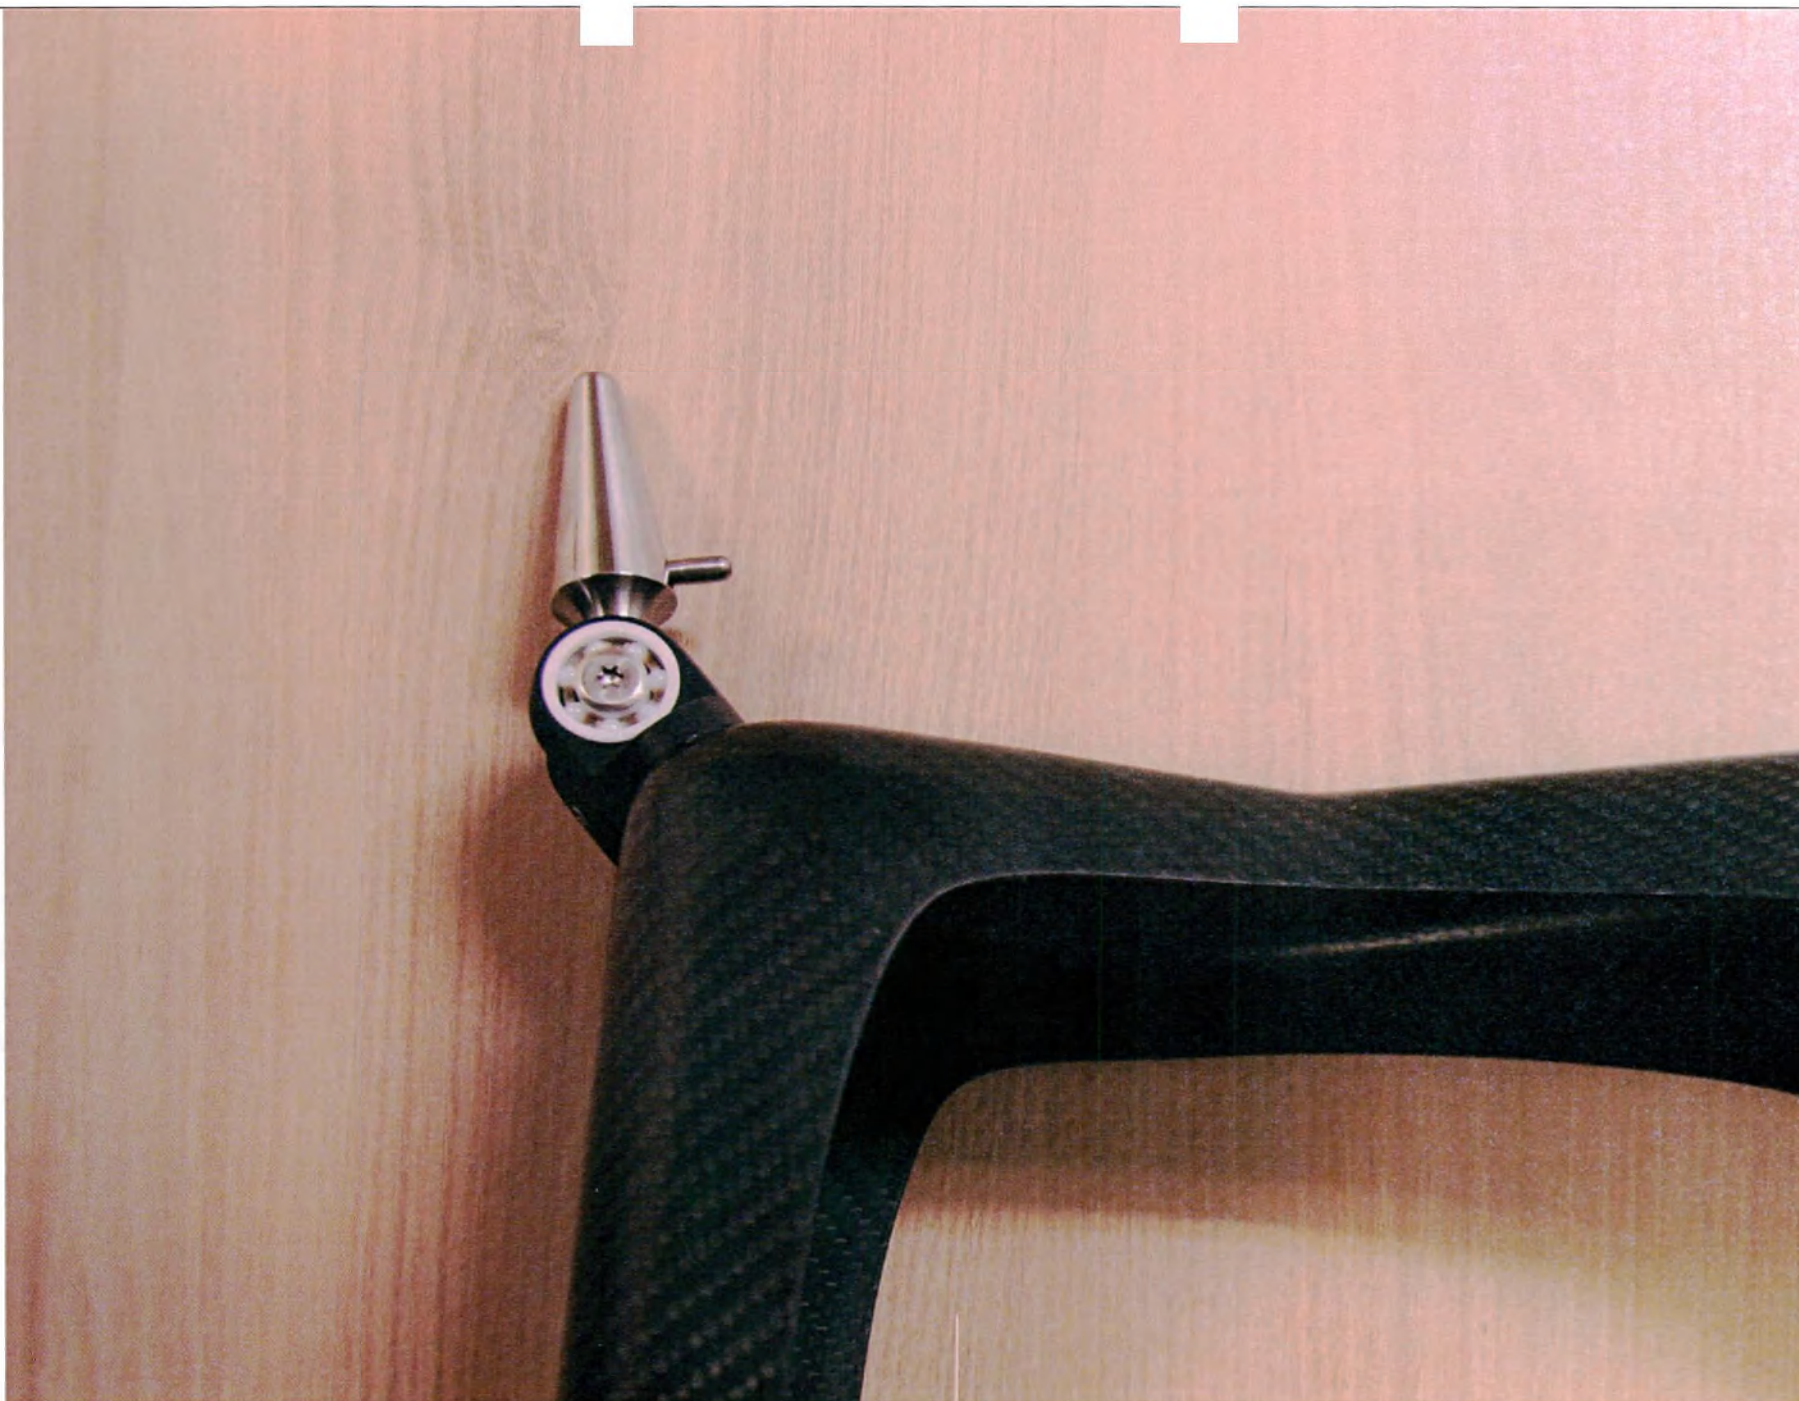

Позиционер ноги: Фиксатор нижней конечности

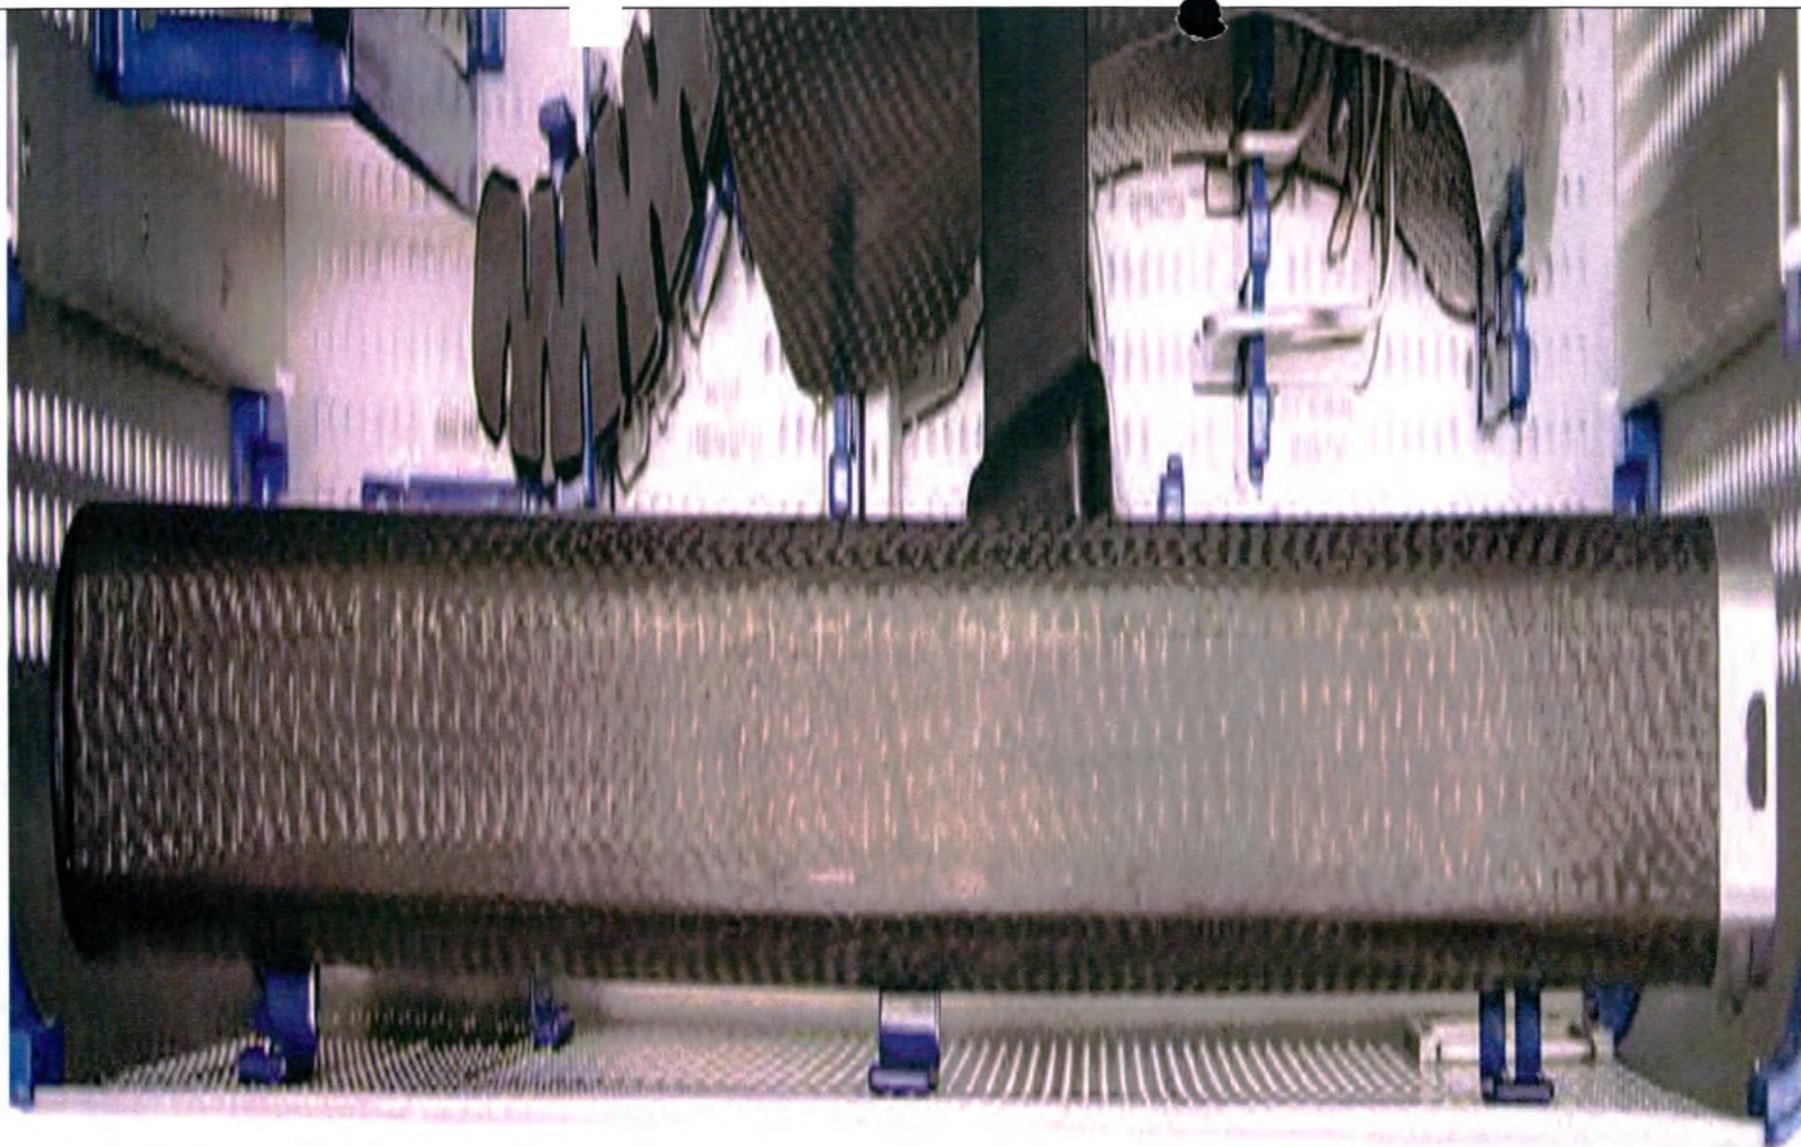

Позиционер ноги: Штанга основная

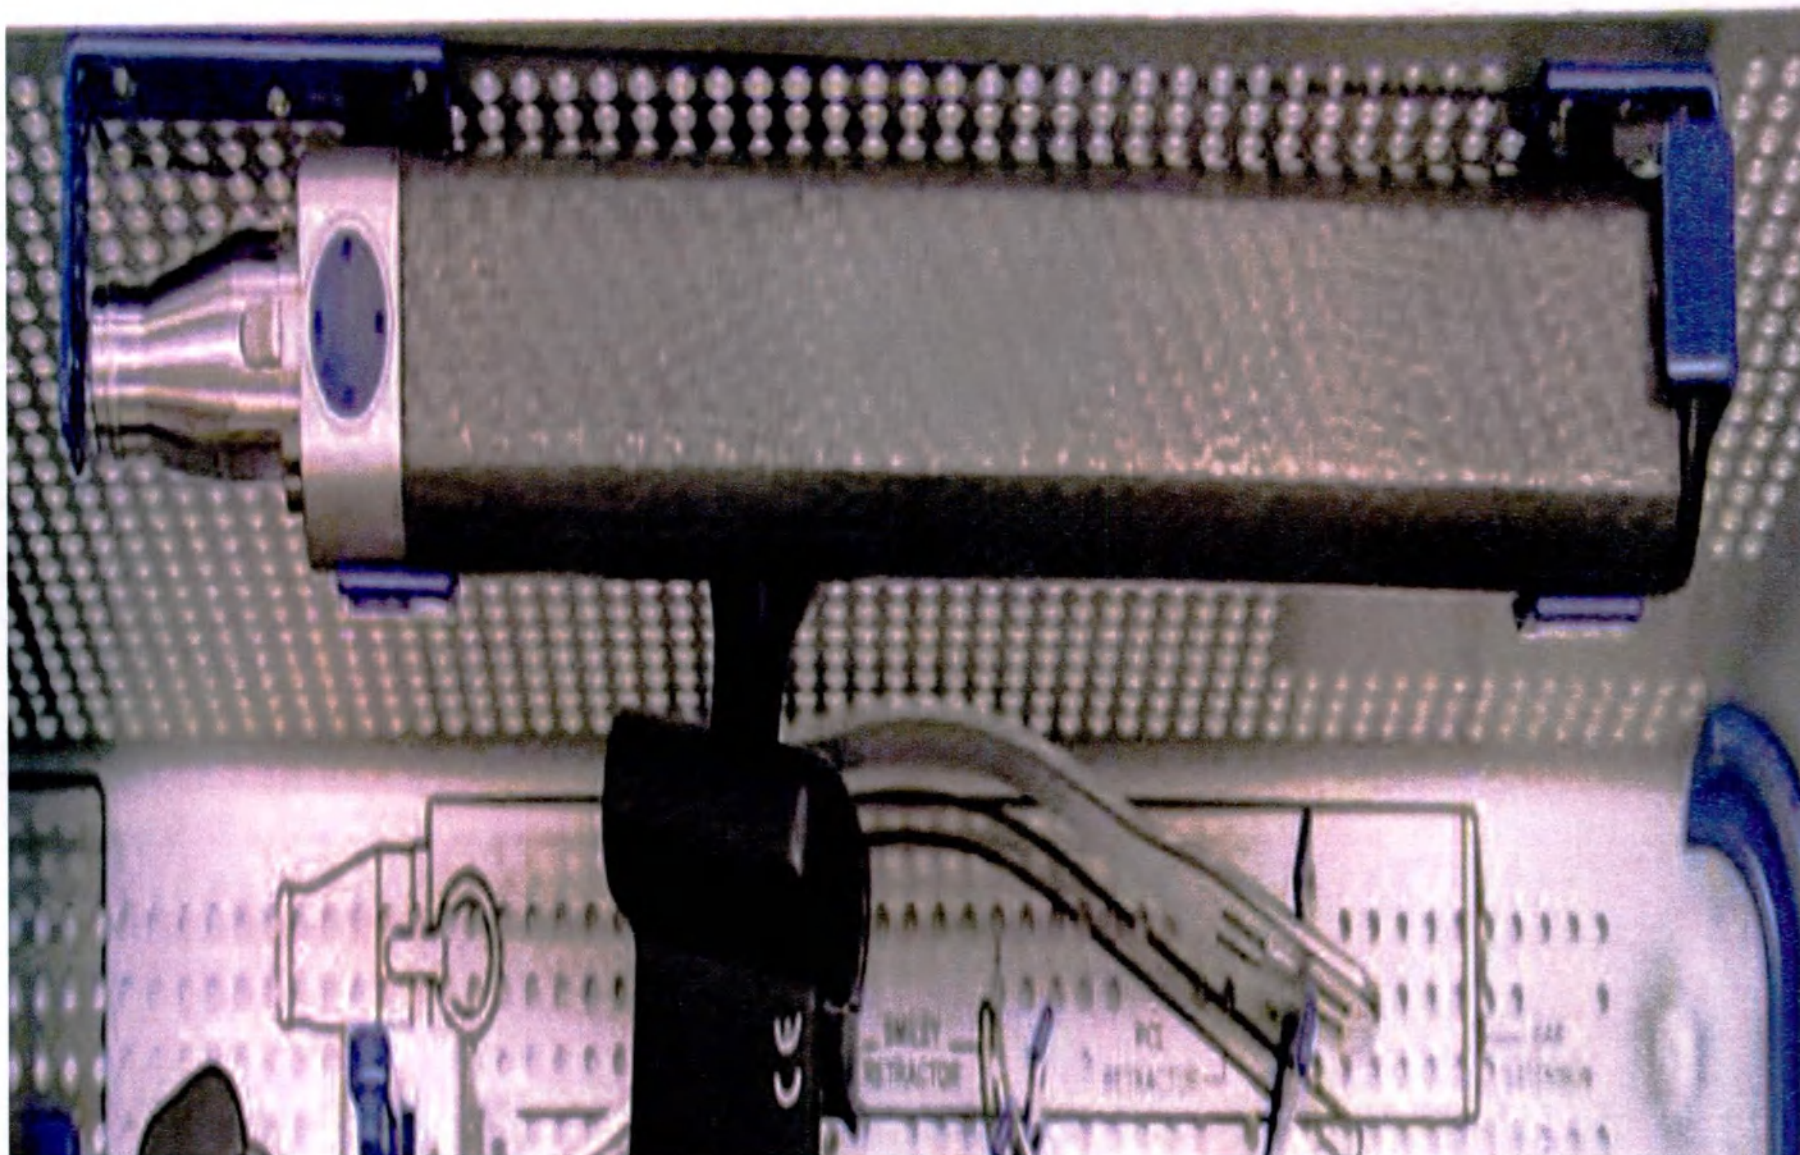


Позиционер ноги: Штанга удлиняющая



Позиционер ноги: Фиксатор позиционера нижней конечности скользящий



Позиционер нижней конечности

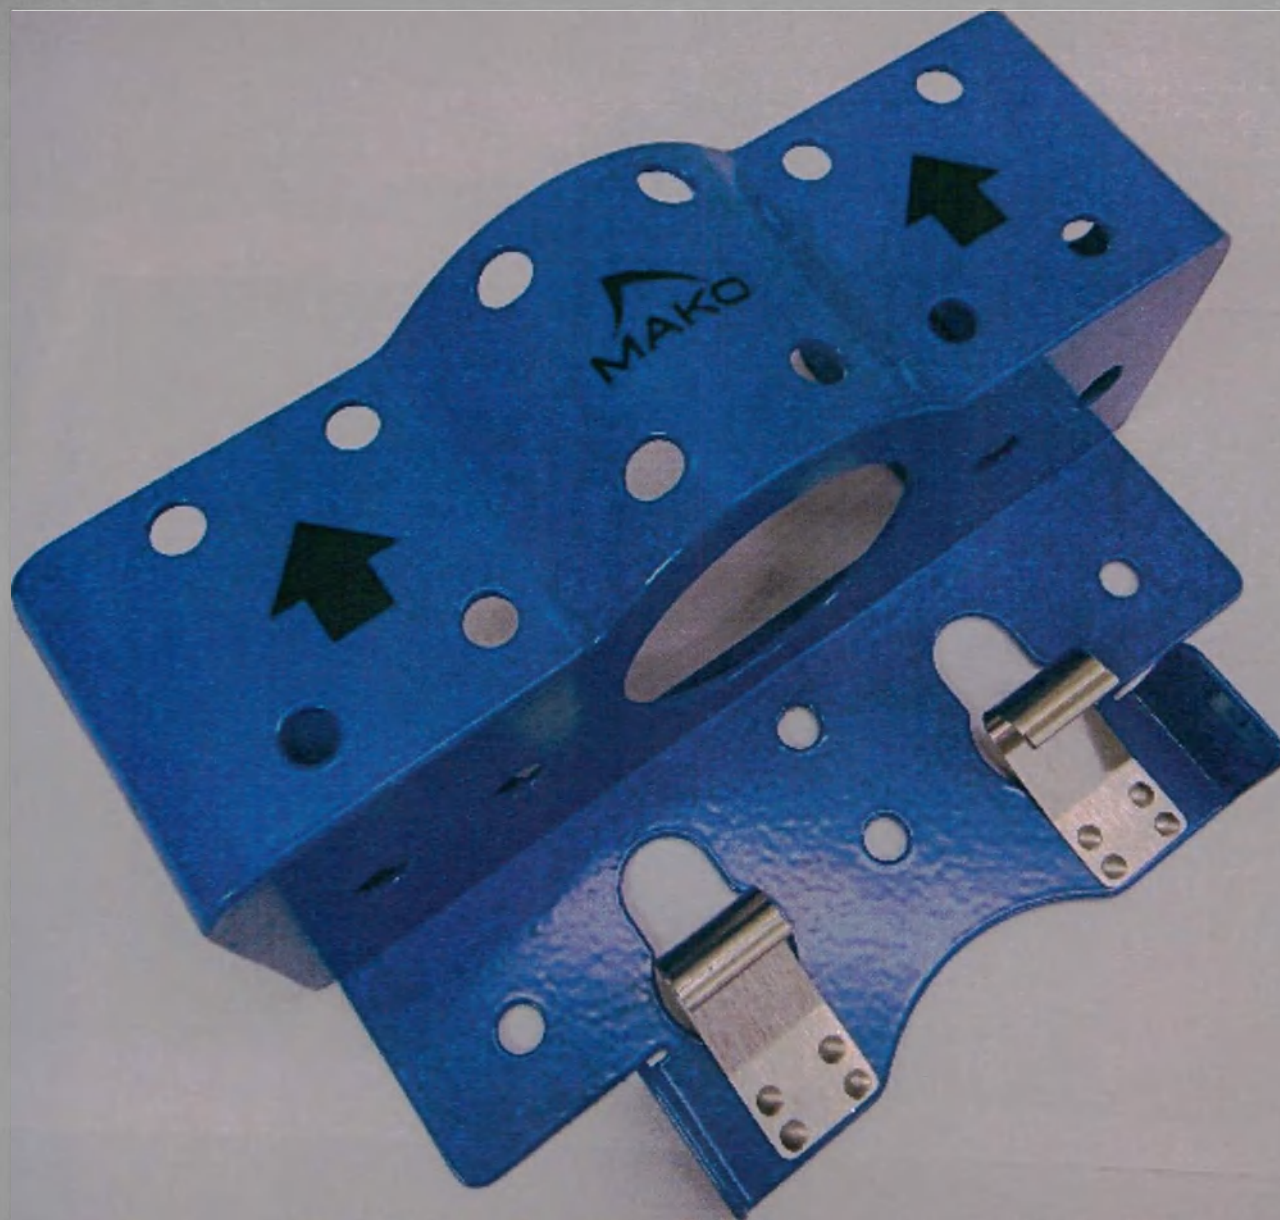

Фиксатор силового модуля MICS



Упаковка Кабель ретрактора



Кабель ретрактора



Ключ MICS для фиксации лезвия пилы. Считаю возможным распространить фотографию на все варианты исполнения: Ключ, Ключ фиксирующий



Заглушка адаптера MICS



Заглушка адаптера MICS



Насадка силового модуля MICS для примера




Насадка пилы сагиттальная, прямая




Насадка пилы сагиттальная, прямая




Насадка пилы сагиттальная, прямая

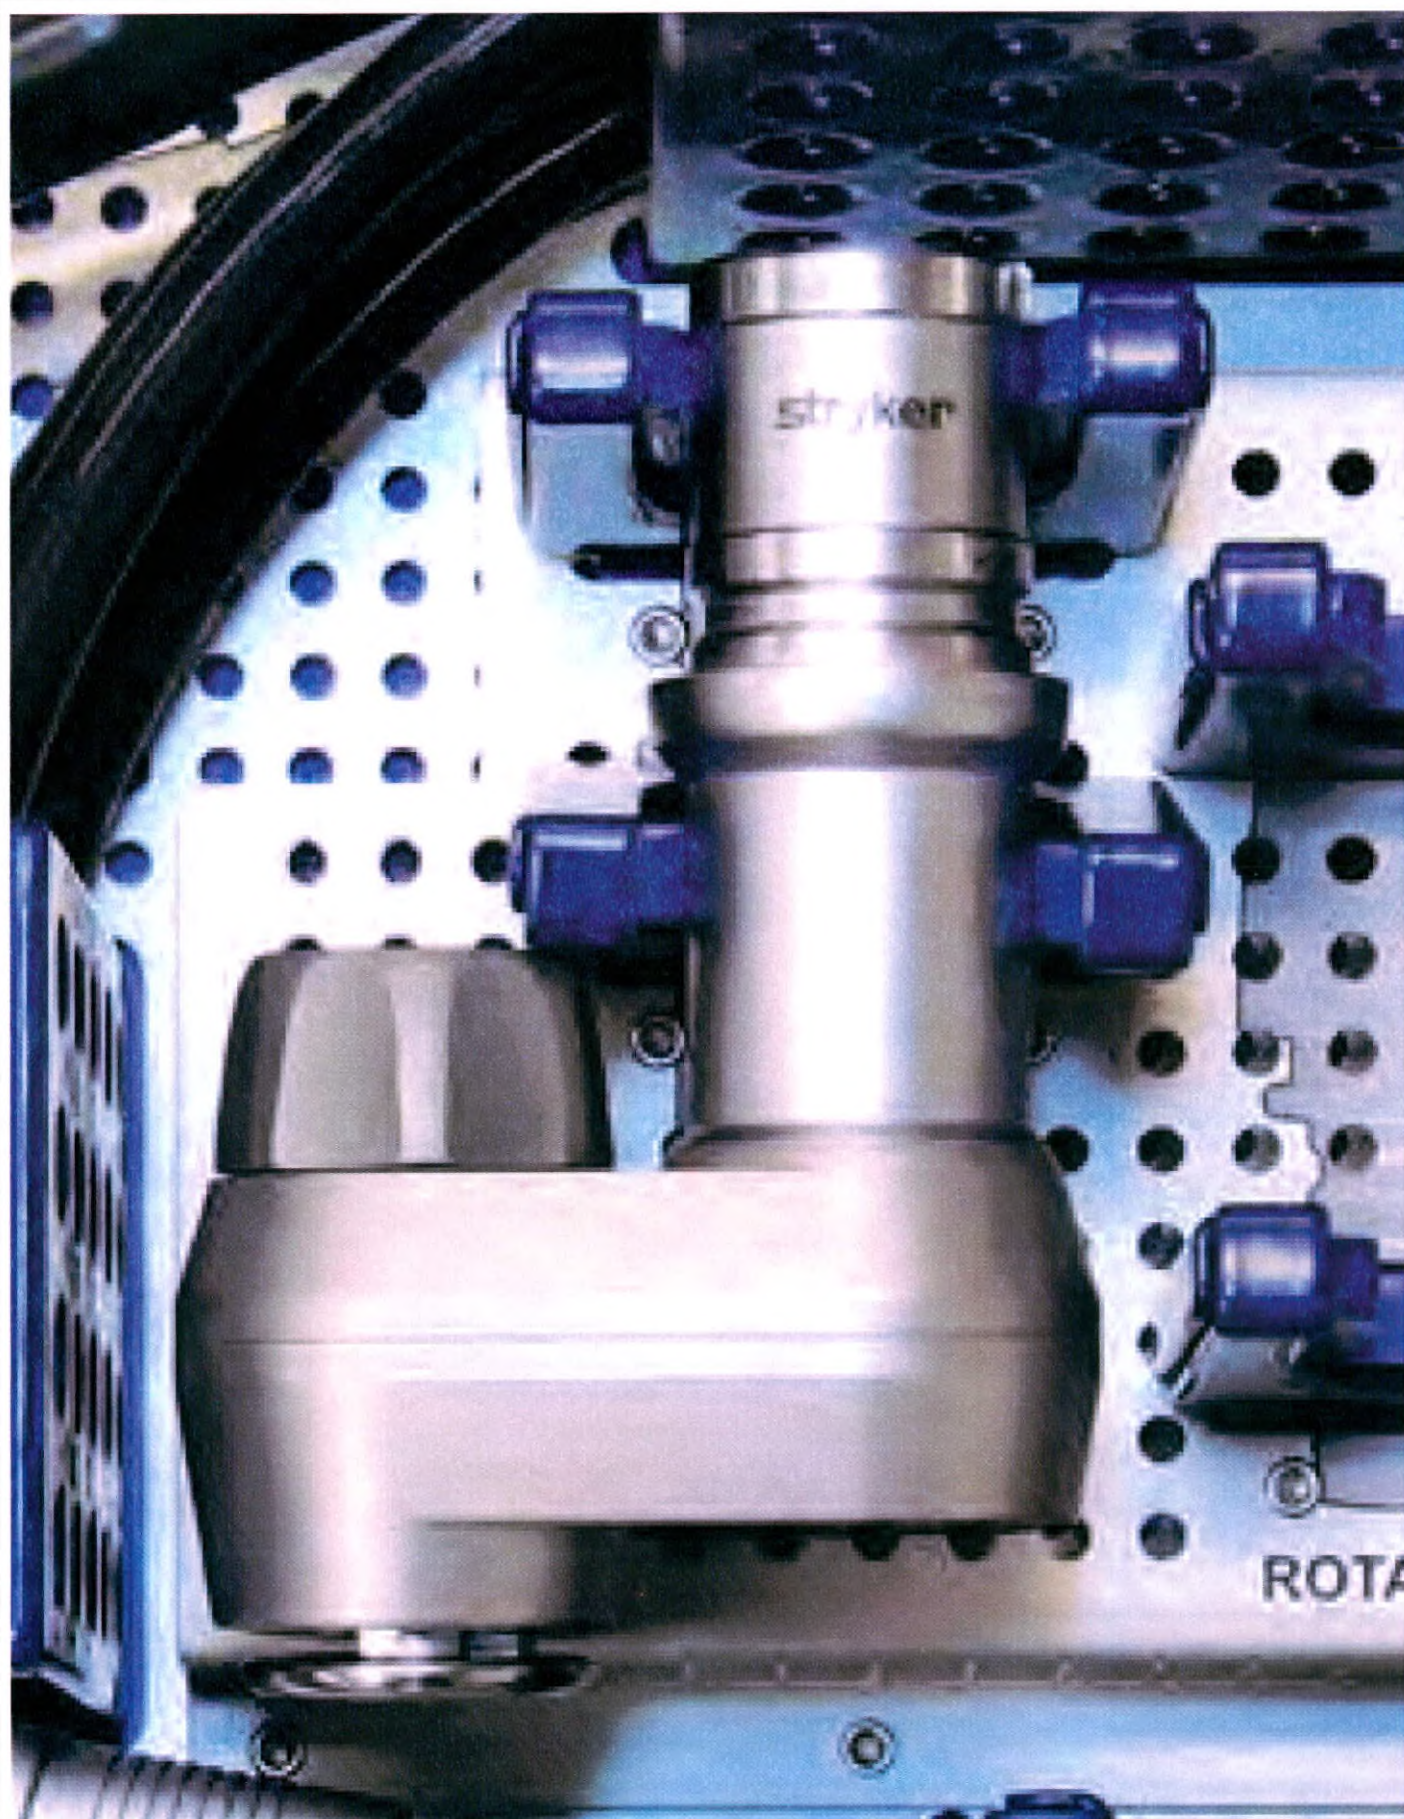

Насадка пилы сагиттальная, угловая

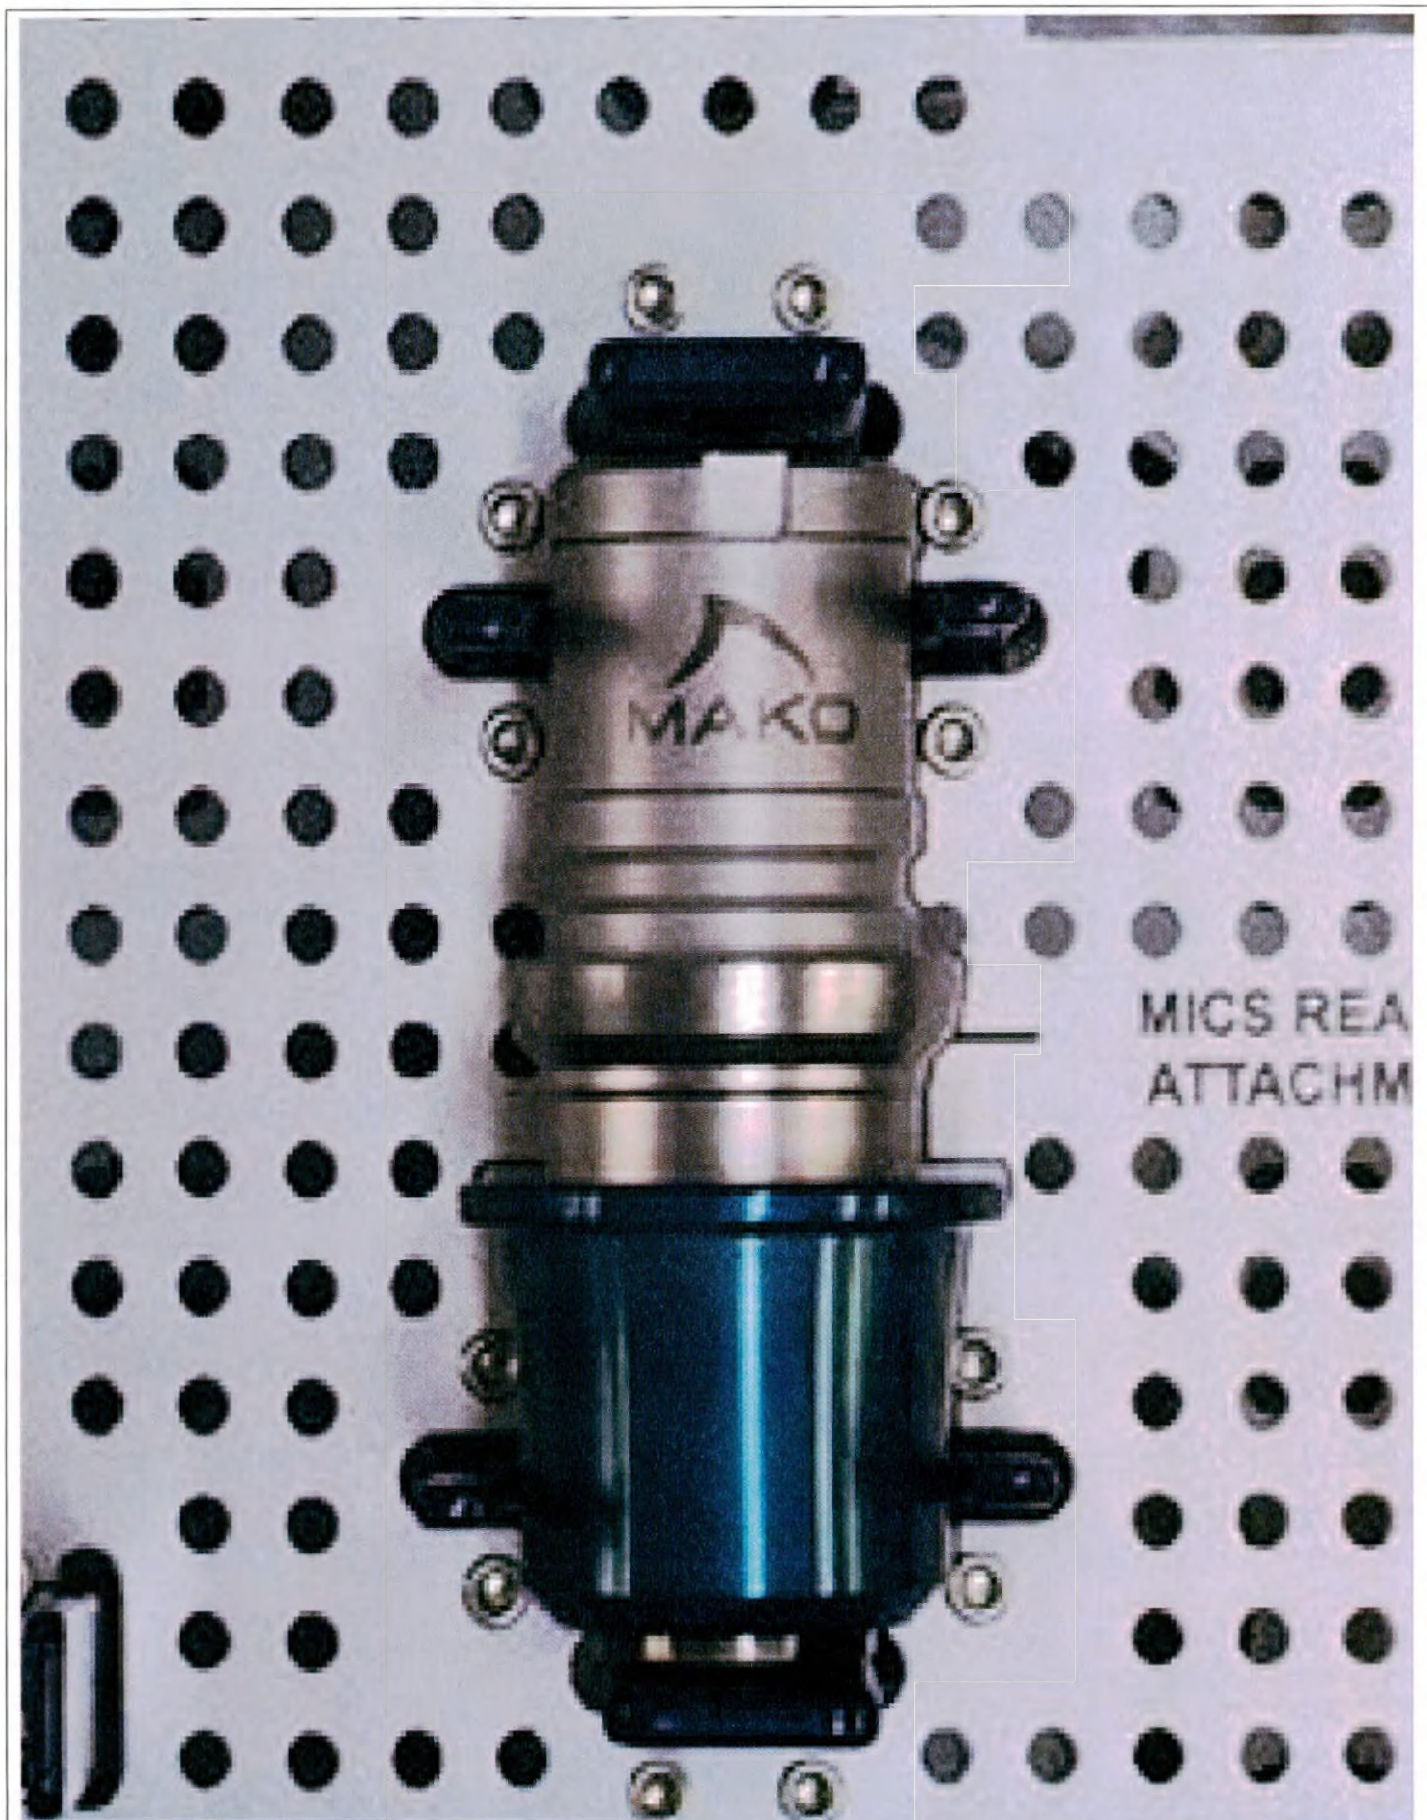

Насадка для римирования высокоскоростная

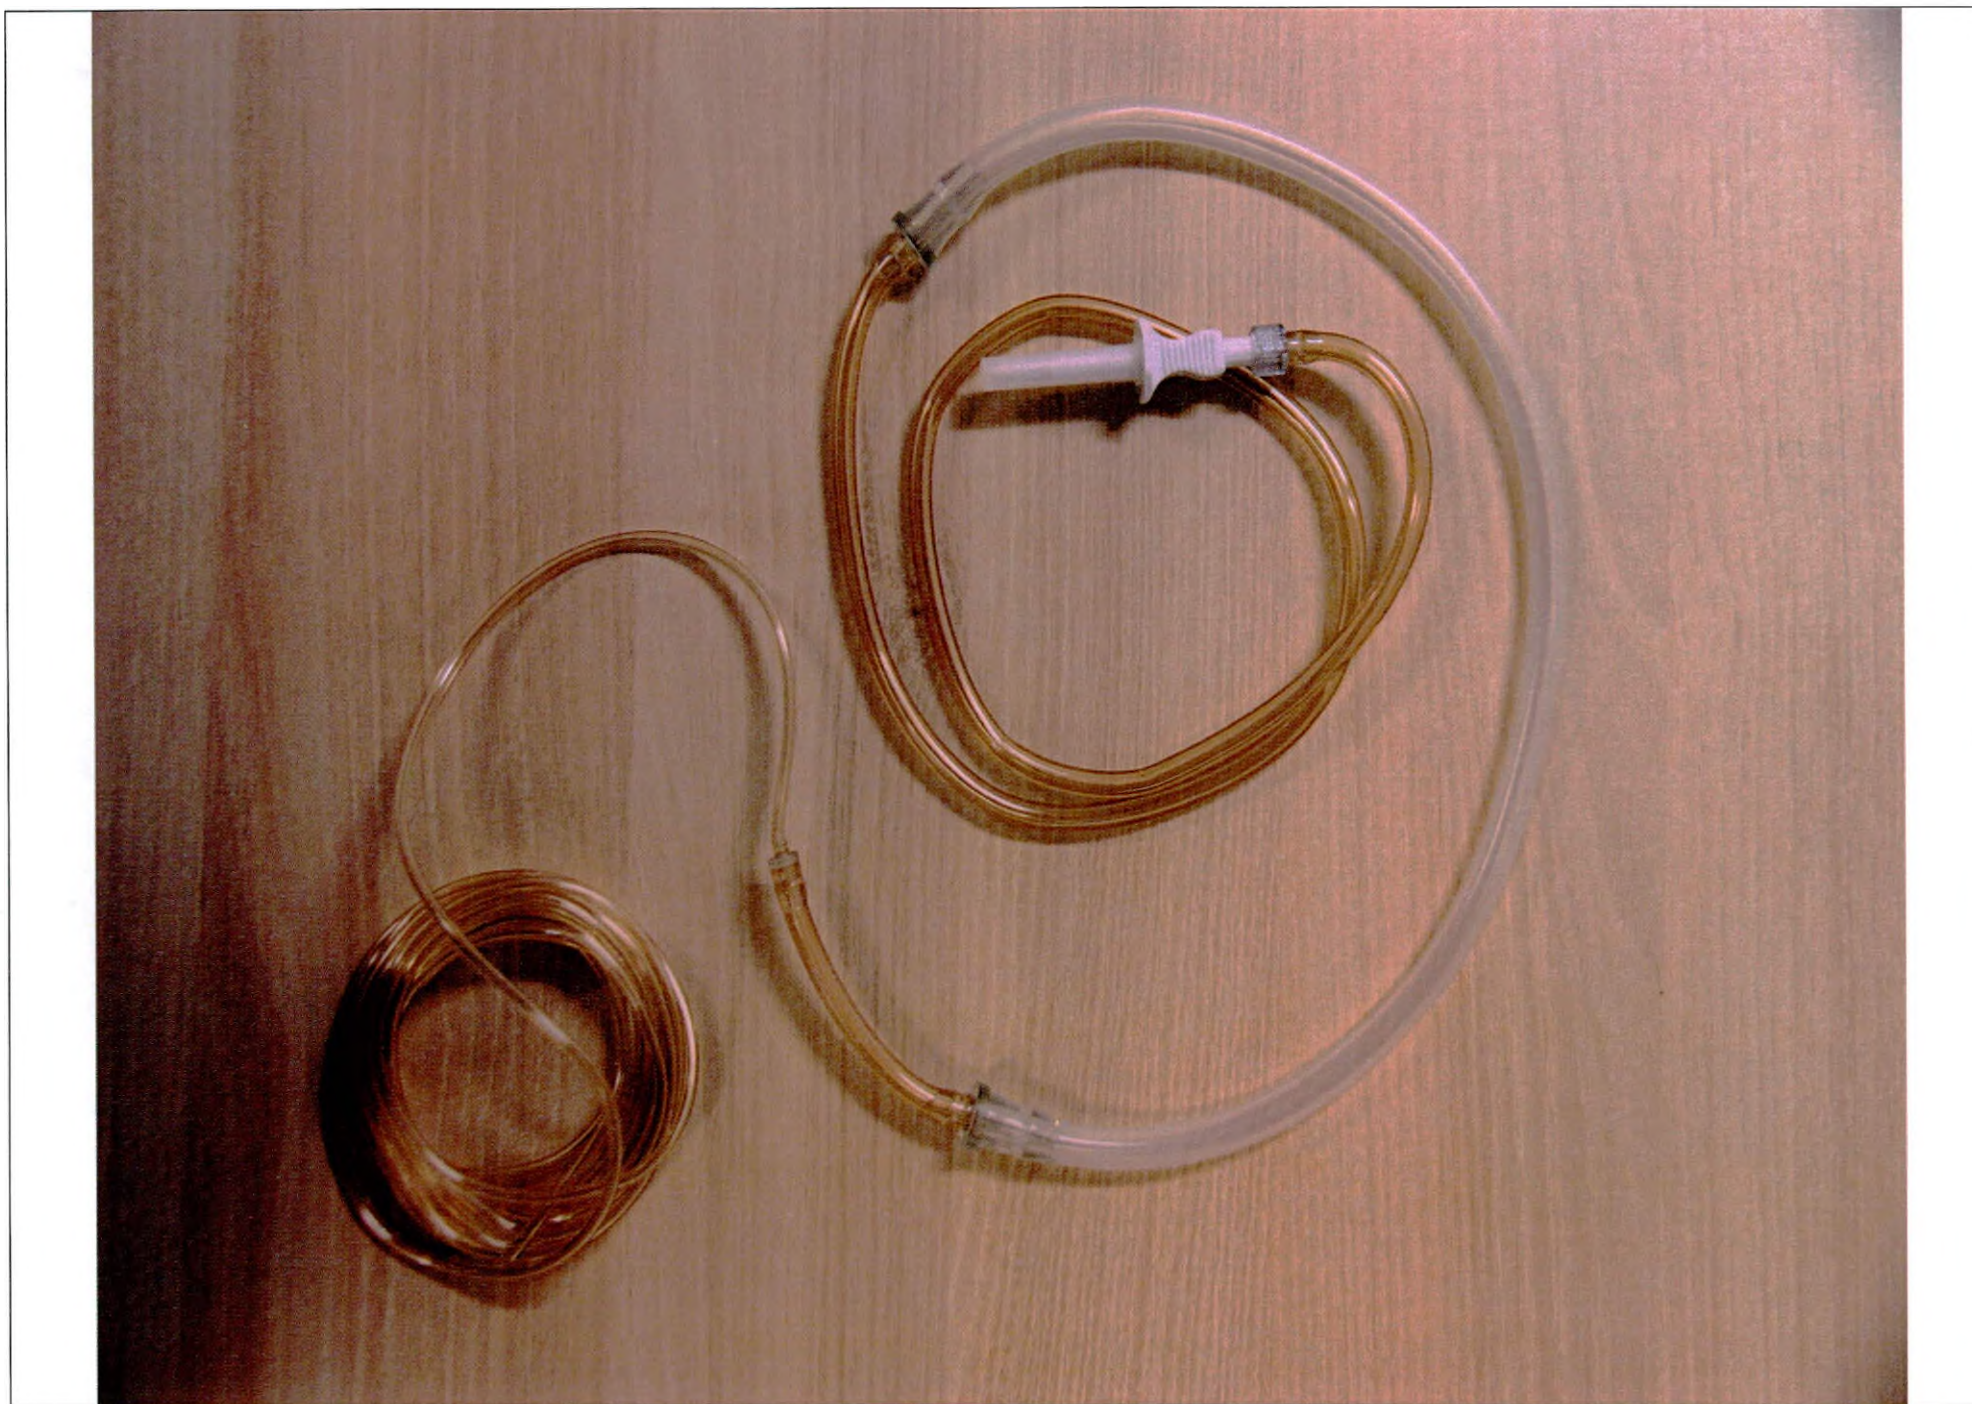


Трубка ирригационная для бура MAKO




Упаковка трубки ирригационная МАКО



Материал укрывной МАКО (стерильный)

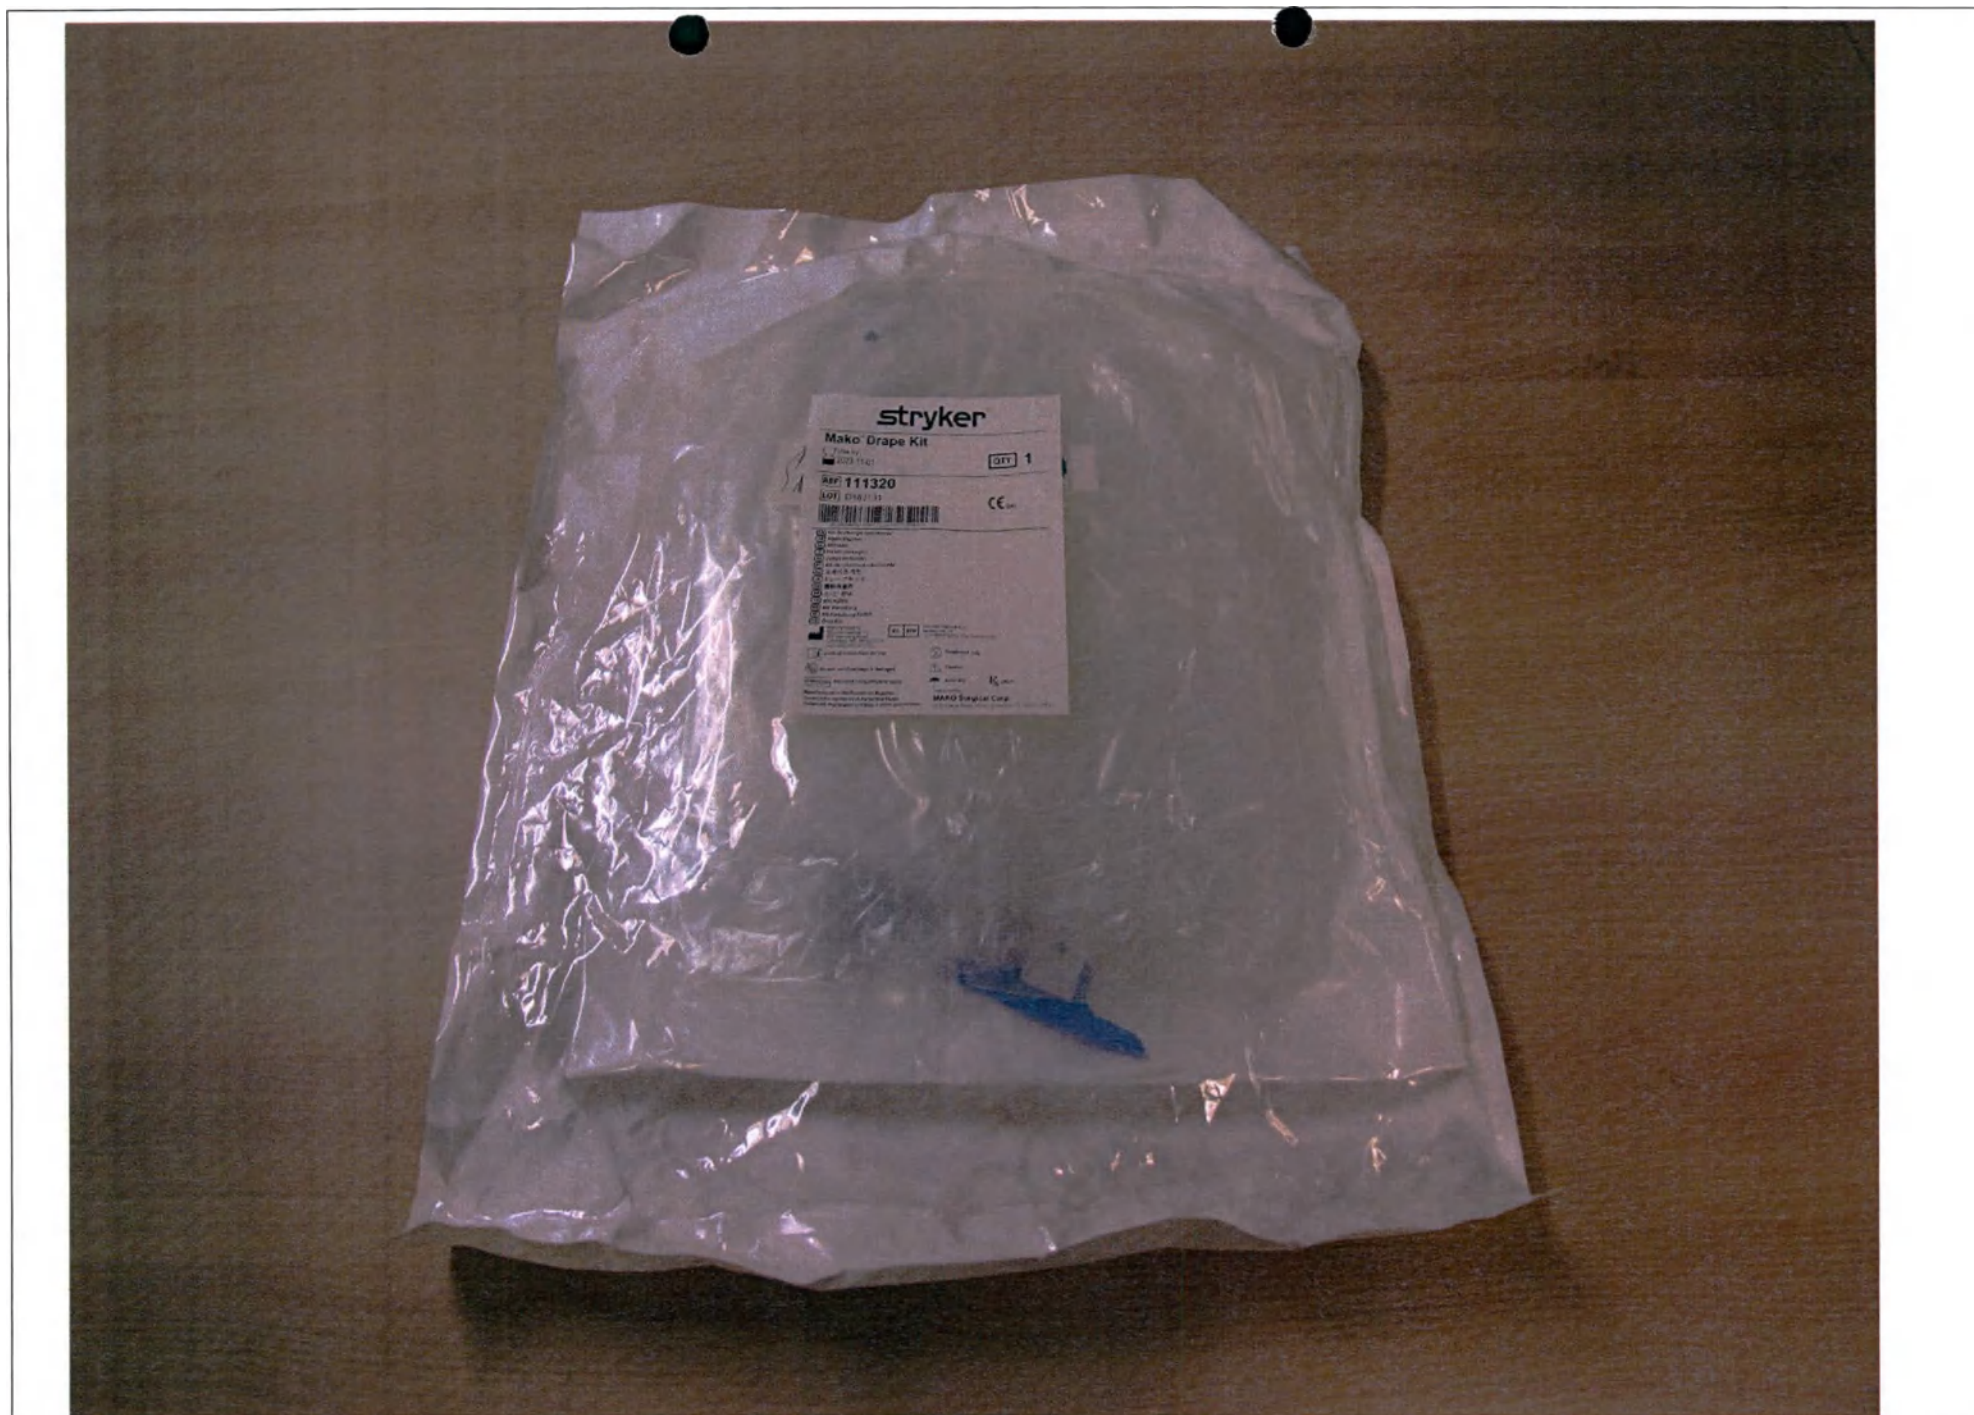

Упаковка Материала укрывного МАКО (стерильного)

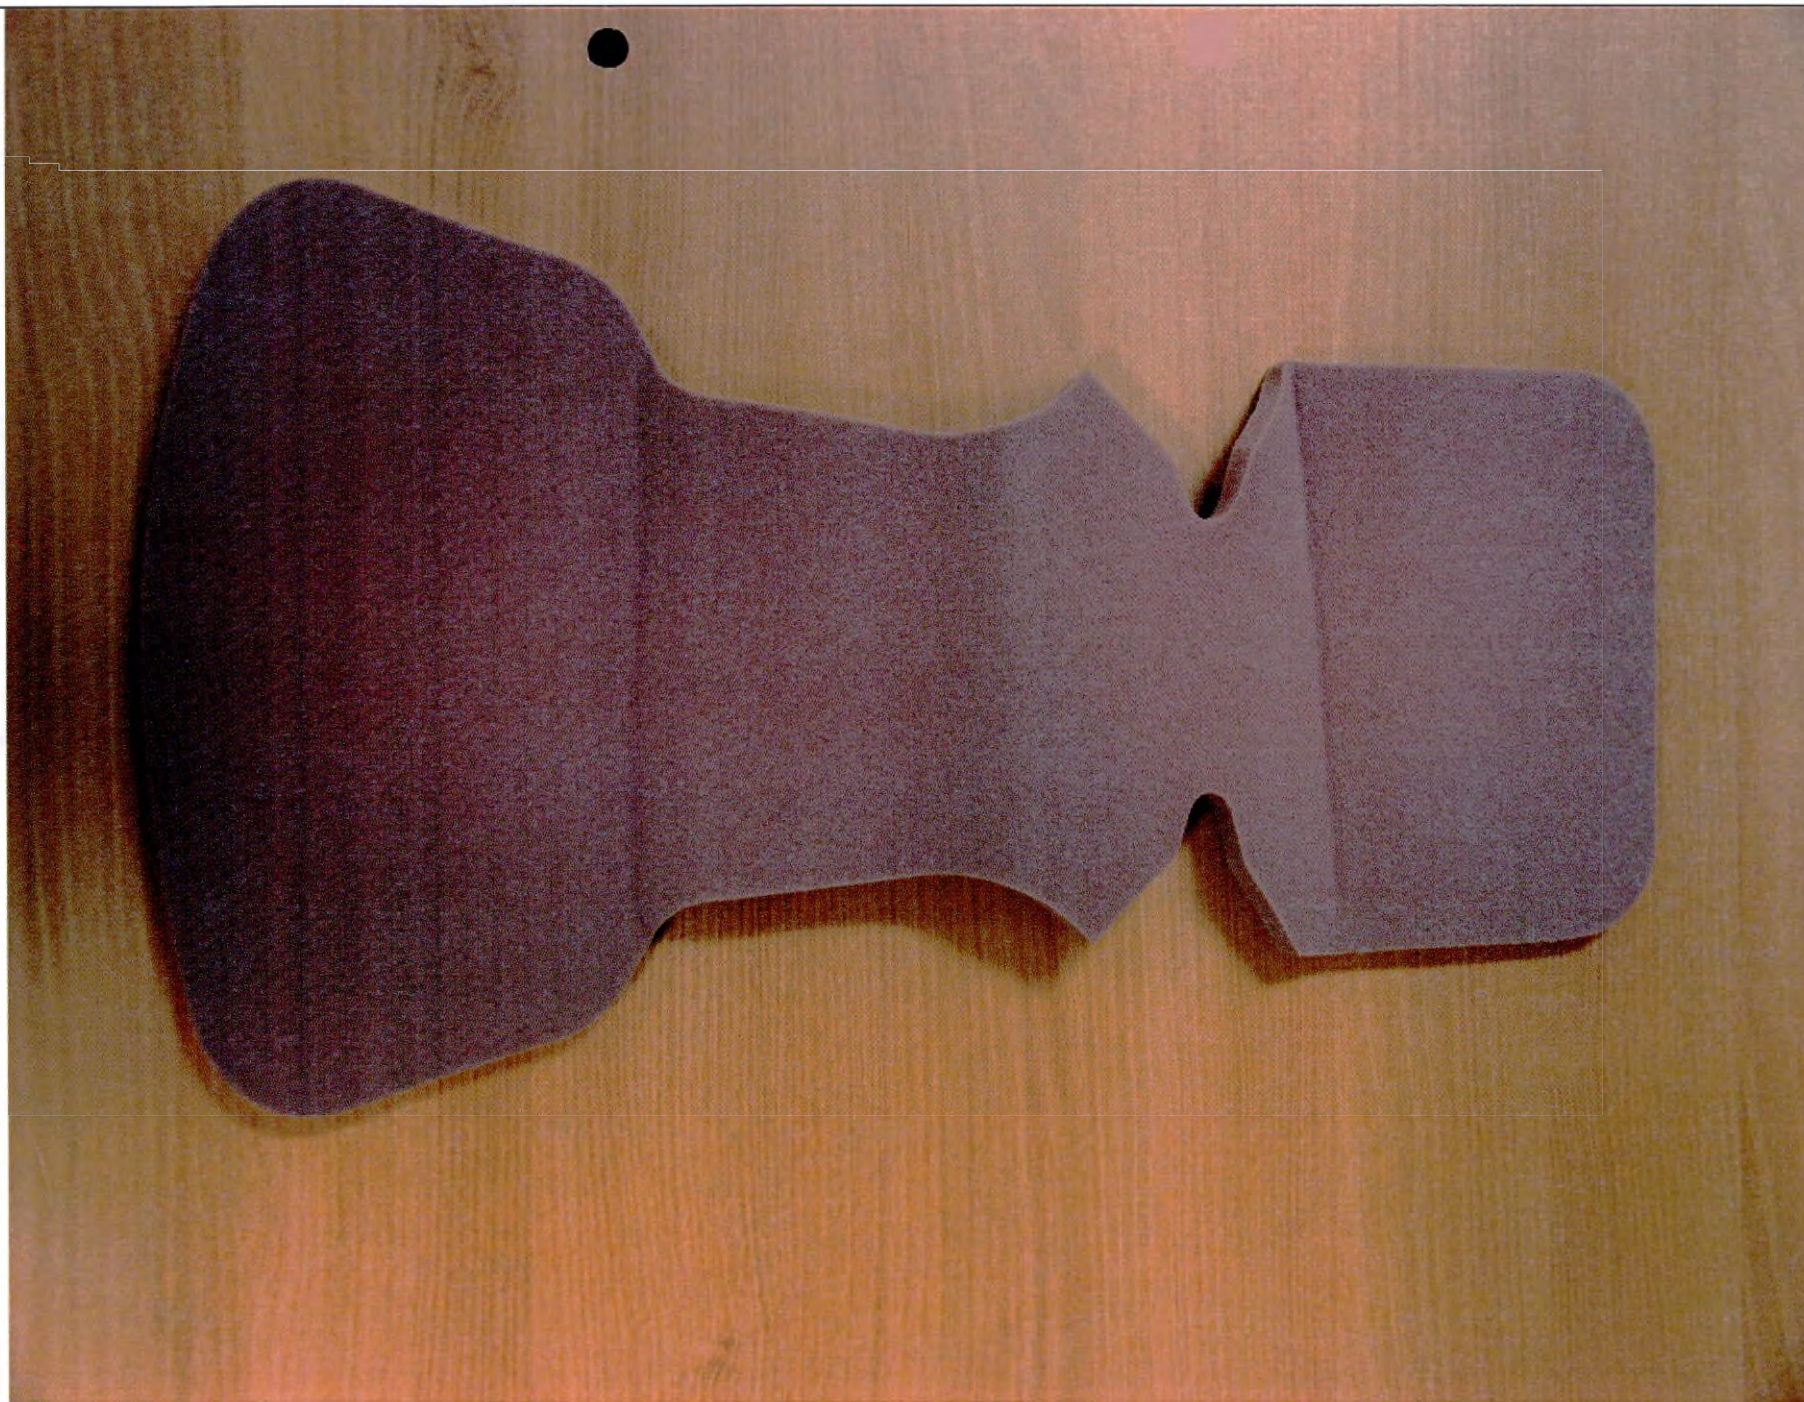

Материал укрывной для позиционера DeMayo для нижних конечностей (стерильный): Прокладка




Материал укрывной для позиционера DeMayo для нижних конечностей (стерильный): Застёжка



Упаковка материала укрывного для позиционера DeMayo для нижних конечностей (стерильного): Штанга, Застежка



Чехол для хранения манипулятора роботизированной системы МАКО, Чехол для хранения модуля управления МАКО.

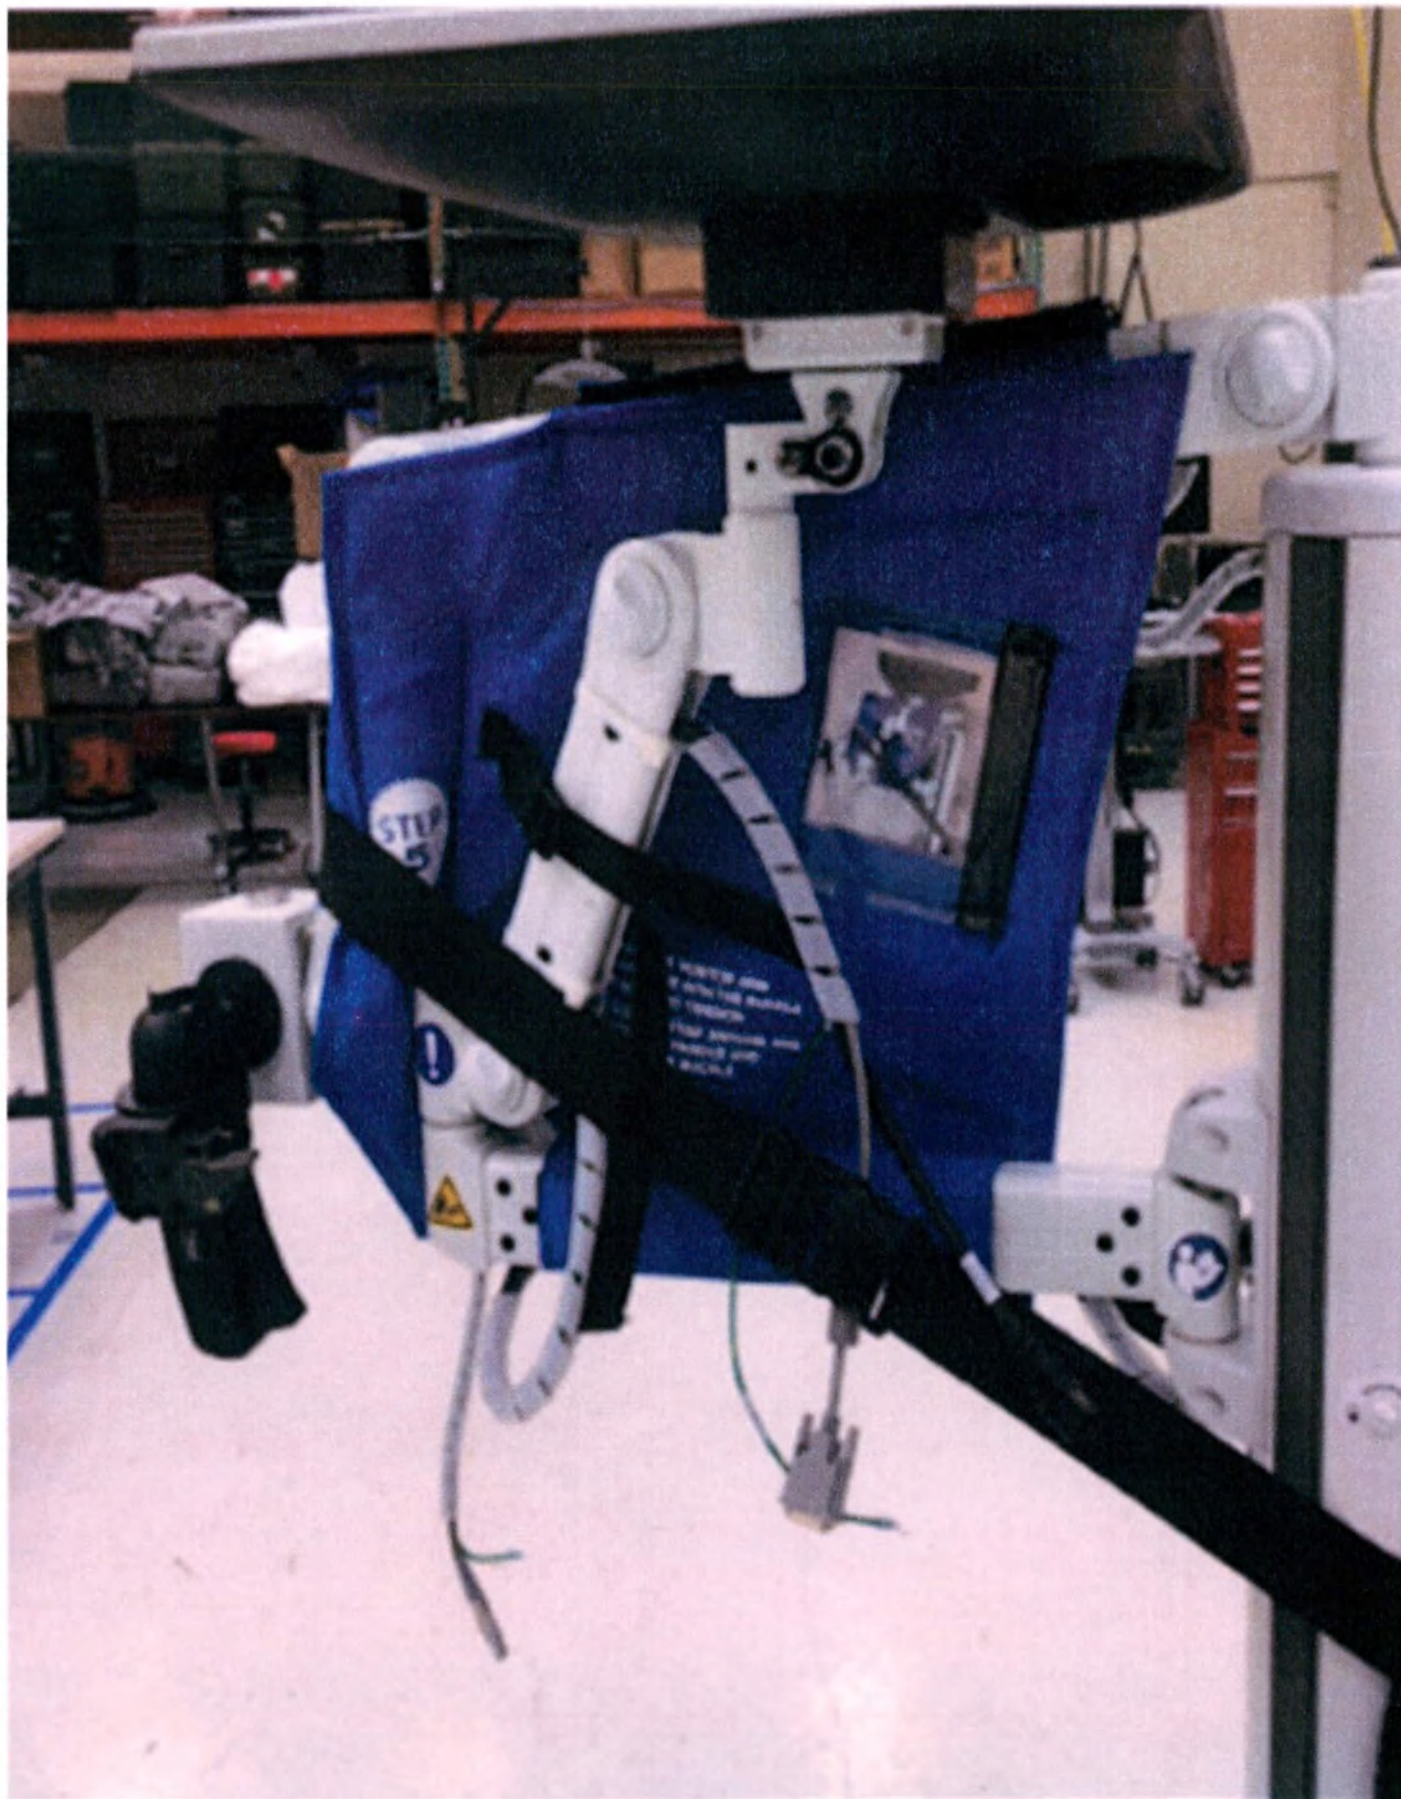

Чехол для хранения стойки камеры MAKO




Мешок для чехлов МАКО



Штанга для томографии




Застежка

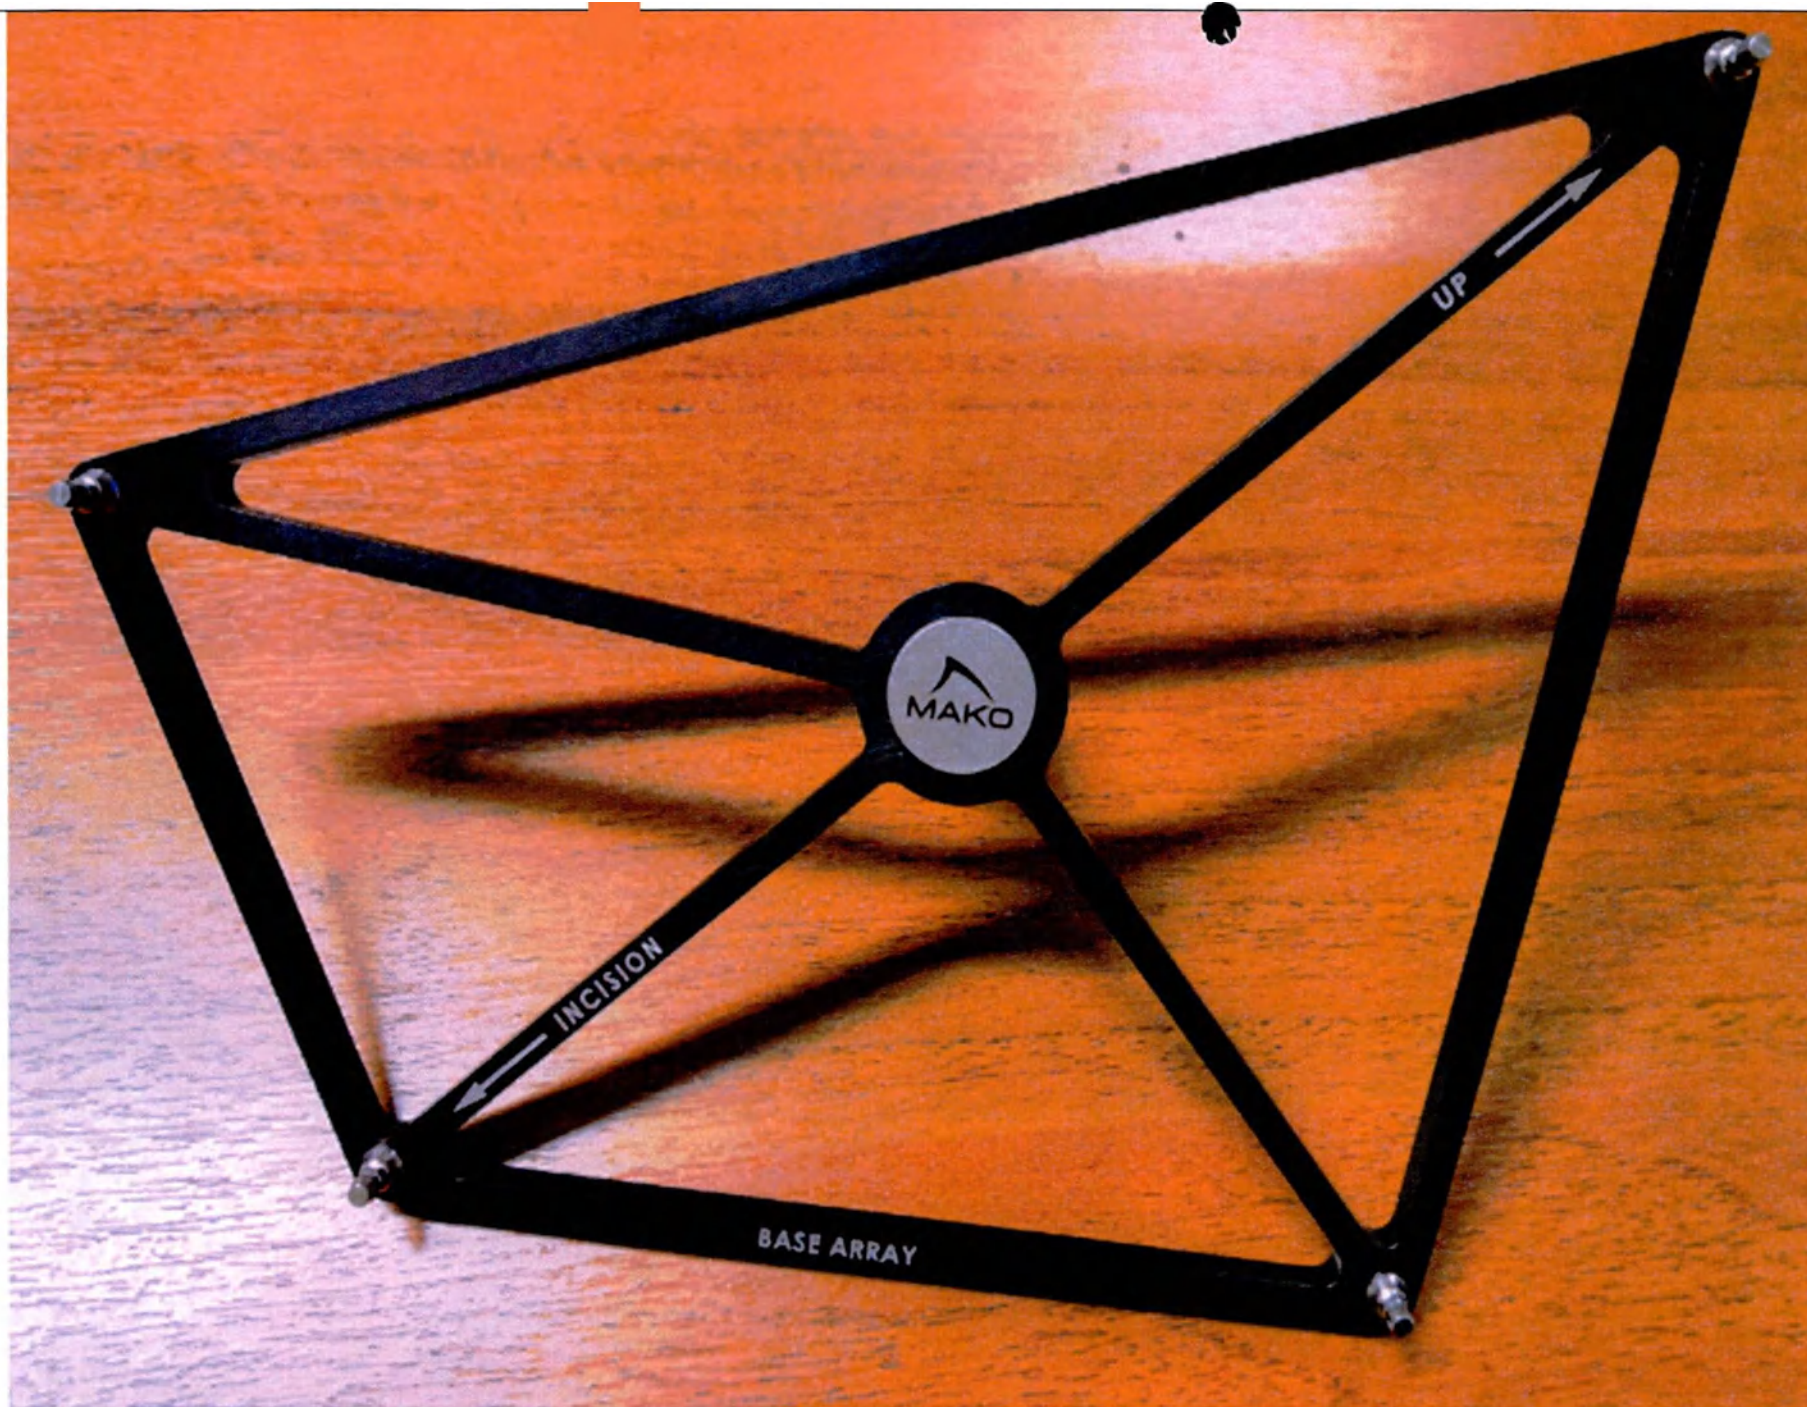

Платформа трекиговая калибровочная



Комплект МАКО для проведения компьютерной томографии коленного сустава для одномышелкового эндопротезирования: штанга для томографии: штанга для томографии

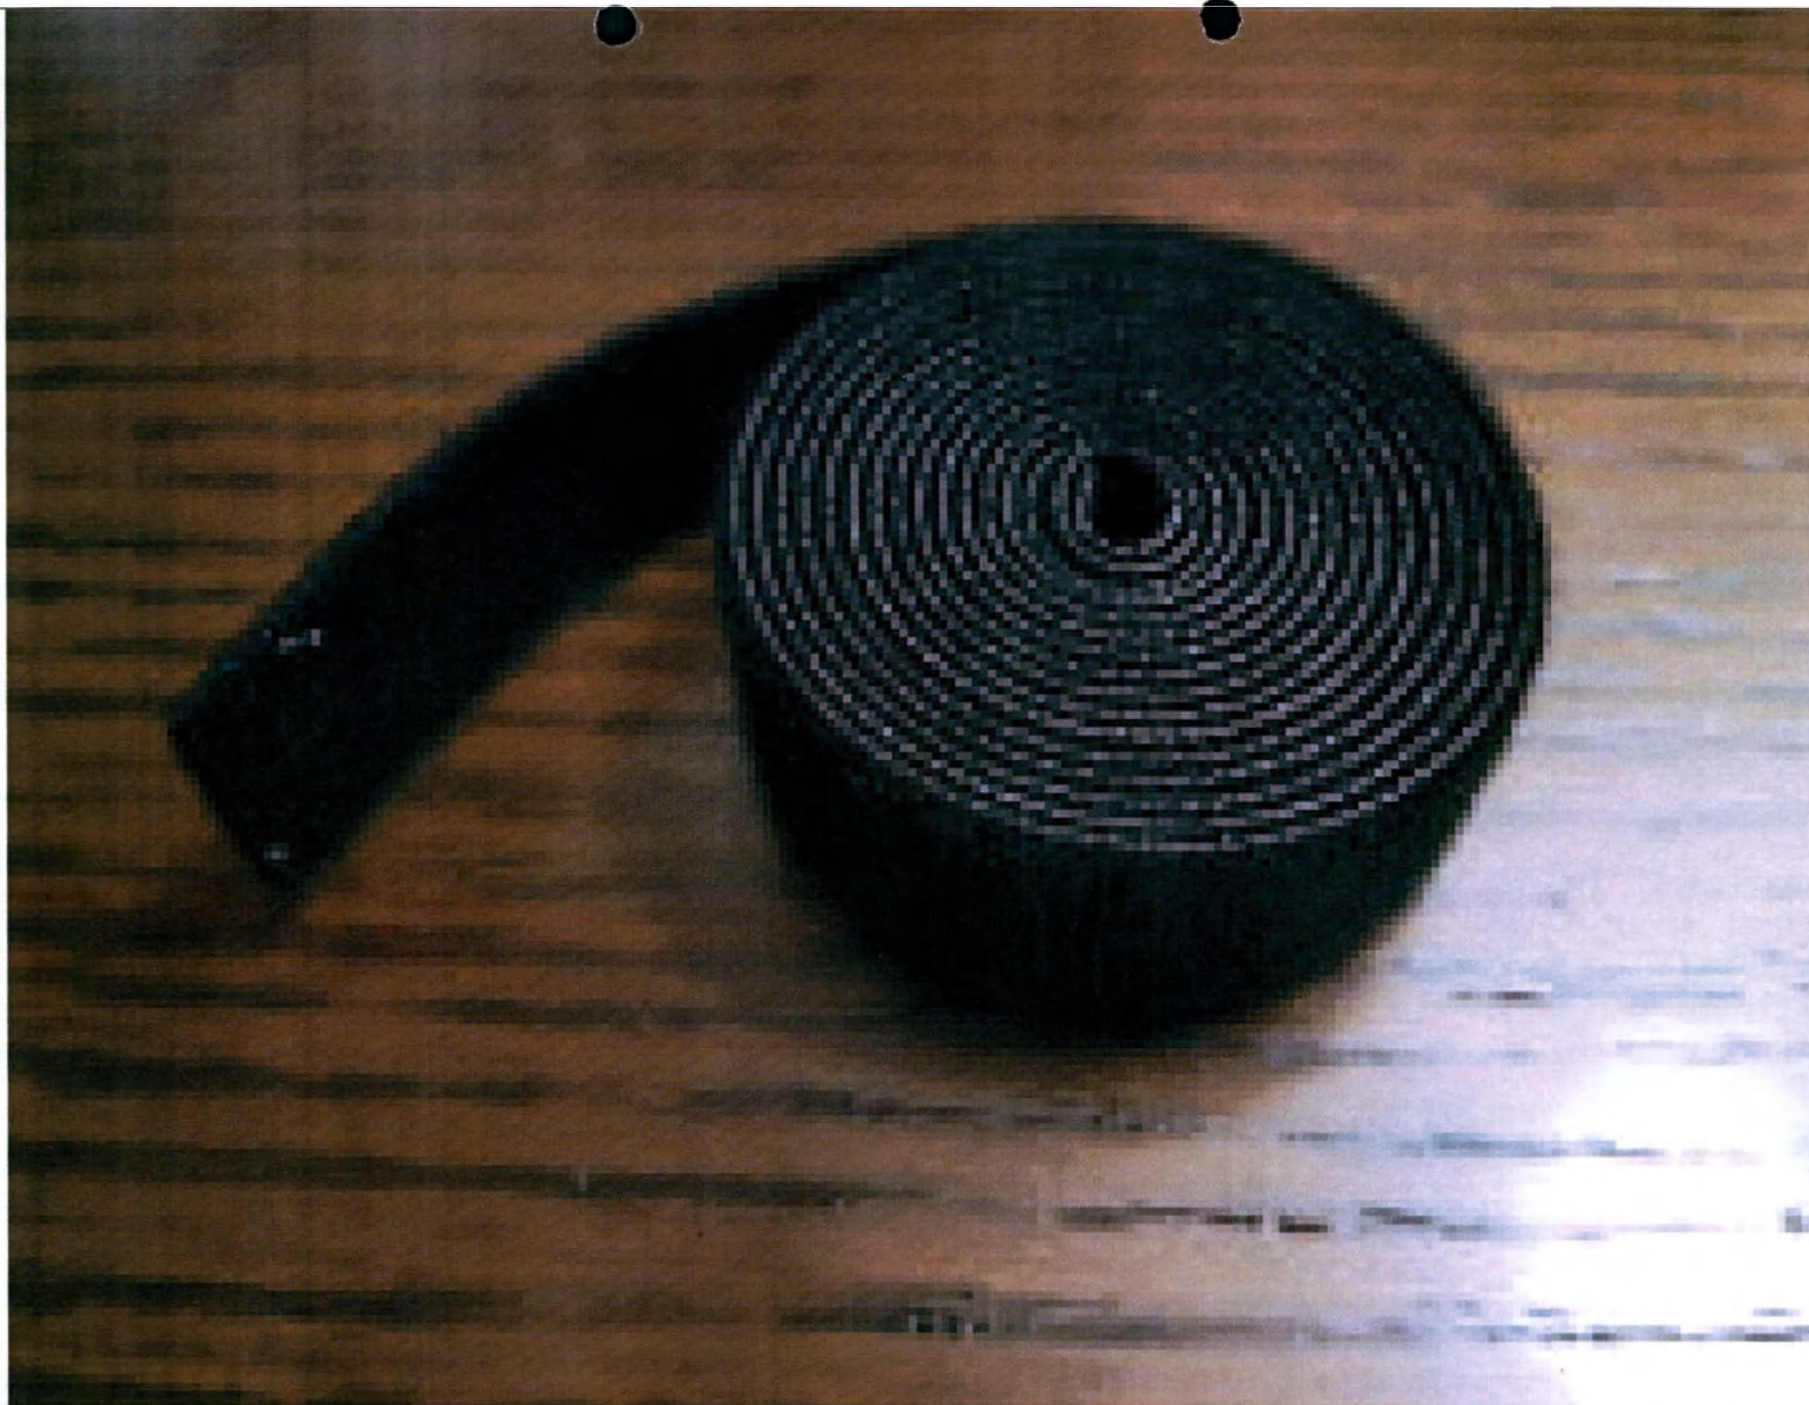


Комплект МАКО для проведения компьютерной томографии коленного сустава для одномышечкового эндопротезирования: штанга для томографии: застежка

MAKO KNEE

stryker

Протокол КТ-сканирования

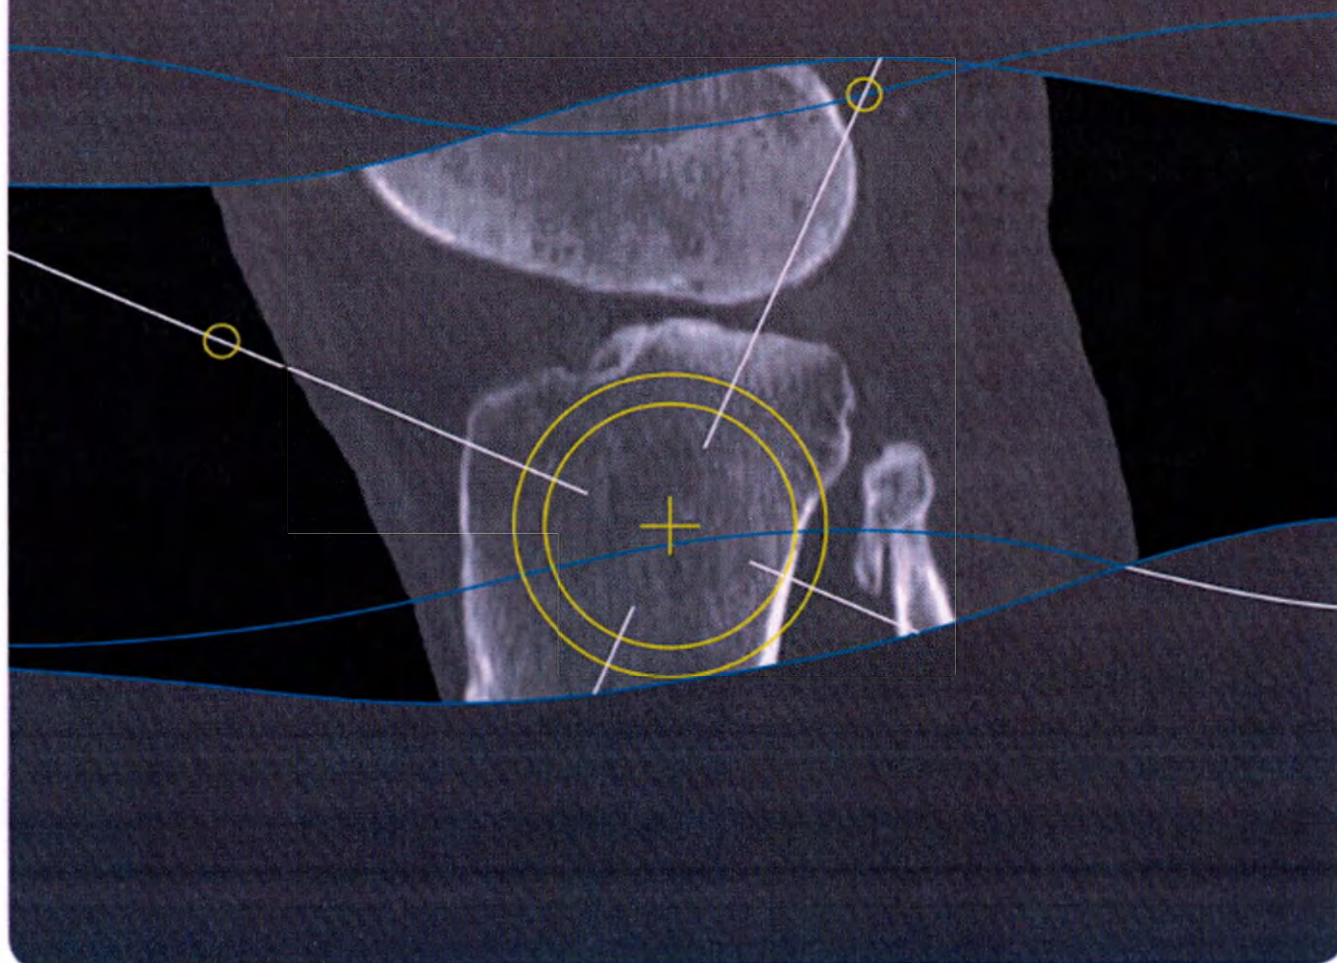


Протокол КТ-сканирования MAKO KNEE.

Mako TNA

stryker

Руководство пользователя приложения

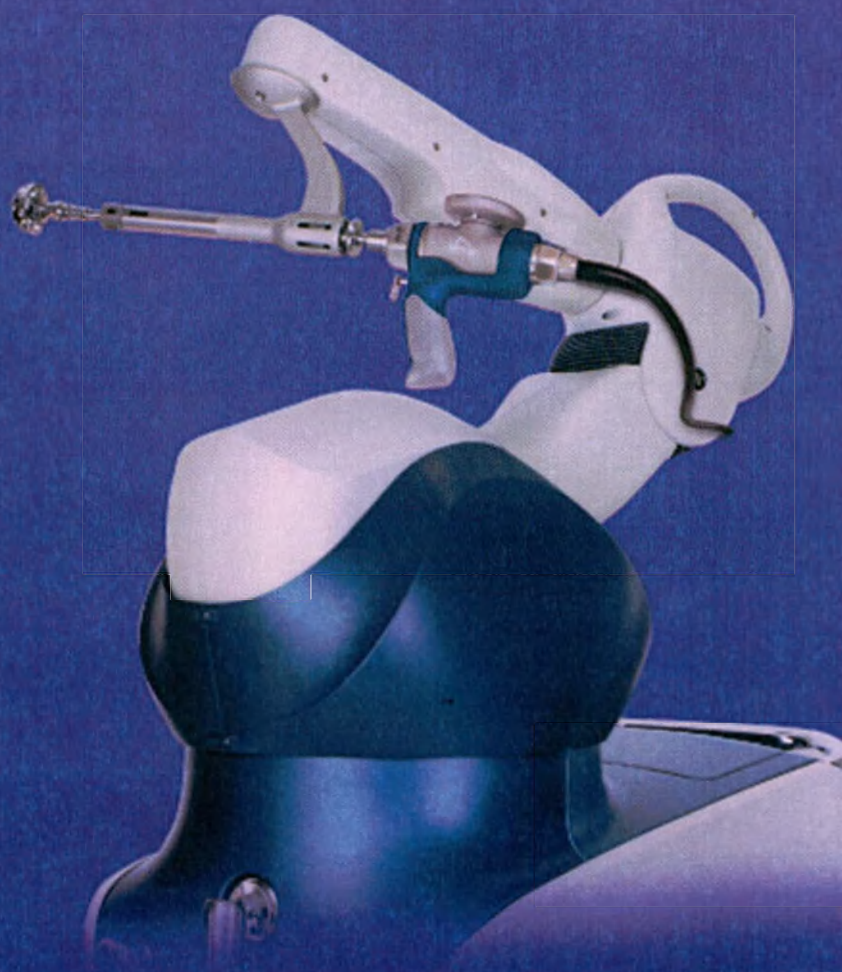


Руководство пользователя приложения МАКО ТНА (версия 4.0)

Mako TNA

stryker

Руководство
для хирурга

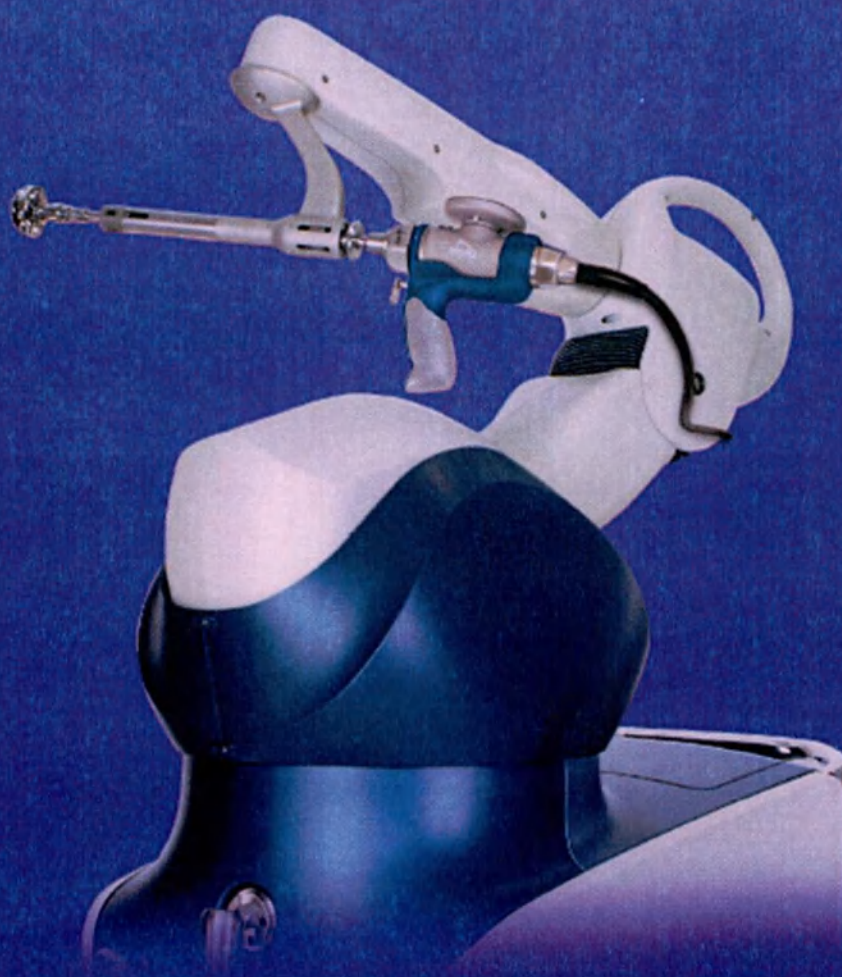

Руководство для хирурга MAKO TNA (версия 4.0)

Mako PКА

stryker

Руководство пользователя приложения




Руководство пользователя приложения МАКО РКА (версия 3.0)

МАКО ТКА

stryker

Руководство пользователя приложения

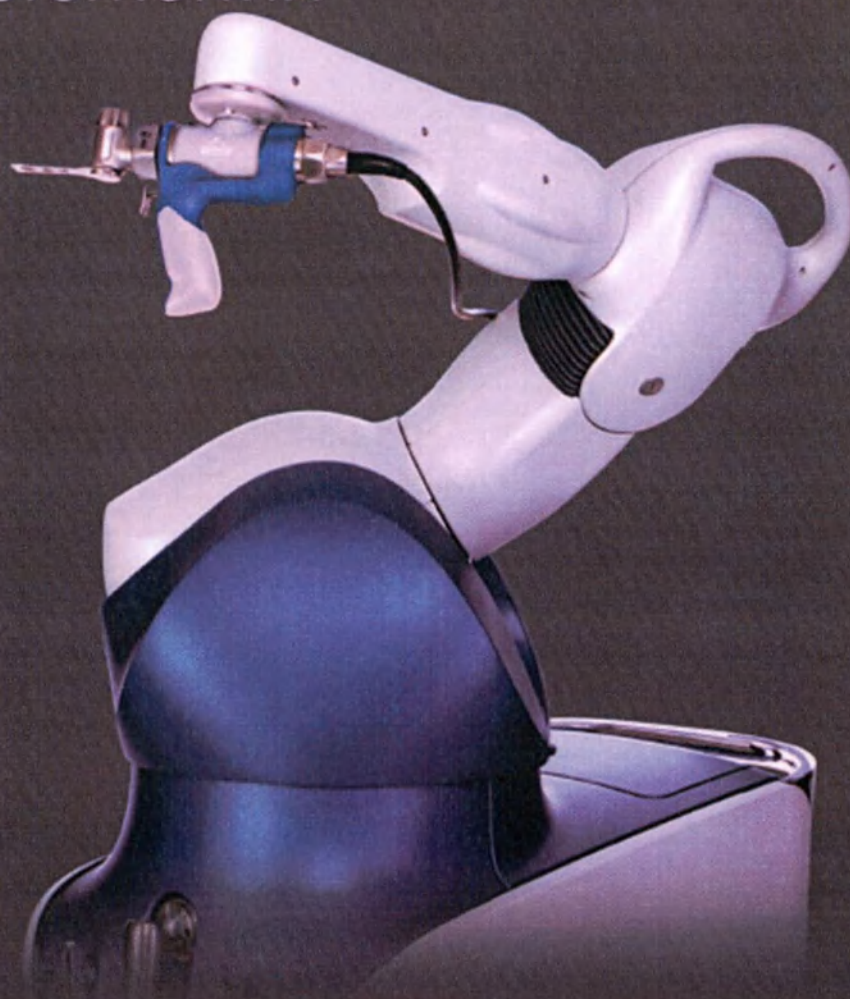

Руководство пользователя приложения МАКО ТКА (версия 1.0)

MAKO

stryker

Техническое руководство пользователя




Техническое руководство пользователя MAKO. Модель 3.1.

MAKO

stryker

Руководство по чистке и стерилизации инструментов

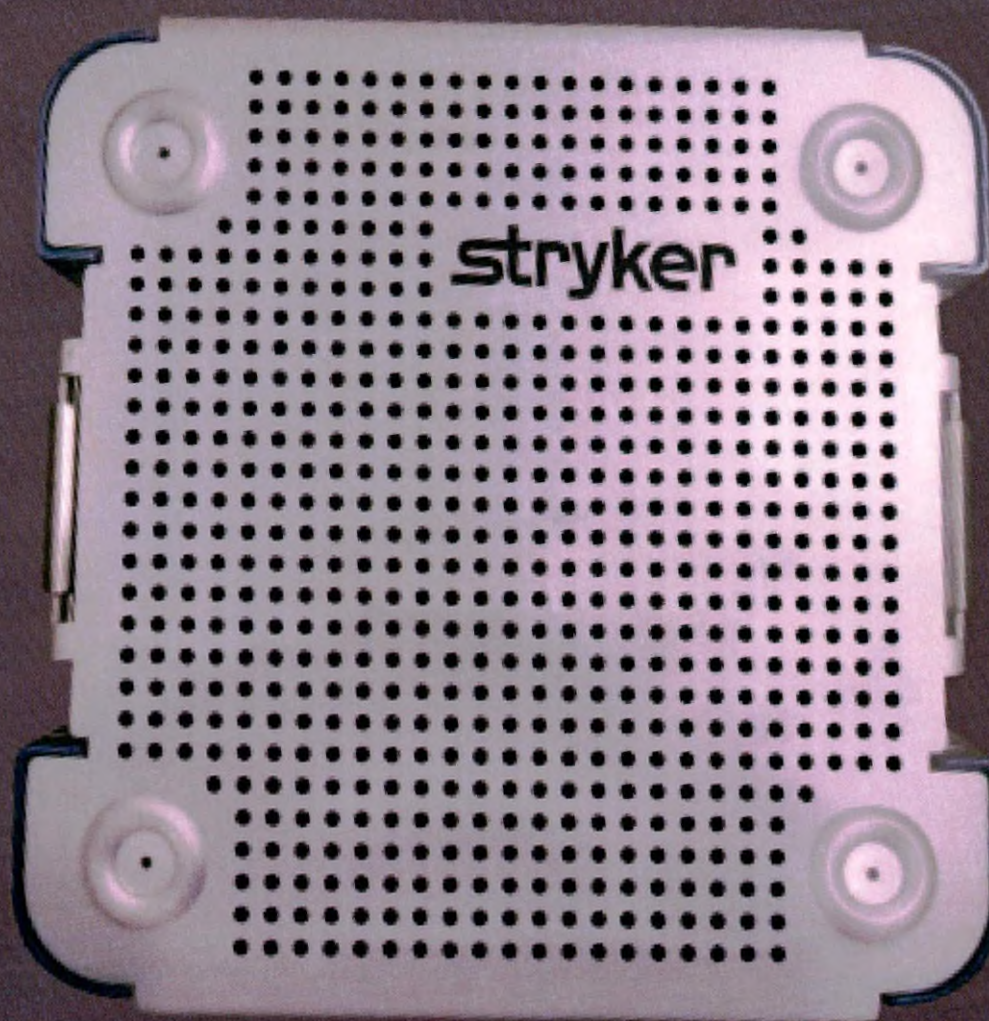

Руководство по очистке и стерилизации инструментов Мако

ПОЗИЦИОНЕР НОГИ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Руководство пользователя. Позиционер ноги

ПОЗИЦИОНЕР НОГИ

Руководство по очистке и стерилизации инструментов




Руководство по очистке и стерилизации инструментов. Позиционер ноги

Mako TNA

stryker

Руководство пользователя приложения

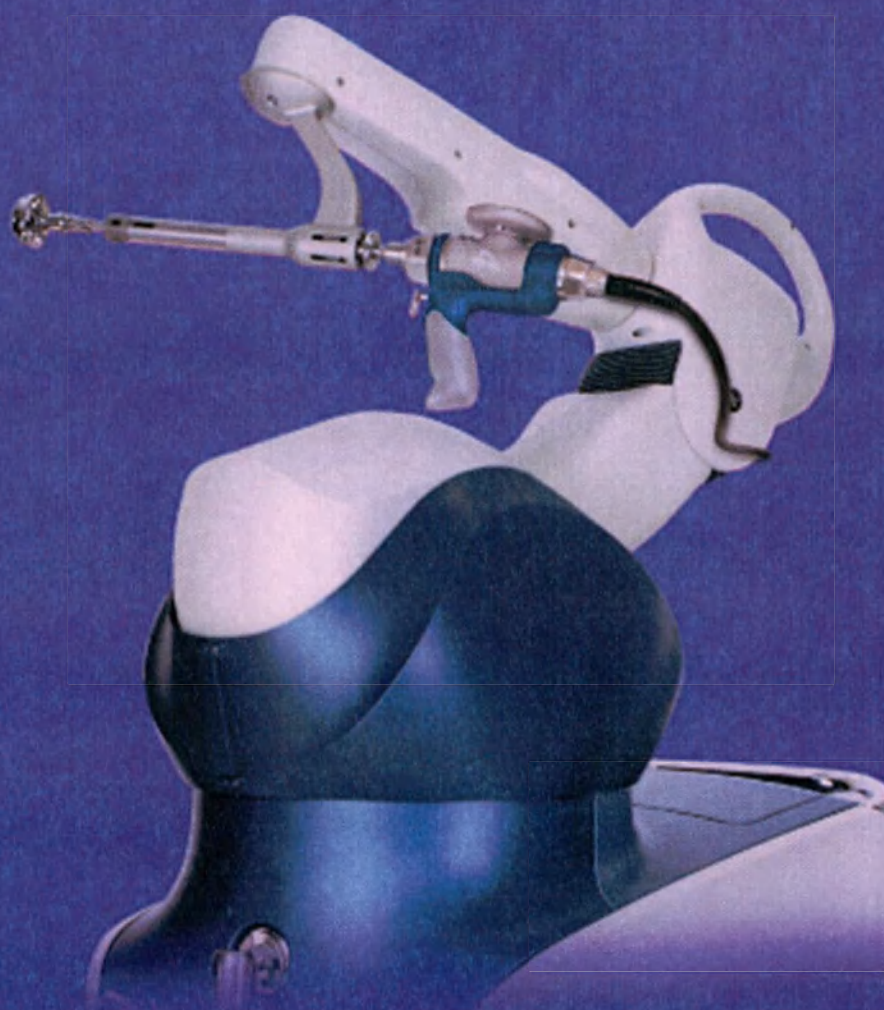


Руководство пользователя приложения Мако ТНА (версия 3.1)

Мако ТНА

stryker

Руководство для хирурга

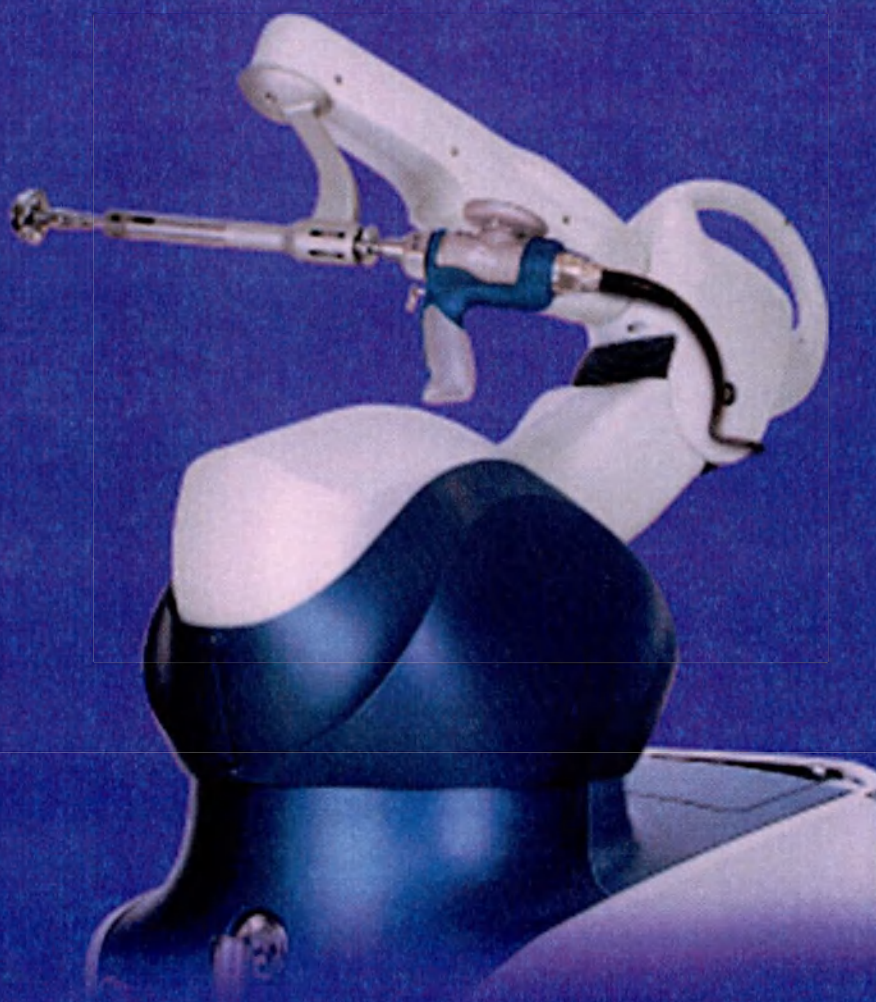


Руководство для хирурга Мако ТНА. (версия ТНА 3.1.x)

Mako THA

stryker®

Протокол КТ-сканирования

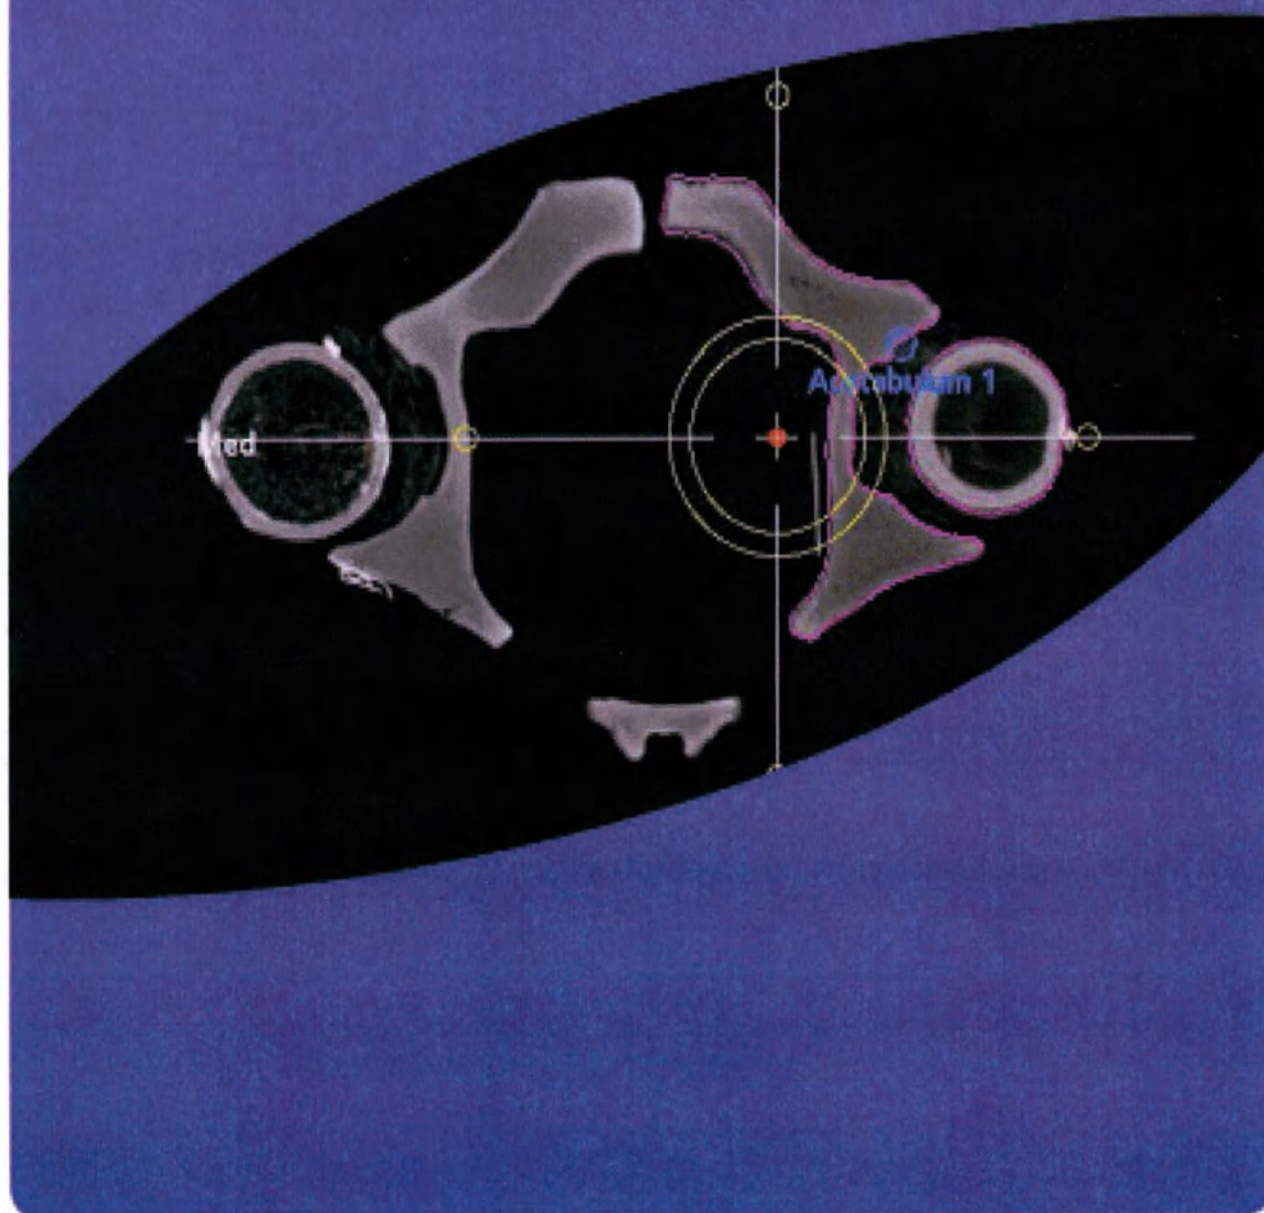

Протокол КТ- сканирования Мако ТНА

Mako PKA

stryker®

RESTORIS® MCK

Руководство
для хирурга



Руководство для хирурга Мако РКА. (версия 3.0)

Дополнение к руководствам пользователя на медицинское изделие

Система роботизированная МАКО для реконструктивных операций

Разработчик:

MAKO Surgical Corp. (МАКО Серджиал Корп.)
3365 Enterprise Avenue, Weston, FL 33331 USA
(3365 Энтерпрайз Аве., Уэстон, Флорида 33331, США)

Производитель:

MAKO Surgical Corp. (МАКО Серджиал Корп.)
3365 Enterprise Avenue, Weston, FL 33331 USA
(3365 Энтерпрайз Аве., Уэстон, Флорида 33331, США)

Место производства медицинского изделия:

1. MAKO Surgical Corp., 3365 Enterprise Avenue, Weston, FL 33331 USA (США)
2. Microtek Medical, Inc, 602 Lehmborg Road Columbus, MS 39702 USA (США);
3. Innovative Medical Products Inc, 87 Spring Lane Plainville Connecticut 06062, USA (США).

Официальный представитель производителя в России:

ООО «Страйкер» (Stryker LLC)
125167, город Москва, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80,
этаж 3, часть помещения 1
+7 (495) 785 07 68

Дополнение к руководствам пользователя на медицинское изделие

REF

stryker®

№ РЗН

от

года

Система роботизированная МАКО для реконструктивных операций

Место производства:

XXXXXXXXXX

Производитель:

MAKO Surgical Corp.

3365 Enterprise Avenue,
Weston, FL 33331 USA



Пример проекта маркировки для продажи изделия на территории Российской Федерации



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 70 листа (ов)
Менеджер по регистрации и контролю
качества ООО «Страйкер»



А.В. Моисеева
Дата: 26.05.2023 г.