



Согласовано

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ –
Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)

Организация

Россия, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, 7, стр. 4

Адрес

Генеральный директор

Должность

Мартин Пьер Колас

Фамилия, Имя

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись/Signature



Фотографические изображения

Видеоуретерореноскоп гибкий FLEX-XC1 одноразовый в вариантах исполнения

2023

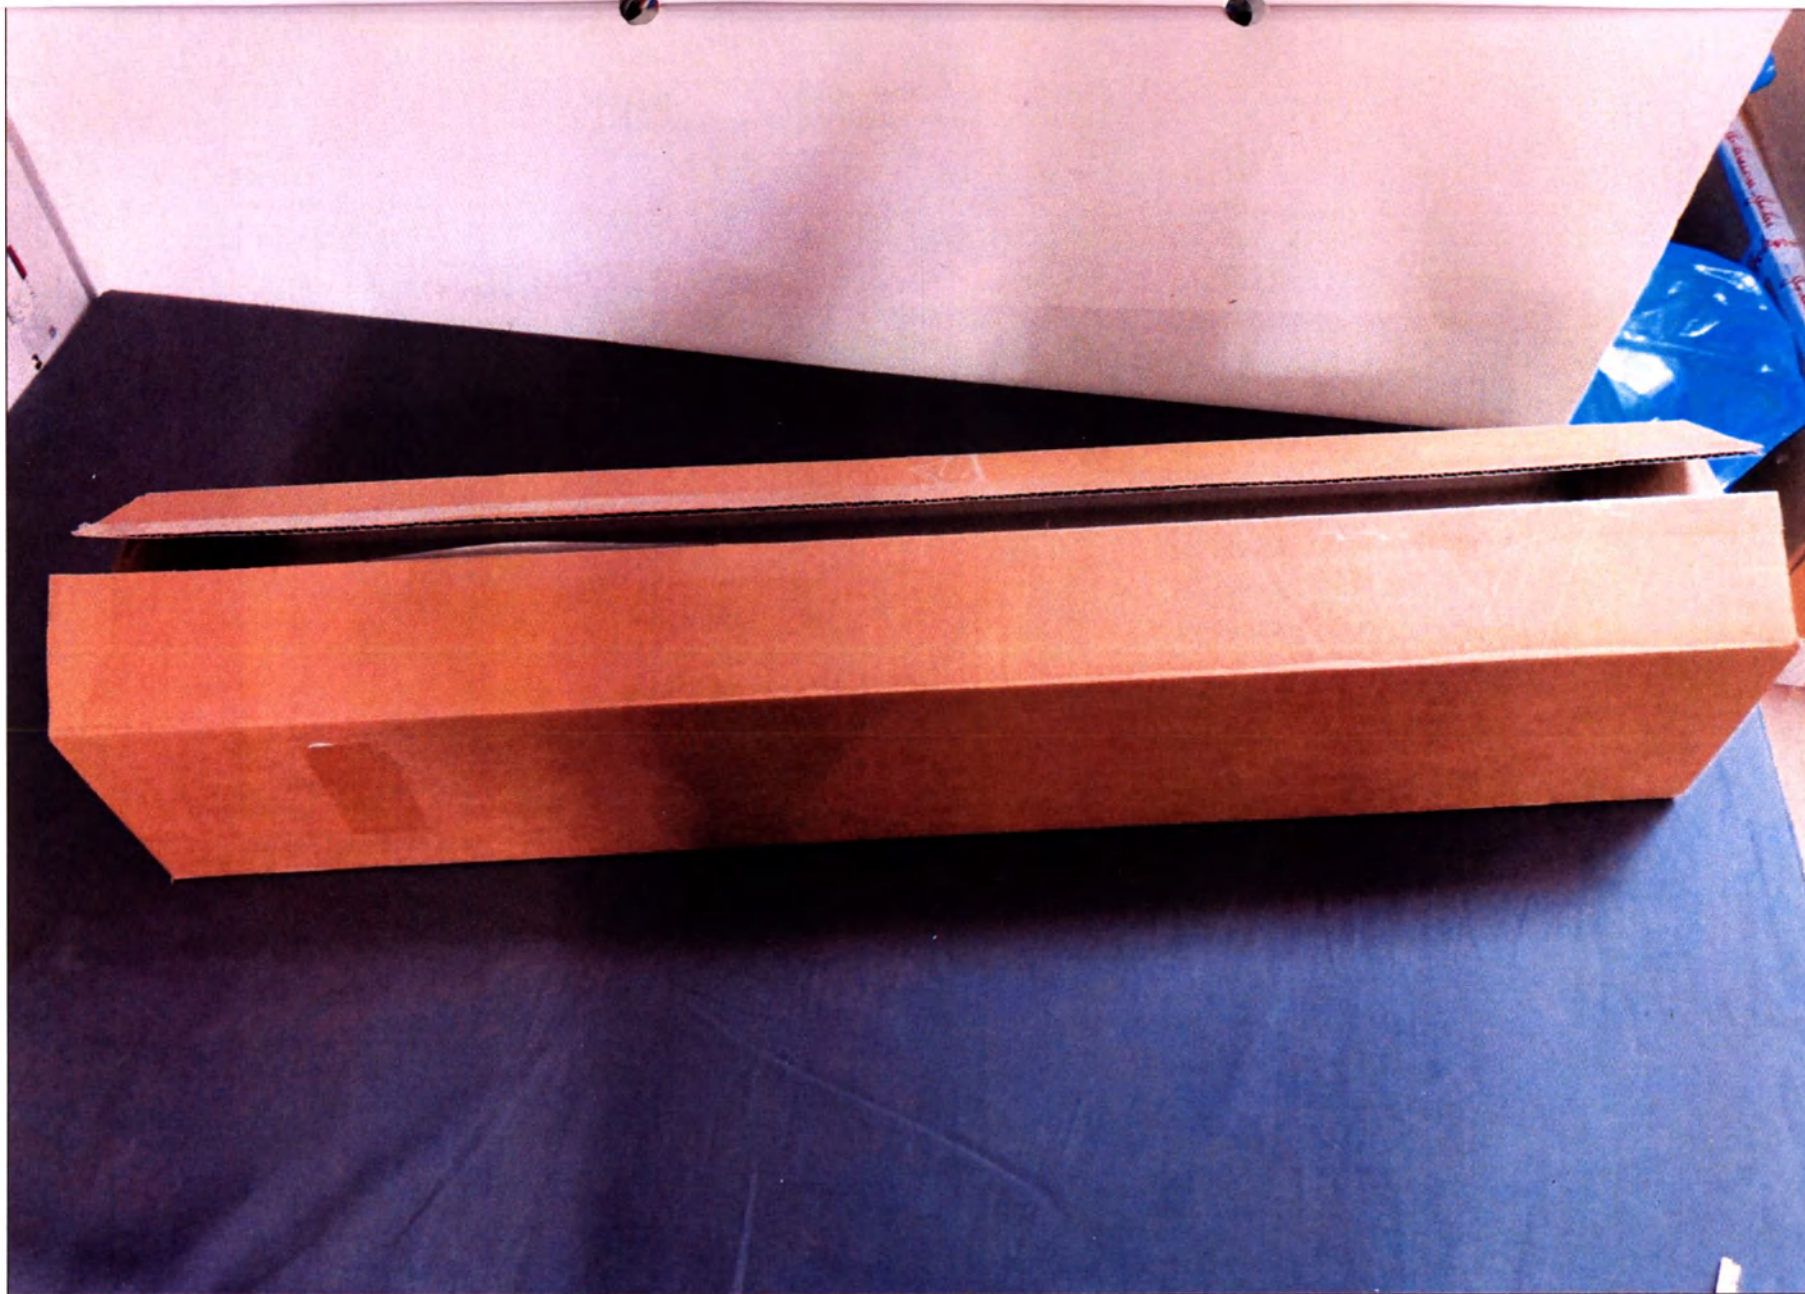


Рис. 1. Видеоуретерореноскоп гибкий FLEX-XC1 одноразовый в вариантах исполнения Транспортная упаковка.



KARL STORZ SE & CO. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ ENDOSKOPE

9 Fr / 3.5 Fr x 70 cm

REF 091279-06

LOT 500081039

QTY 1




5°C 25°C



de Video-Uretero-Renoskop FLEX-XC1
en Video Uretero-Renoscope FLEX-XC1
fr Vidéo-urétéro-néphroscope FLEX-XC1
it Video-uretero-renoscopio FLEX-XC1
es Videoureterorenoscopio FLEX-XC1
pt Videoureterorenoscópio FLEX-XC1

60% 15%



STERILE EO



2024-05-09

Rx only MD




2022-11-09

www.karlstorz.com/ifu

CE 0123

UDI (01)04048551428030(11)221109(17)240509(10)500081039(422)203

Рис. 2. Видеоуретерореноскоп гибкий FLEX-XC1 одноразовый в вариантах исполнения. Маркировка на транспортной упаковке.

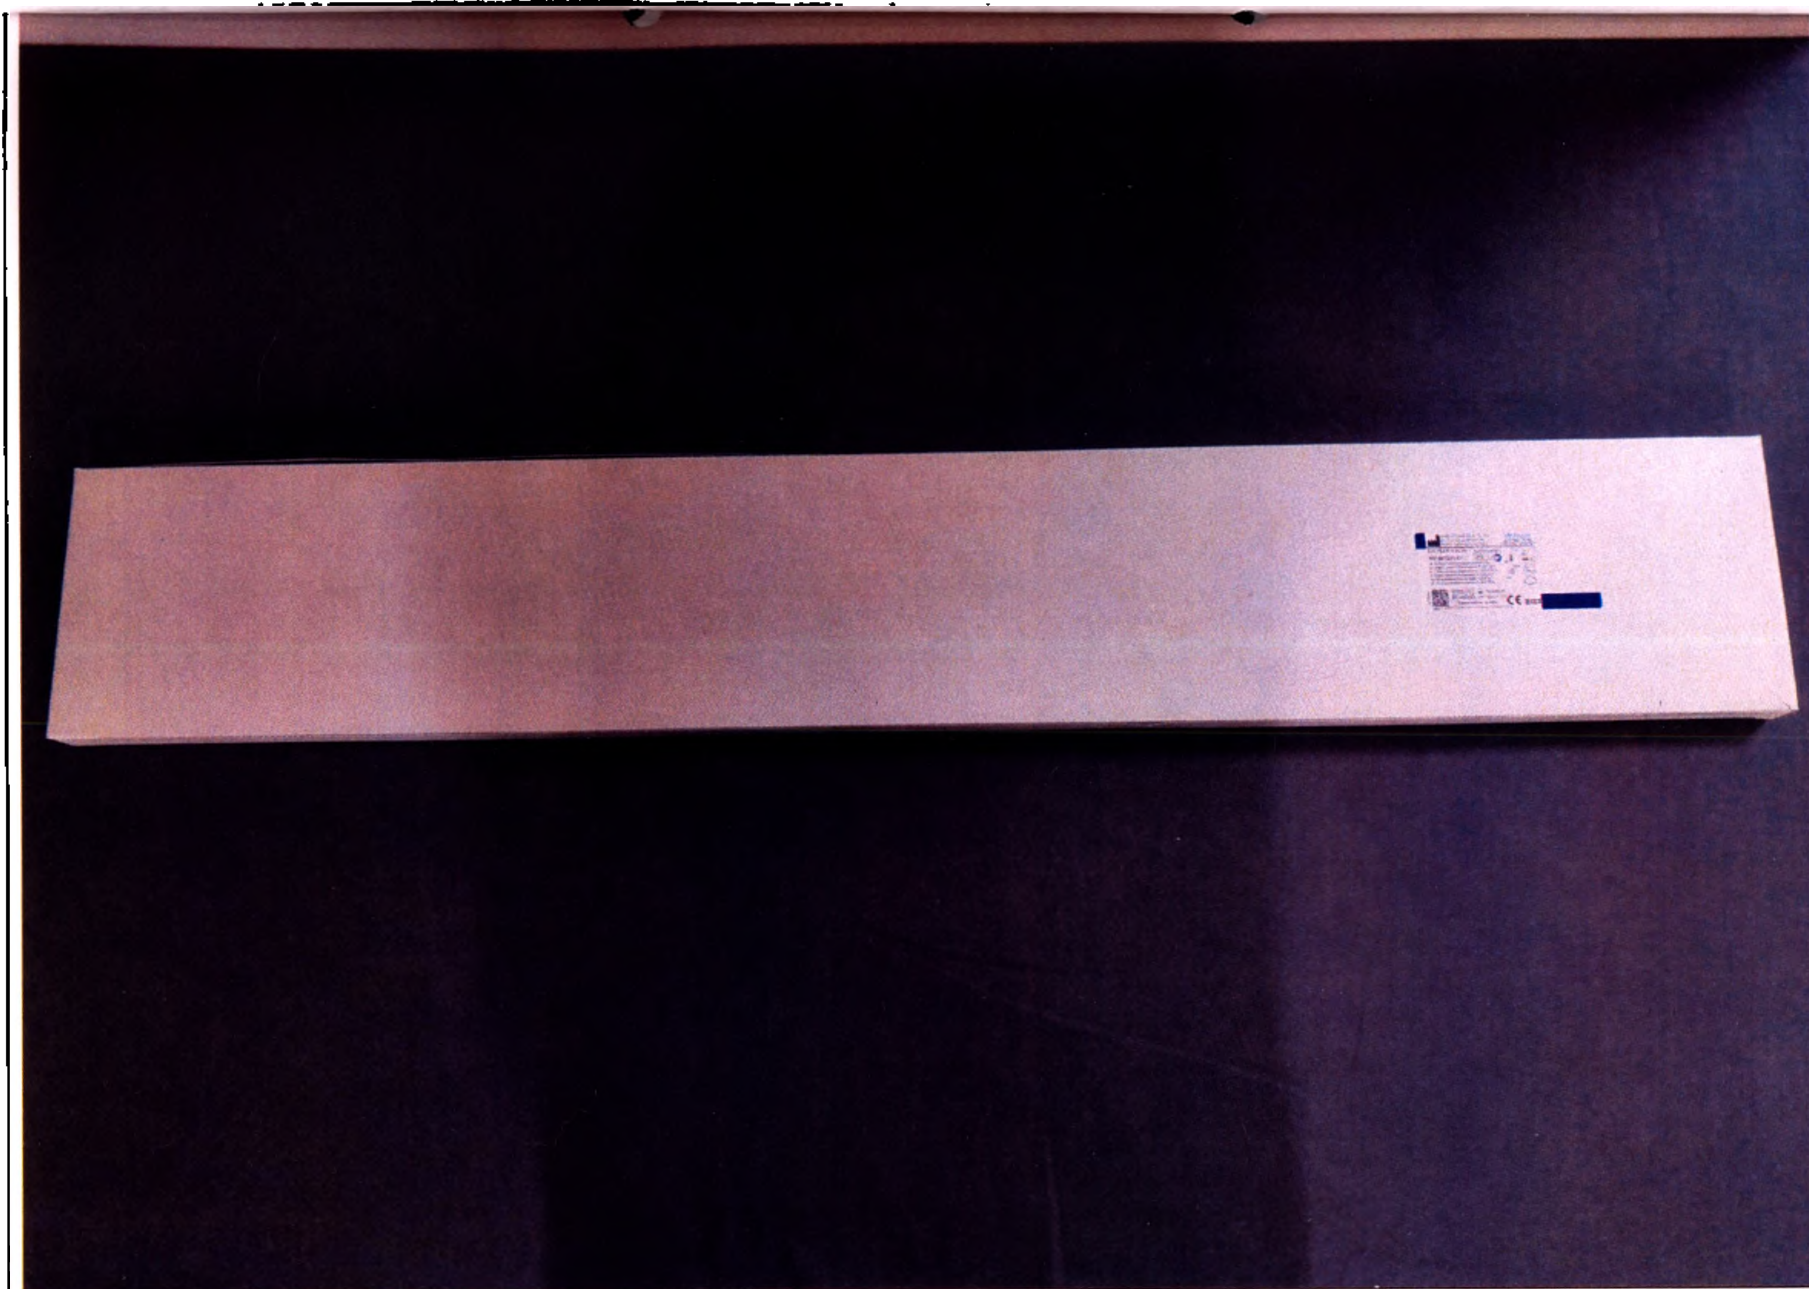

**Рис. 3. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, позитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fг / 3,5 Fг × 70 см).
Вторичная упаковка**



KARL STORZ SE & Co. KG
 Dr.-Karl-Storz-Straße 34
 78532 Tuttlingen/Germany



KARL STORZ ENDOSKOPE


9 Fr / 3.5 Fr x 70 cm

LOT 500080311

REF 091271-01

QTY 1

de Video-Uretero-Renoskop FLEX-XC1
 en Video Uretero-Renoscope FLEX-XC1
 fr Vidéo-urétéro-néphroscope FLEX-XC1
 it Video-uretero-renoscopio FLEX-XC1
 es Videoureterorenoscopio FLEX-XC1
 pt Videoureterorenoscópio FLEX-XC1

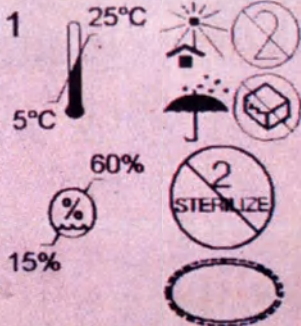

LV020002



STERILE EO

Rx only MD


www.karlstorz.com/ifu


 2024-04-27



 2022-10-27


 0123



UDI (01)04048551428016(11)221027(17)240427(10)500080311(422)203

Рис. 4. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, позитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см).
Маркировка на вторичной упаковке

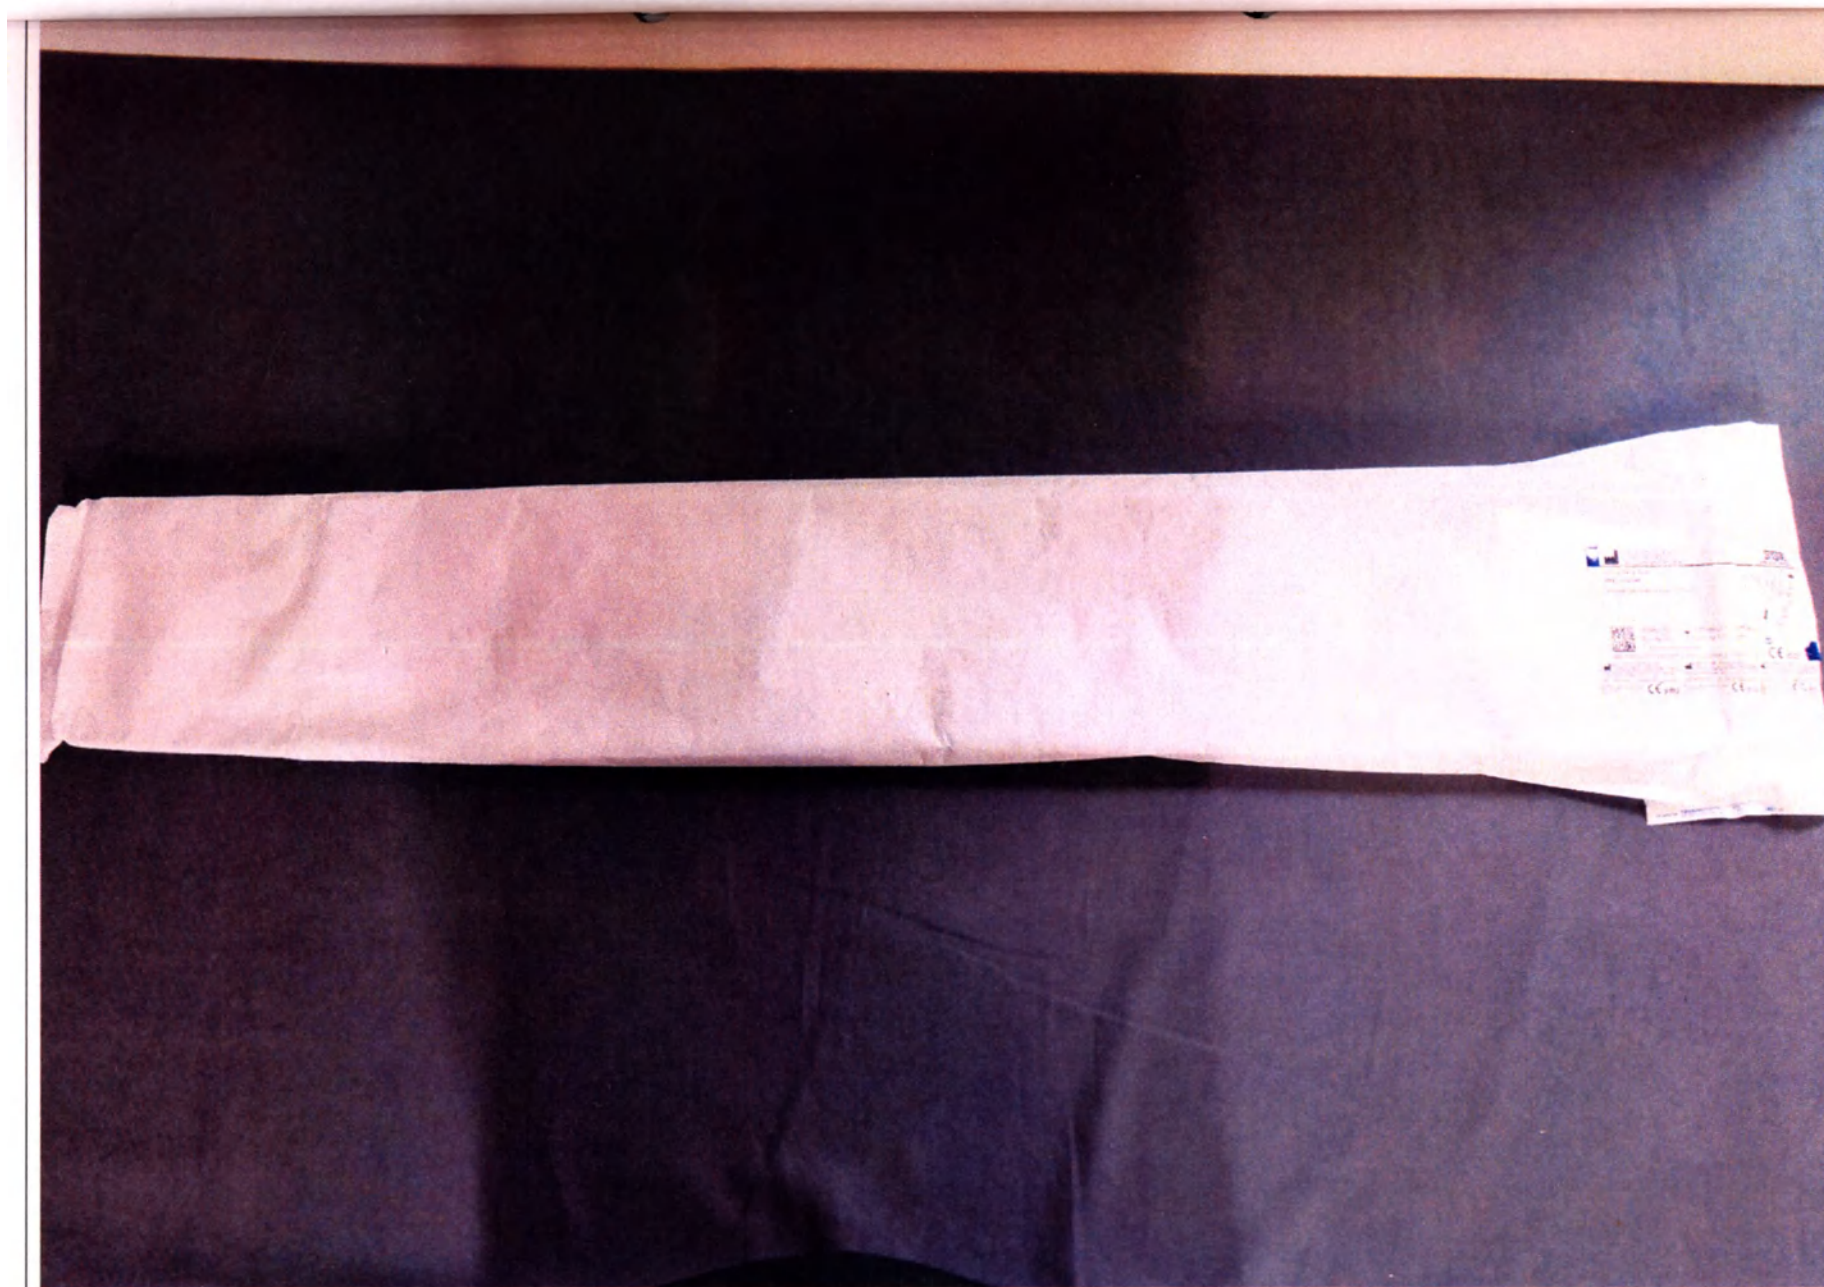

**Рис. 5. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, позитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см).
Первичная упаковка**


KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ - ENDOSKOPE

9 Fr / 3.5 Fr x 70 cm

REF 091271-01

en Video Uretero-Renoscope FLEX-XC1

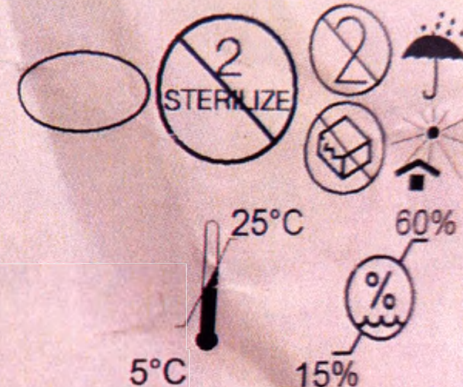

LV020002

STERILE EO

Rx only MD

www.karlstorz.com/ifu

2024-04-27

2022-10-27

LOT 500080311

QTY 1

UDI(01)04048551428016(11)221027(17)240427(10)500080311(422)203

CE 0123

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany

9 Fr / 3.5 Fr x 70 cm QTY 1 LOT 500080311

REF 091271-01

Video Uretero-Renoscope FLEX-XC1

STERILE EO 2024-04-27 CE 0123

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany

9 Fr / 3.5 Fr x 70 cm QTY 1 LOT 500080311

REF 091271-01

Video Uretero-Renoscope FLEX-XC1

STERILE EO 2024-04-27 CE 0123

KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany

9 Fr / 3.5 Fr x 70 cm QTY 1 LOT 500080311

REF 091271-01

Video Uretero-Renoscope FLEX-XC1

STERILE EO 2024-04-27 CE 0123

Рис. 6. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, позитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см).
Маркировка на первичной упаковке



Рис. 7. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, позитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см)

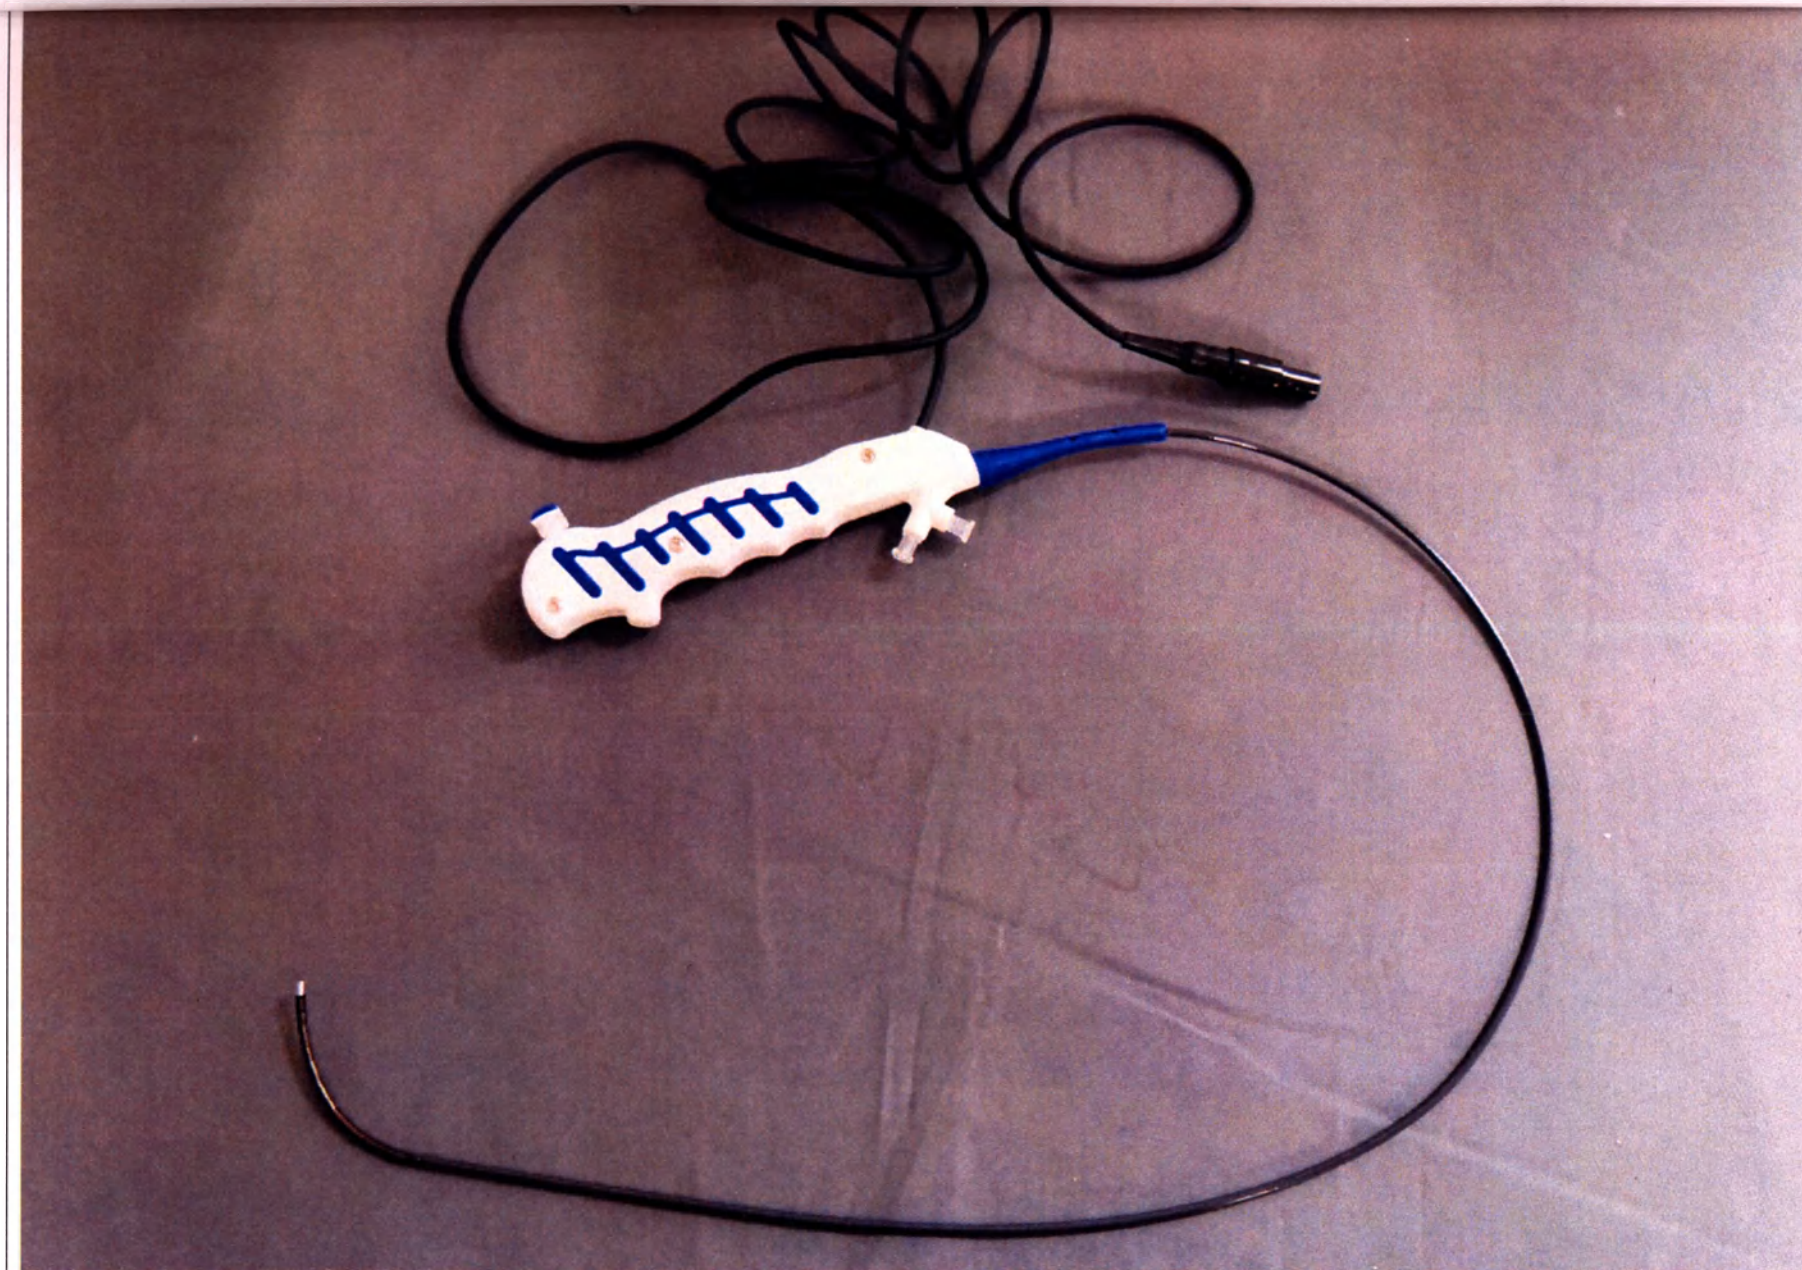


Рис. 8. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, позитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см)



Рис. 9. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, позитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см)

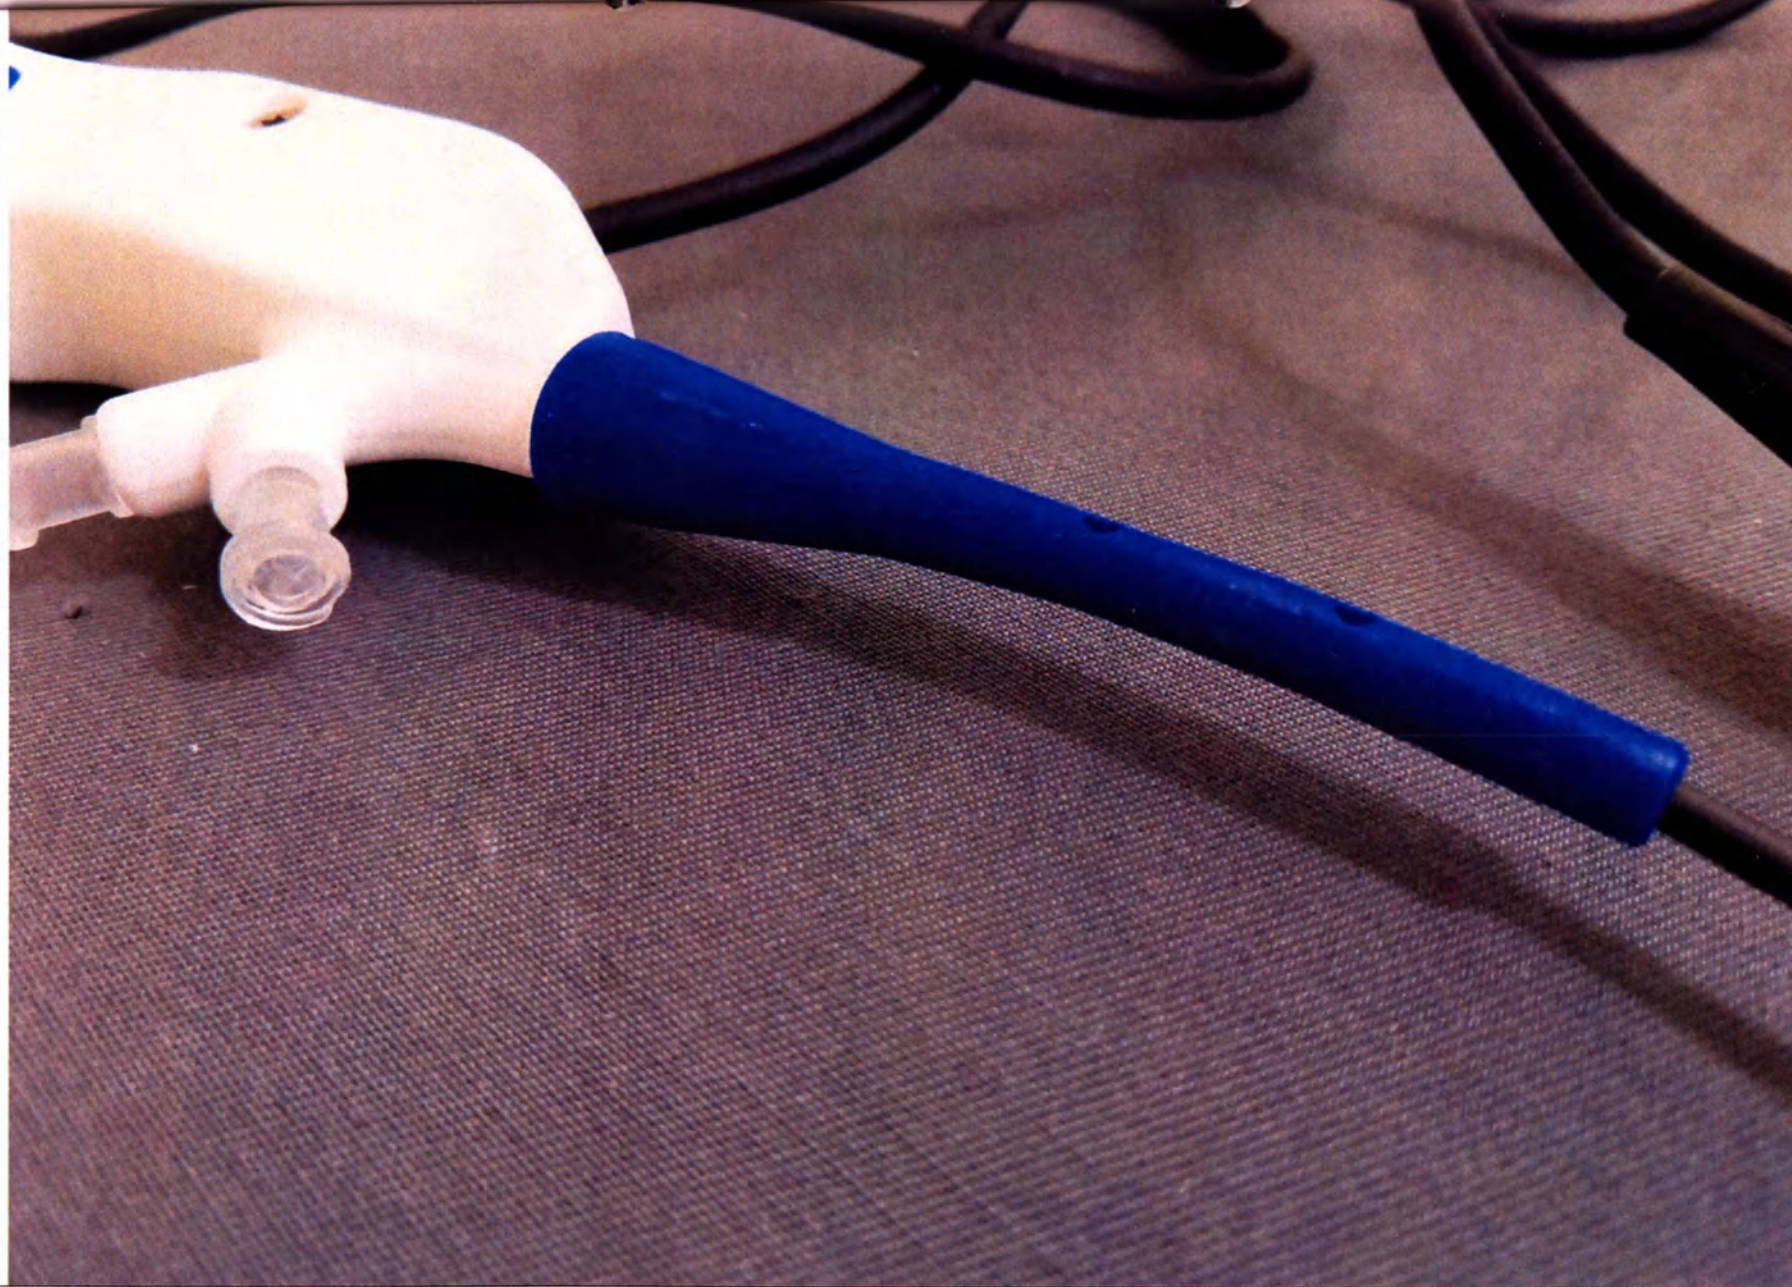


Рис. 10. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, позитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см)

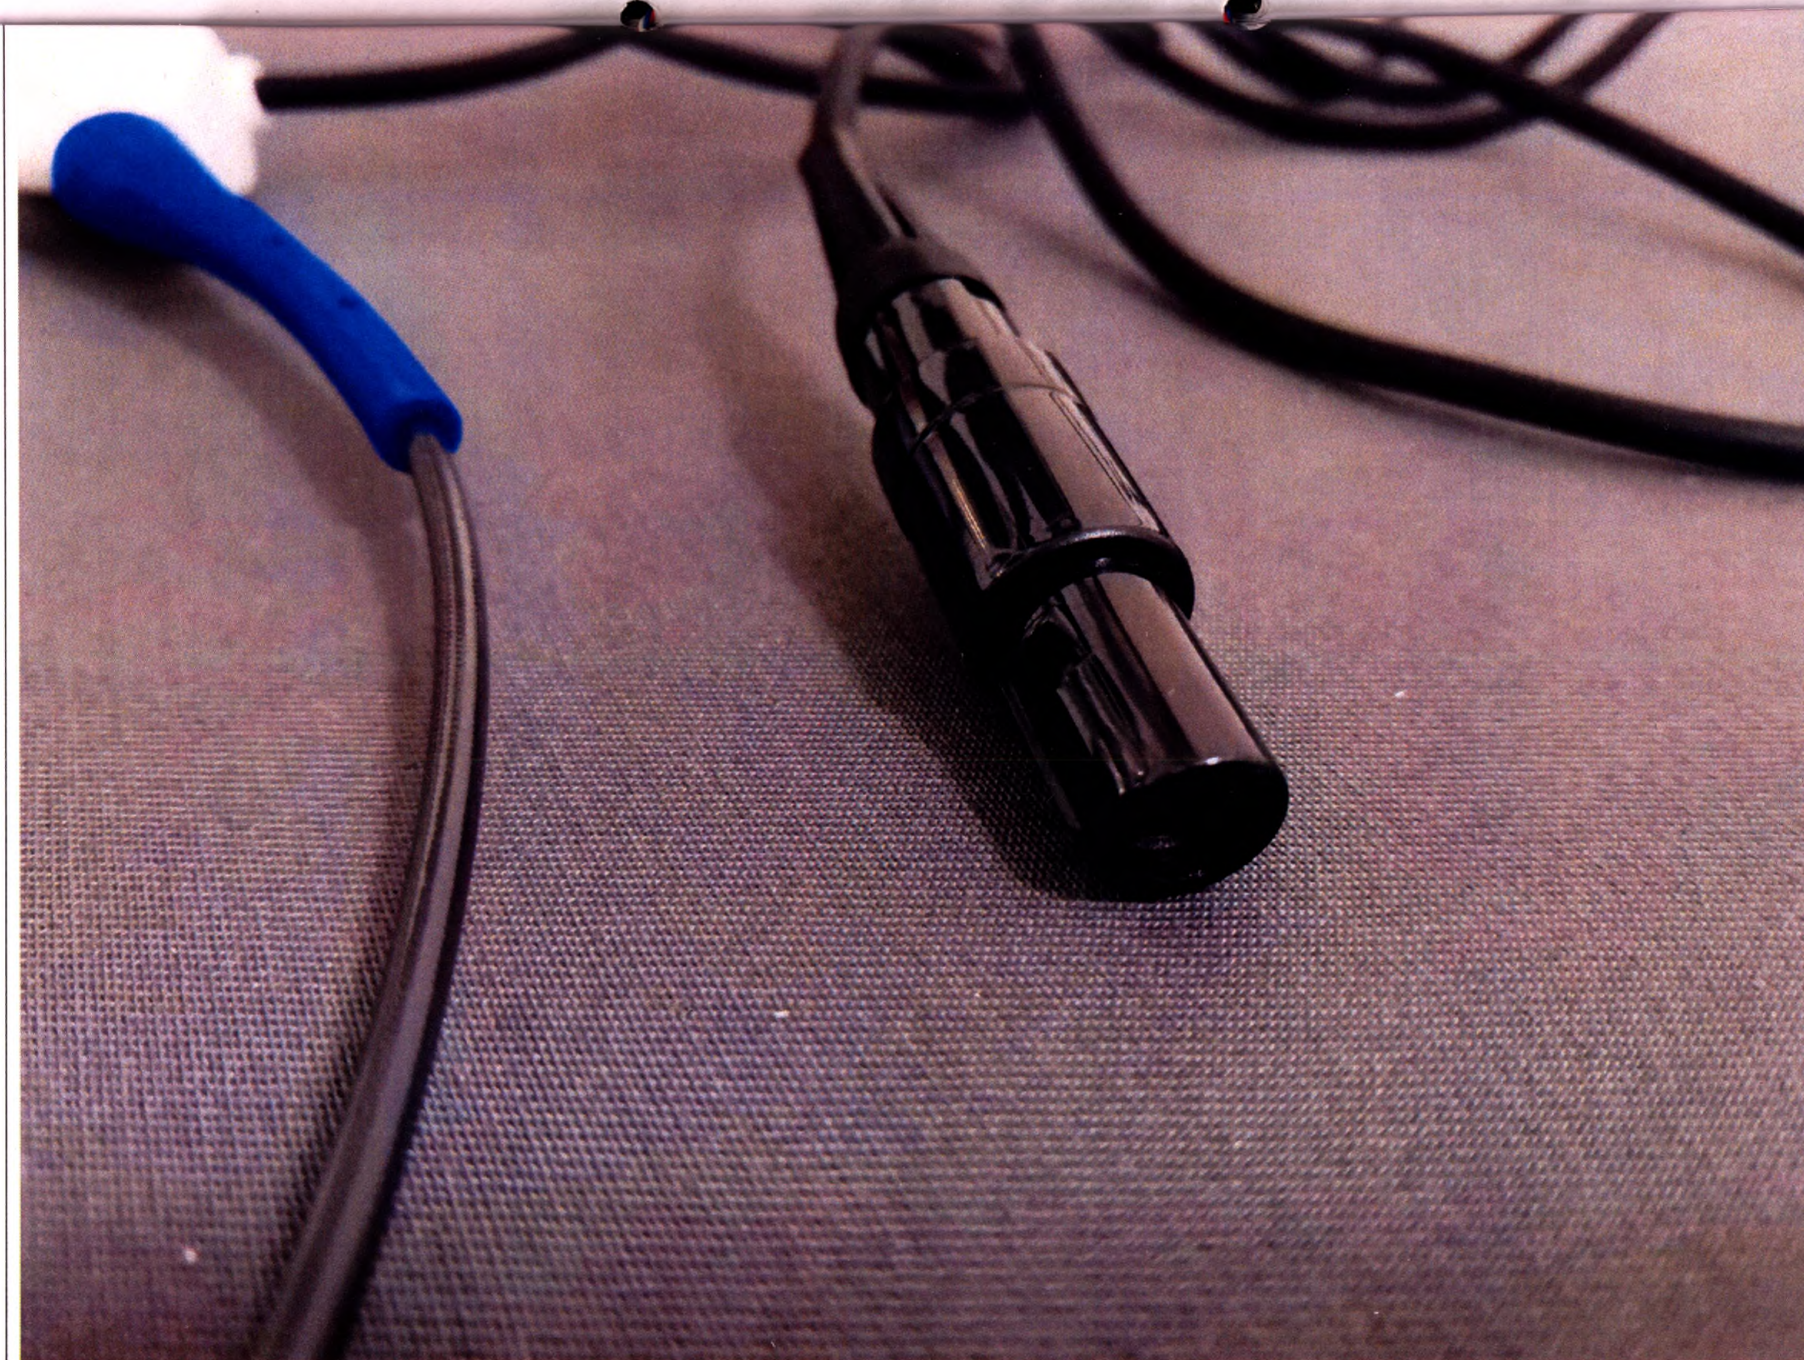


Рис. 11. Видеоуретероскоп FLEX-XC1, позитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см)

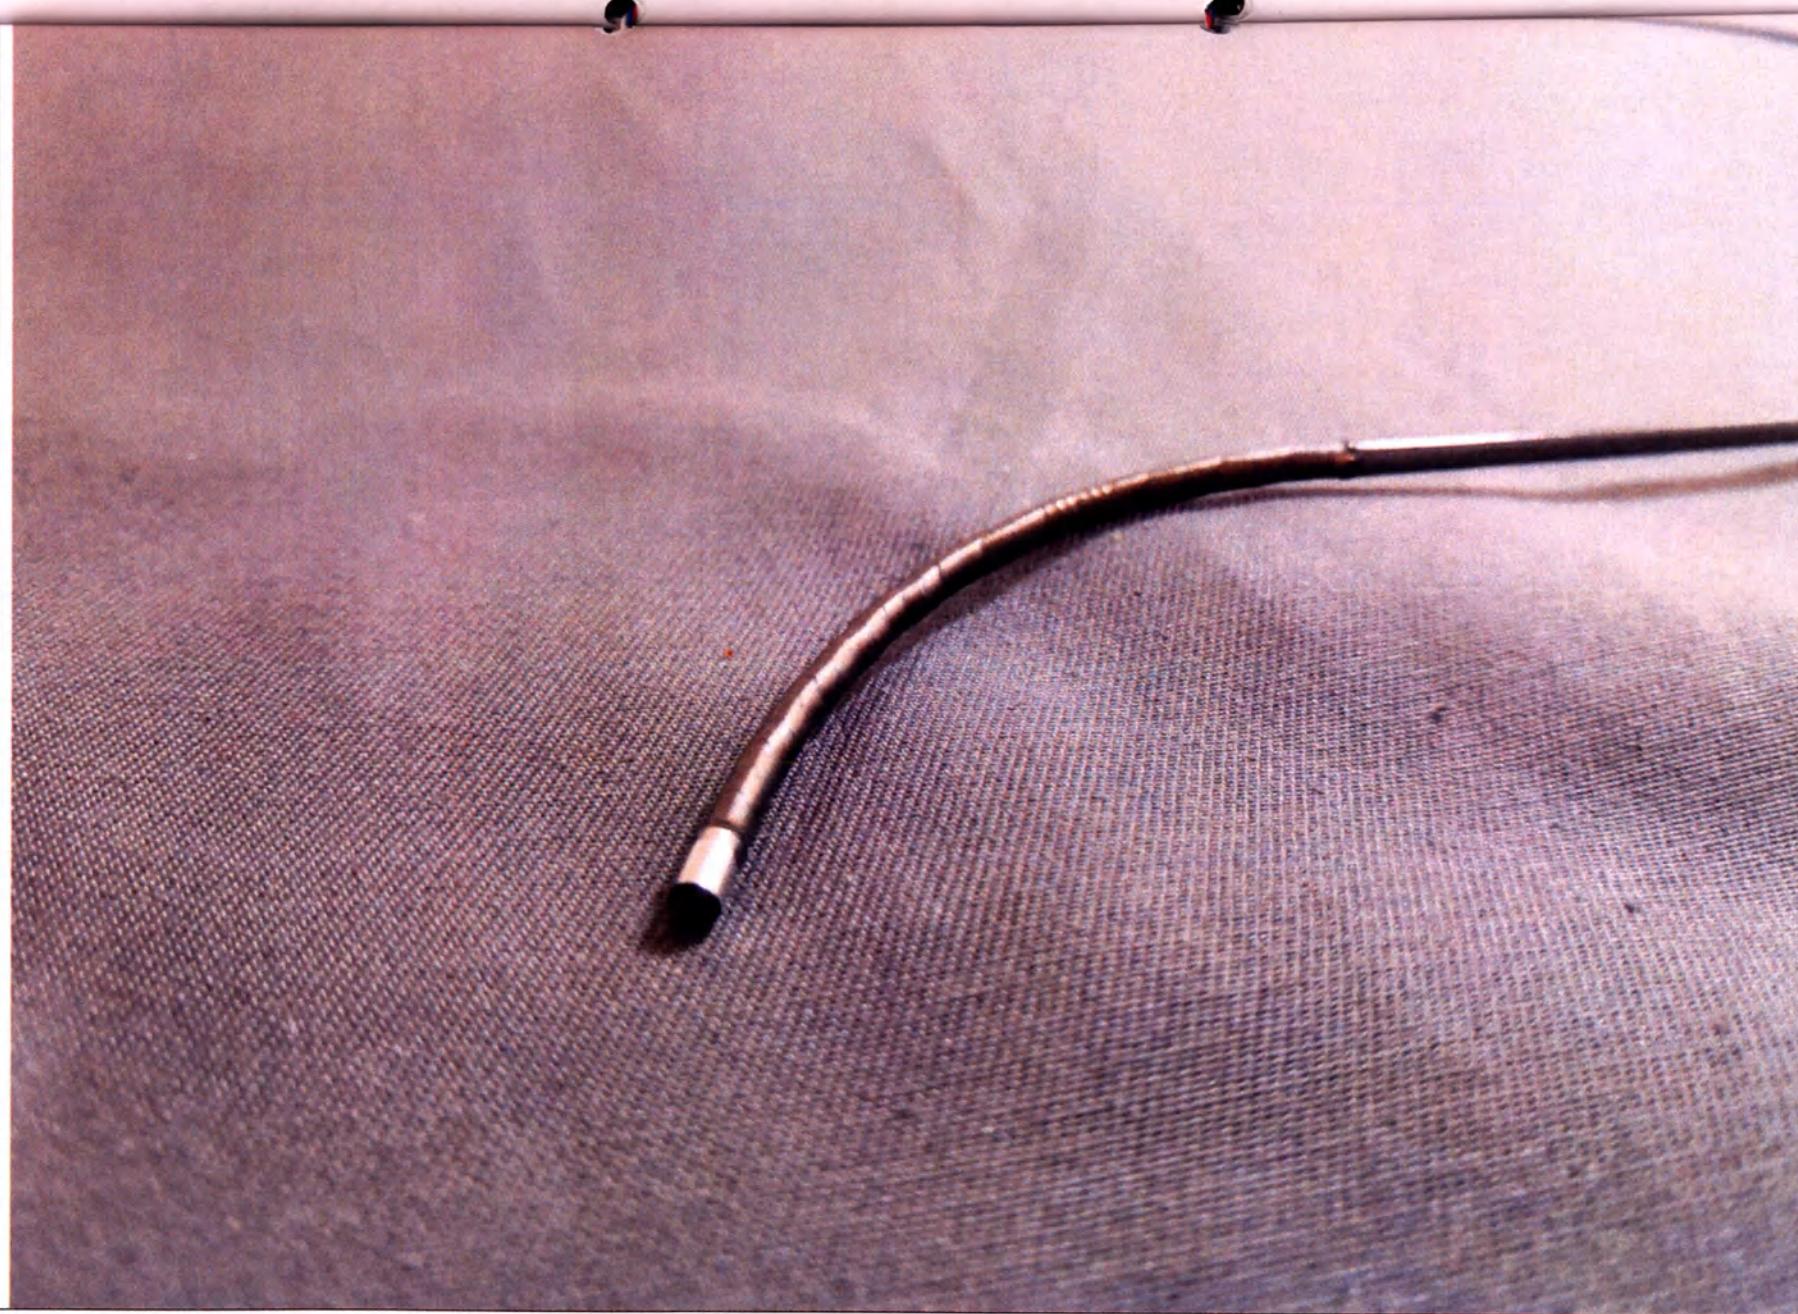


Рис. 12. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, позитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см)



Рис. 13. Адаптер Е-Вох ТС028. Потребительская упаковка

UN624791-C



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany


STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF TC028

de E-BOX für X-LINK
en E-BOX for X-LINK
fr E-BOX pour X-LINK
it E-BOX per X-LINK
es E-BOX para X-LINK
pt E-BOX para X-LINK

SN VN624791-C

QTY 1



020002



Rx only

MD



2022-08-09



www.karlstorz.com/ifu

UDI (01)04048551439043(11)220809(21)VN624791-C(422)840

CE

Рис. 14. Адаптер E-Box TC028. Маркировка на потребительской упаковке

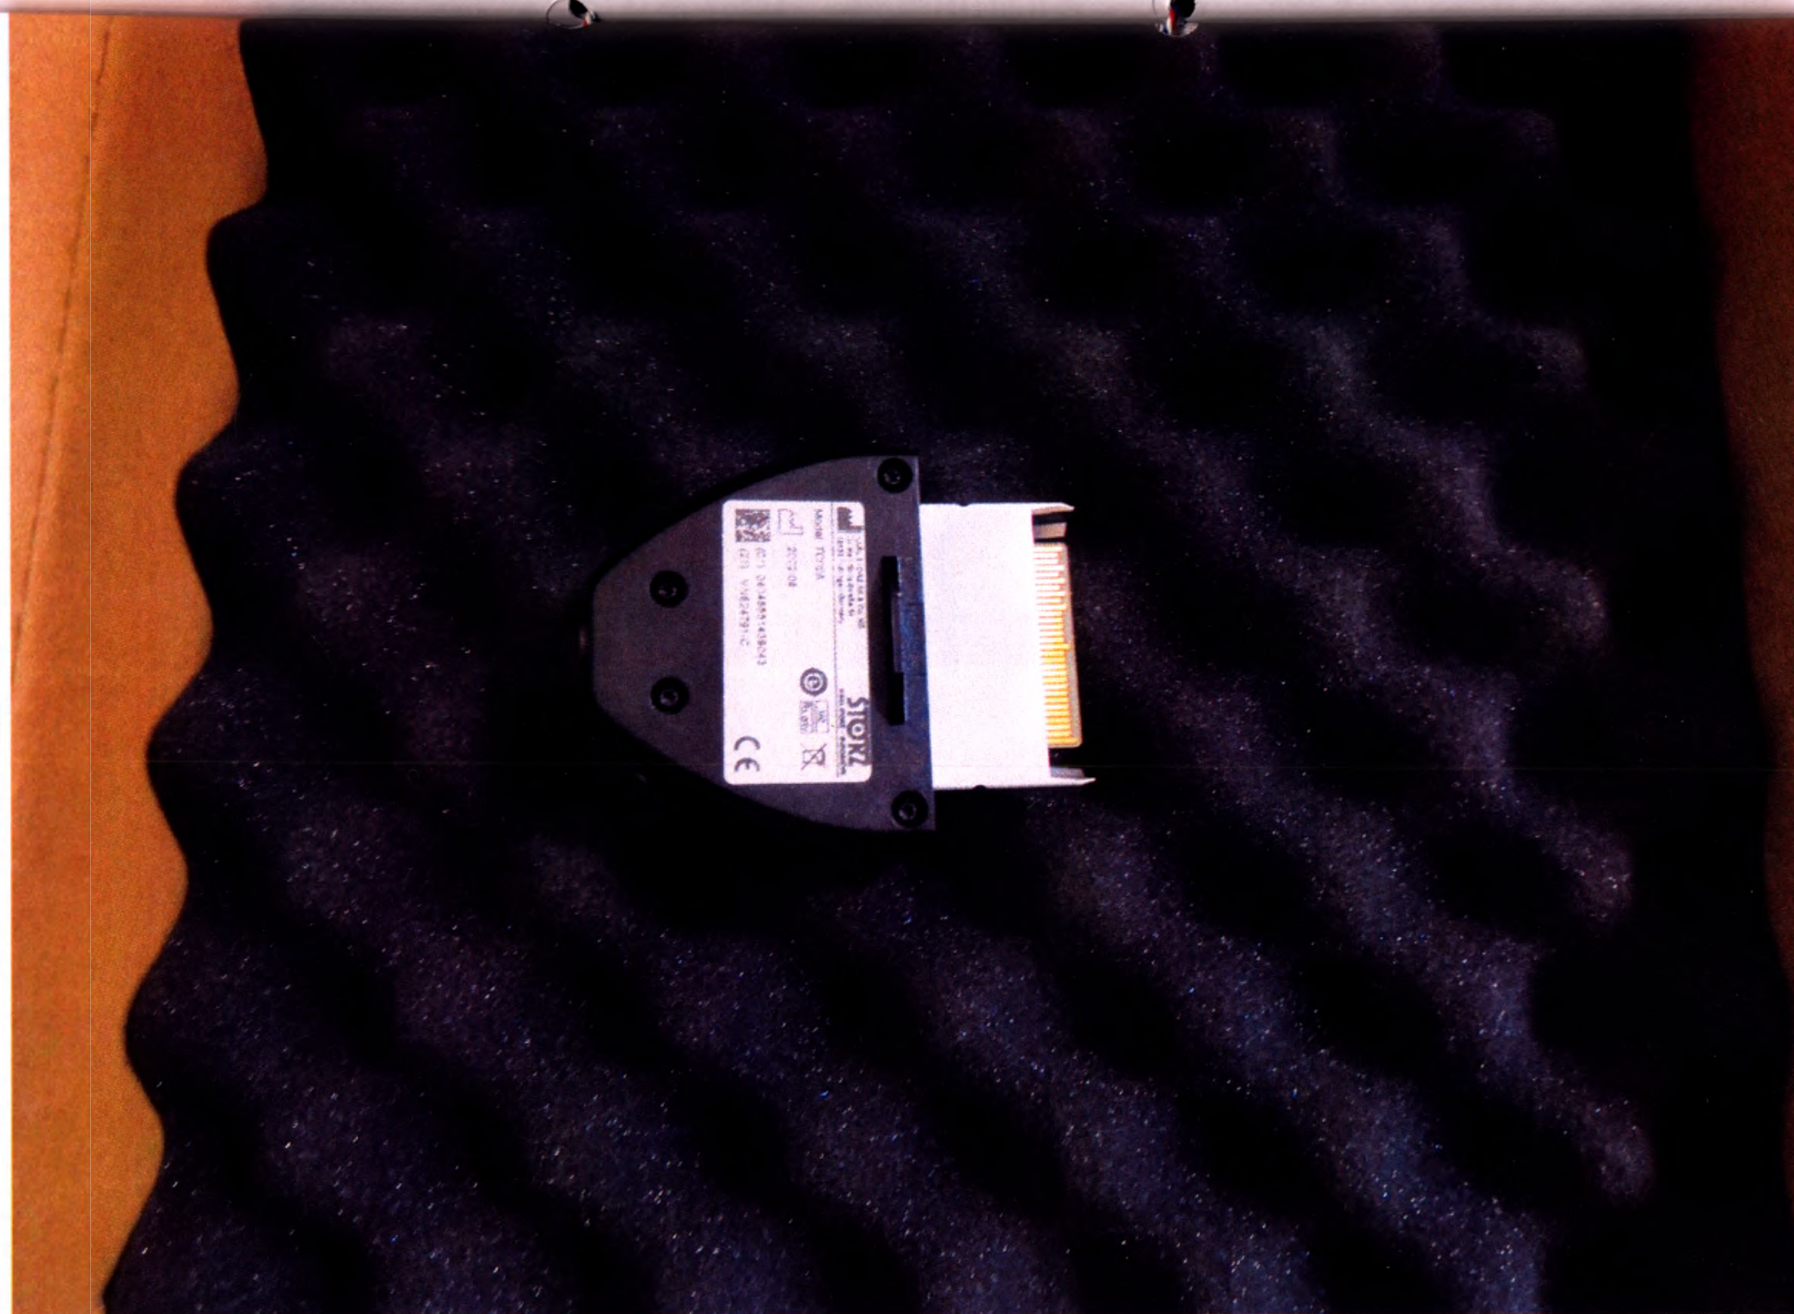


Рис. 15. Адаптер E-Box TC028



Рис. 16. Адаптер E-Box TC028



Рис. 17. Адаптер E-Box TC028



Рис. 18. Адаптер Е-Box TP012. Потребительская упаковка



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE

REF TP012

SN UP3016

QTY 1

E-Box f.flex. Endoskope z.Einmalgebrauch
E-Box for flex. single-use Endoscopes
E-Box pour vidéo-endoscope flexible
E-Box, per video-endoscopi flessibili
E-Box para endoscop. flex de un solo uso
E-Box, para videoendoscópios flexíveis



RxONLY

(01)04048551431429(240)TP012(21)UP3016

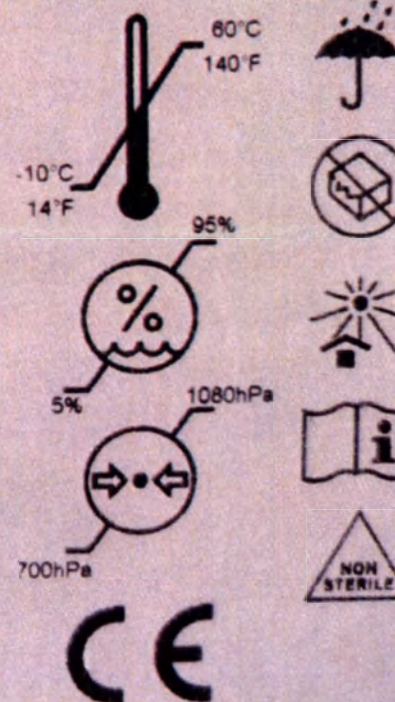


Рис. 19. Адаптер E-Box TP012. Маркировка на потребительской упаковке



Рис. 20. Адаптер E-Box TP012. Потребительская упаковка



Рис. 21. Адаптер E-Box TP012

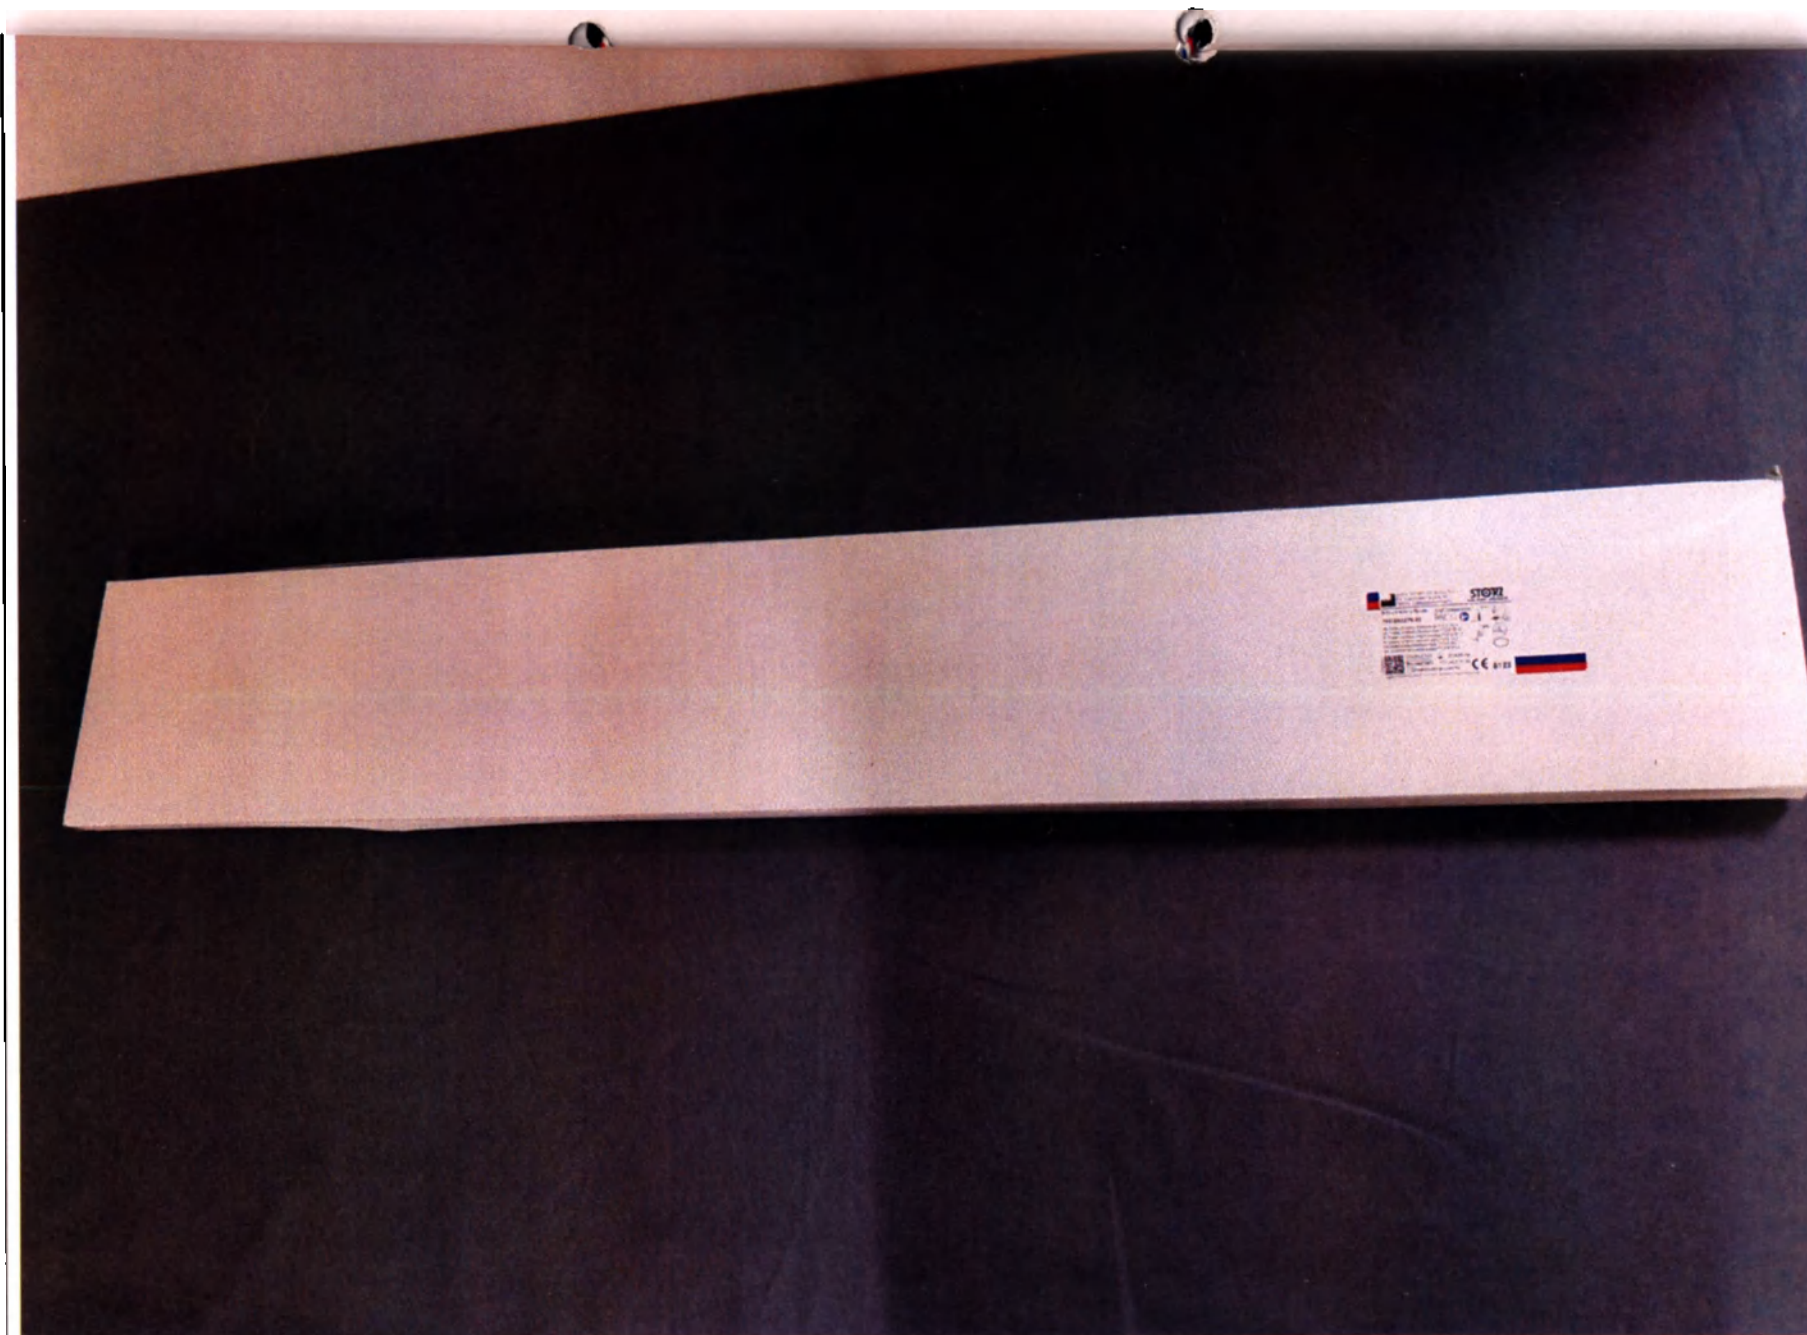


Рис. 22. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, контрпозитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см). Вторичная упаковка



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ ENDOSKOPE

9 Fr / 3.5 Fr x 70 cm

LOT 500081039

REF 091279-01

QTY 1



de Video-Uretero-Renoskop FLEX-XC1
en Video Uretero-Renoscope FLEX-XC1
fr Vidéo-urétéro-néphroscope FLEX-XC1
it Video-uretero-renoscopio FLEX-XC1
es Videoureterorenoscopio FLEX-XC1
pt Videoureterorenoscópio FLEX-XC1

LV020002



STERILE EO



2024-05-09

Rx only MD



2022-11-09



www.karlstorz.com/ifu

CE 0123

UDI

(01)04048551428023(11)221109(17)240509(10)500081039(422)203



Рис. 23. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, контрпозитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см). Маркировка на вторичной упаковке

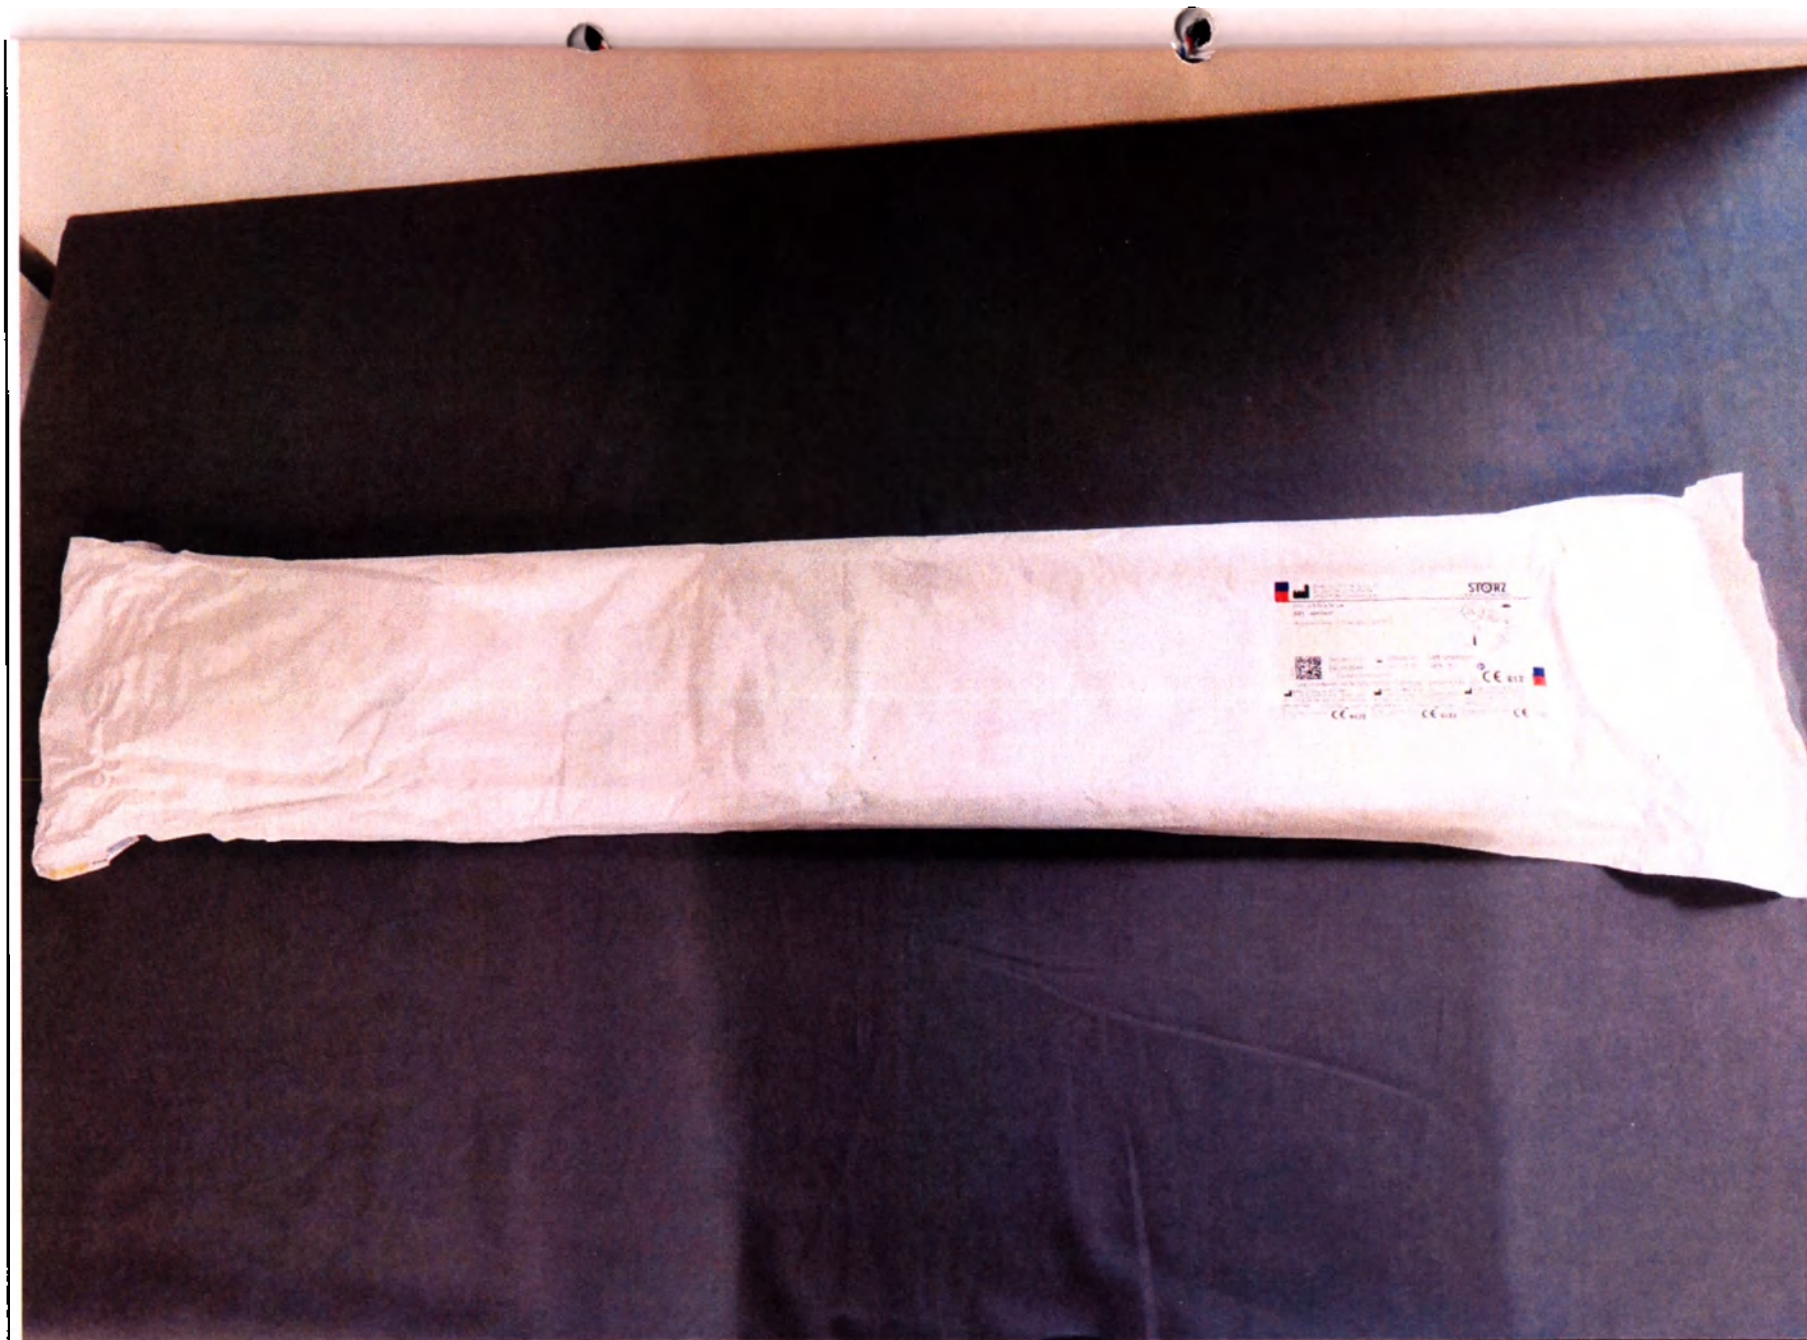


Рис. 24. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, контрпозитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см). Первичная упаковка

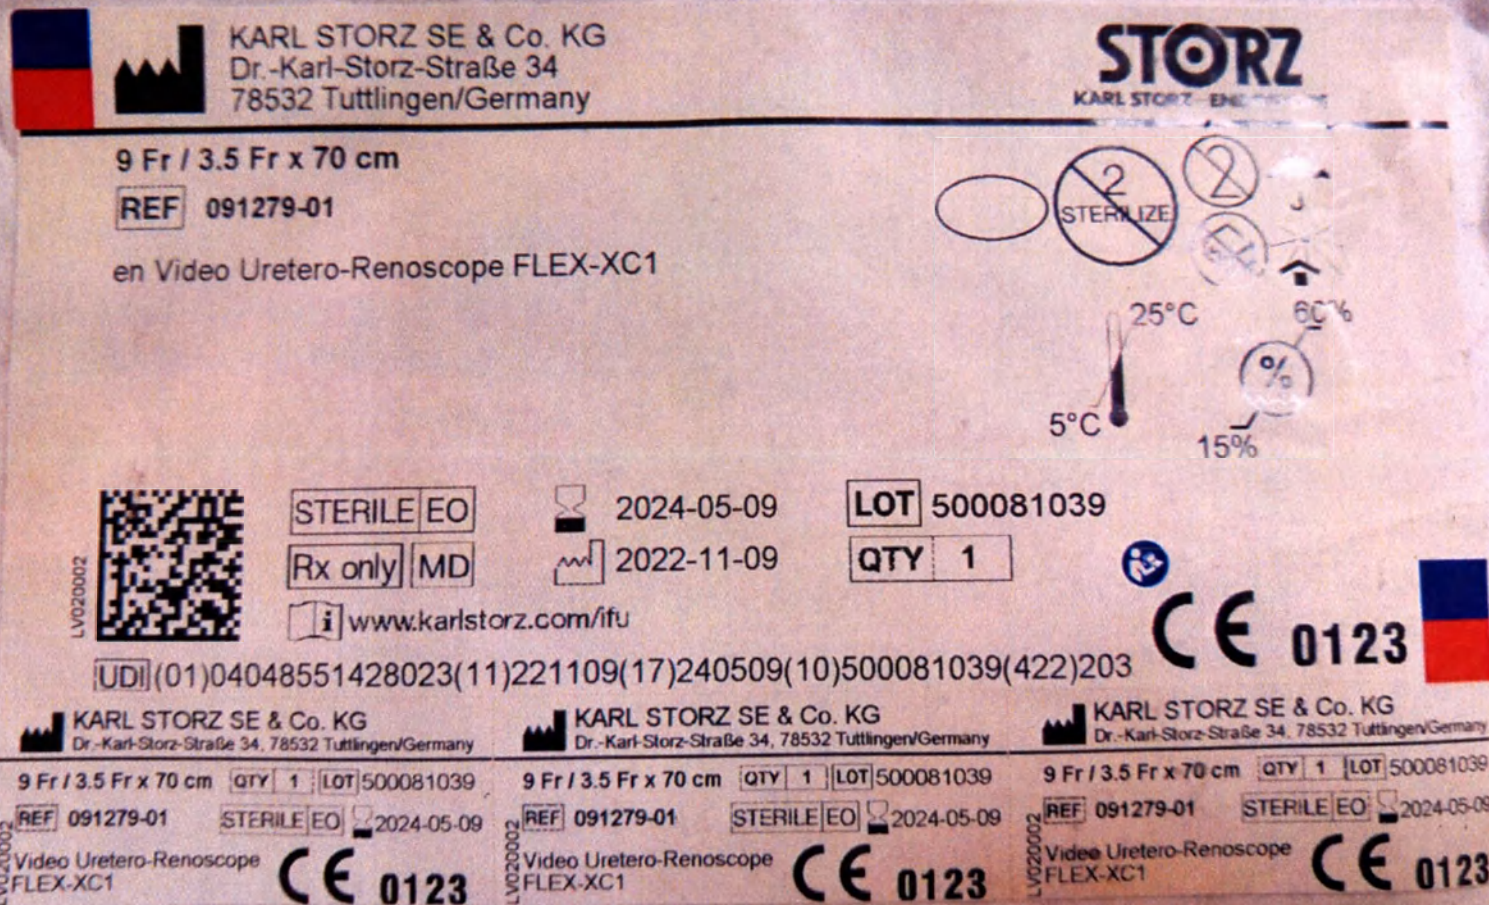


Рис. 25. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, контрпозитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см). Маркировка на первичной упаковке



Рис. 26. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, контрпозитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см)

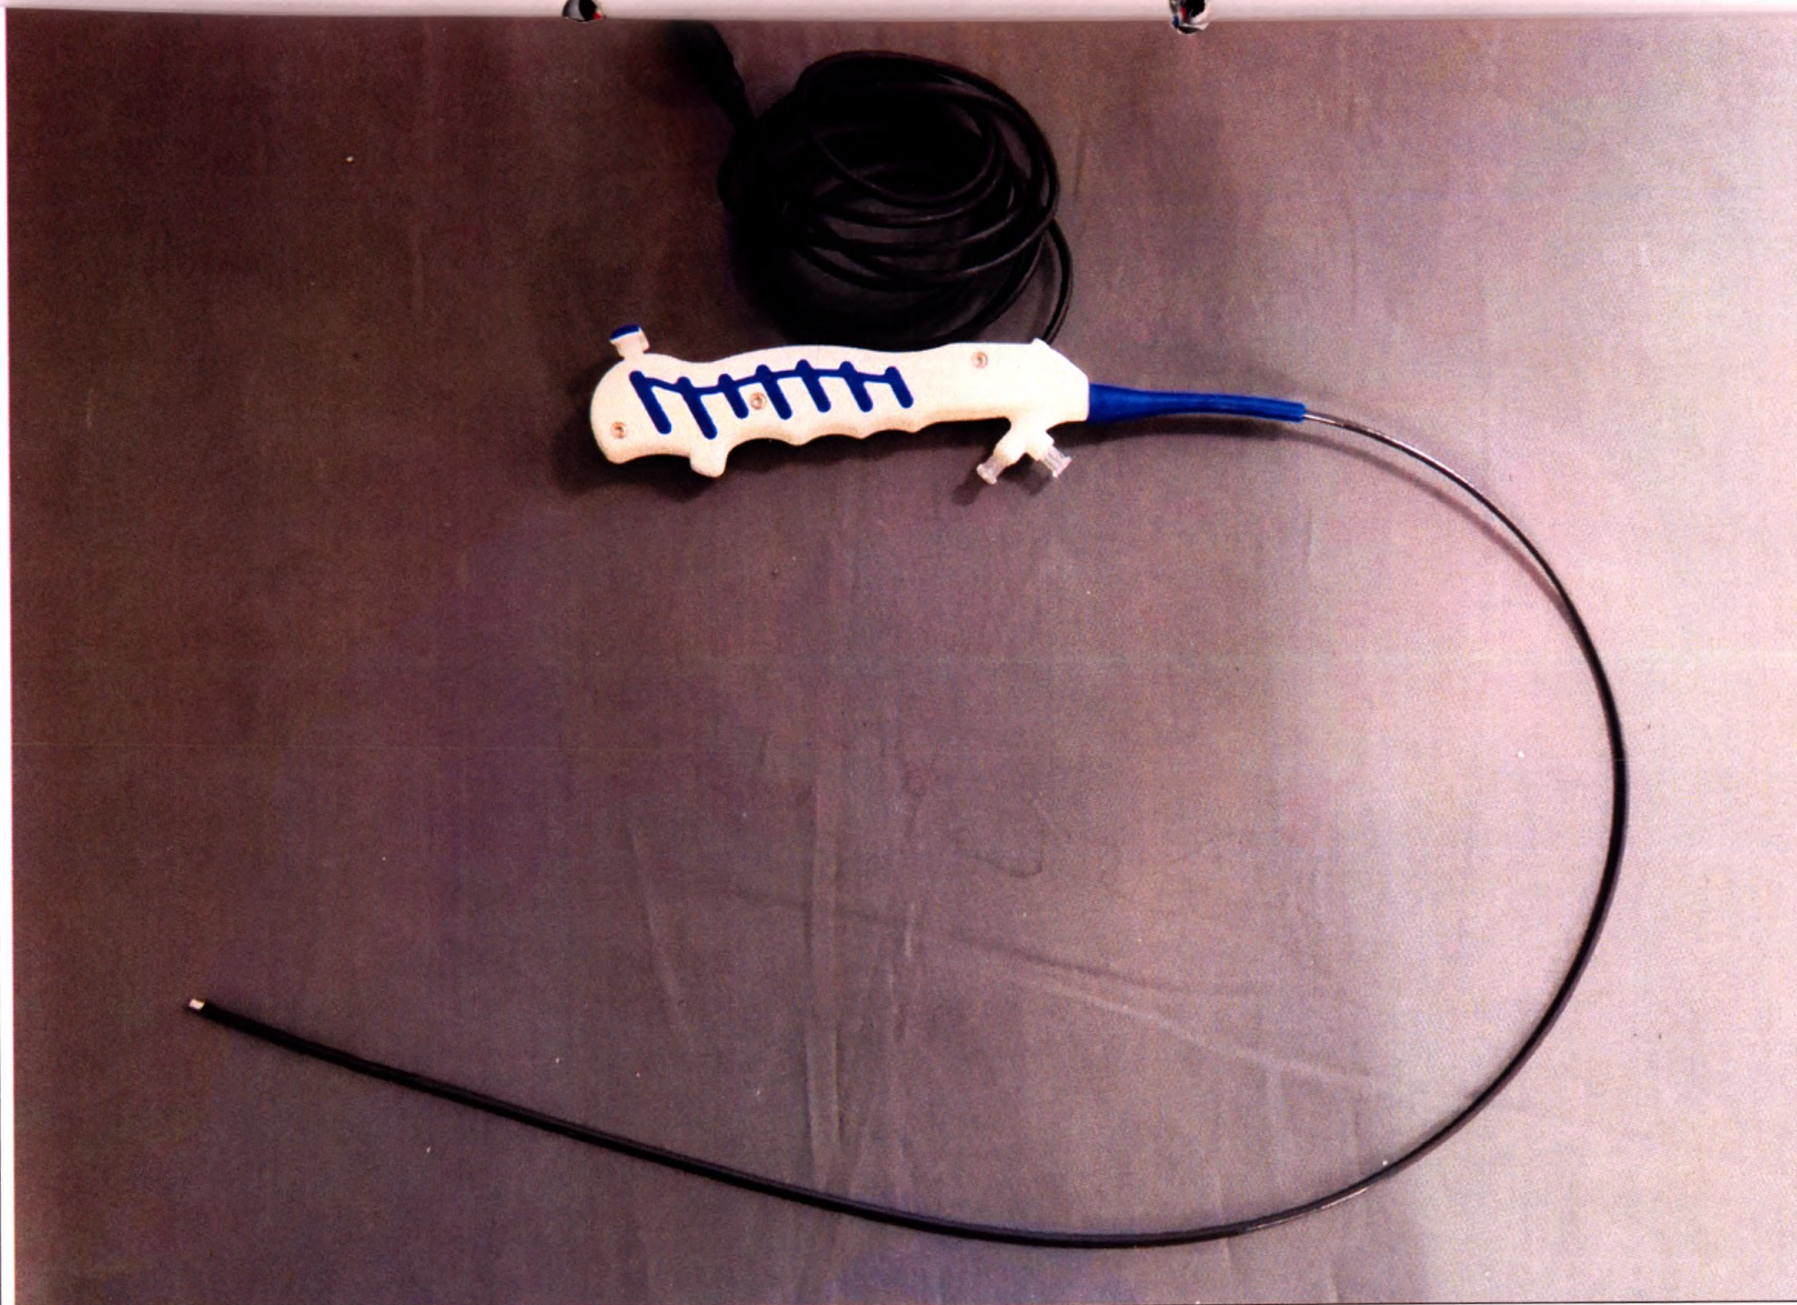


Рис. 27. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, контрпозитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см)

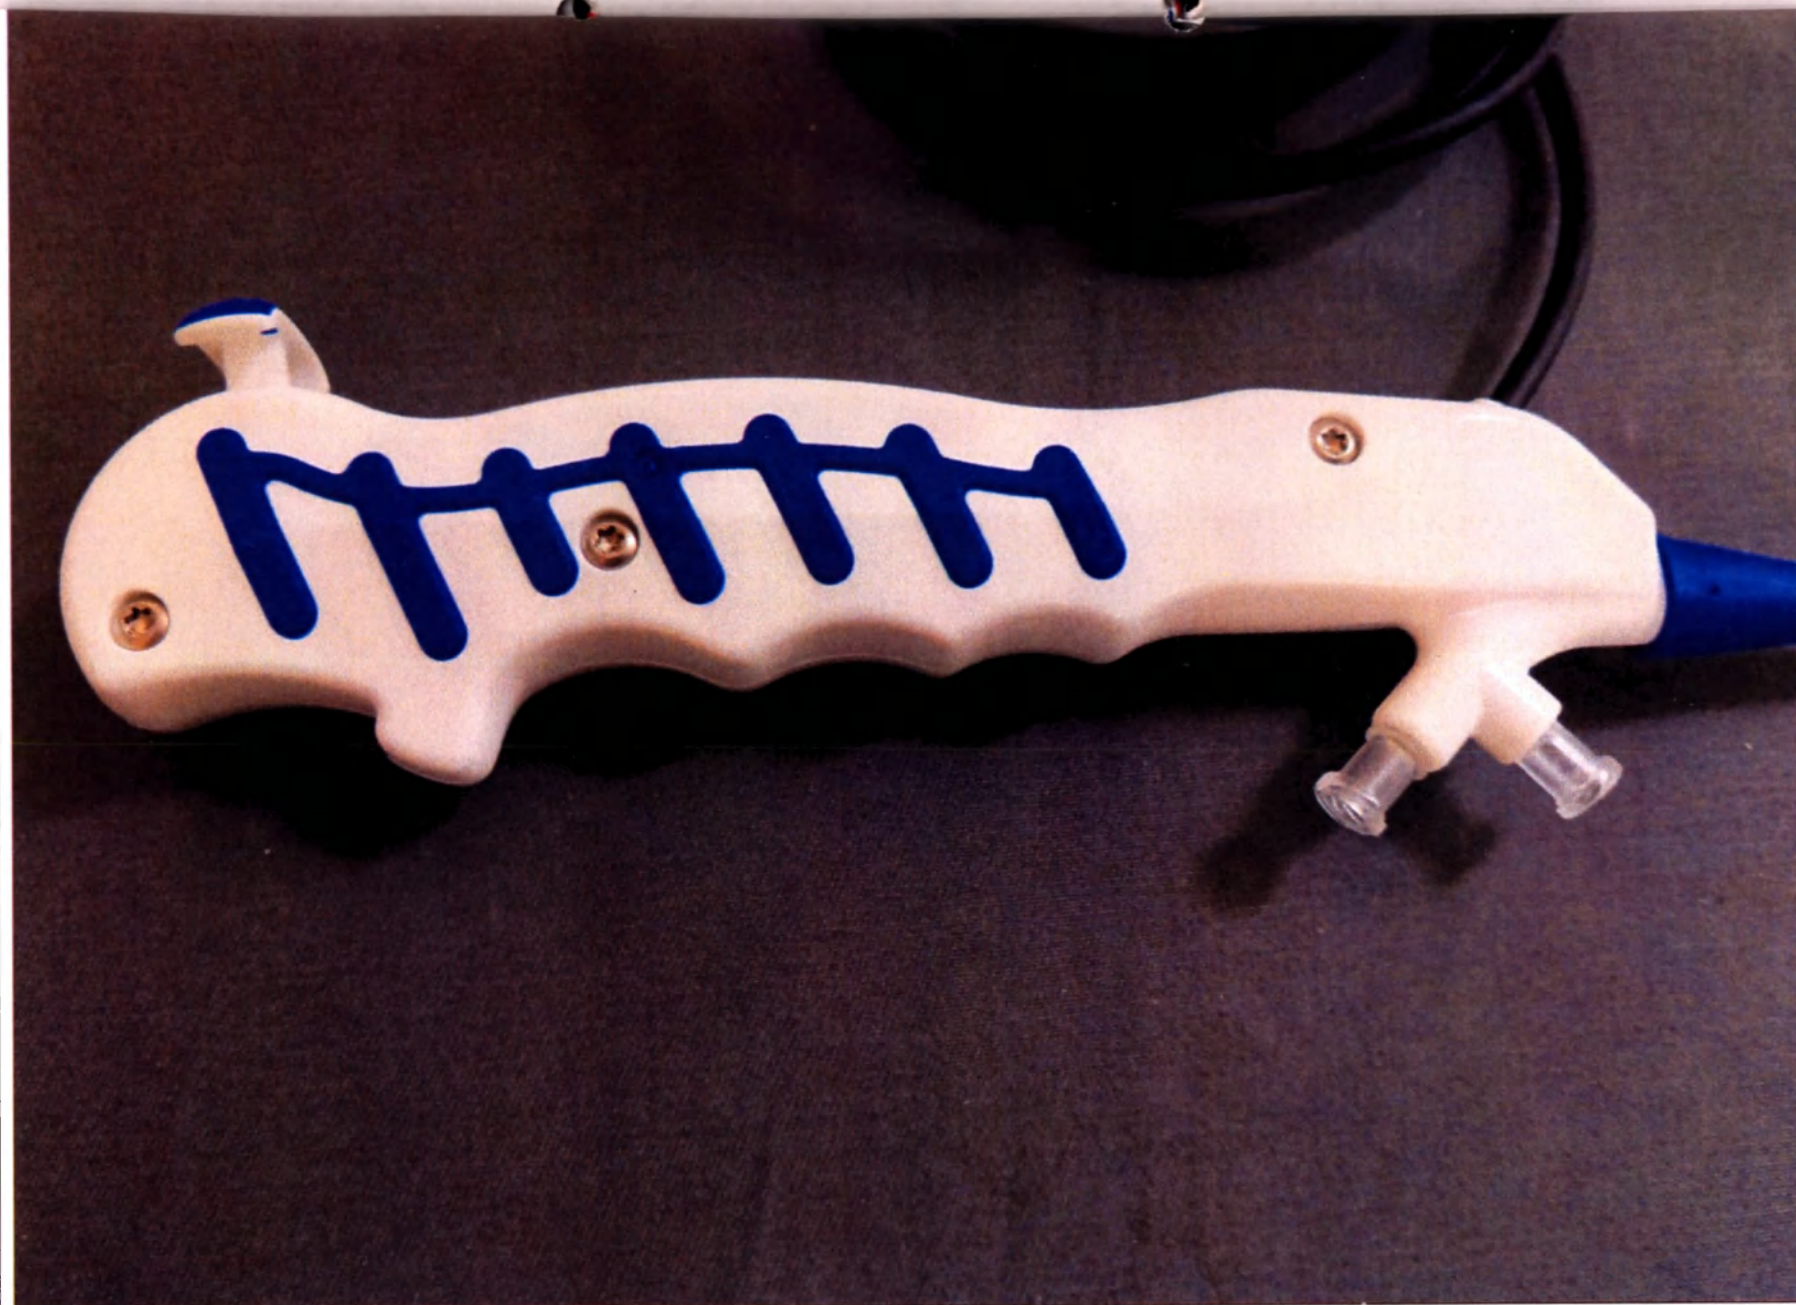


Рис. 28. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, контрпозитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см)



Рис. 29. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, контрпозитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см)

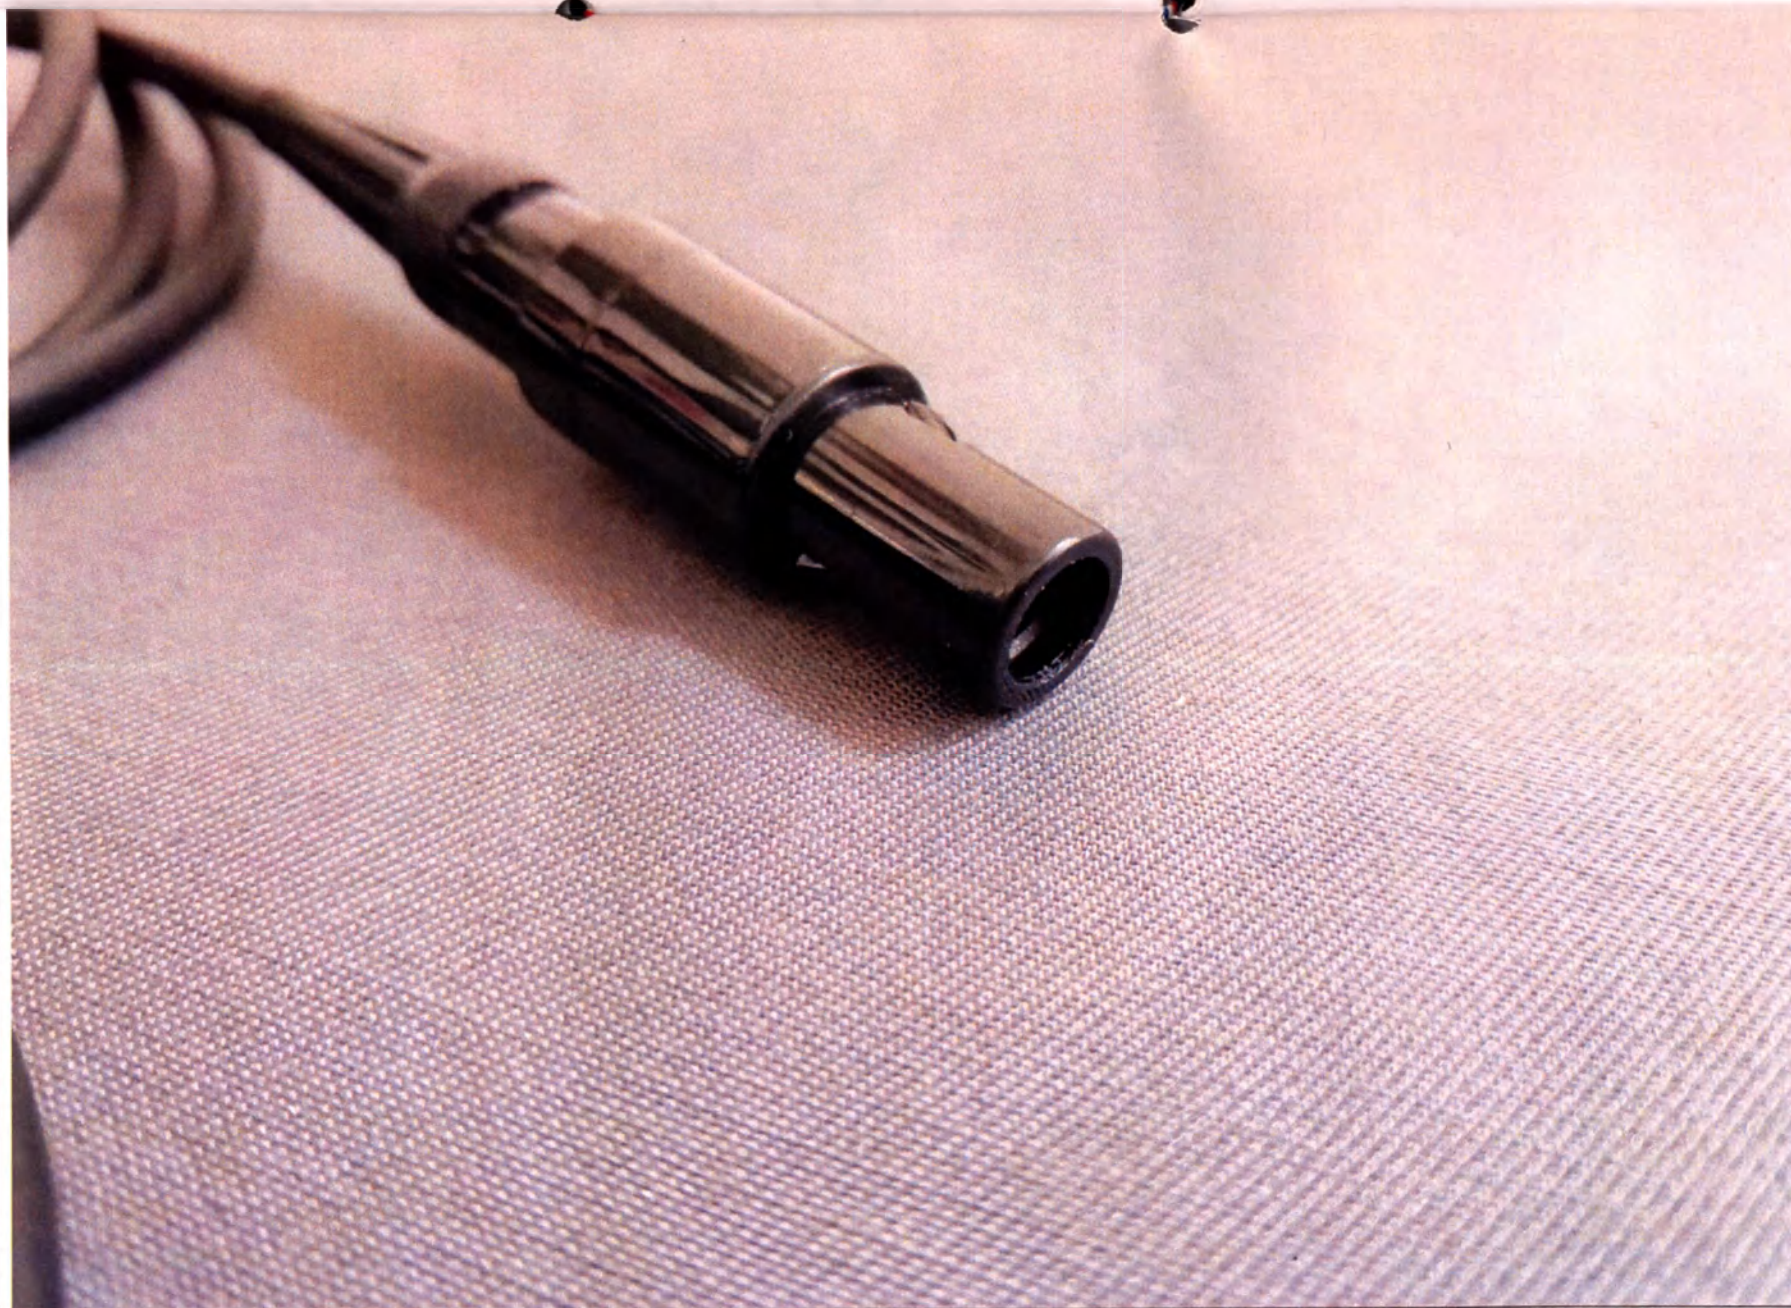


Рис. 30. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, контрпозитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см)

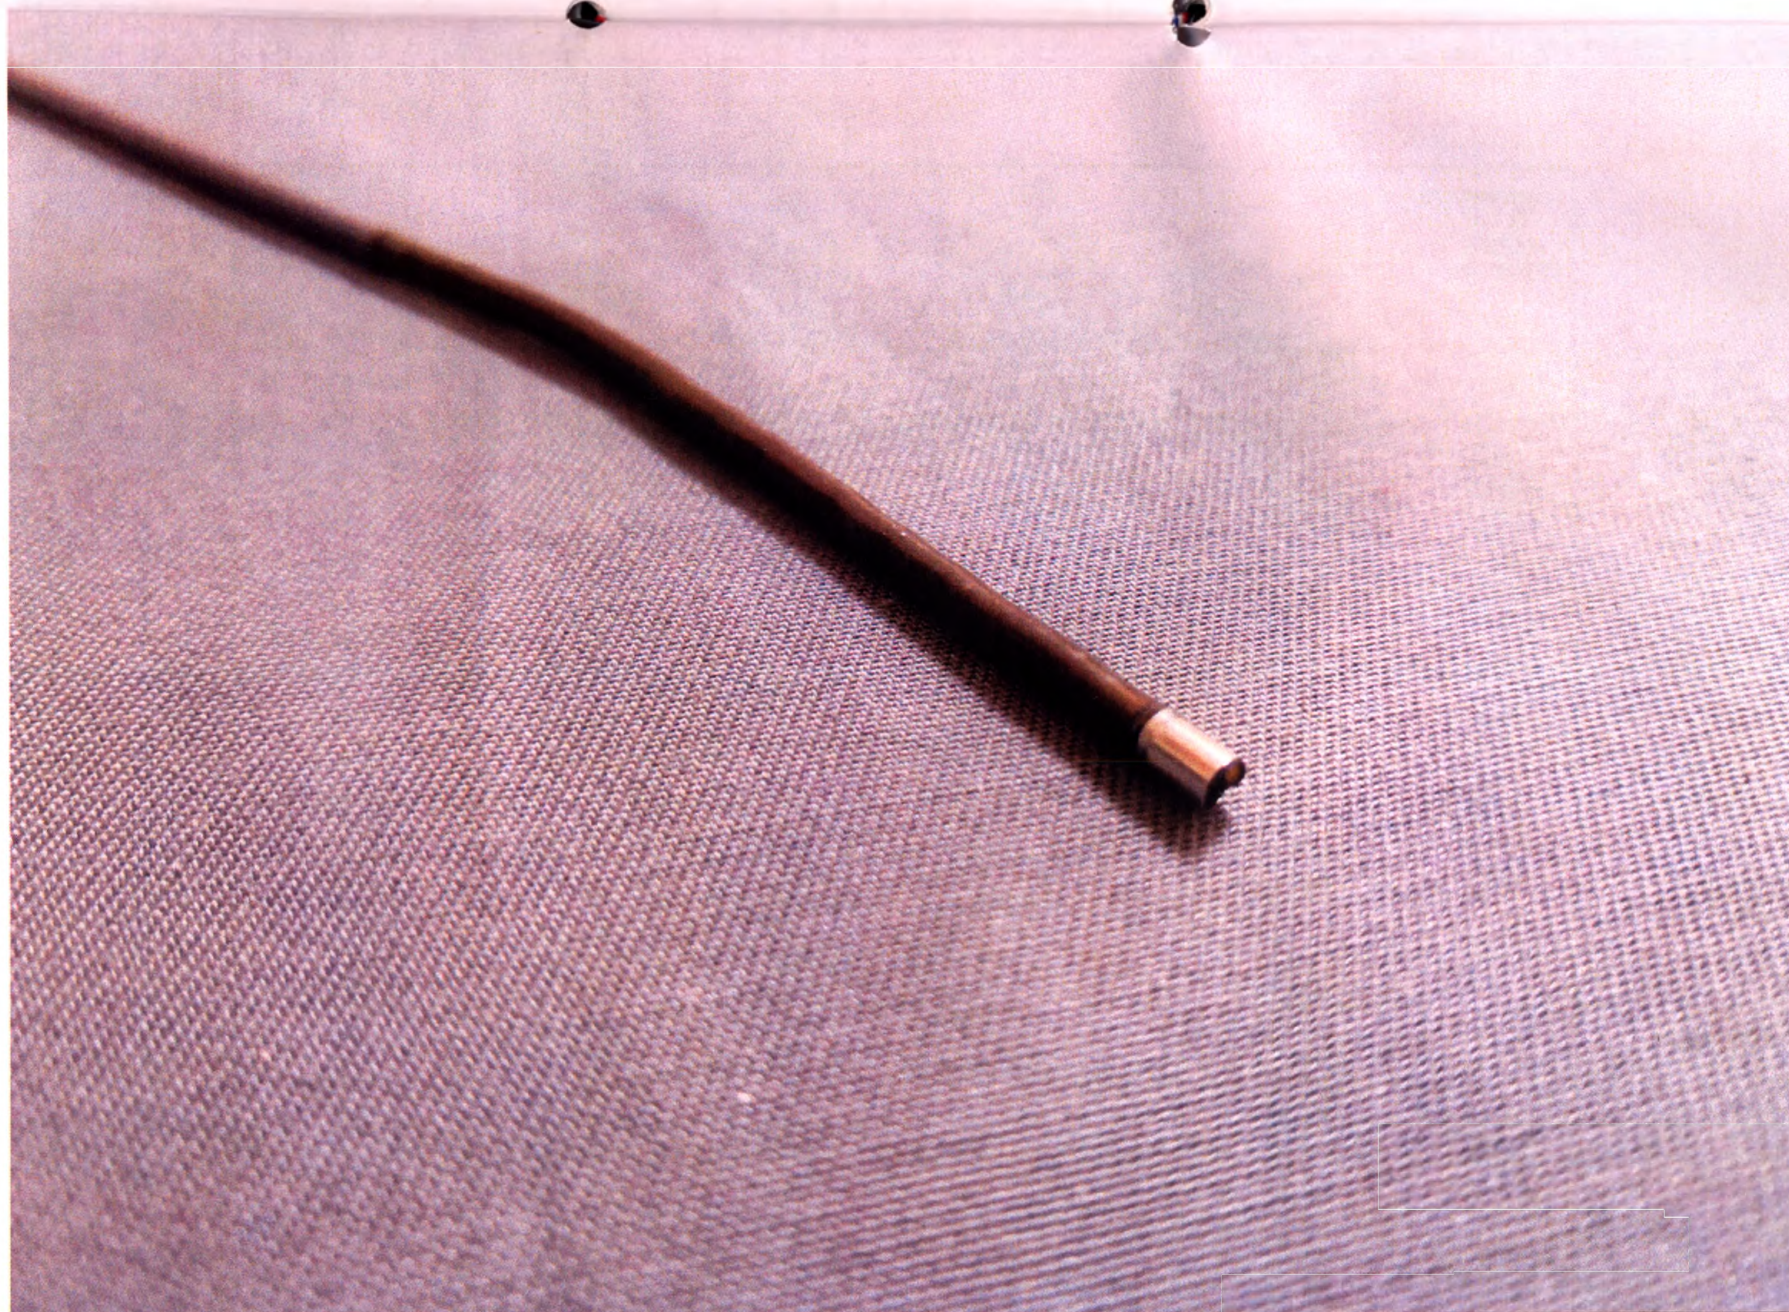


Рис. 31. Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, контрпозитивный механизм отклонения 3,00 мм/ 1,16 мм × 70 см (9 Fr / 3,5 Fr × 70 см)

091271-06

STORZ
KARL STORZ—ENDOSCOPE

Видеоуретерореноскоп гибкий FLEX-XC1 одноразовый в вариантах исполнения:

Видеоуретерореноскоп FLEX-XC1, позитивный механизм отклонения

РУ № _____ от _____

Производитель

KARL STORZ SE & Co. KG

Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532

Tuttlingen / Germany (Германия)

Уполномоченный
представитель на
территории РФ

Общество с ограниченной ответственностью

КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК

(ООО КШТЭ ВОСТОК)

Россия, 115114, г. Москва,

Дербеневская набережная, 7, стр. 4

Рис. 32. Пример макета маркировки на русском языке



33