

УТВЕРЖДАЮ


Коммерческий руководитель
по направлению "Медицина"

ООО «ИТЕХ ЛАБ»


 Рыков Е.А.
«01.03.2023» 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Обеспечение программное прикладное «NTechMed CT Brain» для обработки изображений
стандарта DICOM по ТУ 58.29.32-001-14161592-2022, производства ООО «ИТех лаб»,
Россия

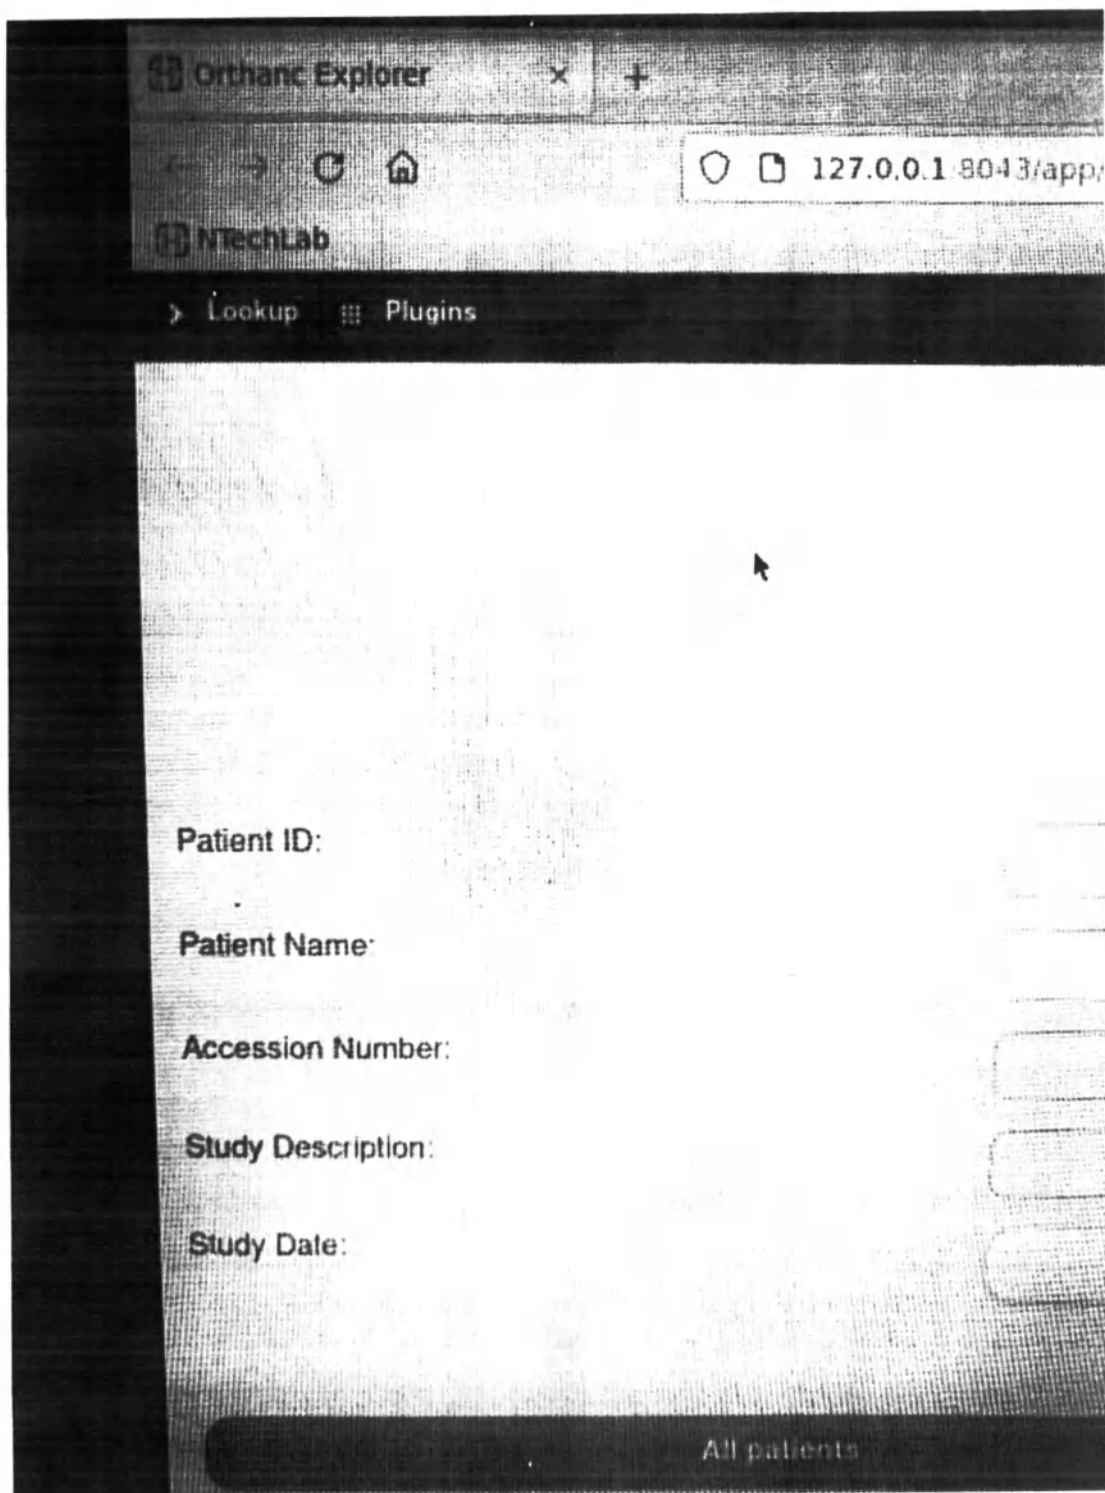


Пример работы ПО через браузер Mozilla Firefox

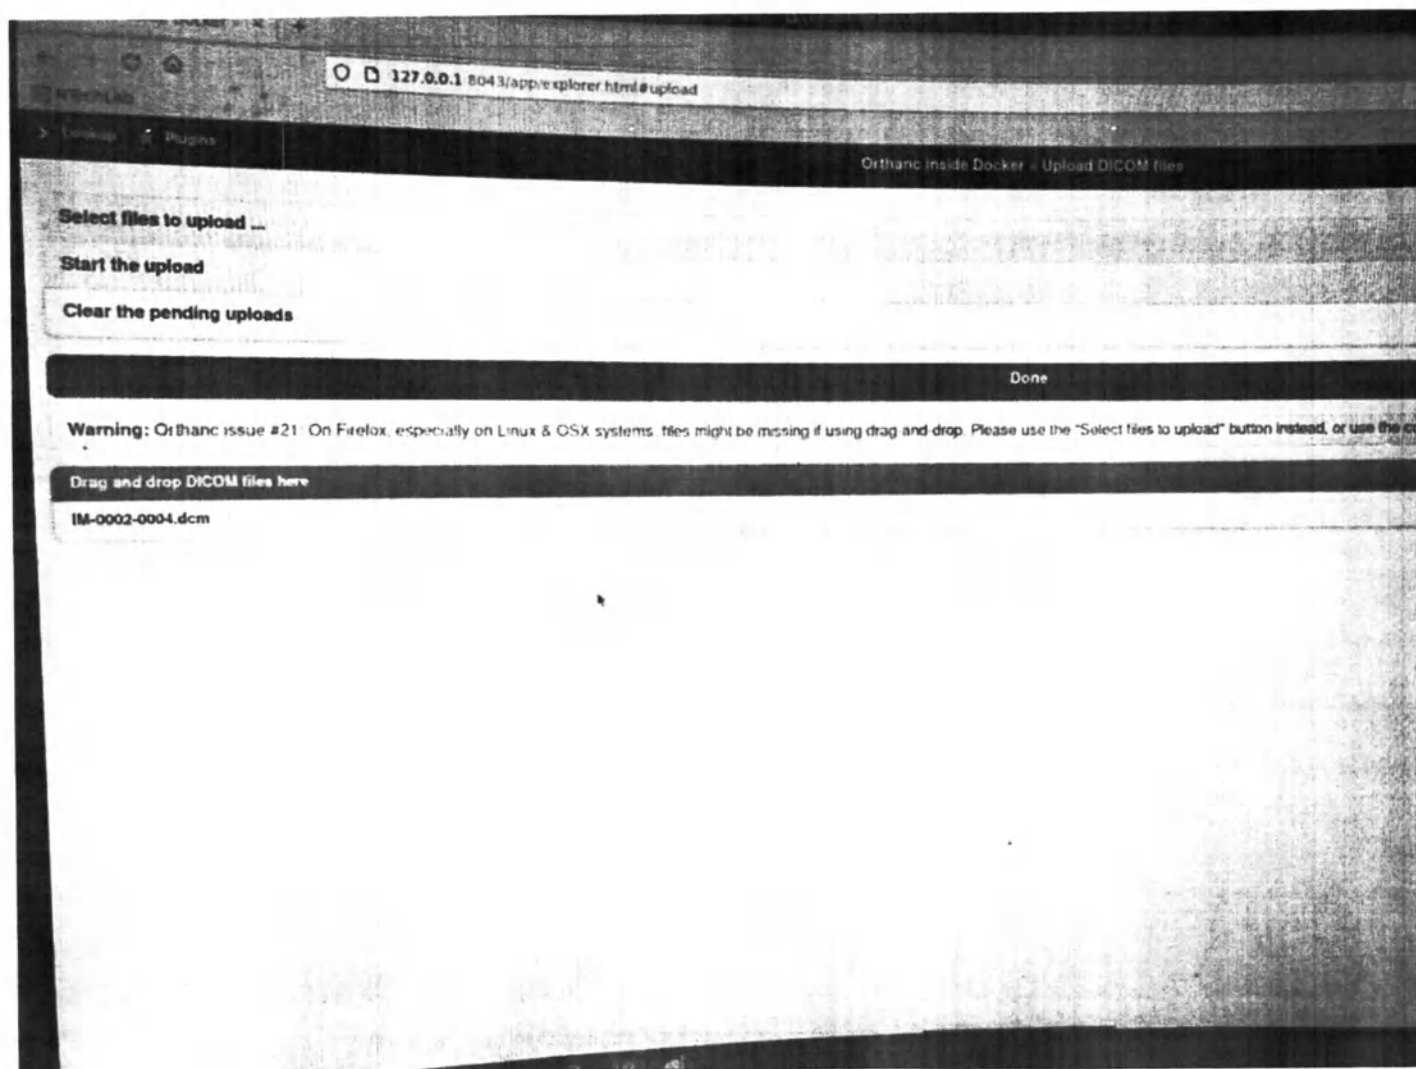


Интерфейс загрузки изображения через браузер Mozilla Firefox

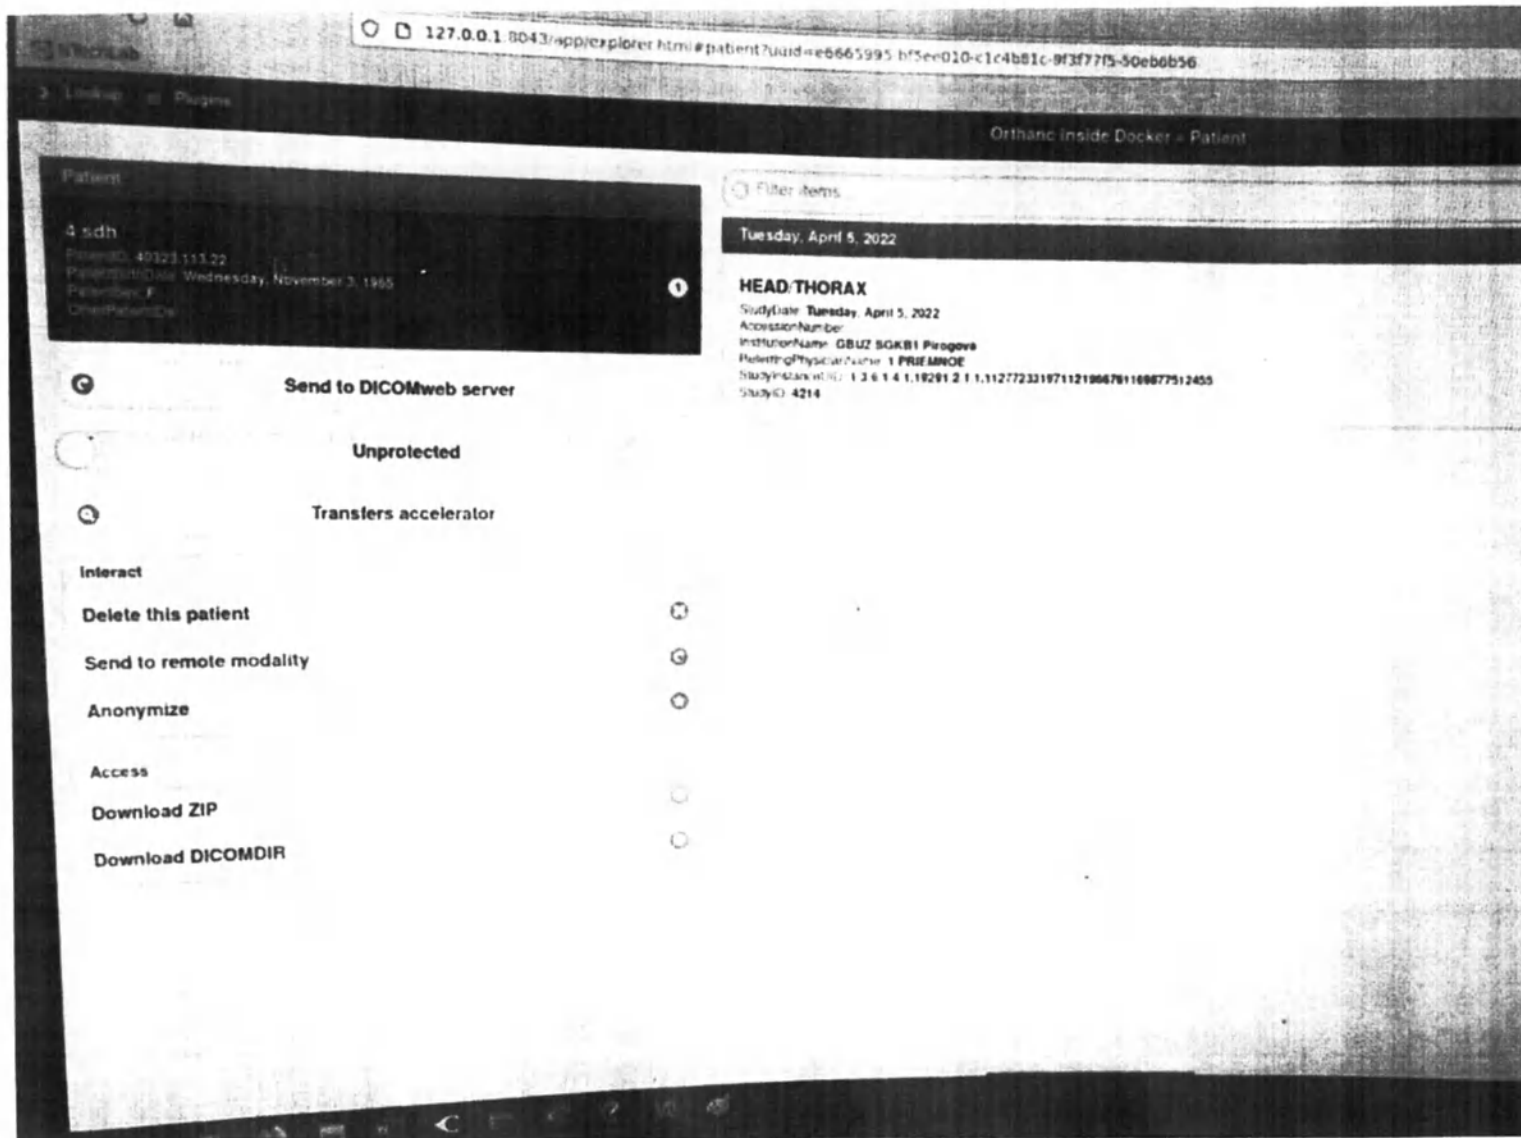


Открытие изображения через браузер Mozilla Firefox

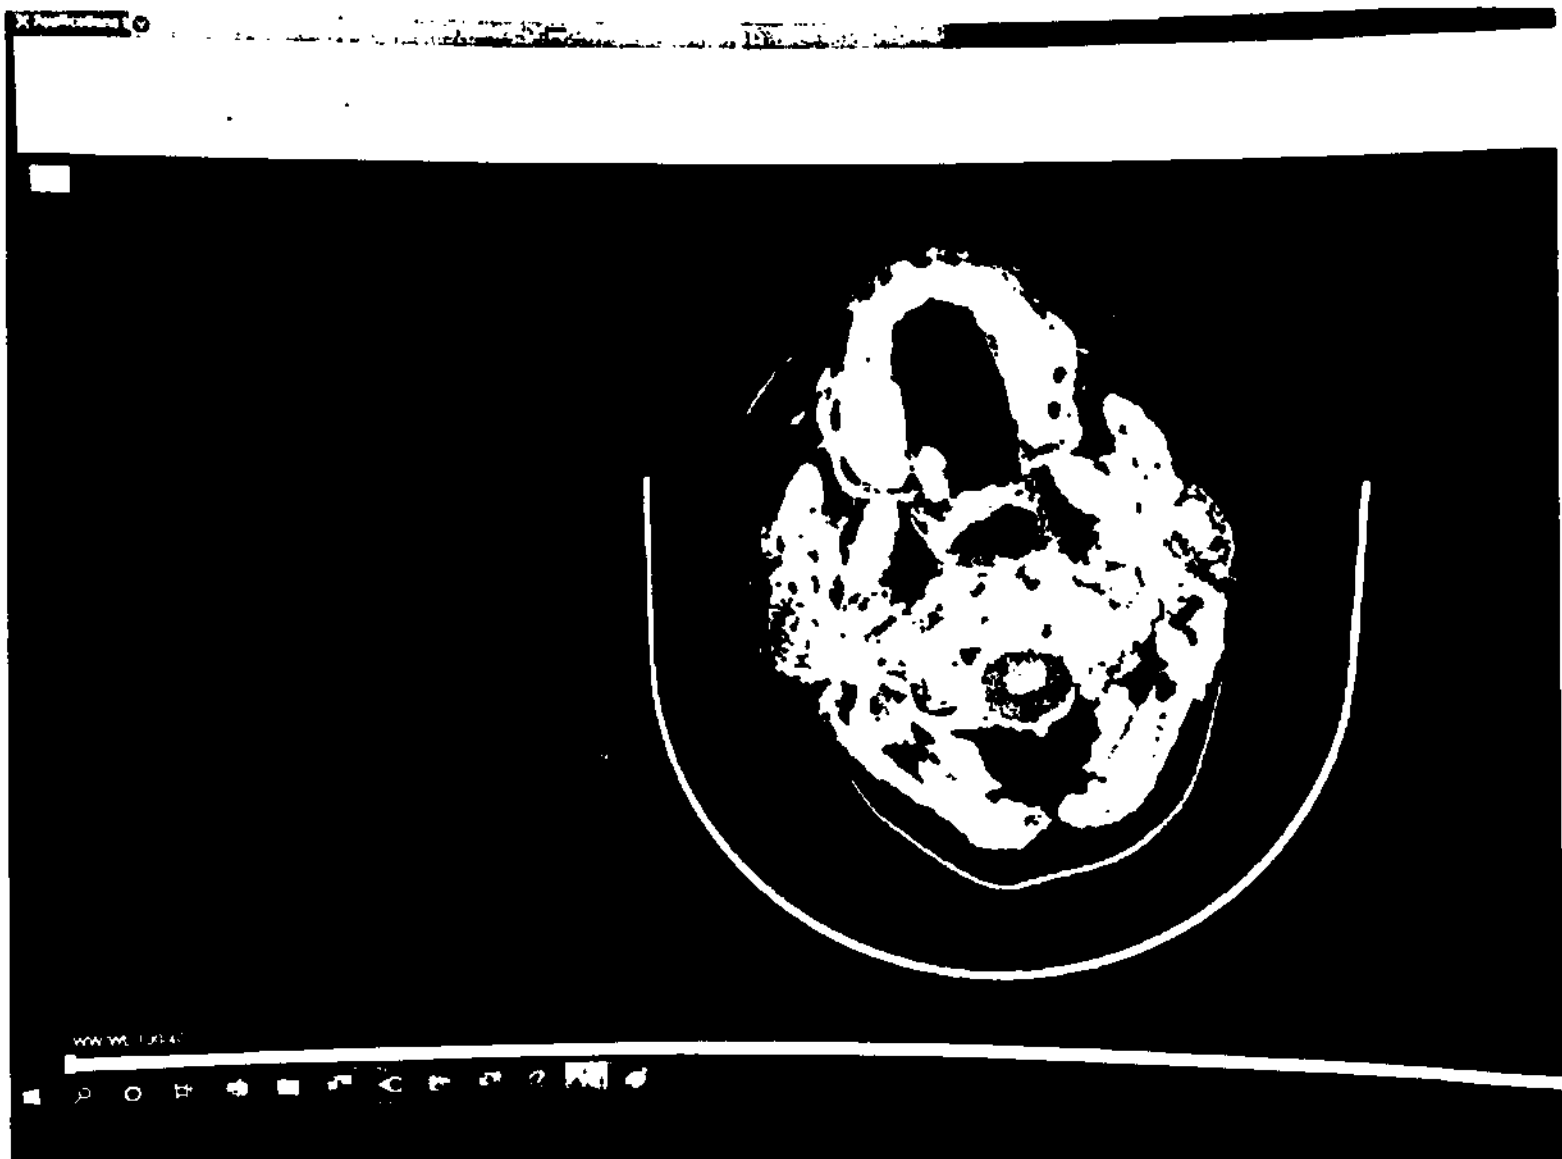


Обзор изображения через браузер Mozilla Firefox

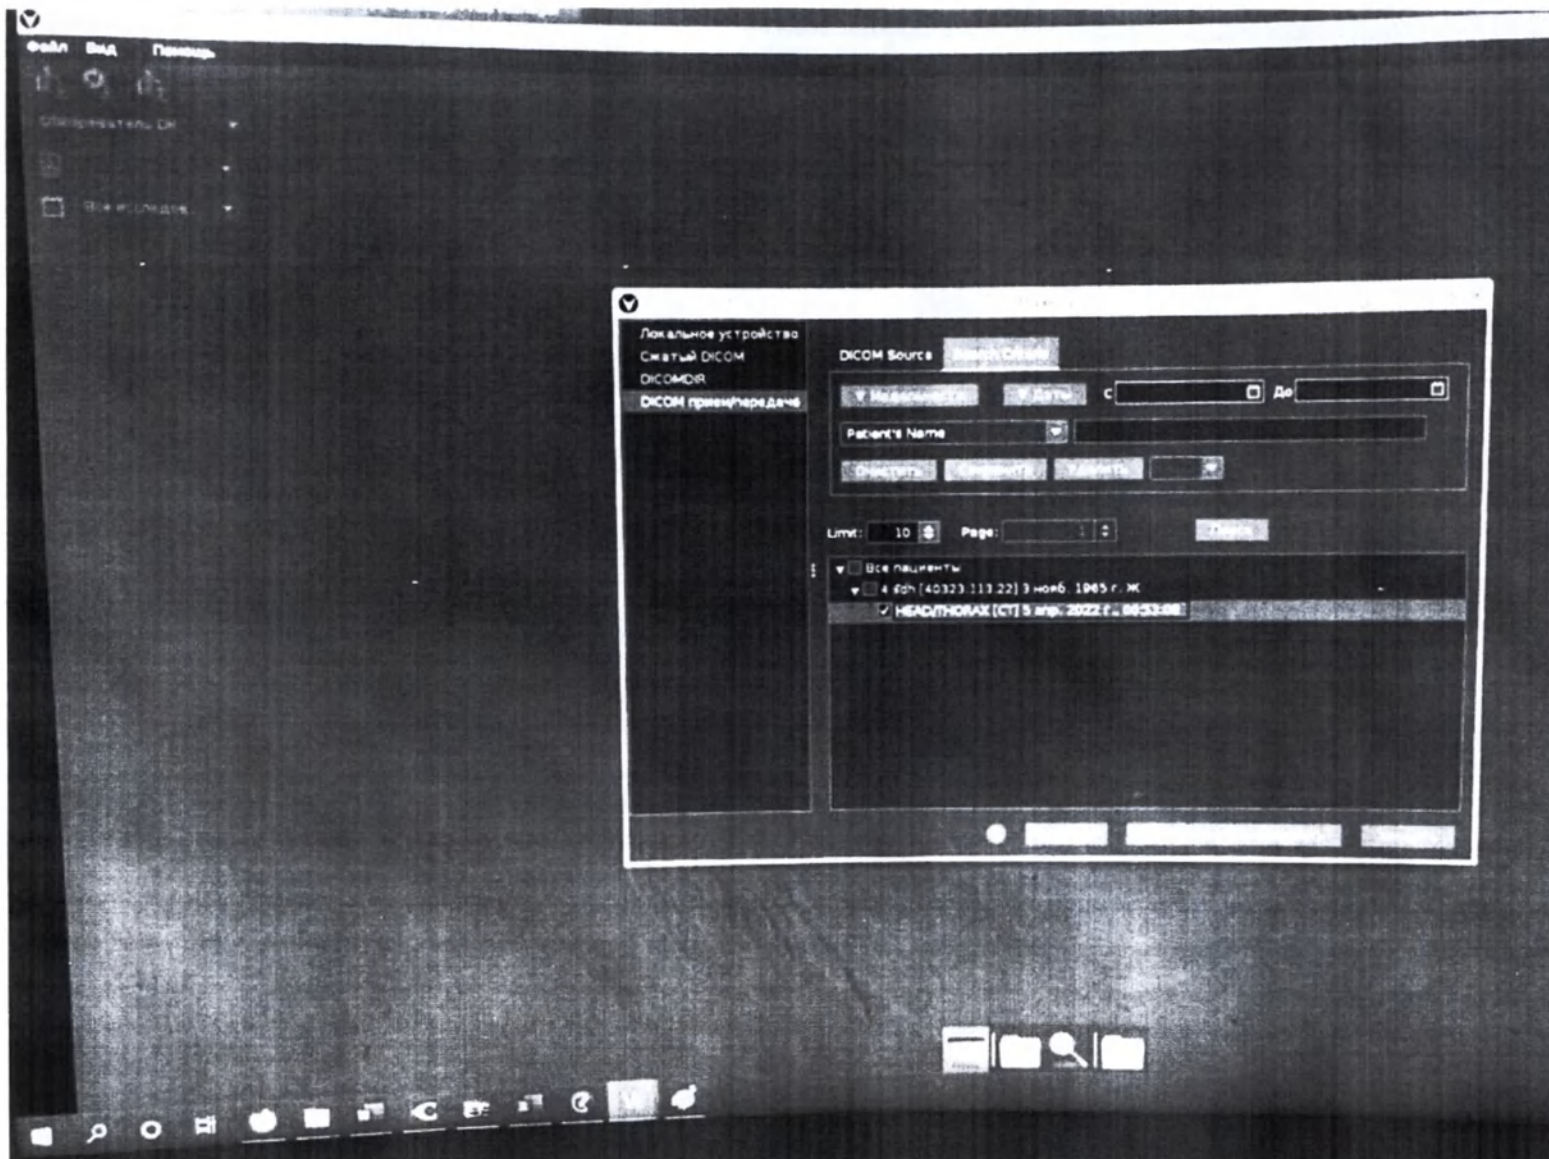

Загрузка изображения в инструментари Weasis

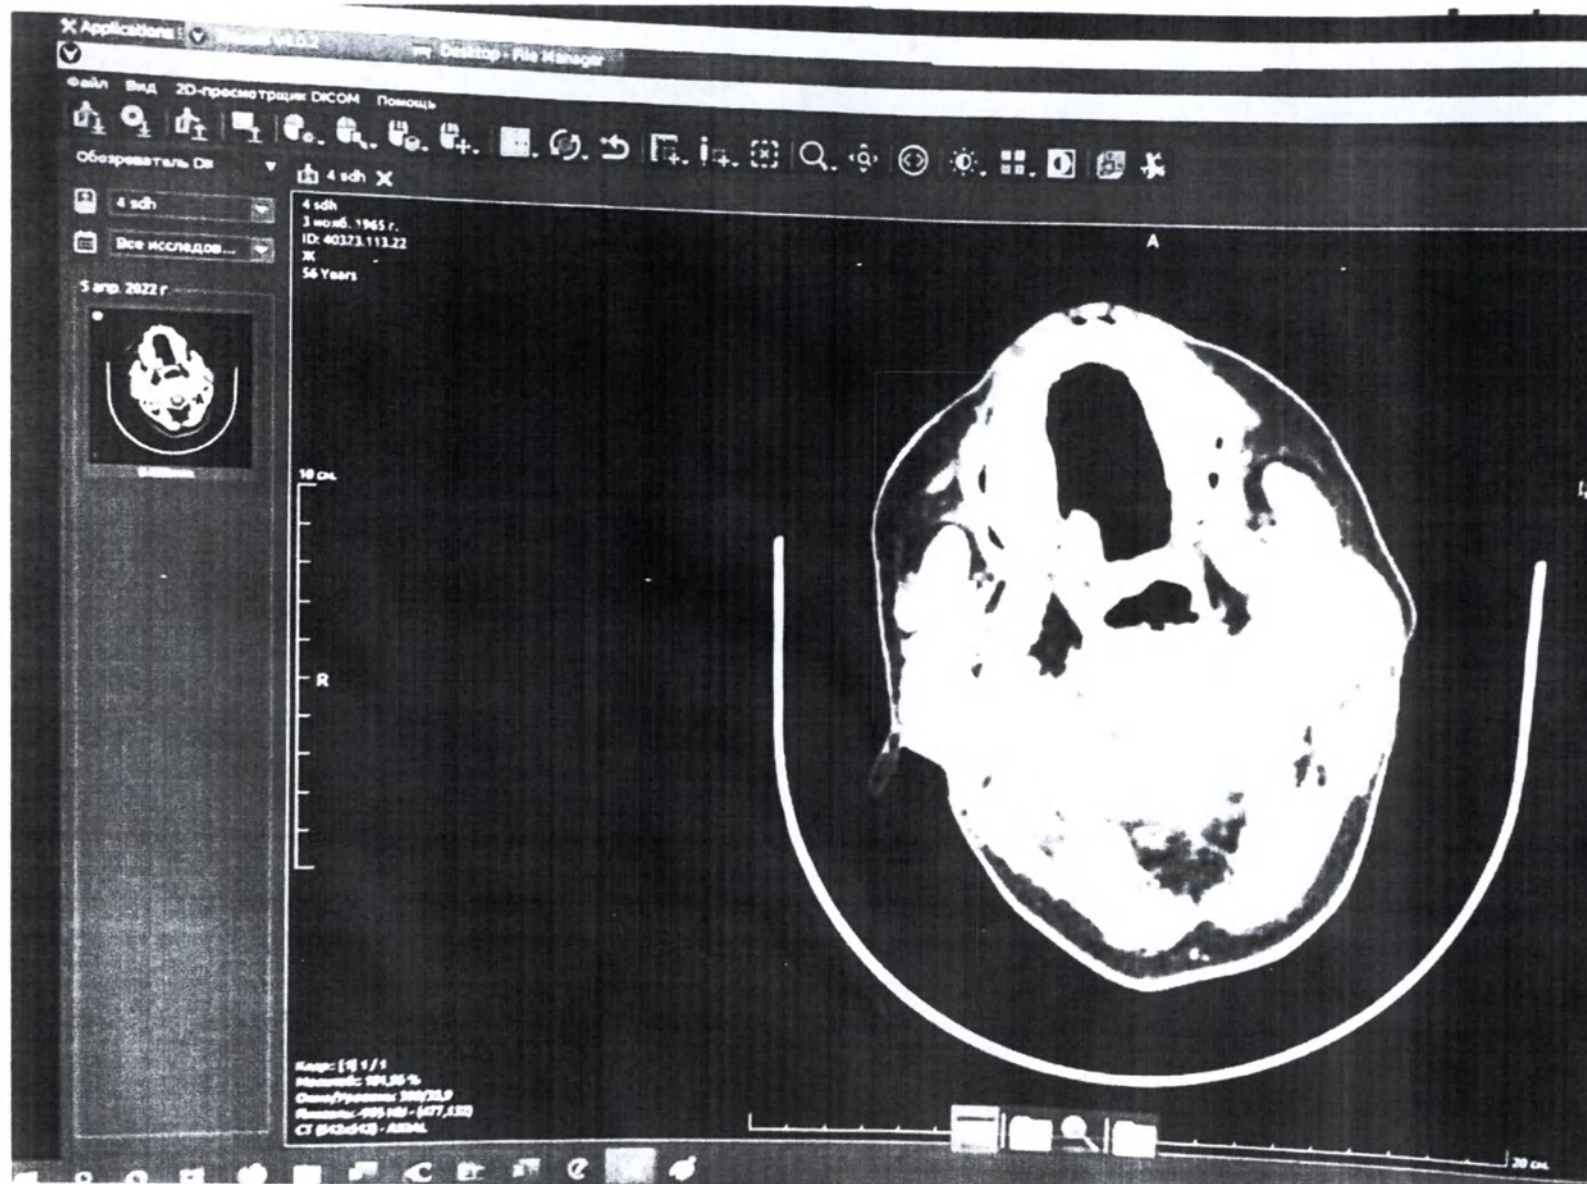

Работа с изображением в инструментарии Weasis

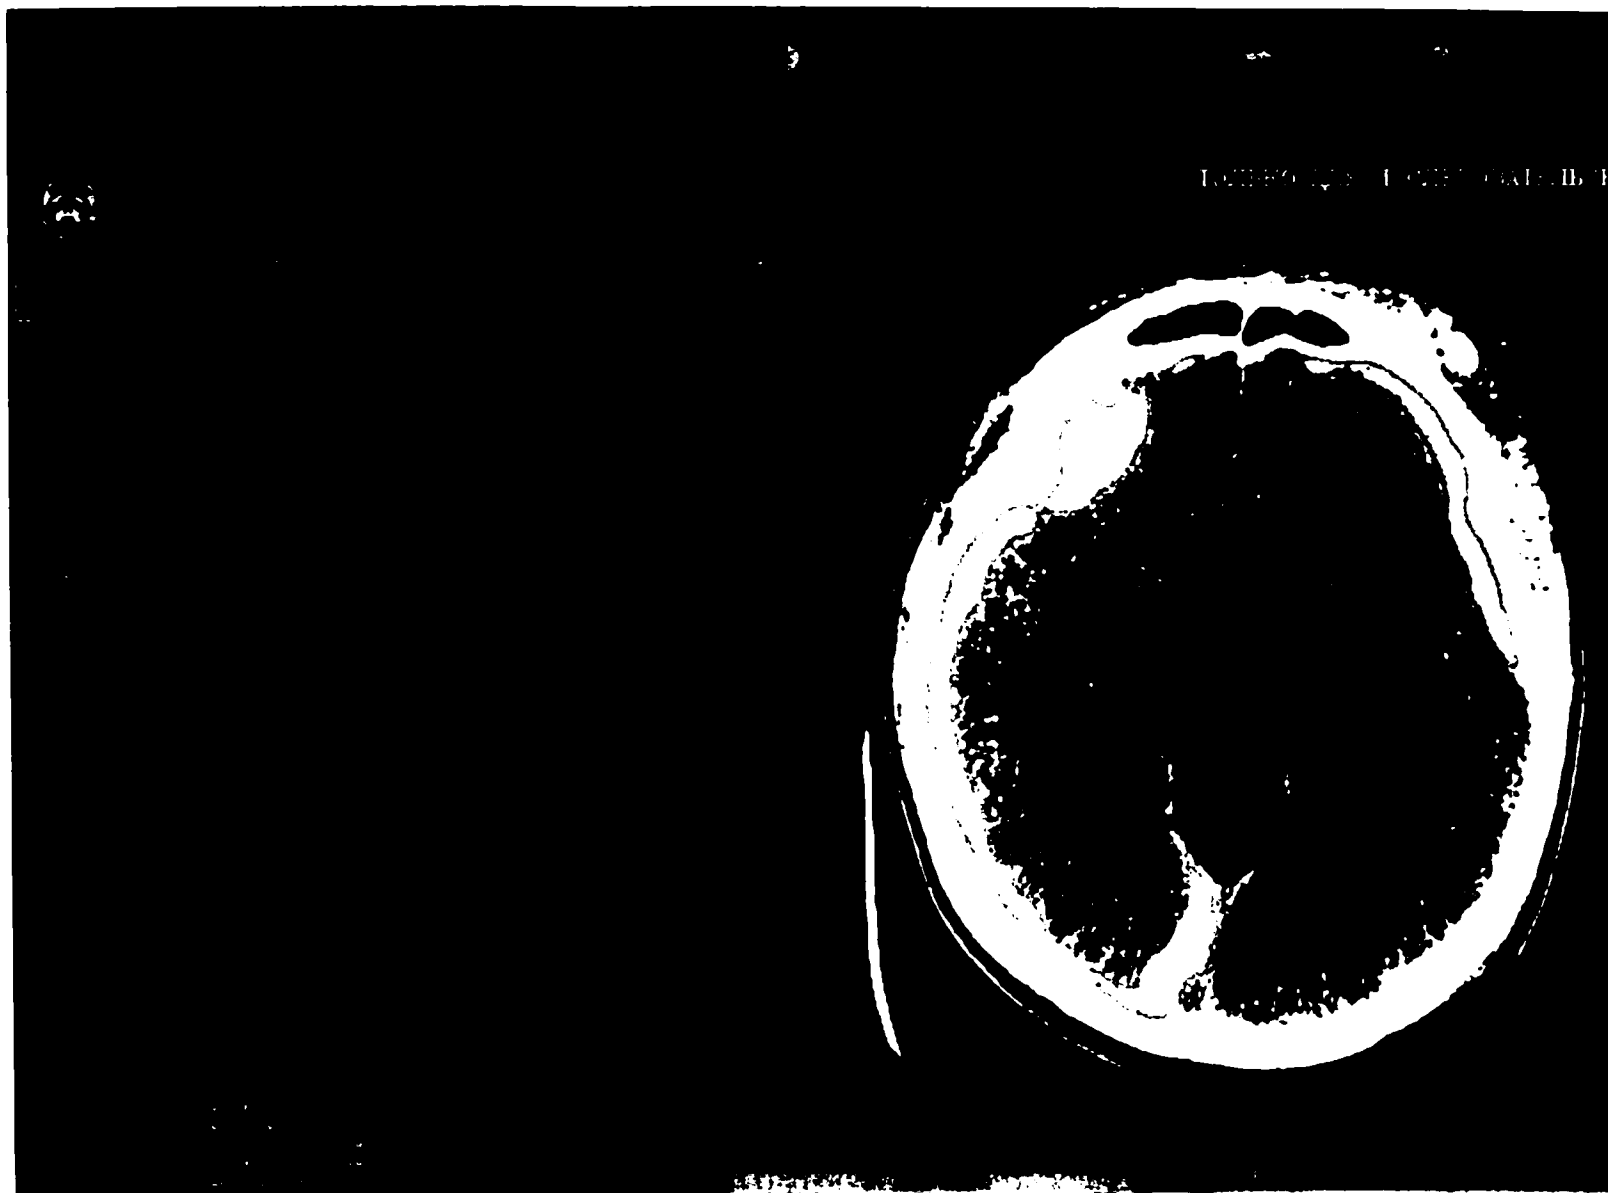

*(a) - скриншот рабочей области экрана. просмотр изображений.

Примечание:


В связи с тем, что ПО не подразумевает своего интерфейса информация о производителе, ПО, а также версии сохраняется в специальном поле метainформации DICOM файлов SeriesDescription во всех дополнительных сериях, генерируемых ПО, как результат обработки данных.

В зависимости от вида используемого просмотрщика, пользователь видит информацию о ПО либо в рабочей области экрана при отображении исследования, либо может увидеть эту информацию через просмотр тегов исследования.

Ниже на рисунках представлены скриншоты рабочей области экрана (а) и тегов исследования (б) на примере одного из просмотрщиков, где содержатся сведения, которые могут рассматриваться в качестве маркировки медицинского изделия, предназначенные для пользователя с целью получения информации о наименовании, производителе, версии программного обеспечения и т.д.

10 листов

Коммерческий руководитель по направлению
"Медицина"

Подпись  /Рыков Б.А. /

