

Фотографические изображения медицинского изделия
Имплантат для остеосинтеза рассасывающийся стерильный
по ТУ 32.50.22-021-52318770-2022

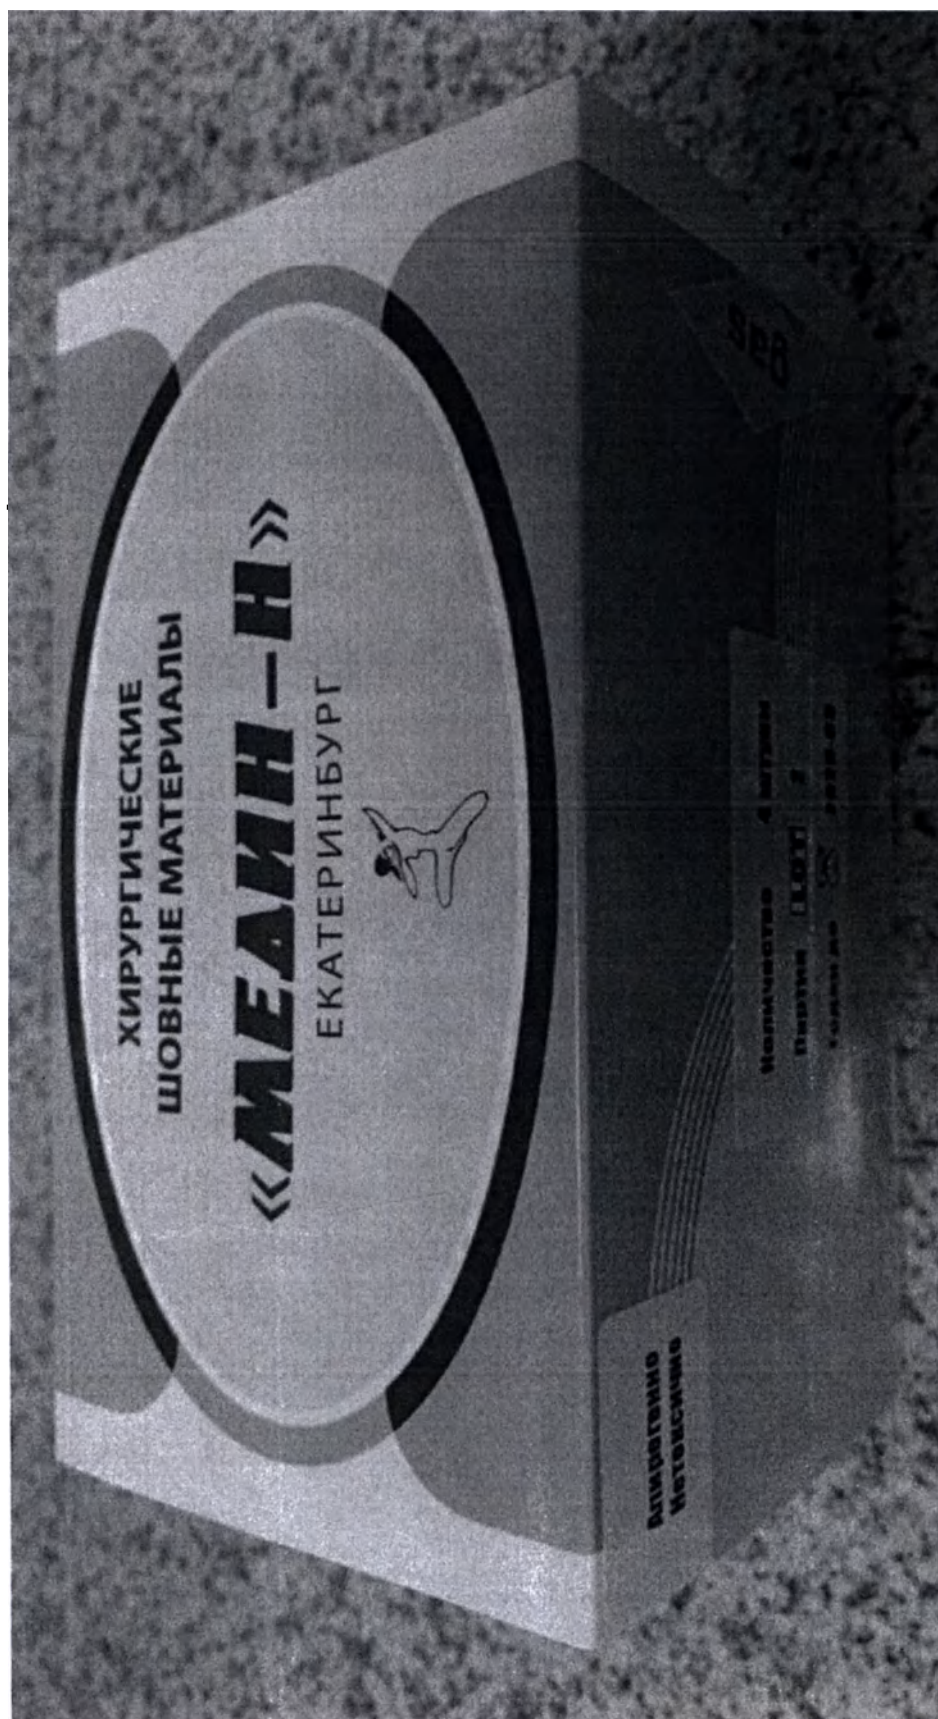


Фото 1 – Групповая упаковка
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2х20 мм, стерильный - Пин 2х20

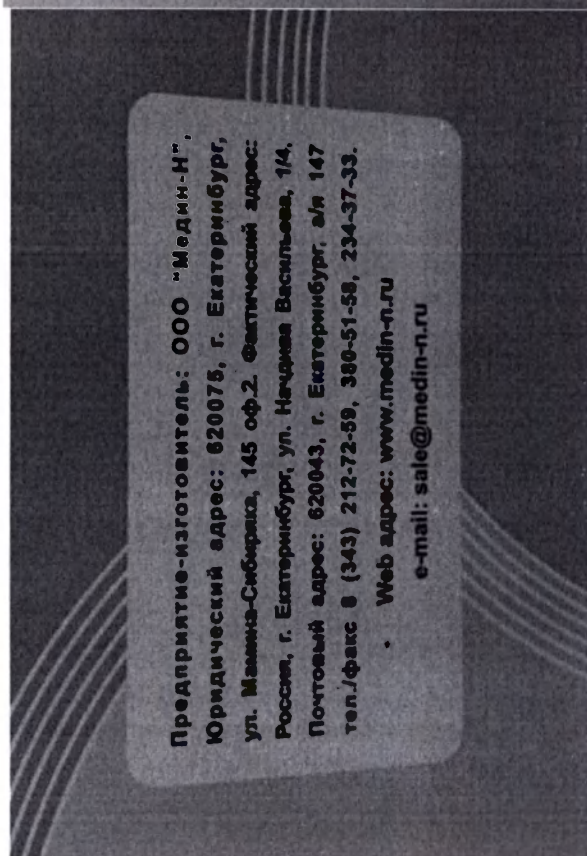
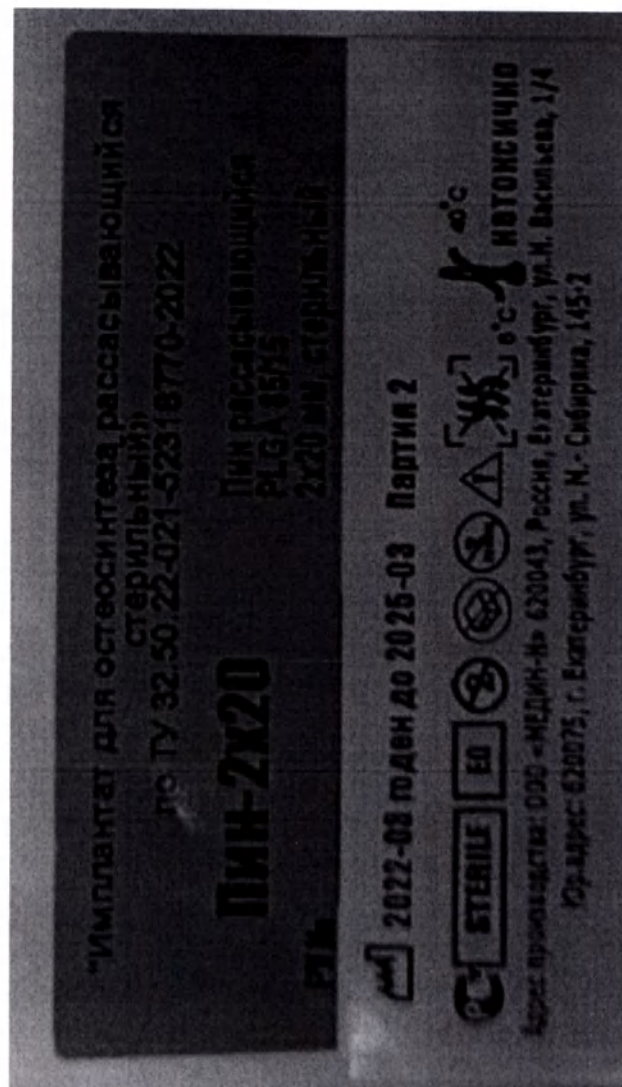
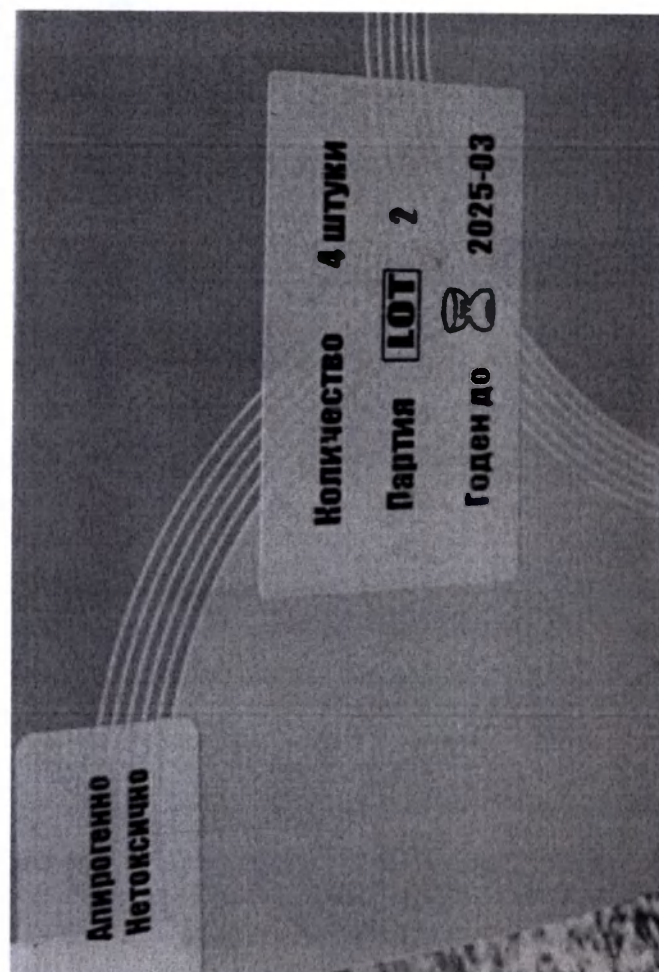


Фото 2 – Маркировка групповой упаковки
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2x20 мм, стерильный - Пин 2×20

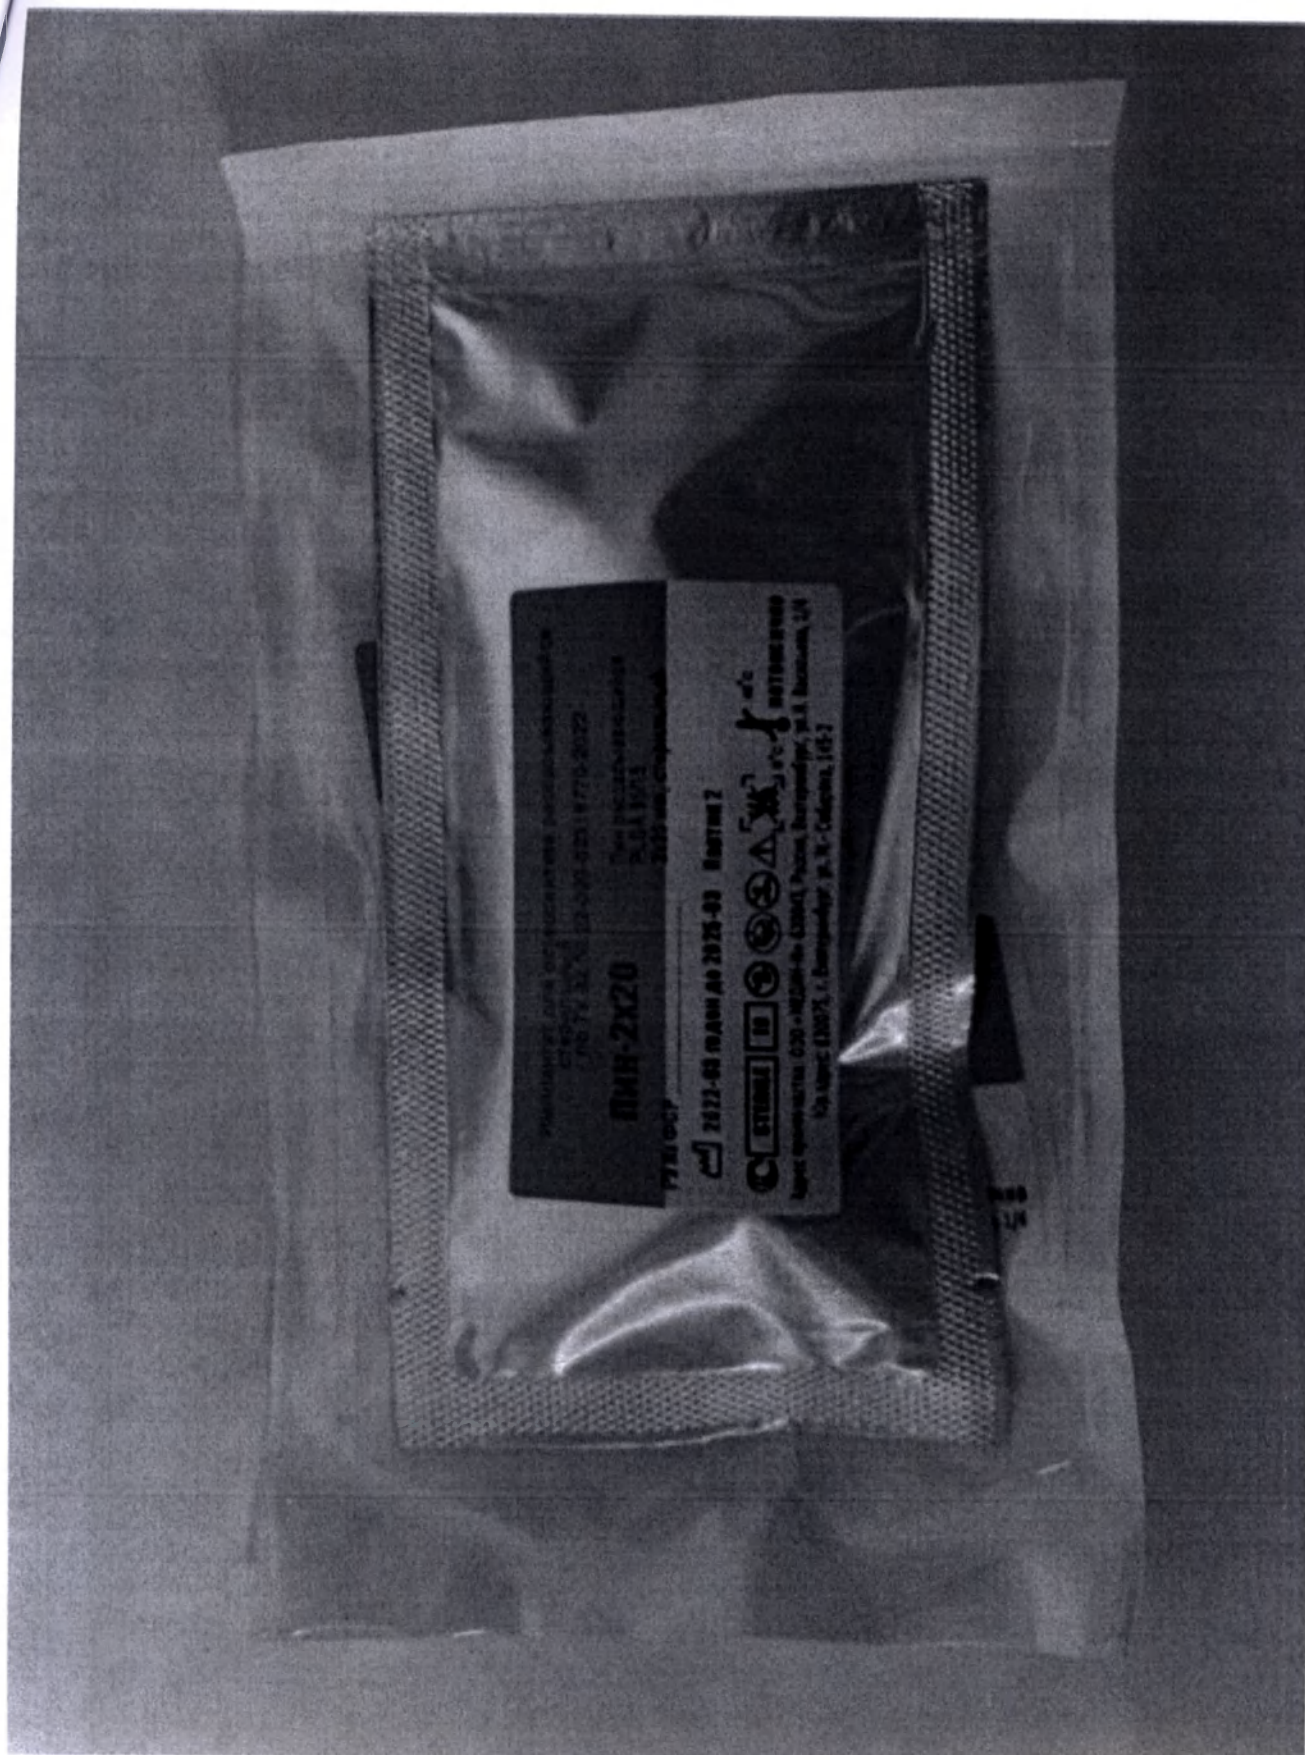


Фото 3 – Стерилизационная упаковка
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2x20 мм, стерильный - Пин 2×20



Фото 5 – Пенал из полиэтилена для изделия
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2х20 мм, стерильный - Пин 2×20

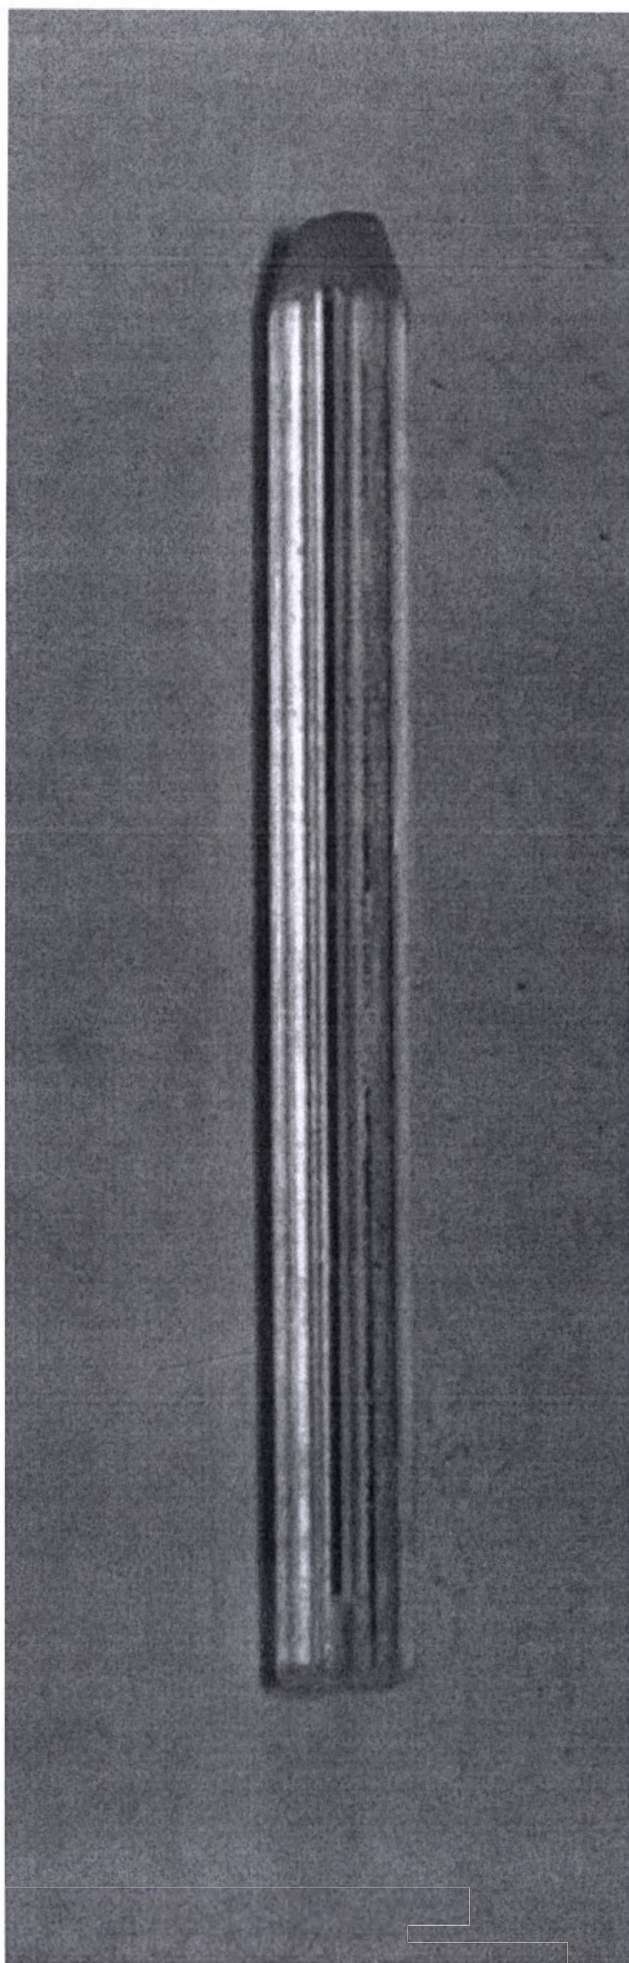


Фото 6 – Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2x20 мм, стерильный - Пин 2×20



Фото 7 – Групповая упаковка
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2х30 мм, стерильный - Пин 2х30

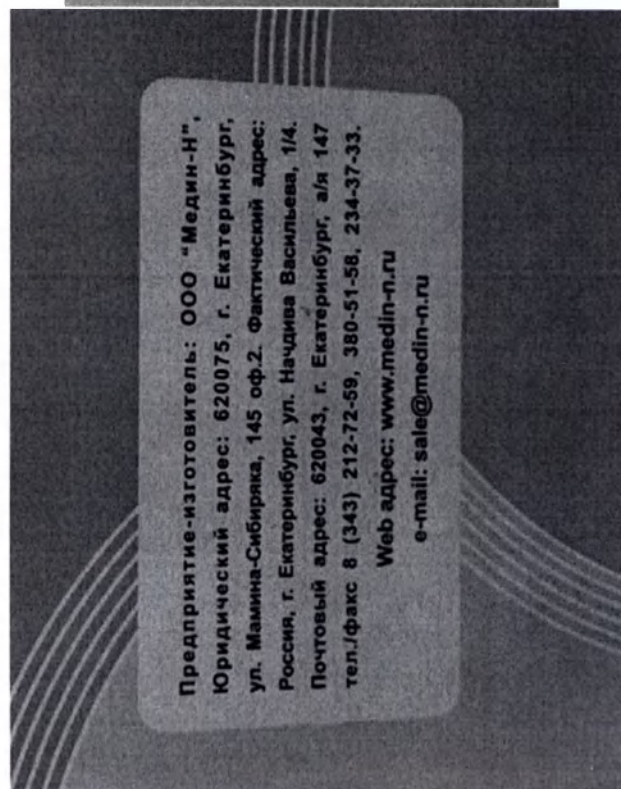
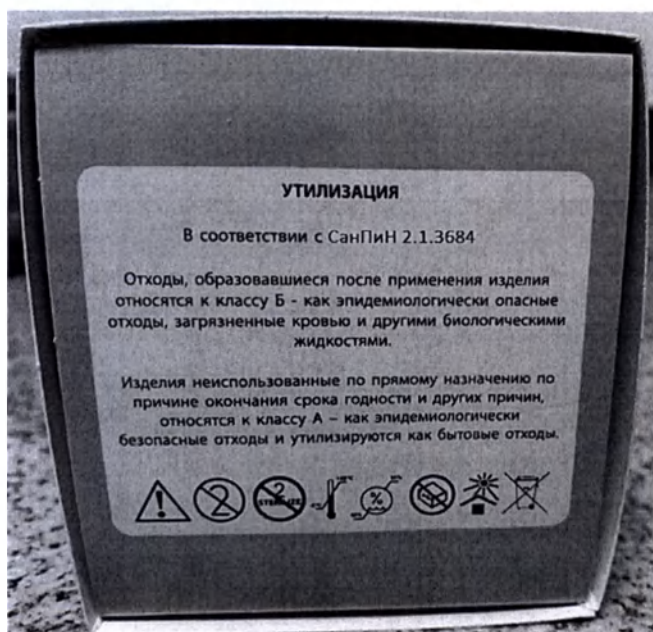
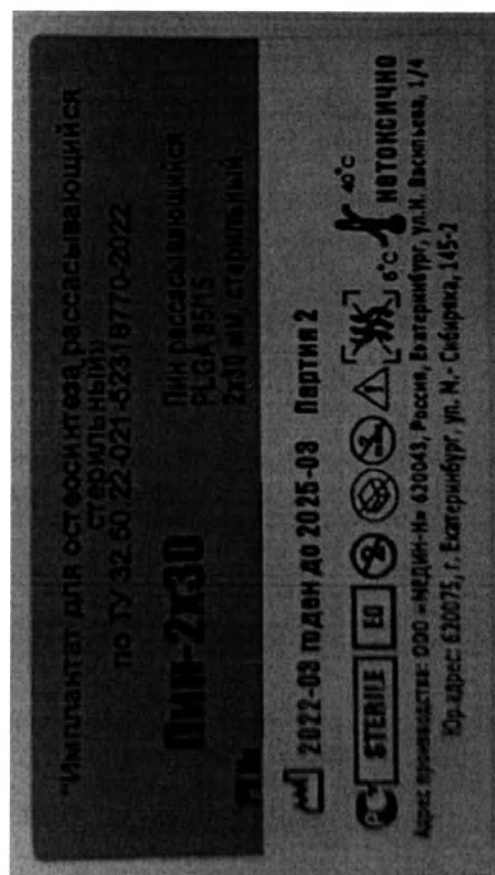
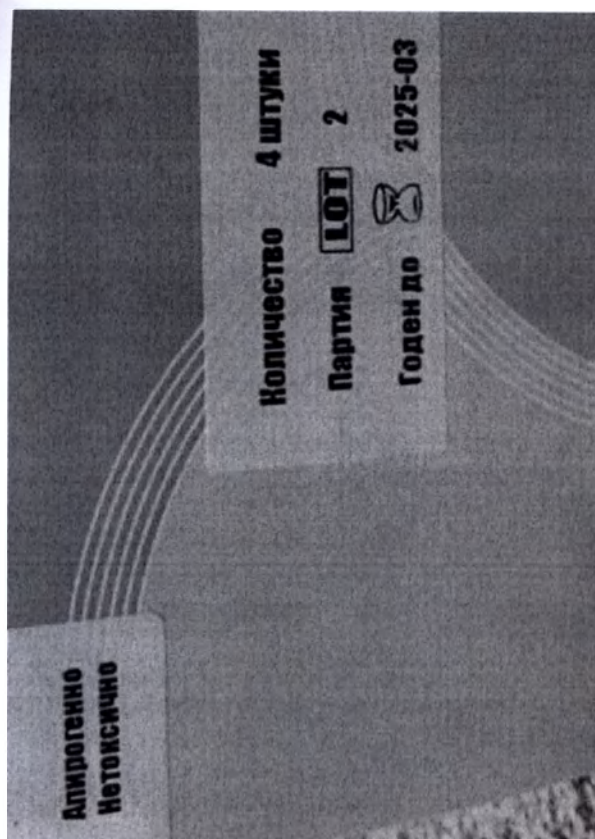


Фото 8 – Маркировки групповой упаковки
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2x30 мм, стерильный - Пин 2x30

"Имплантат для остеосинтеза, рассасывающийся
стерильный»
по ТУ 32.50.22-021-82318770-2022

ПИН-2х30

Пин рассасывающийся
PLGA 85/15
2х30 мм, стерильный

 2022-08 годен до 2025-08 Партия 2


 СТЕРИЛЕ

EO







 40°C

НЕТОКСИЧНО

Адрес производства: ООО «МЕДИН-Н» 620043, Россия, Екатеринбург, ул. Н. Васильева, 1/4
Юр. адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. М.- Сибиряка, 145-2

Фото 9 – Маркировка стерилизационной упаковки
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2х30 мм, стерильный - Пин 2х30

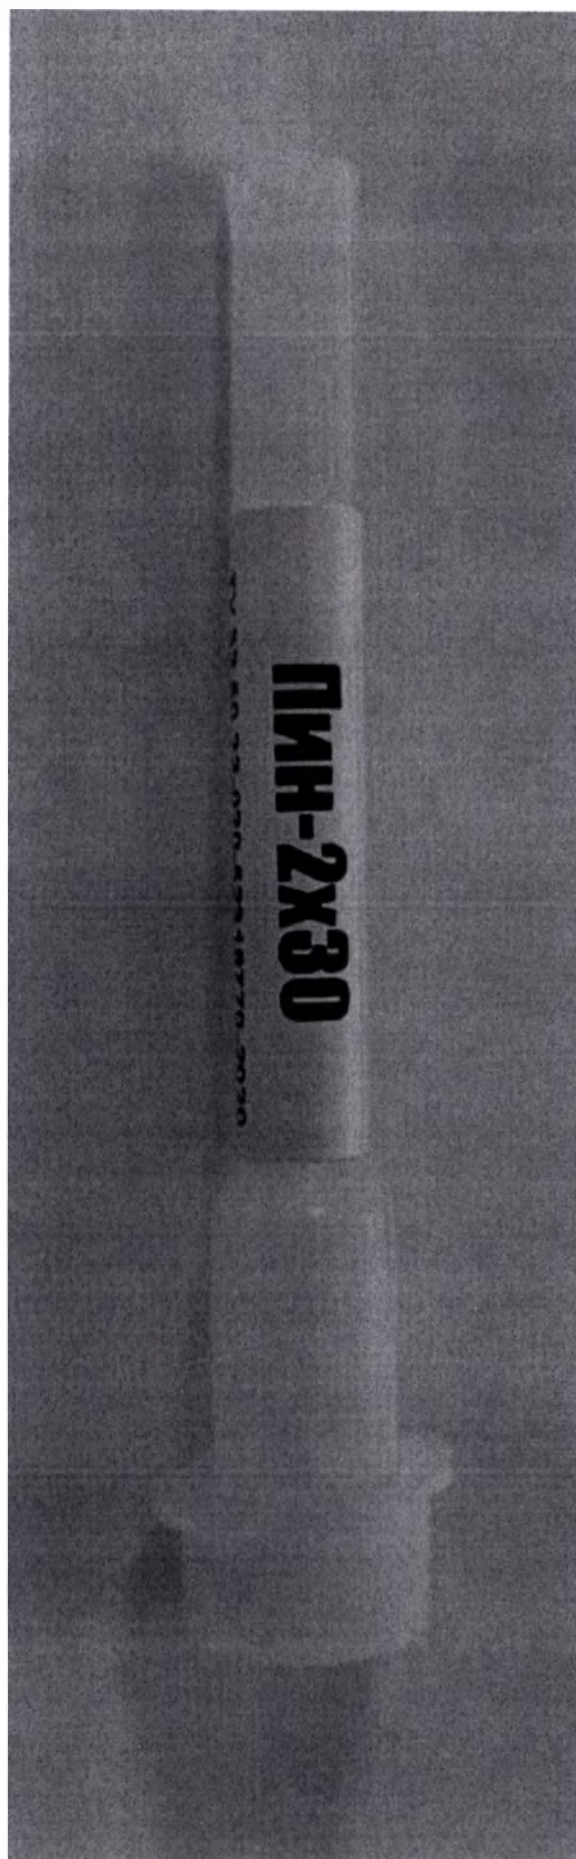


Фото 10 – Пенал из полиэтилена для изделия
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2х30 мм, стерильный - Пин 2×30

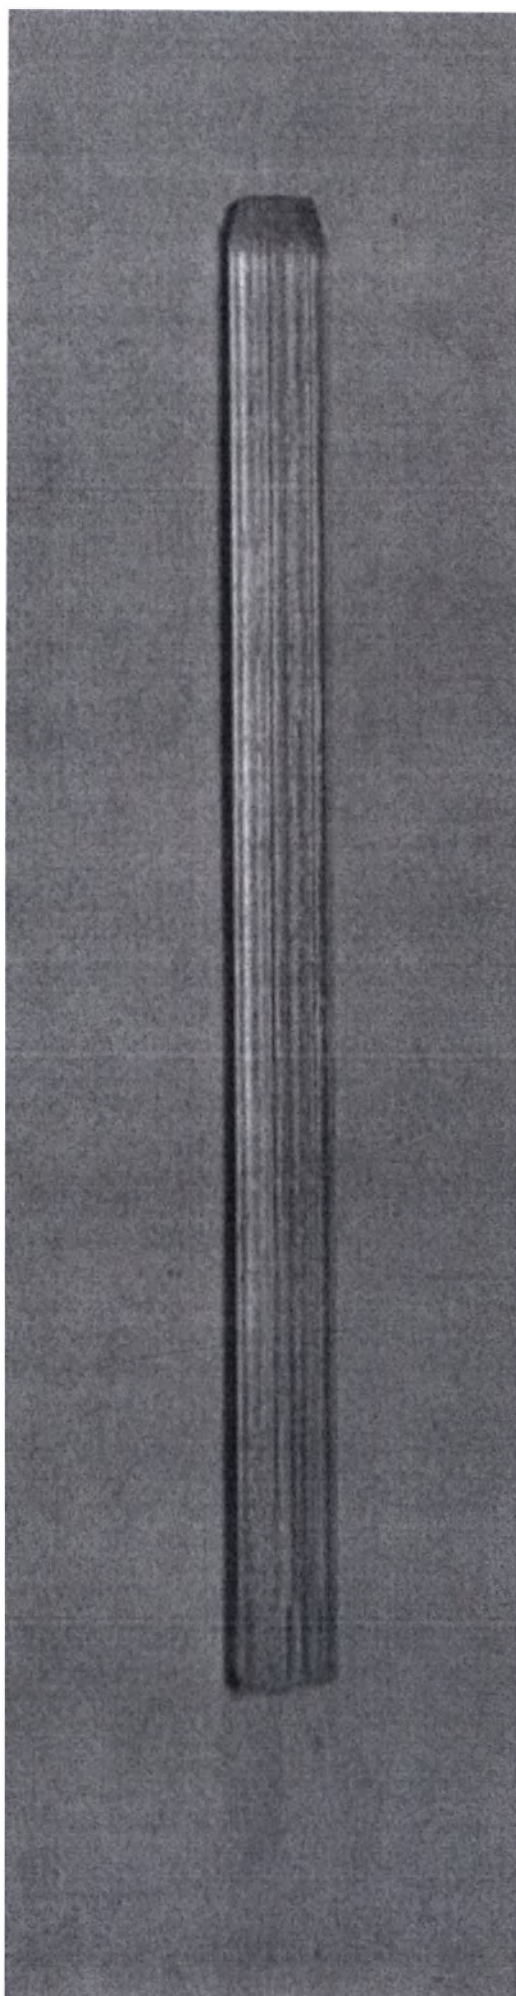


Фото 11 – Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2x30 мм, стерильный - Пин 2×30

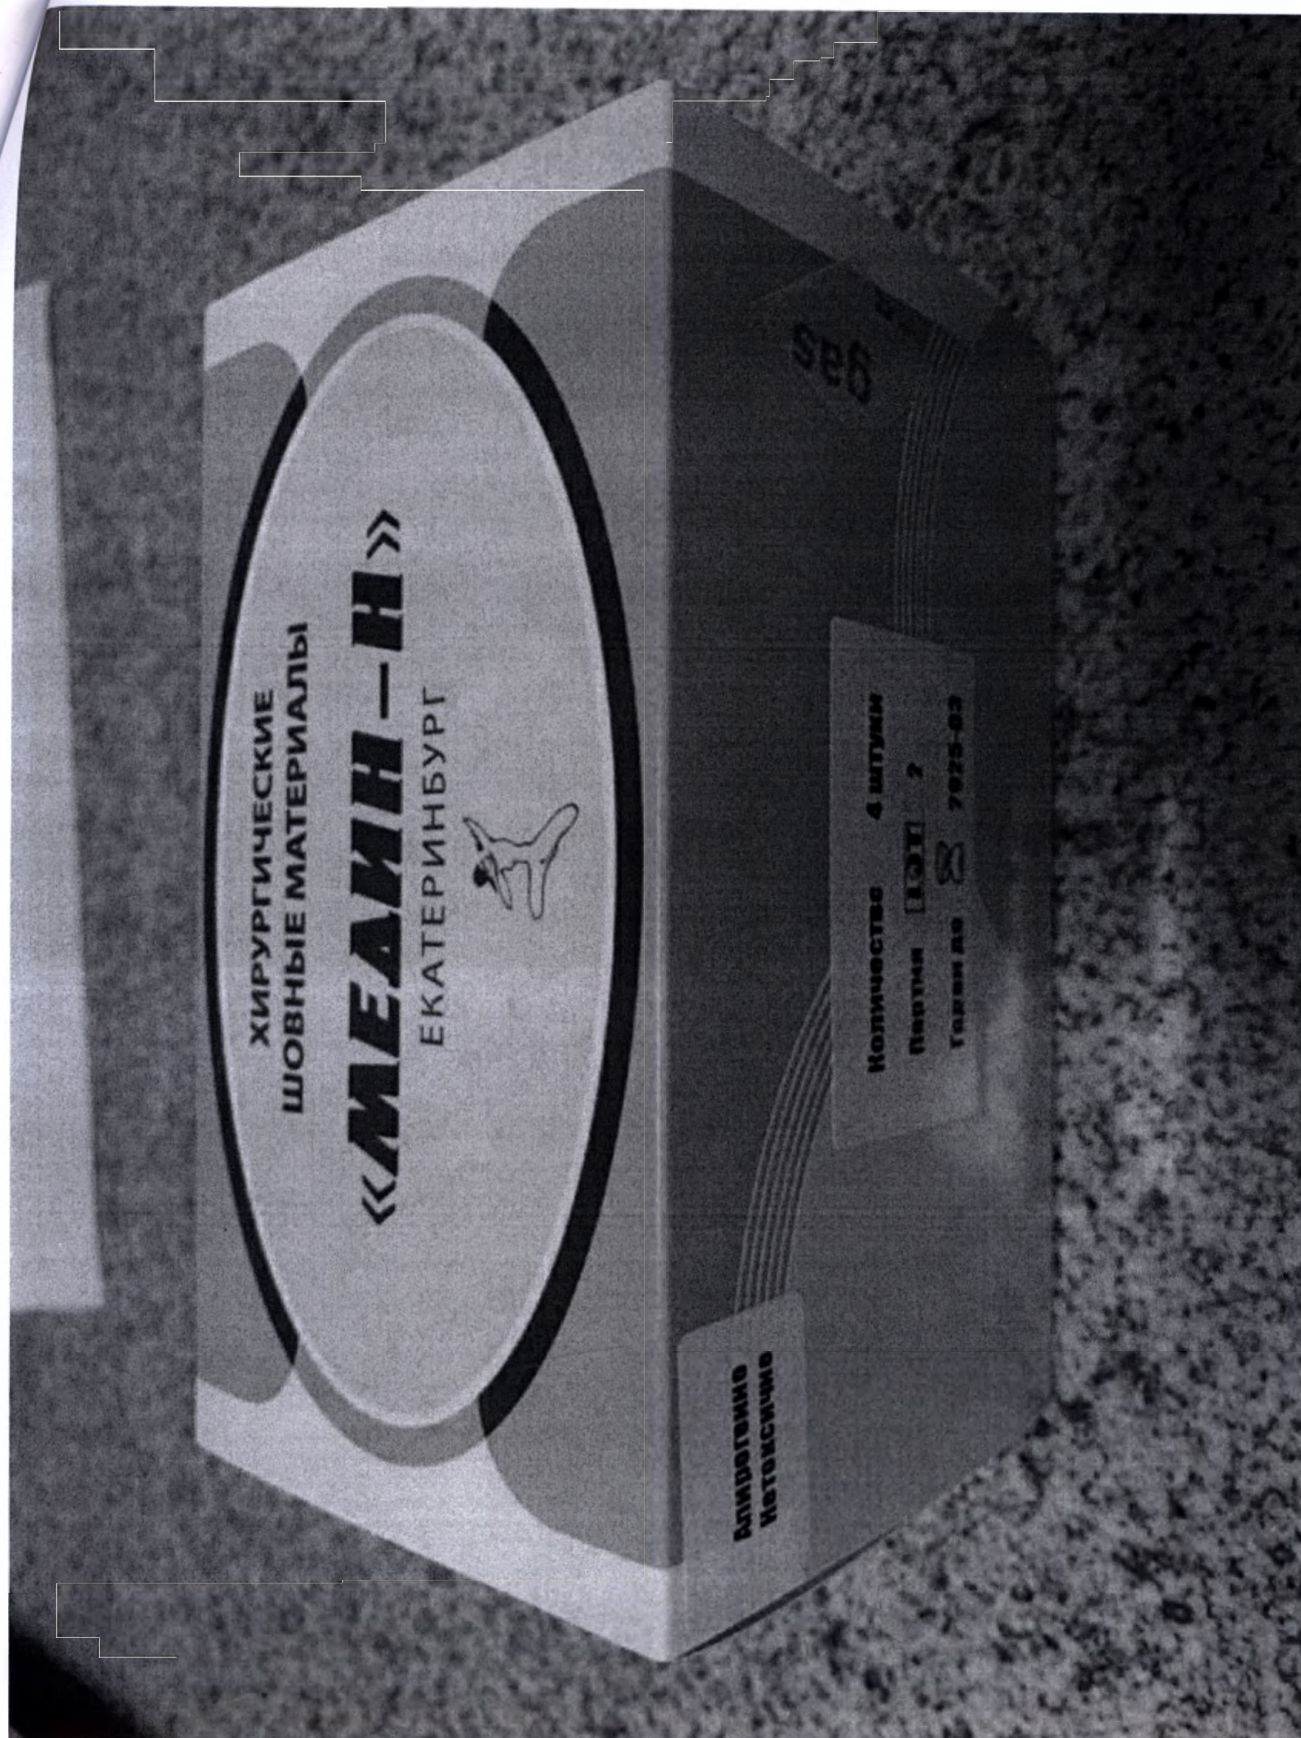


Фото 12 – Групповая упаковка
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2x40 мм, стерильный - Пин 2×40

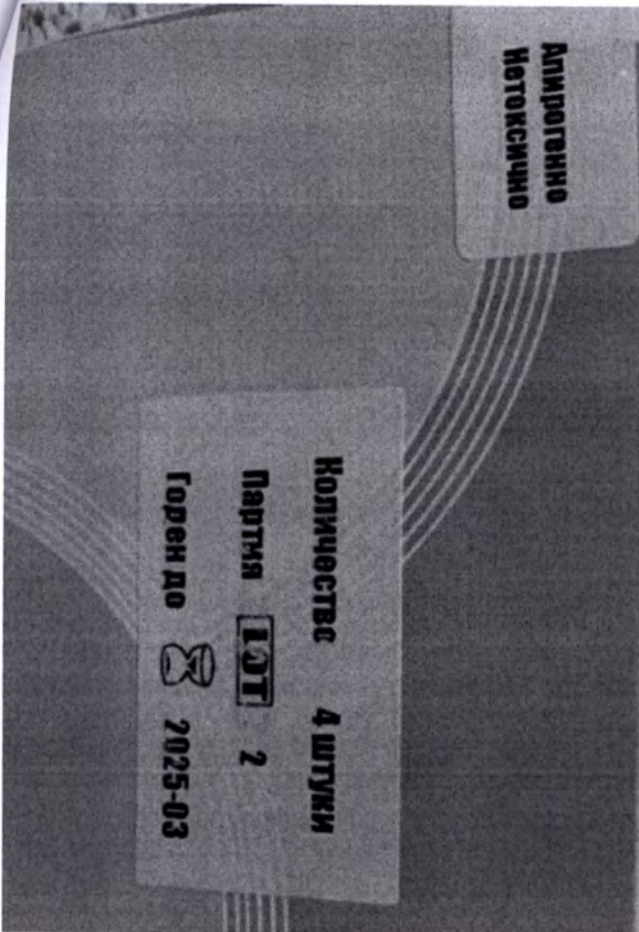
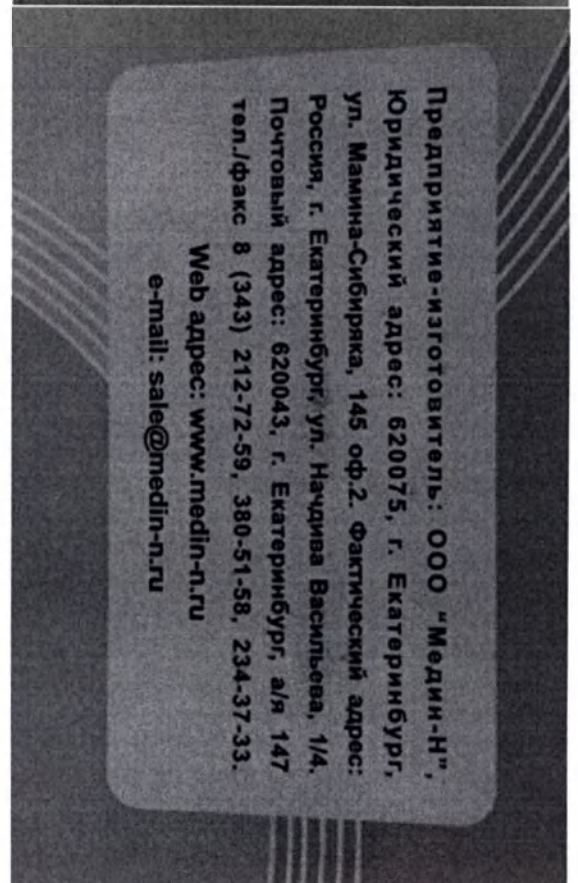


Фото 13 – Маркировки групповой упаковки
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2х40 мм, стерильный - Пин 2х40

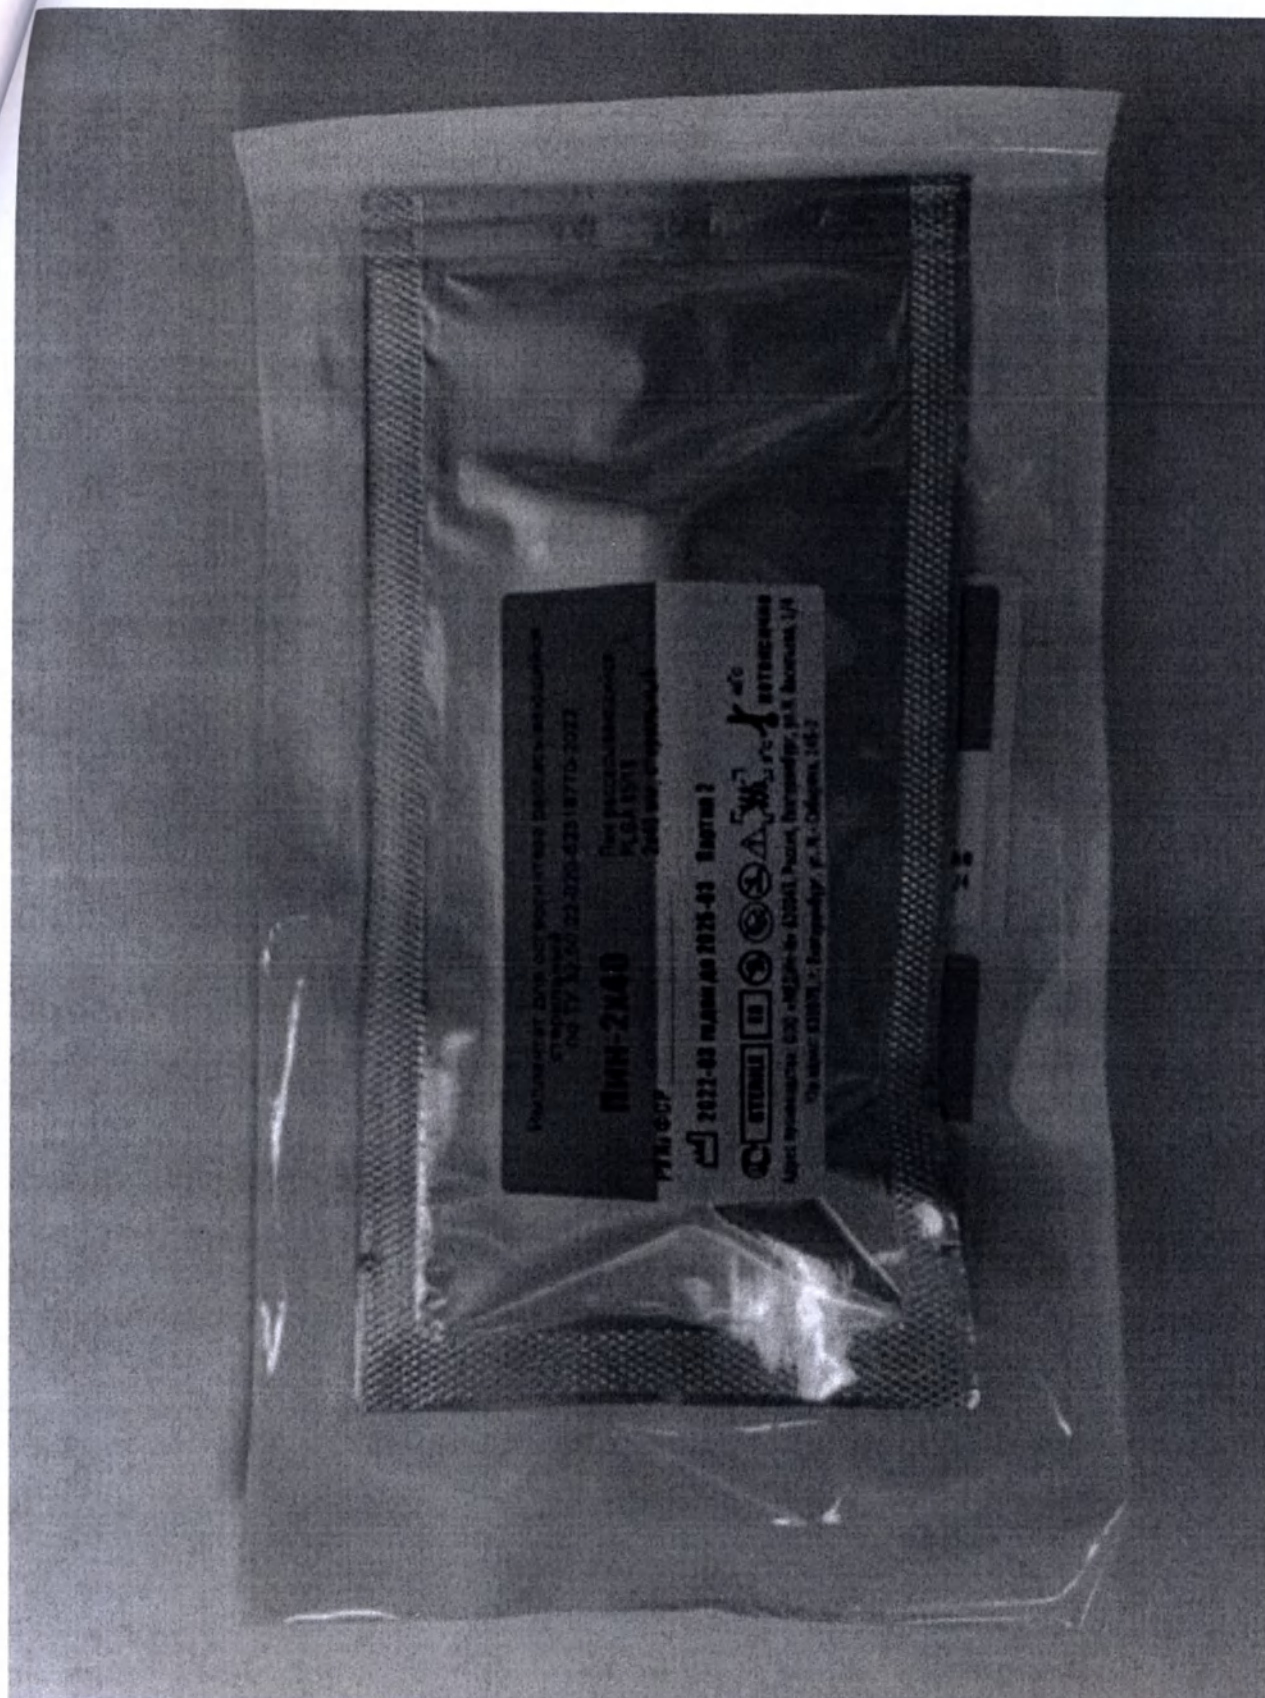


Фото 14 – Стерилизационная упаковка
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2x40 мм, стерильный - Пин 2×40




Имплантат для остеосинтеза, рассасывающийся
стерильный)
по ТУ 32.50.22-021-82318770-2022

ПИН-2х40

Пин рассасывающийся
PLGA 85/15
2х40 мм, стерильный

2022-08 годен до 2025-08 Партия 2

STERILE EO



Адрес производства: ООО «МЕДИН-Н» 620043, Россия, Екатеринбург, ул. Н. Васильева, 1/4
Юр. адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. М.- Сибиряка, 145-2

Фото 15 – Маркировка стерилизационной упаковки
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2х40 мм, стерильный - Пин 2х40

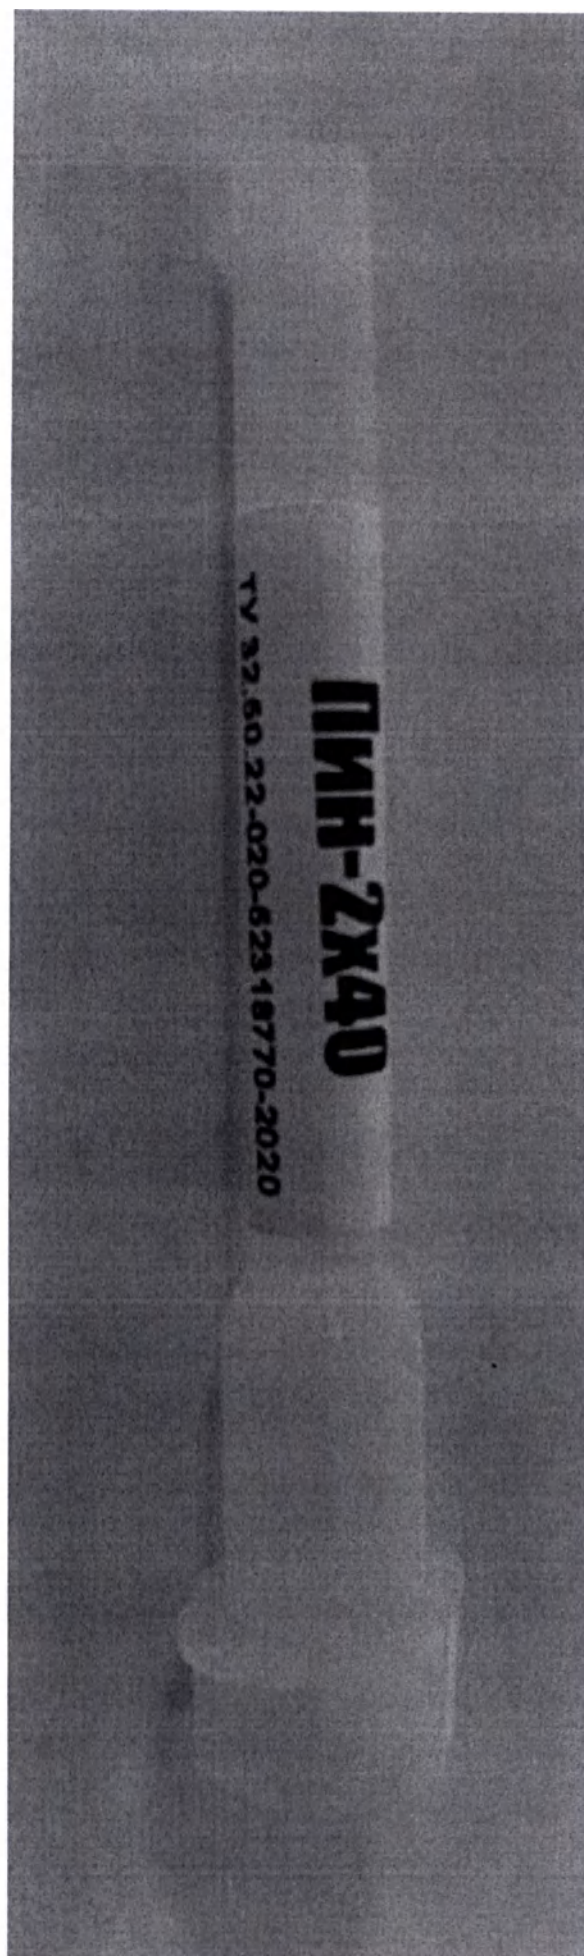


Фото 16 – Пенал из полиэтилена для изделия
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2х40 мм, стерильный - Пин 2×40

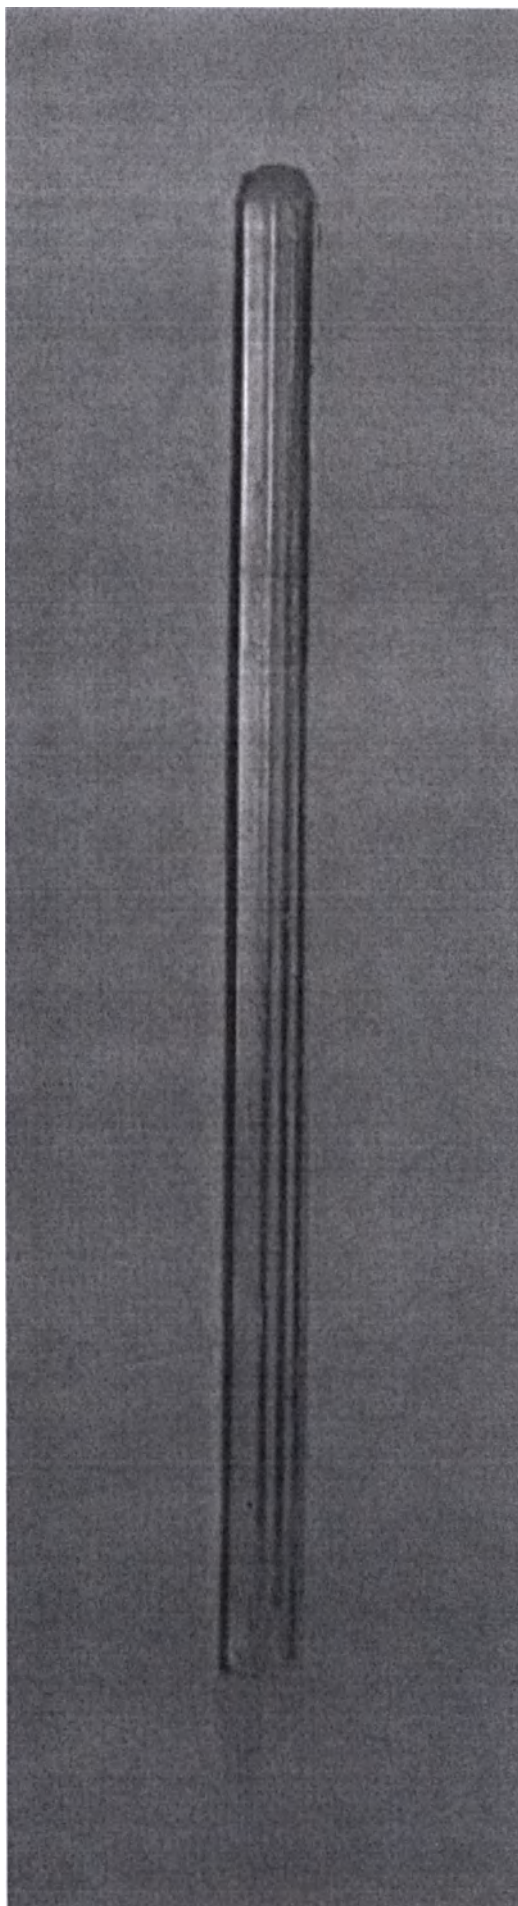


Фото 17 – Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2х40 мм, стерильный - Пин 2х40



Фото 18 – Групповая упаковка
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2х50 мм, стерильный - Пин 2х50

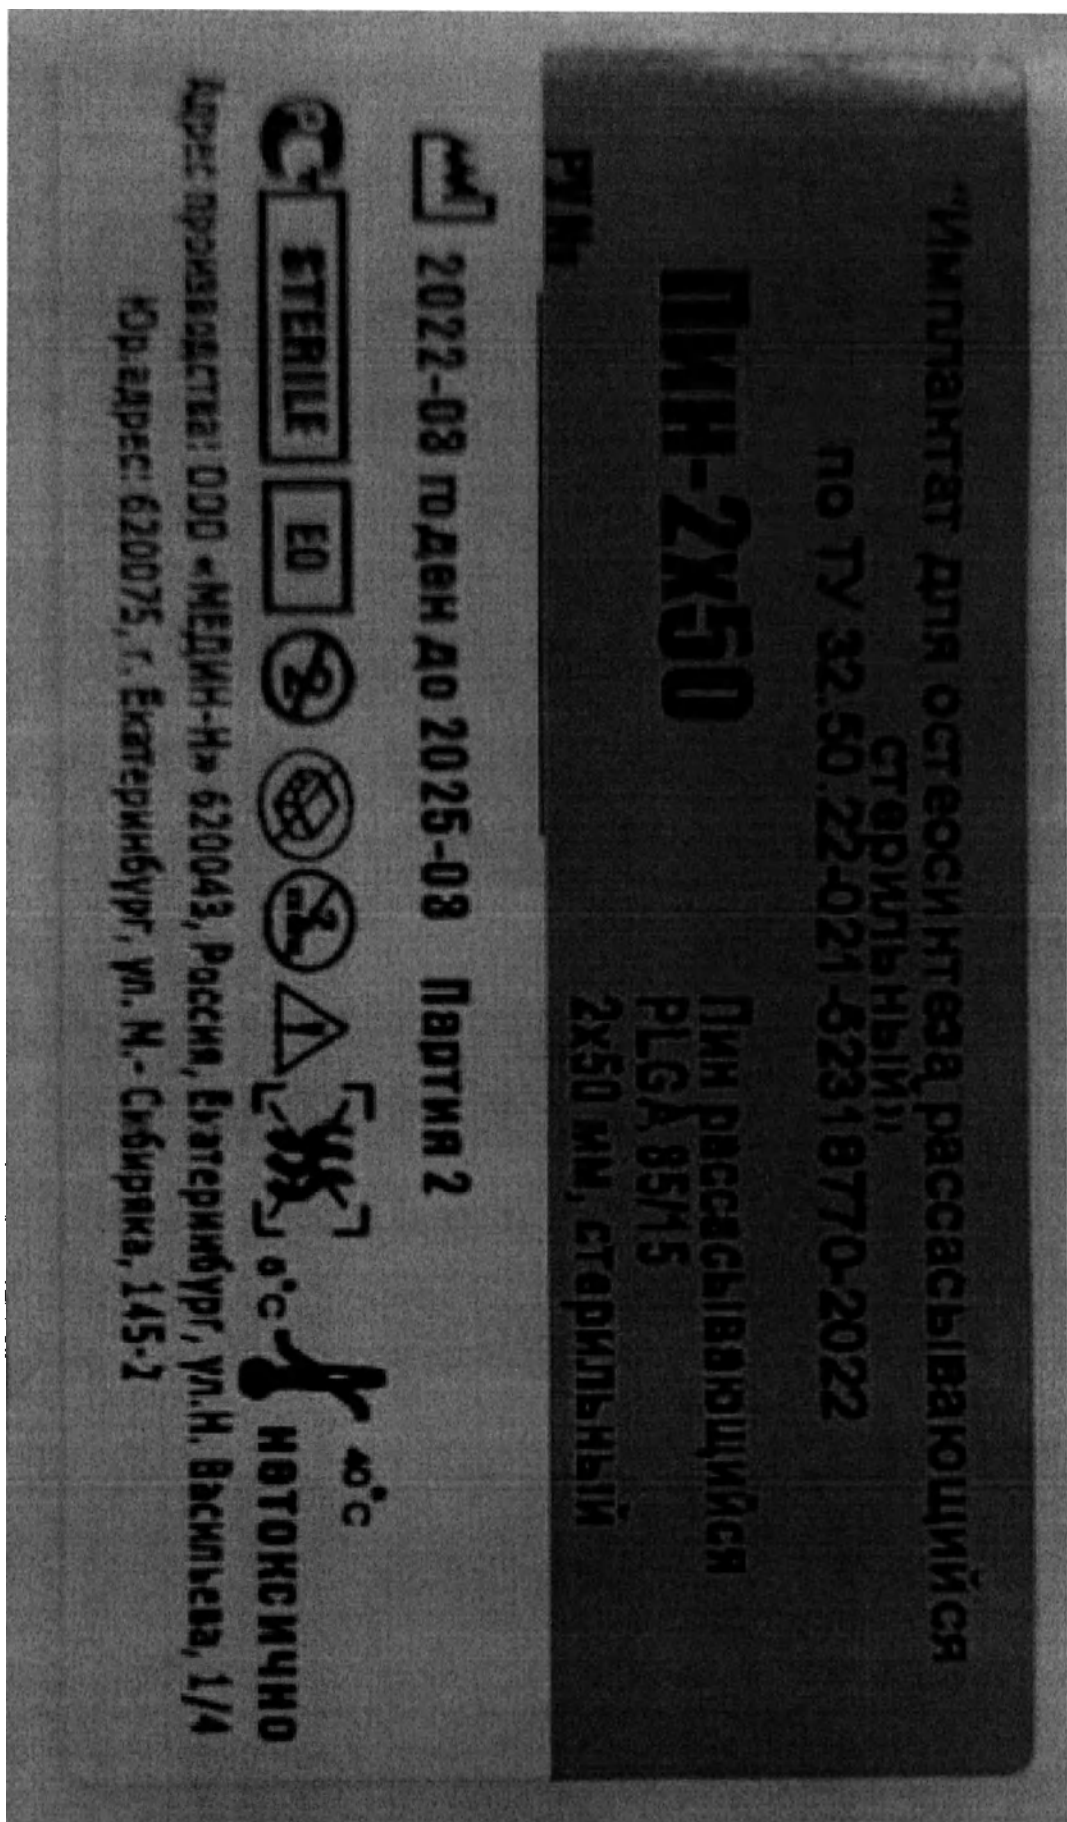


Фото 20 – Маркировка стерилизационной упаковки
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2х50 мм, стерильный - Пин 2х50

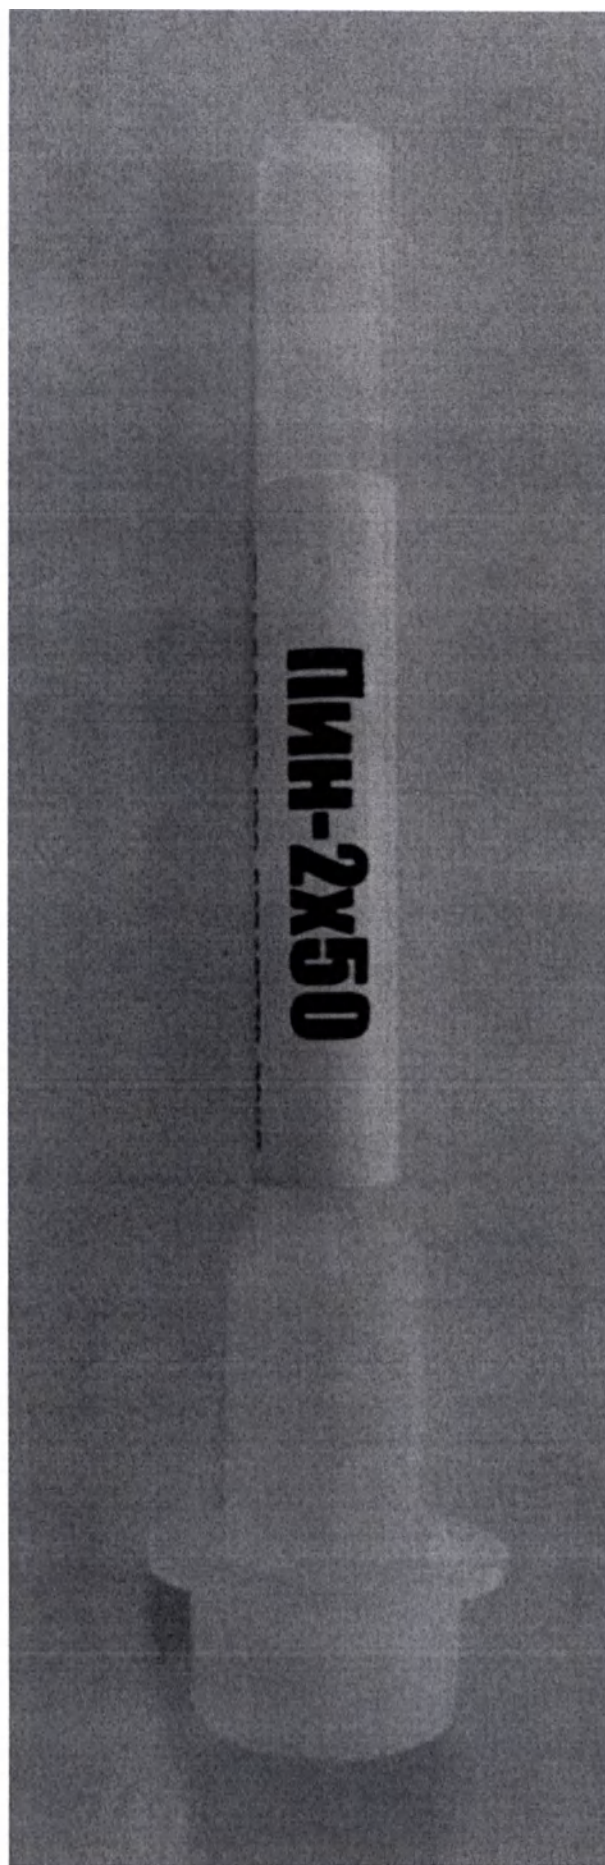


Фото 21 – Образец 4 - Пенал из полиэтилена для изделия
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2x50 мм, стерильный - Пин 2×50

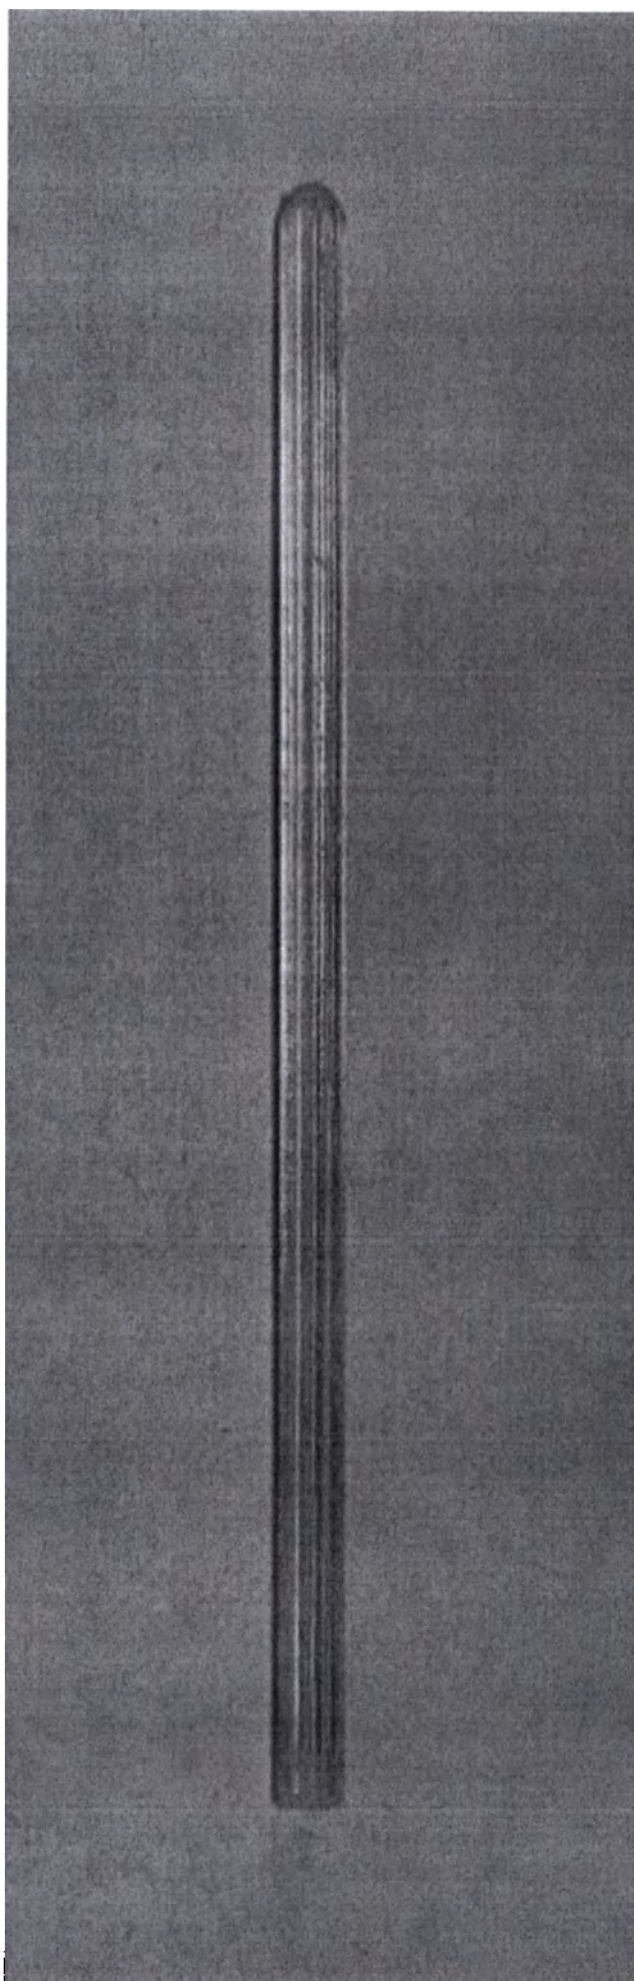


Фото 22 – Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2x50 мм, стерильный - Пин 2×50

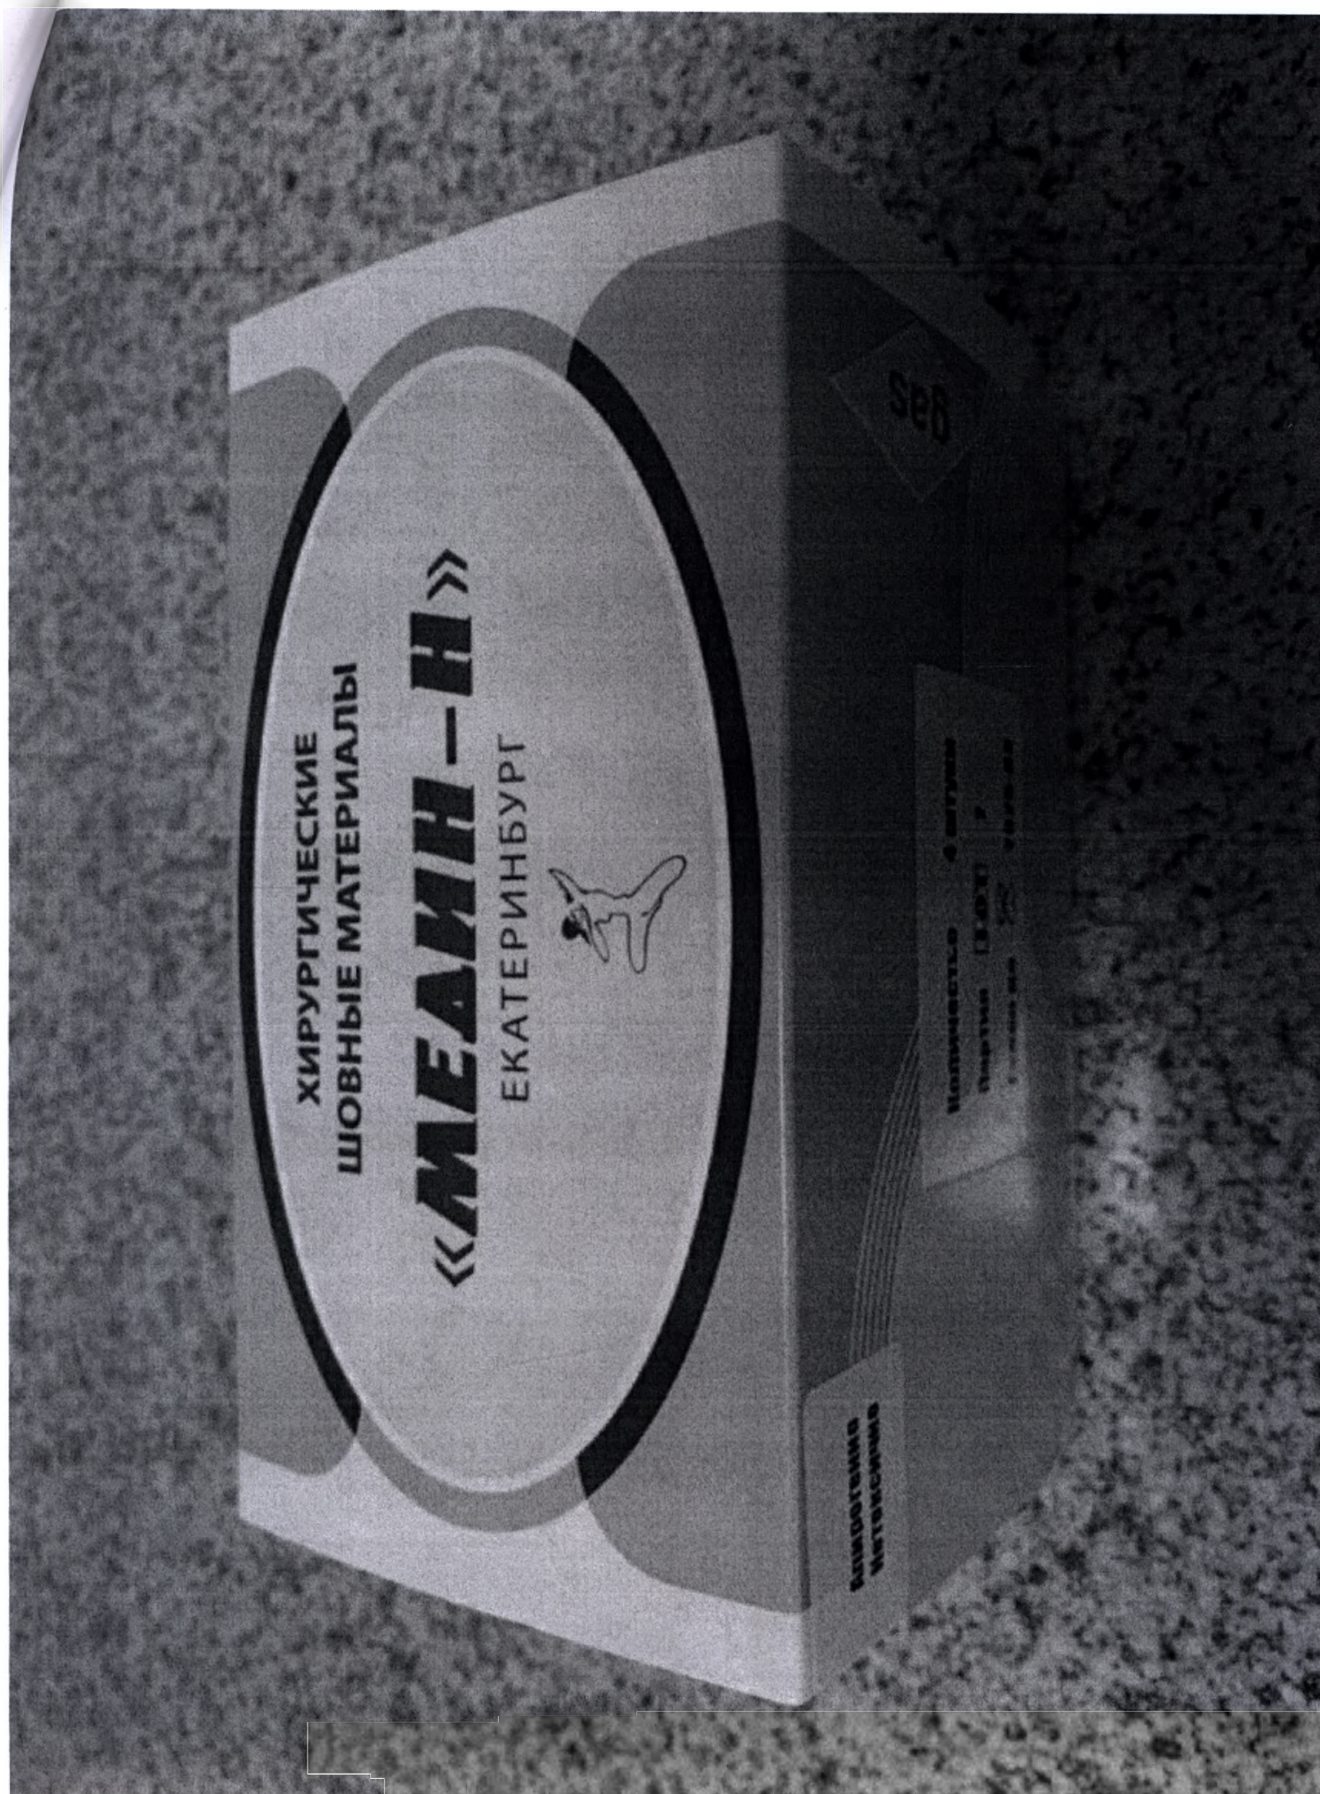


Фото 23 – Групповая упаковка
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2x60 мм, стерильный - Пин 2×60

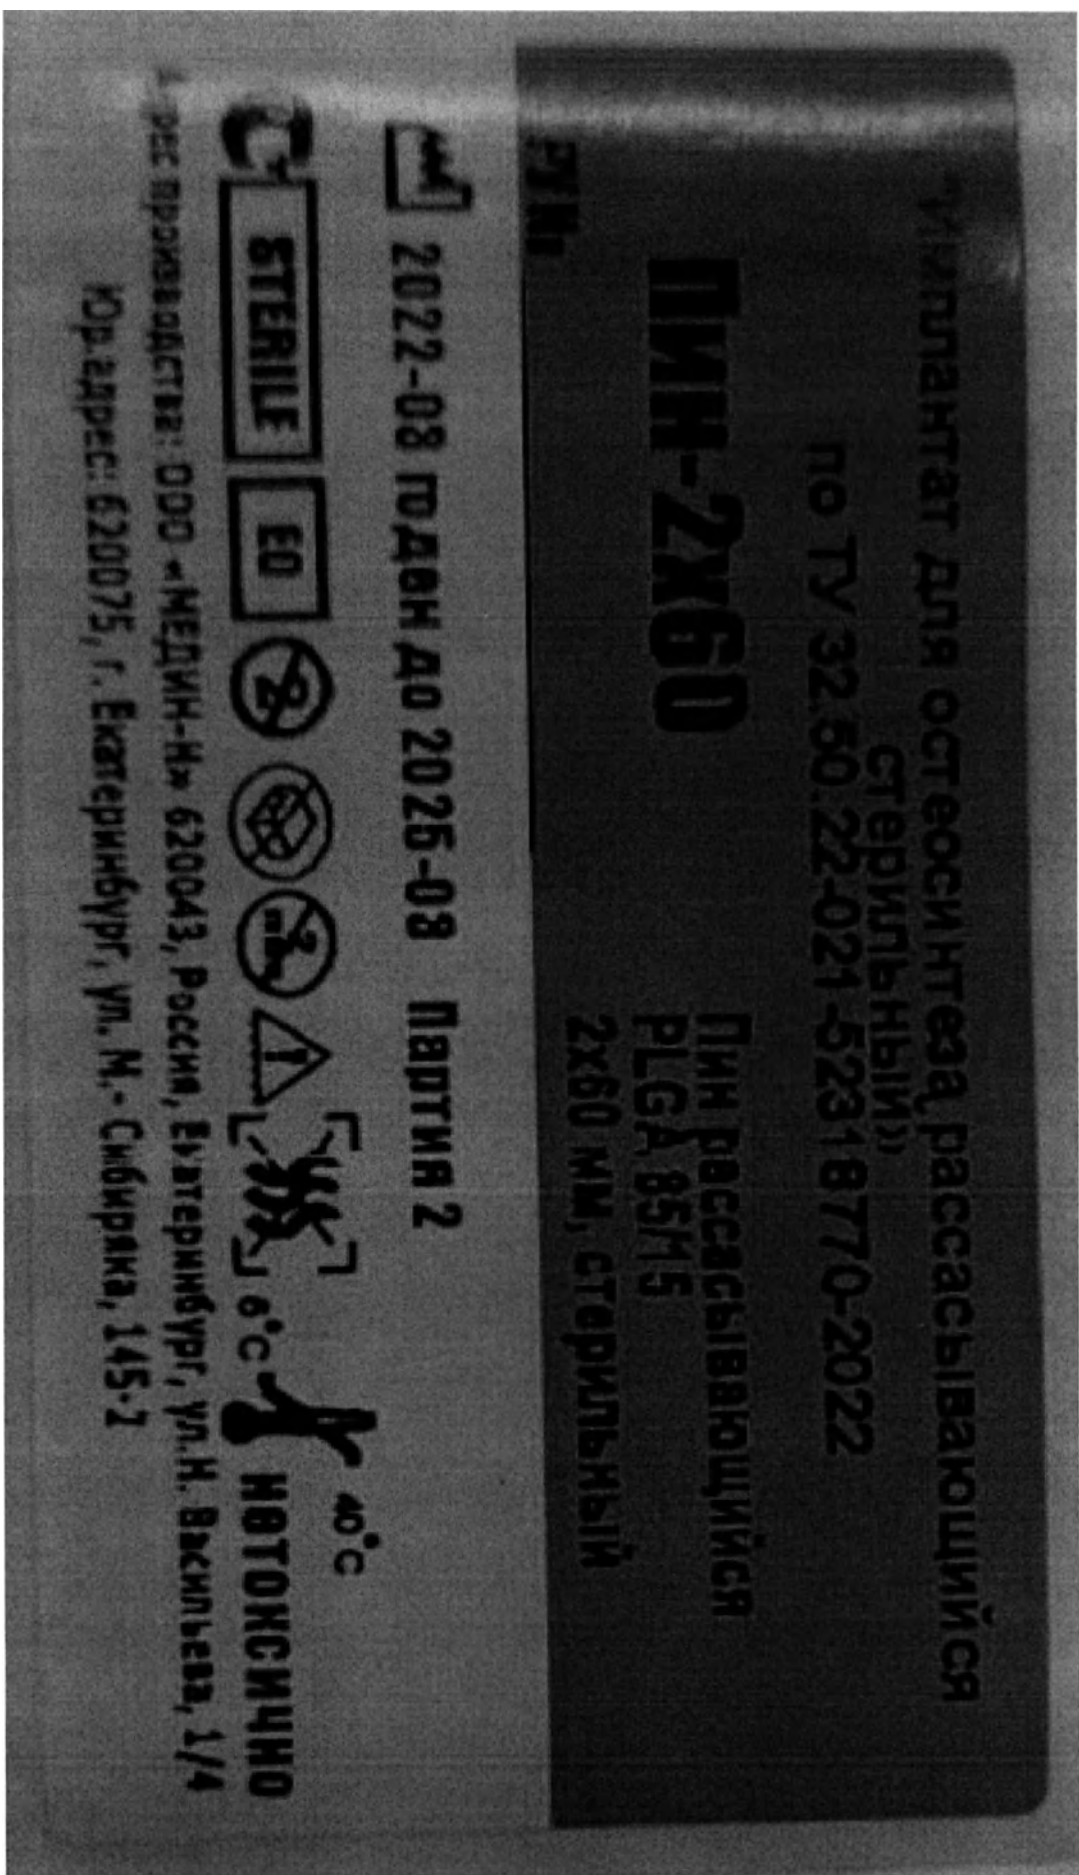


Фото 25 – Маркировка стерилизационной упаковки
Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2х60 мм, стерильный - Пин 2×60



Фото 26 – Пенал из полиэтилена

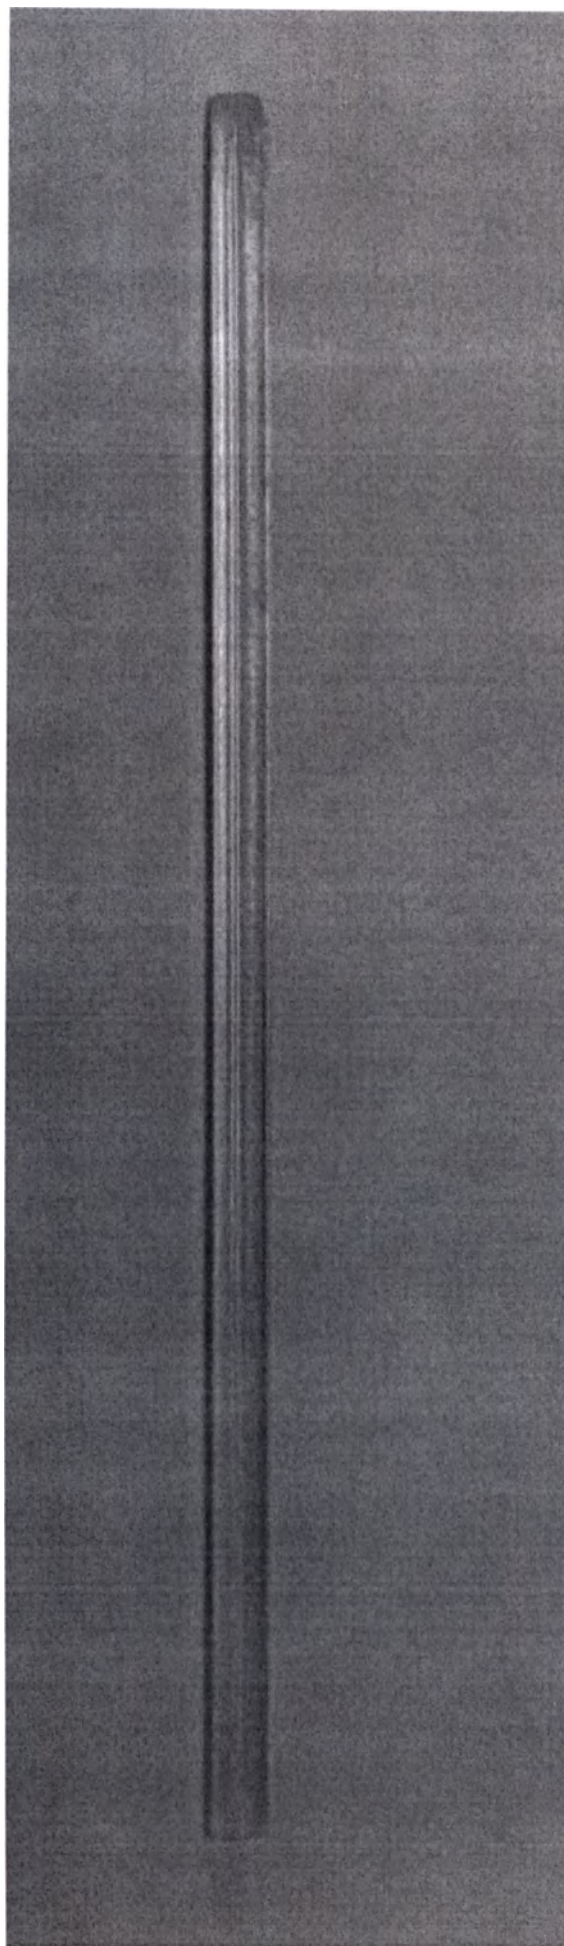


Фото 27 – Пин рассасывающийся PLGA 85/15, 2х60 мм, стерильный - Пин 2×60

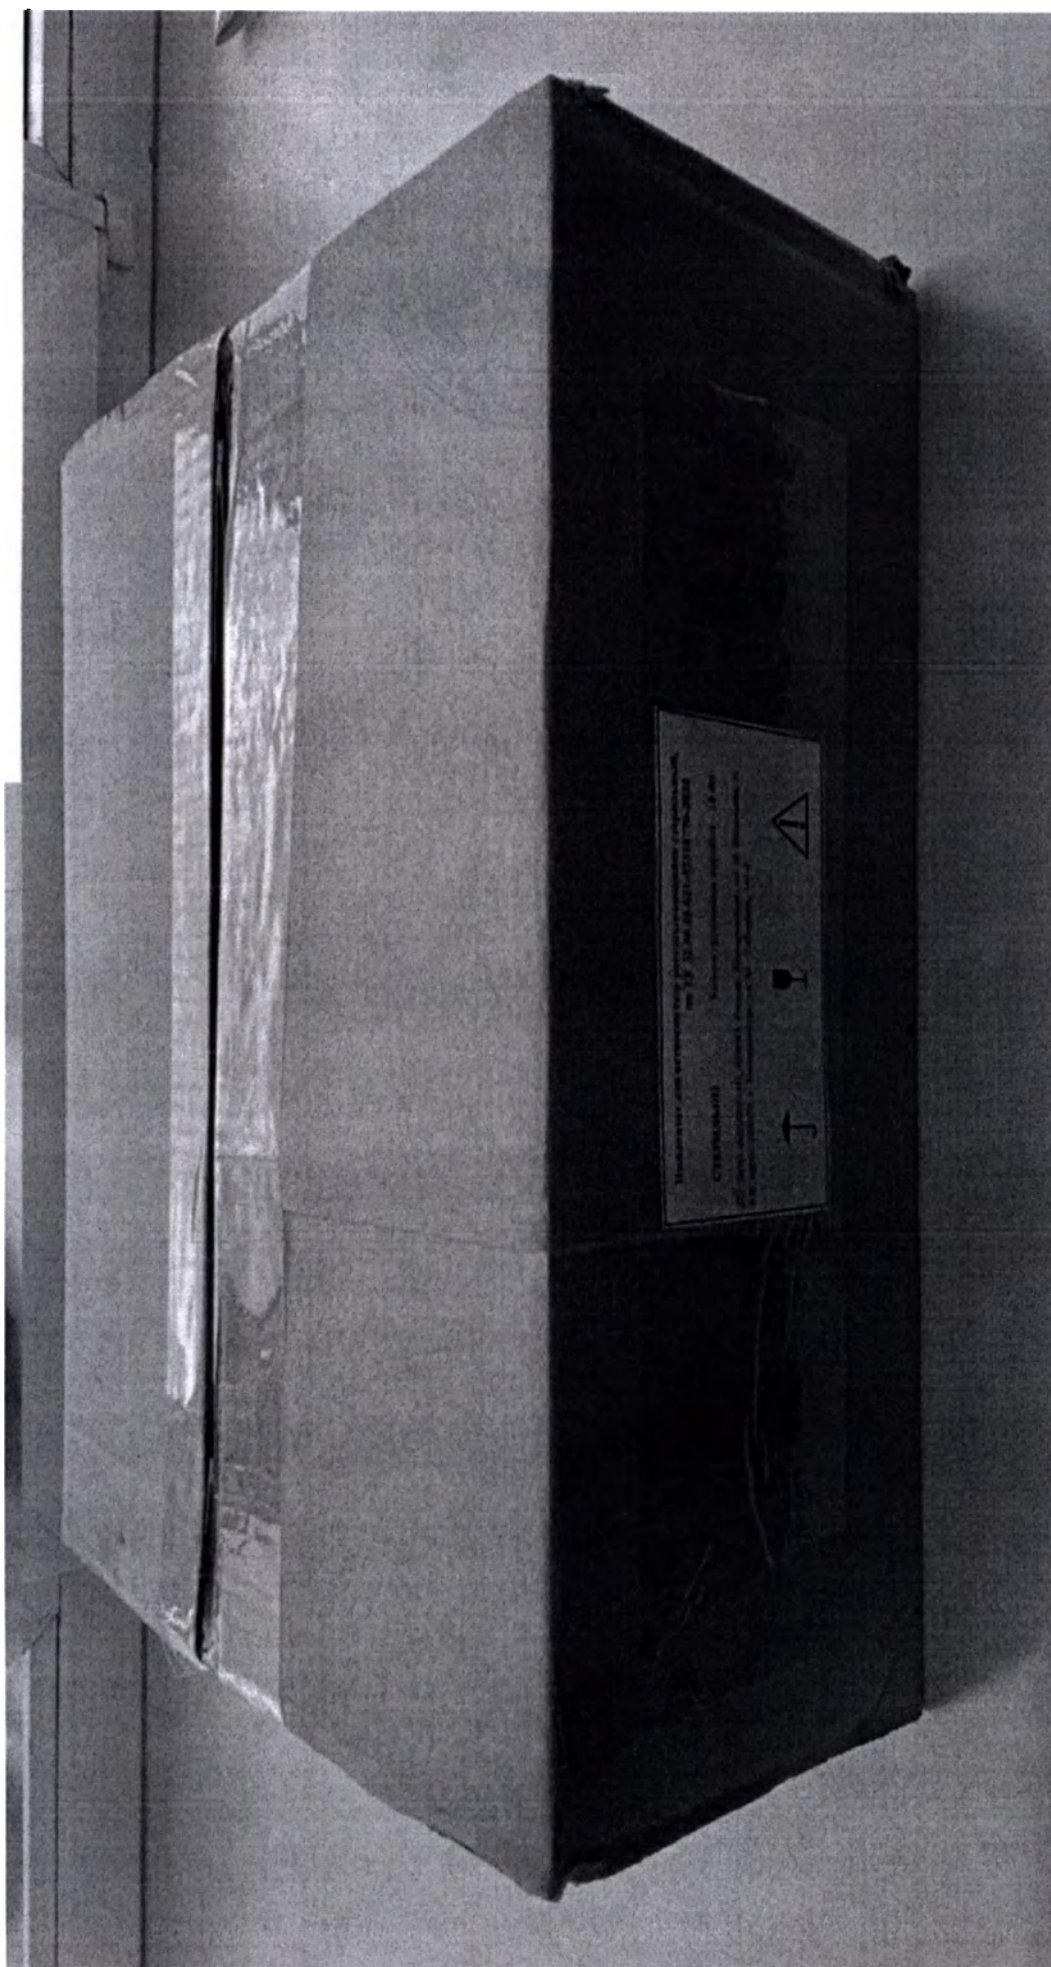


Фото 29 – Образец транспортная упаковка

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 28 листа(ов)

Директор ООО «Медин-Н»

В.Ф. Жданов

