



Средство офтальмологическое Систейн Ультра без консервантов (3 мл)



SAMPLE – NOT FOR RESALE

SystaneTM

ULTRA
Lubricant Eye Drops



PRESERVATIVE-FREE

FAST-ACTING DRY EYE
SYMPTOM RELIEF

For Extended Protection
and High Performance

3mL
Alcon



STERILE A

Средство офтальмологическое Систейн Ультра без консервантов (10 мл)





Средство офтальмологическое Систейн Ультра Плюс без консервантов (3 мл)



UNVERKÄUFLICHES MUSTER

SystaneTM
HYDRATION

Benetzungstropfen für die Augen



KONSERVIERUNGSMITTELFREI

LANG ANHALTENDE
LINDERUNG DER SYMPTOME
TROCKENER AUGEN

Enthält Hyaluronat für
weiterentwickelte Befeuchtung

3 ml

Alcon



STERILE A

Средство офтальмологическое Систейн Ультра Плюс без консервантов (10 мл)





ООО «Алкон Фармацевтика»

Юридический адрес:

125315, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 72, корп.3

Т Т +7 495 961 1333 | Ф +7 495 775 4720

ОГРН 1027739129857

ИНН 7709354370

КПП 774301001

"УТВЕРЖДАЮ"

Менеджер по регистрации
медицинских изделий

ООО «Алкон Фармацевтика»



Волкова Д.О.

«17» августа 2022 г.

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Средство офтальмологическое Систейн Ультра без консервантов:

Варианты исполнения:

1. Средство офтальмологическое Систейн Ультра без консервантов;
2. Средство офтальмологическое Систейн Ультра Плюс без консервантов;

Макет маркировки картонной упаковки Систейн Ультра без консервантов (10 мл). Картонная упаковка для варианта в 3 мл идентична.



ВЕРНАКЕ Д. СТЕРИЛИЗАЦИЈА ПРИМЕНЕНИМ МЕТОДОМ
АСЕПТИЧЕСКОЈ ОБРАБОТКИ

ACCEPTED MANUSCRIPT

Ці частки інфраадрозольних систем *Ультра-Біо* використовують у промисловості для протравлення, а також у фармації при виробленні онкологічної лікувальної діжки. Також цю лінійку можна розглядати як:

ПОДЛЕЖАЮЩЕГО АДМИНИСТРАЦИИ ГОСУДАРСТВА. УКАЗАВ КТО ИЗ НАС НЕ ПОЖЕЛ
ИЛИ НЕ МОЖЕЛ ИЛИ НЕ ХОТЕЛ СЛУЖИТЬ В ГОСУДАРСТВЕ
УКАЗАВШИЕ НА НЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВО И ПРАВИТЕЛЬСТВО НАНЕСУТ
ЕМУ ДЕНЕЖНОЕ ПОКАЗАНИЕ ИЛИ ПОКАЗАНИЕ

[illegible]

Қазақстан Республикасының Конституциясы мен Заңдарымен өзінің құқықтарын және ұстанымдарын қатаң сақтауға уәдесін бергендігіне қатысты өзін-өзі бағалау және өзін-өзі бағалауға ұйымының мүшесінің өзінің қатысуымен жүзеге асырылатынын білдіретін.

Алгебра өткізгіштігі мен төмендеушілік сияқты қасиеттері бар, әрі
жұмыс істейтін өлшемдердің қосындысы (қосындылардың қосындысы)
түрдегі қосындылардың қосындысы, ал өлшемдердің қосындысы
өзіндік қосынды, ал өлшемдердің қосындысы өлшемдердің қосындысы
өзіндік қосынды, ал өлшемдердің қосындысы өлшемдердің қосындысы



После изготовления все, что можно было сделать
выпускать флажки, стержни флажков все,
чтобы сделать их лучше (сделать).
И выложить до истечения срока годности,
указанного на этикетке.

Түбәндәгеләрнең һәр биштен беренчесе үзгәртүгә эри
мәктәпкә килгән, әр биштен беренчесе үзгәртүгә эри
үзгәртүгә эри, әр биштен беренчесе үзгәртүгә эри.

РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗНИКОВ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ

we have $\sigma_{\text{max}}(\mathbf{A}) \leq \sqrt{2}$ and $\sigma_{\text{min}}(\mathbf{A}) \geq \sqrt{2}$.



ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СРЕДСТВО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ

Систейн

УЛЬТРА

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

- Мгновенный комфорт
- Можно напать на линзы



10 мл

Alcon

Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі
М. ҚАЖЫМАНОВТЫҢ ҚҰРМАНЫ
ҚҰРДЫҒЫ ҚОЛДАУҒА АРНАЛҒАН
• Ақпарат және спорт

• **ANALIZA DE TENDENCIAS Y PUNTO DE EQUILIBRIO**

Address: ALKERMED, INC., 4333 W. 38TH STREET, FORT WORTH, TX 76116-5099, USA
 Tel: 817-339-7000
 Fax: 817-339-7001
 E-mail: info@alkerm.com
 Web: www.alkerm.com

Нематричные дискриминанты в России
© 2012/15.26

[illegible]

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

«Владимирская губерния». 1880. № 190. № 191, 192.
Александровский, А. В. 72-й.
№ 191. № 192. 72-й. 191-192.

[illegible]

And, I believe, I shall follow it.

11/11/2019, 10:41 AM - 11/11/2019, 10:41 AM

DATA INPUT: 10/10/2018 10:00

4694

4694

STERILE A Стерилизация с применением методов асептической обработки

Асептикалық өңдеуді қолданумен зарарсыздандырылған

Средство офтальмологическое Систейн Ультра без консервантов предназначено для временного облегчения проявлений синдрома «сухого глаза», таких как жжение и раздражение. Средство офтальмологическое Систейн Ультра без консервантов можно использовать для смазывания и поддержания увлажнения силикон-гидрогелевых и гидрогелевых контактных линз дневного и пролонгированного ношения.

СОСТАВ

Средство офтальмологическое Систейн Ультра без консервантов – это стерильный раствор, содержащий полиэтиленгликоль 400, пропиленгликоль, гидроксипропилгуар, сорбитол, аминотетил пропанол, кислоту борную, калия хлорид и натрия хлорид. Систейн Ультра офтальмологиялық консерванттарсыз құралы көздің құрғақ синдромы симптомдарын уақытша жеңілдетуге арналған, жану және тітіркену.

Консерванттарсыз Систейн Ультра офтальмологиялық құралын күндіз және ұзартыла тағылатын силиконды-гидрогельді және гидрогельді контактілі линзаларды майлау және ылғалдандыру үшін қолдануға болады.

ҚҰРАМЫ


Консерванттарсыз Систейн Ультра офтальмологиялық құралы-полиэтиленгликольді 400, пропиленгликольді, гидроксипропилгуарды, сорбитолды, аминотетил пропанолды, бор қышқылын, калий хлоридін, натрий хлоридін құрайтын стерильді ерітінді болып табылады.

300056180-0622



www.molbiol.ru

После использования, прежде чем закрыть
компюок флакона, стряхните флакон вниз,
чтобы удалить остатки средства.
Использовать до истечения срока годности.
Указанного на упаковке.
Подавляющая часть кутинина как правило
жидкая, ерпидна кадыктарын кетир
үшін кутинин төмен карай сирди
Капалада көрсетілген жарамдылық мерзімі
зактыланған дейін пайдаланыңыз.

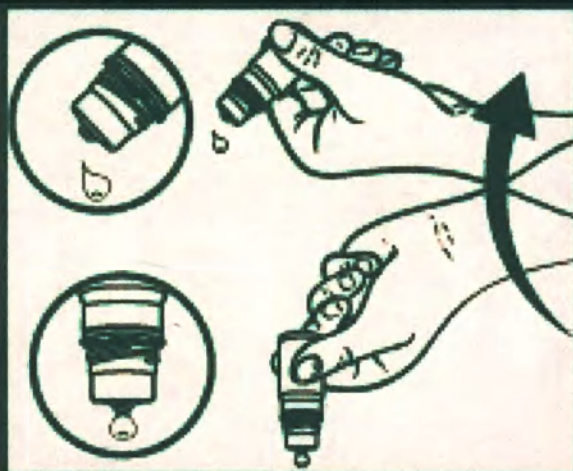

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СРЕДСТВО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ

Систейн

УЛЬТРА

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

- Мгновенный комфорт
- Можно капать на линзы



10 мл

STERILE A

Alcon

Код партии/Партия коды/ : **LOT**

Исп. до/Дейін қолд./ 

Дата изгот. \Дайындалған күні:/ 

Систем Уаыра офтальмологиялық

консультациялар құралы

КҮНДІЛІК ҚОЛАДАНҒА АРНАЛҒАН

• Азальдік комфорт

• Айналарға тамшыдай алабы

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ӨНДІРІШІ:

«Алькон Лабораториз, Инк.» США/АҚШ,

Alcon Laboratories, Inc. 6201 South Freeway, Fort

Worth, TX 76134-2099, USA

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА/

ӨНДІРІС АЛАҒЫ: Alcon Research LLC,

6201 South Freeway, Fort Worth, TX, 76134-2099,

США

Персональное удостоверение в России

№ ФСЗ 2012/13526

Уполномоченный представитель

производителя на территории Российской

Федерации / импортер / организация,

принимавшая участие в тендере на территории

Республики Беларусь / Ресей Федерациясының

ауымындағы өндірістің уәкілетті өкілі /

импортер / Беларусь Республикасының

ауымында

назарымызға қабылданған ұяым: 000

«Алькон Фармацевтика» Россия, Москва,

Александровский пр-т, д. 72, корпус 3, Тел.: +7 (495)

961-1333 /

«Алькон Фармацевтика» ЖШС, Ресей, Мәскеу,

Александровский пр-т, д. 72-үй,

корп. 3, Тел.: +7 (495) 961-1333

Уполномоченный представитель

производителя на территории РК / ҚР

ауымындағы өндірістің уәкілетті өкілі: 100

«Алькон Қазақстан»,

Алматы, ҰА, Күрментауы, 95/

«Алькон Қазақстан» ЖШС, Алматы қ.

Күрментауы К-С/ 95

Макет флакона Систейн Ультра без консервантов (10 мл). Флакон для варианта 3 мл идентичен.

средство офтальмологическое

СИСТЕЙН

УЛЬТРА

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

10 мл STERILE A Alcon

3М 2°C/30°C

Средство офтальмологическое Систейн Ультра без консервантов. Тщательно встряхнуть перед использованием. Не прикасайтесь к кончику носика флакона, так как это может привести к загрязнению раствора. Не используйте, если индикатор вскрытия поврежден или отсутствует, либо если колпачок с контролем вскрытия поврежден. Систейн Ультра офтальмологиялық консерванттарсыз құралы Тамшуыр ұшына қол тигізбеніз флакон.

себебі бұл әкелуі мүмкін ерітіндінің ластануы қараңыз. Қолданар алдында сілкі керек. Ашу индикаторы зақымдалған немесе жоқ болса, ашуды бақылау қақпағы зақымдалған болса, қолданбаңыз. Производственная площадка/Өндірістік алаң: Alcon Research, LLC, 6201 South Freeway, Fort Worth, TX, 76134-2099, США

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ӨНДІРУШІ: «Алкон Лабораториз, Инк.», США/АҚШ, Alcon Laboratories, Inc., 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA

LOT

300056181-0622

средство офтальмологическое

СИСТЕЙН

УЛЬТРА

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

10 мл

STERILE A

Alcon



Средство офтальмологическое
Систейн Ультра без консервантов
Тщательно встряхнуть перед
использованием. Не прикасайтесь к
кончику носика флакона, так как это
может привести к загрязнению
раствора. Не используйте, если
индикатор вскрытия поврежден или
отсутствует, либо если колпачок с
контролем вскрытия поврежден.
Систейн Ультра офтальмологиялық
консерванттарсыз құралы Тамшуыр
ұшына қол тигізбеніз флакон.

себебі бұл әкелуі мүмкін ерітіндінің
ластануы қараңыз. Қолданар
алдында сілкі керек. Ашу
индикаторы зақымдалған немесе
жоқ болса, ашуды бақылау қақпағы
зақымдалған болса, қолданбаңыз.
Производственная площадка/
Өндірістік алаң: Alcon Research, LLC,
6201 South Freeway, Fort Worth, TX,
76134-2099, США
■ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ӨНДІРУШІ:
«Алкон Лабораториз, Инк.», США/АҚШ,
Alcon Laboratories, Inc., 6201 South
Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA

LOT

EXP



Макет маркировки картонной упаковки Систейн Ультра Плюс без консервантов (10 мл). Картонная упаковка для варианта 3 мл идентична.



300056185-0622

стерилизация с применением методов
асептического приготовления

(стерильное офтальмологическое (желе) для офтальмологической
консервации) применяется для временного обеспечения
применения препарата «Сухое Глаз», таких как жжение и
раздражение. (желе) для офтальмологической консервации можно
использовать для увлажнения контактных линз, как

офтальмических так и параназальных, при длительном и
продолжительном ношении.

(стерильное офтальмологическое (желе) для офтальмологической
консервации) – это стерильный раствор, содержащий натрия
гидрокарбонат, повидон-К30, 400, пропангидрокарбонат,
гидрокарбонат натрия, калий хлорид и натрия хлорид.


консервация (желе) для офтальмологической
краткосрочной и длительной (желе) «желе» для офтальмологической
консервации (желе) для офтальмологической консервации
краткосрочной и длительной (желе) «желе» для офтальмологической
консервации (желе) для офтальмологической консервации

консервация (желе) для офтальмологической консервации
краткосрочной и длительной (желе) «желе» для офтальмологической
консервации (желе) для офтальмологической консервации
краткосрочной и длительной (желе) «желе» для офтальмологической
консервации (желе) для офтальмологической консервации



www.mozgaza.ru

После использования, прежде чем закрыть
колпачок флакона, срежьте флакон вниз,
чтобы удалить остатки средства.
Желательно до истечения срока годности,
использовать на флаконе.
Платформа не имеет каталог, как правило,
жесткая, чтобы избежать повреждений.
Каталог не имеет каталог, как правило,
жесткая, чтобы избежать повреждений.

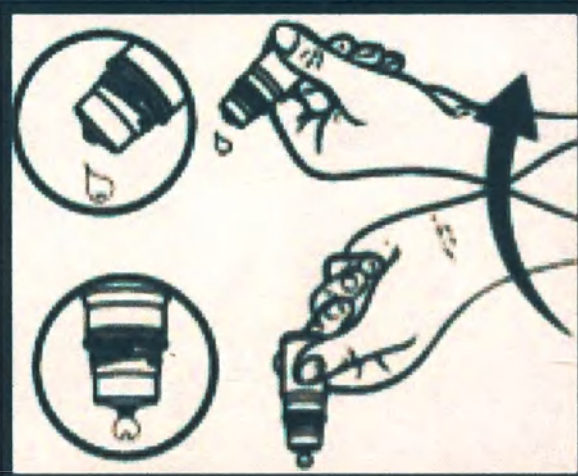

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СРЕДСТВО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯЛЫҚ КОНСЕРВАНТТАРСЫЗ ҚҰРАЛЫ

Систейн

УЛЬТРА ПЛЮС

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

- Экстра увлажнение
- Можно капать
на линзы



10 мл

STERILE A

Alcon

Систейн Ультра Плюс офтальмологиялық
консерванттарсыз құралы
ЭКСТРА ЫЛГАЛДАНДЫРУ

- Құрамында гиалурон қышқылы бар
- Линзаларға тамшылай алады

Уполномоченный представитель
производителя на территории Российской
Федерации / импортер / организация,
принимаящая претензии на территории
Республики Беларусь / Ресей Федерациясының
аумағындағы өндірушінің уәкілетті өкілі /
импорттаушы / Беларусь Республикасының
аумағында наразылықтарды қабылдайтын
ұйым: ООО "Алкон Фармацевтика" Россия,
Москва, Ленинградский пр-т, д.72, корп.3.
Тел.: +7 (495) 961-1333 / «Алкон Фармацевтика»
ЖШҚ Ресей, Мәскеу,
Ленинград даңғылы, 72-үй, корп.3. Тел.:
+7 (495) 961-1333

 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ӨНДІРУШІ: «Алкон
Лабораториз, Инк.», США/АҚШ, Alcon
Laboratories, Inc. 6201 South Freeway, Fort
Worth, TX 76134-2099, USA

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА/
ӨНДІРІСТІК АЛАҢ: Alcon Research LLC, 6201 South
Freeway, Fort Worth, TX, 76134-2099, США

Регистрационное удостоверение в России:
№ ФСЗ 2012/13526

Уполномоченный представитель
производителя на территории РК/ ҚР
аумағындағы өндірушінің уәкілетті өкілі:
ТОО "Алкон Казахстан", г.Алматы,
ул.Курмангазы,95/ «Алкон Казахстан»
ЖШС, Алматы қ., Құрманғазы к-сі, 95

Код партии/Партия коды/ : **LOT**

Исп. до/Дейін колд.:/ 

Дата изгот./Дайындалған күні:/ 

Макет флакона Систейн Ультра Плюс без консервантов (10 мл). Флакон для варианта 3 мл идентичен.

средство офтальмологическое

СИСТЕЙН

УЛЬТРА ПЛЮС

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

10 мл **STERILE A** **Alcon**

3М 30°C

Тщательно встряхнуть перед использованием. Не прикасайтесь к кончику носика флакона, так как это может привести к загрязнению раствора. Не используйте, если индикатор вскрытия поврежден или отсутствует, либо если колпачок с контролем, вскрытия поврежден. Систейн Ультра Плюс офтальмологический консерванттарсыз құралы. Тамшуыр ұшына қол тигізбеңіз флакон, себебі бұл әкелуі мүмкін ертіндінің ластануы қараңыз.

Қолданар алдында сілкі керек. Ашу индикаторы зақымдалған немесе жоқ болса, ашуды бақылау қақпағы зақымдалған болса, қолданбаңыз. Производственная площадка/Өндірістік алаң: Alcon Research, LLC, 6201 South Freeway, Fort Worth, TX, 76134-2099, США

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ӨНДІРУШІ:
«Алкон Лабораториз, Инк.», США/АҚШ,
Alcon Laboratories, Inc. 6201 South Freeway, Fort Worth, TX 76134-2099, USA

LOT

300056186-0622

средство офтальмологическое

СИСТЕЙН

УЛЬТРА ПЛЮС

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

10 мл

STERILE A

Alcon

ВСЕГО ПРОШНУРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

19 ЛИСТА(ОВ)

Волкова Д.О.

