


Фотографическое изображение медицинского изделия

**Реагенты VITROS Фолат в кассете (VITROS Folate Reagent Pack 1/2) для
количественного иммунодиагностического определения фолиевой кислоты методом
усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS**

Реагенты VITROS Фолат в кассете.

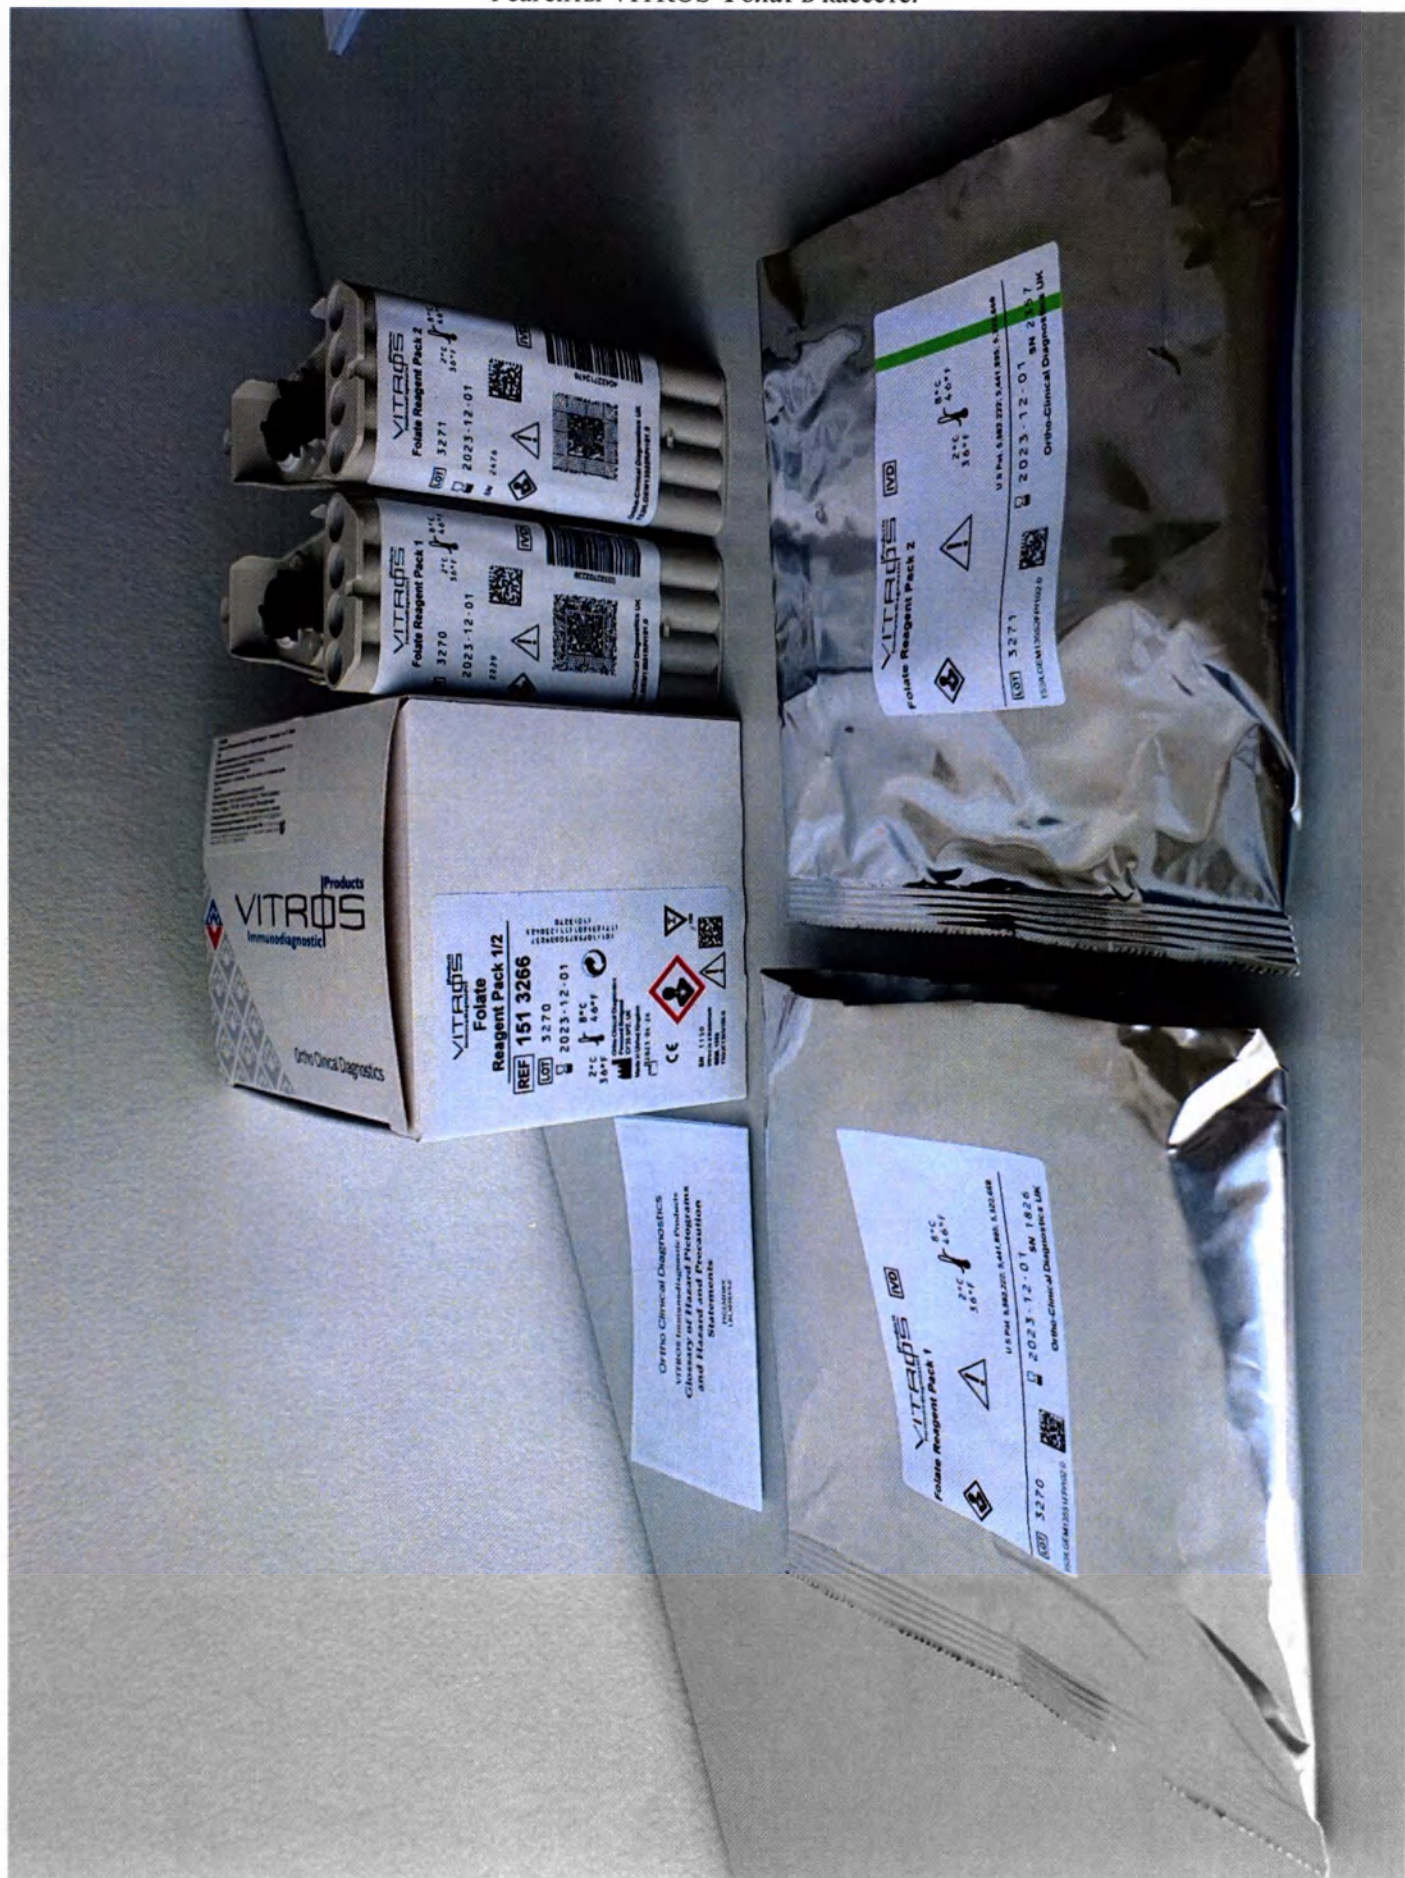

151 3266

Реагенты VITROS Фолат в кассете (VITROS Folate Reagent Pack 1/2) для количественного иммунодиагностического определения фолиевой кислоты методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS, в составе:

1. Реагенты в кассете 1, 1 кассета. 2. Реагент в кассете 2, 1 кассета.

Назначение: Для количественного иммунодиагностического определения фолиевой кислоты методом усиленной хемилюминесценции в сыворотке, плазме (с гепарином) и цельной крови (содержание фолиевой кислоты в эритроцитах) человека на анализаторах серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600) в качестве вспомогательного средства дифференциальной диагностики анемии.

Регистрационное удостоверение в РФ: _____


Уполномоченная организация на территории РФ: ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия, 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, дер. Сколково, ул. Новая, дом. 100, стр. 9
Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Версия _____

Реагенты VITROS Фолат в кассете. Реагенты в кассете 1, вид спереди.



Реагенты VITROS Фолат в кассете. Реагенты в кассете 1, вид сбоку.

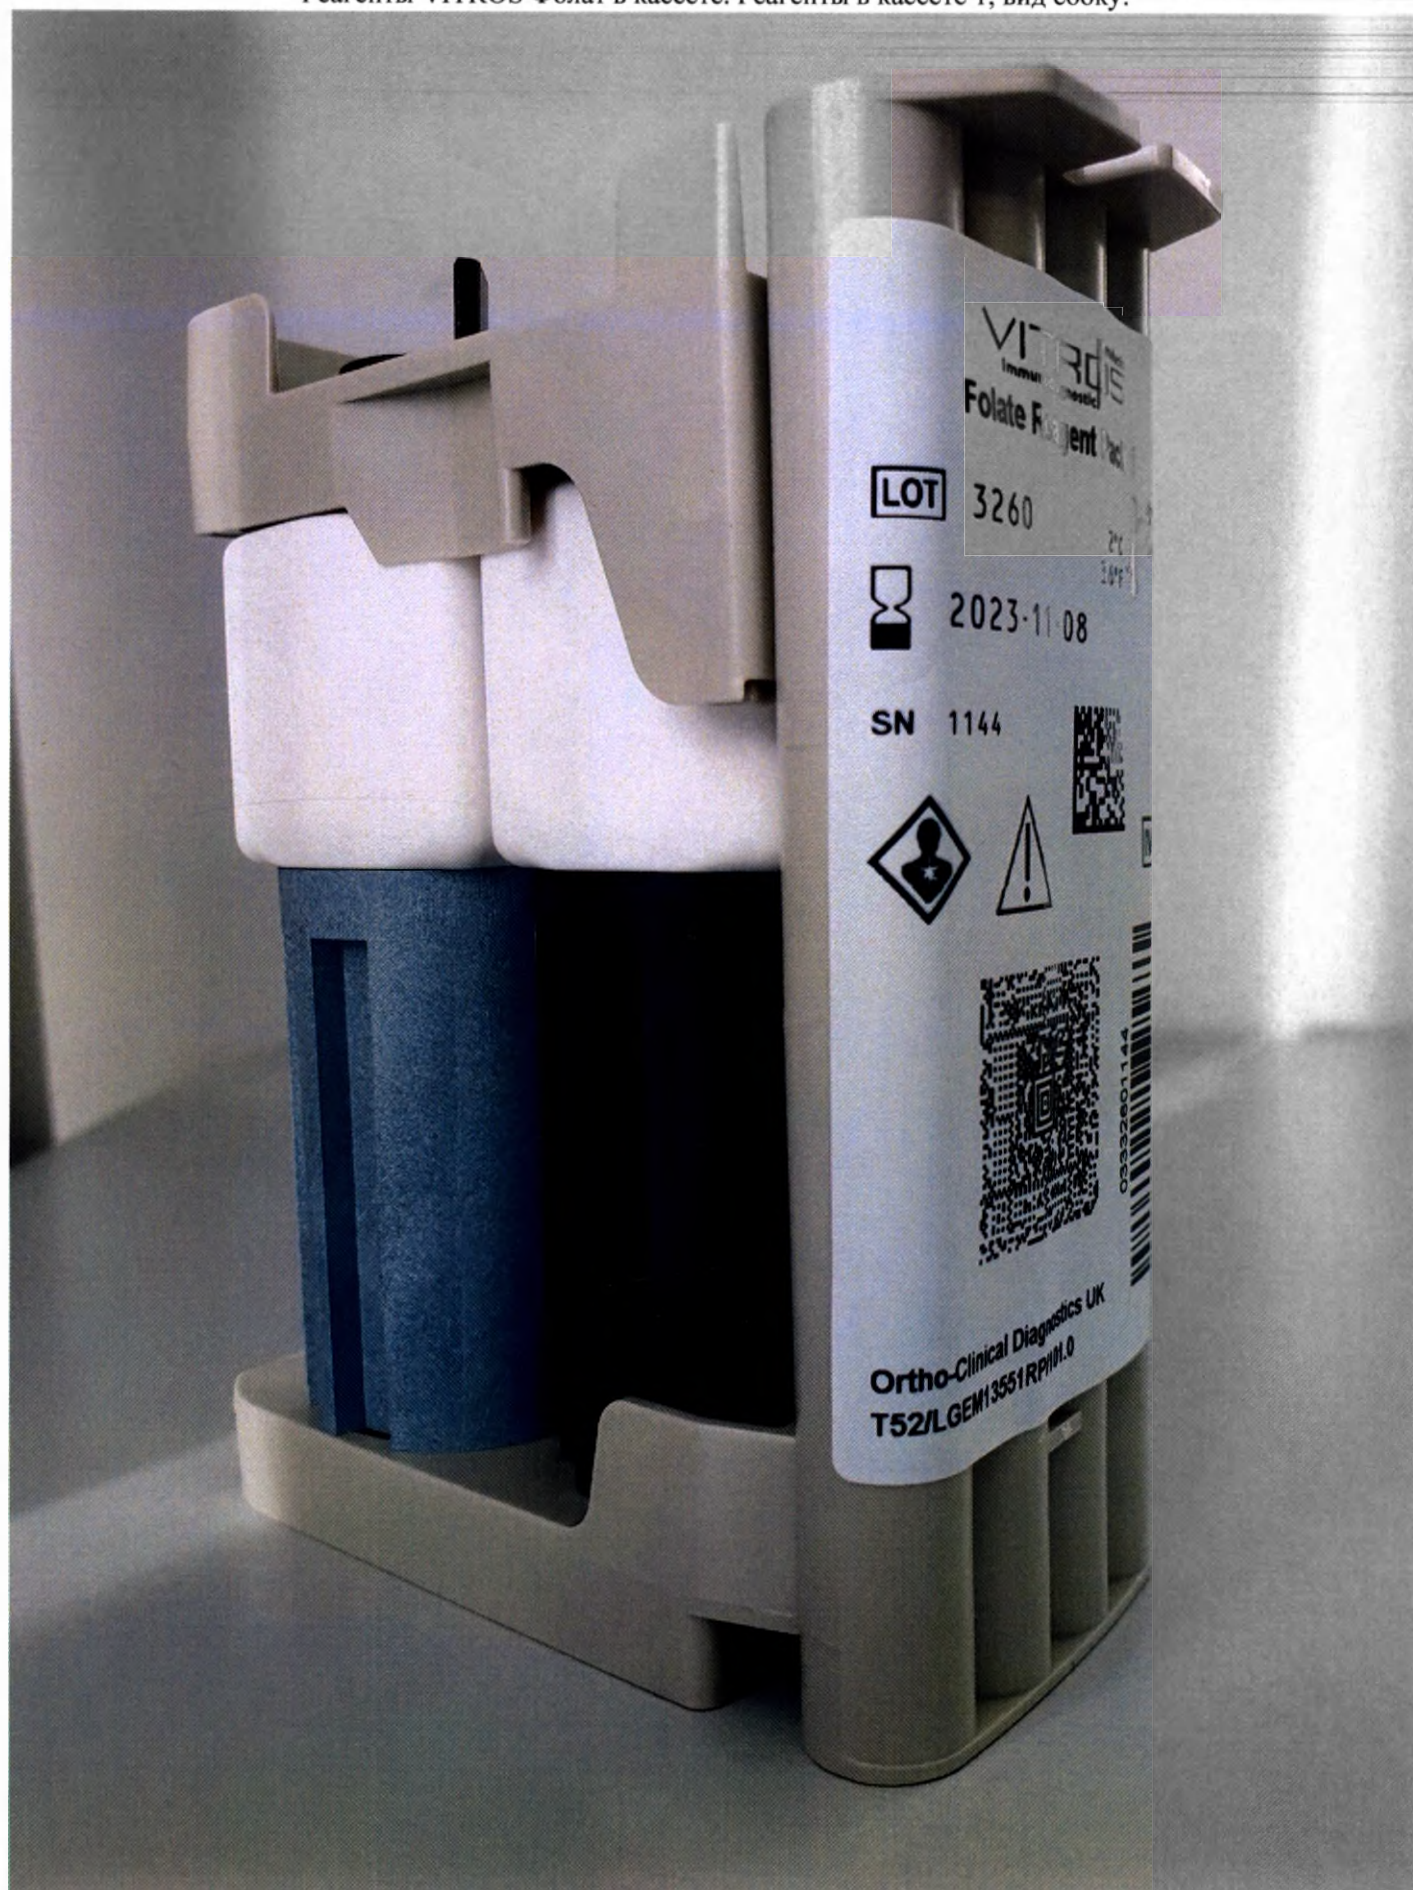

Реагенты VITROS Фолат в кассете. Реагент в кассете 2.



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО

ВСЕГО 6 лист ов

" " 20__ г.

Генеральный директор

ООО "Орто-Клиникал Диагностикс"

В.К. Сергеенко

