



Фотографические изображения

«Реагенты в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических cobas c, cobas Integra (STFR2/Tina-quant Soluble Transferrin Receptor II), в вариантах исполнения»


Атты в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и крови на анализаторах и модулях биохимических cobas c, cobas Integra (STFR2/ Tina-quant Soluble Transferrin Receptor II Cobas Integra/cobas c systems), вариант исполнения 100 тестов

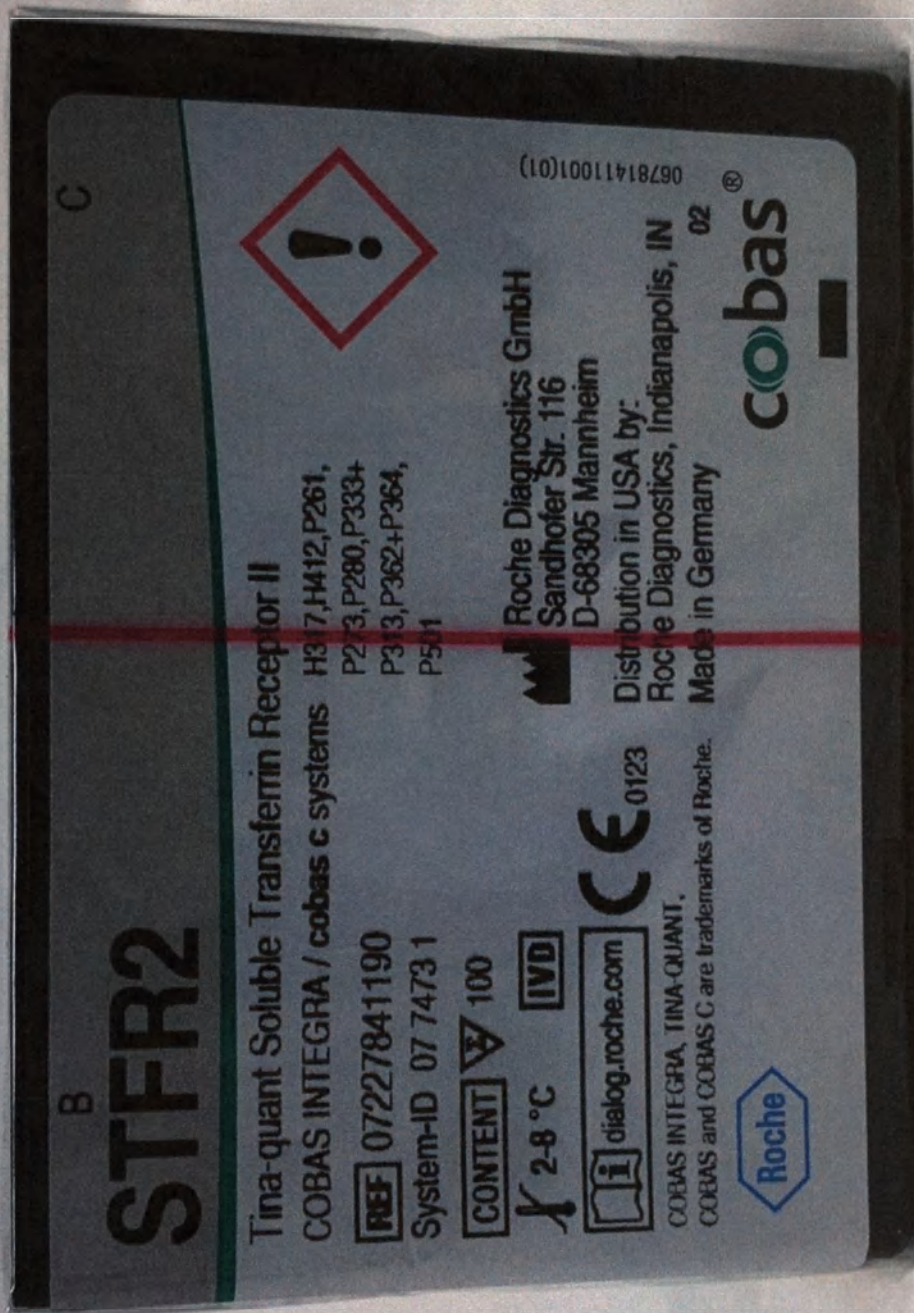

...ты в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и
...крови на анализаторах и модулях биохимических cobas c, cobas Integra (STFR2/ Tina-quant Soluble Transferrin
...r II Cobas Integra/cobas c systems), вариант исполнения 100 тестов

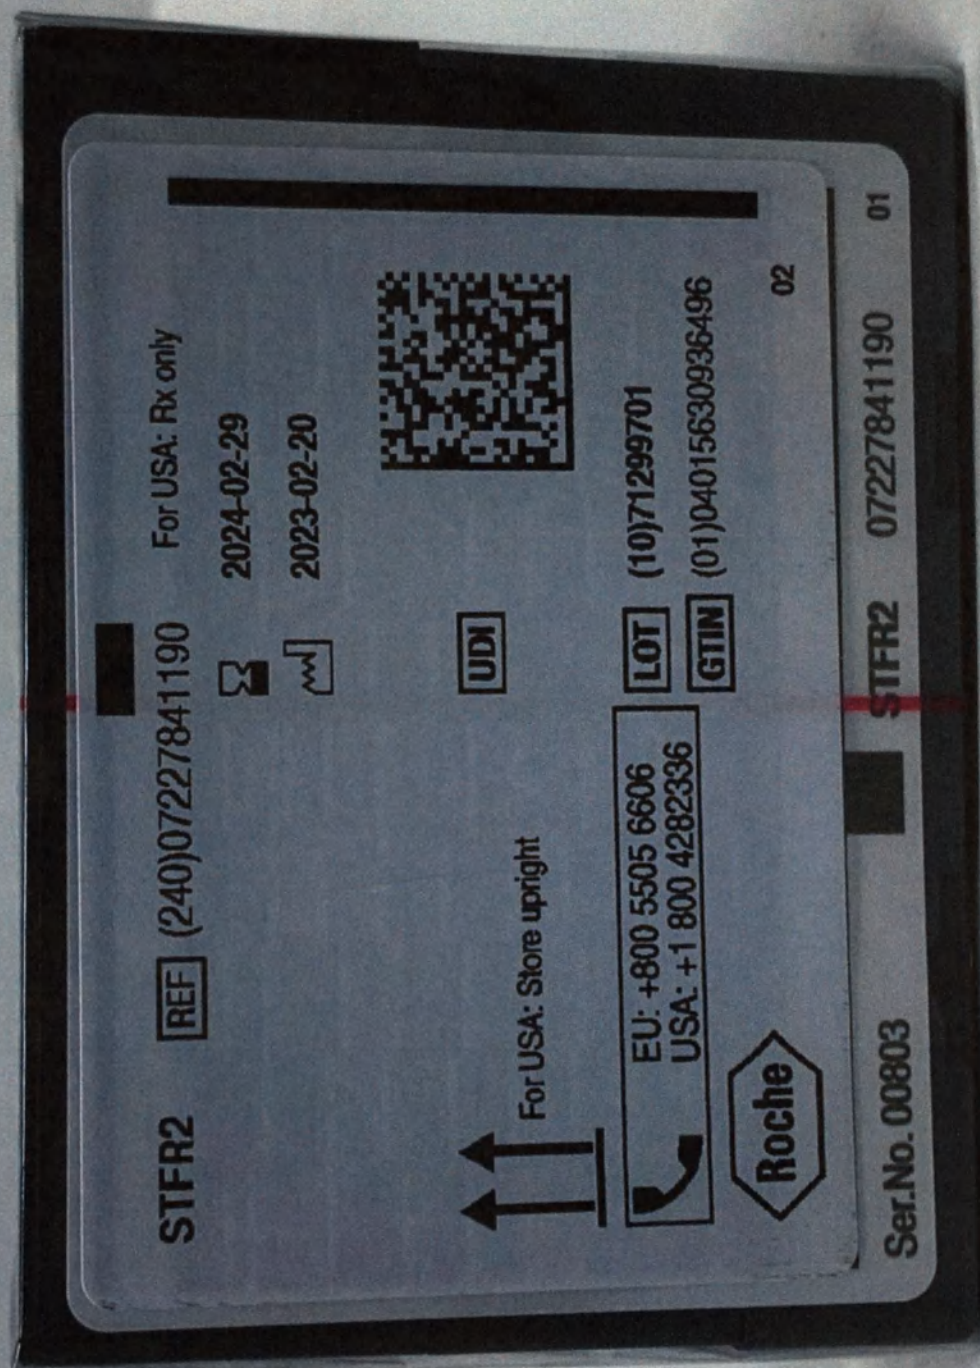

кассеты в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и крови на анализаторах и модулях биохимических cobas c, cobas Integra (STFR2/ Tina-quant Soluble Transferrin receptor II Cobas Integra/cobas c systems), вариант исполнения 100 тестов

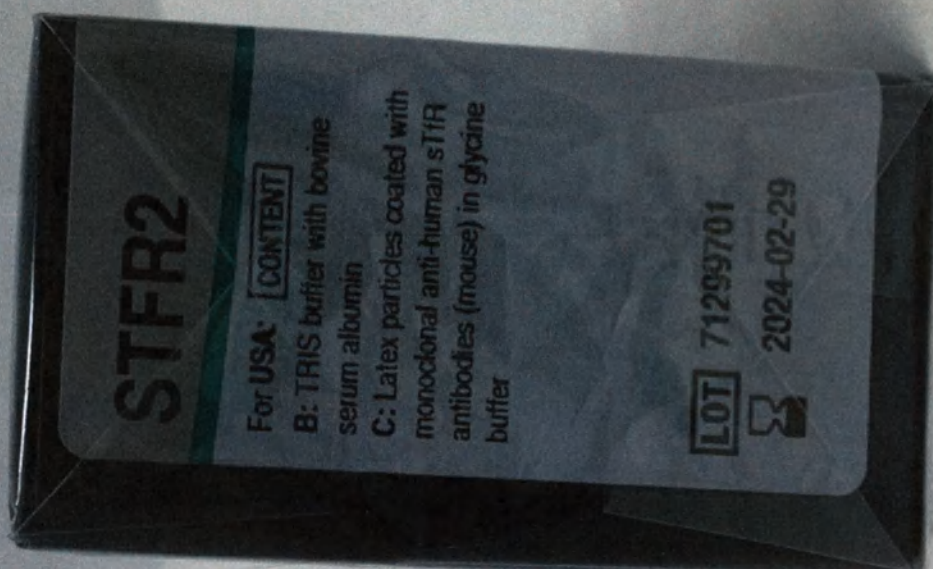



Реагенты в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях биохимических cobas c, cobas Integra (STfR2/ Tina-quant Soluble Transferrin Receptor II Cobas Integra/cobas c systems), вариант исполнения 100 тестов

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 07227841190

кты в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и крови на анализаторах и модулях биохимических cobas c, cobas Integra (STfR2/ Tina-quant Soluble Transferrin Receptor II Cobas Integra/cobas c systems), вариант исполнения 100 тестов


теты в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и крови на модулях биохимических cobas c (STFR2/ Tina-quant Soluble Transferrin Receptor II cobas c systems), ат исполнения 150 тестов



кассеты в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и крови на модулях биохимических cobas c (STFR2/ Tina-quant Soluble Transferrin Receptor II cobas c systems), для исполнения 150 тестов



кассеты в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и крови на модулях биохимических cobas с (STFR2/ Tina-quant Soluble Transferrin Receptor II cobas с systems), 150 тестов

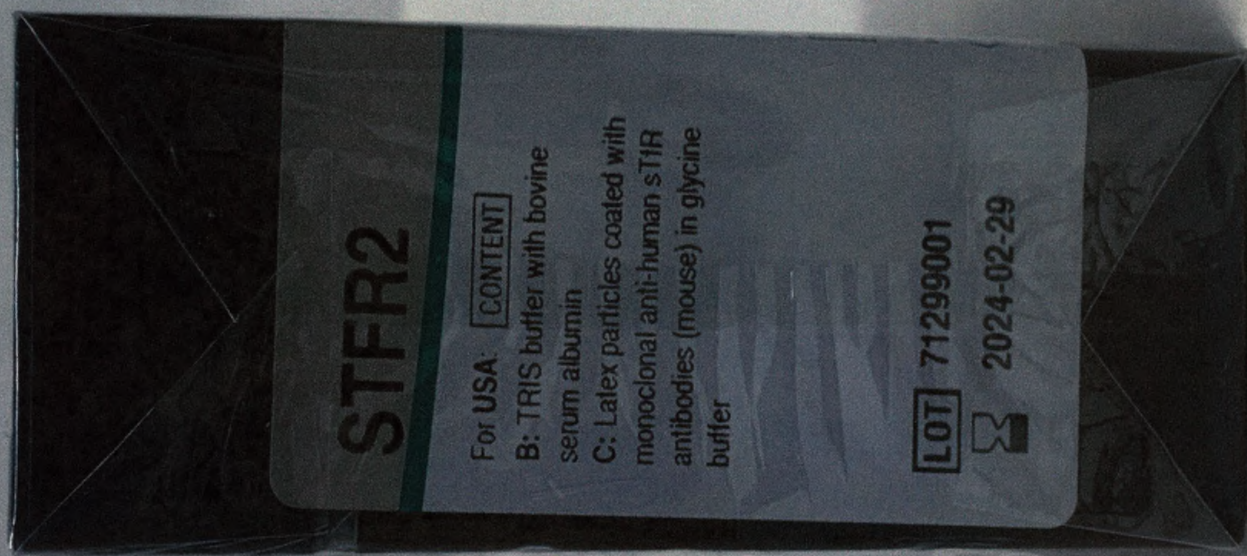



Реагенты в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas с (STFR2/ Tina-quant Soluble Transferrin Receptor II cobas c systems), вариант исполнения 150 тестов

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики *in vitro*


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 07227892190

Реагенты в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas с (STFR2/ Tina-quant Soluble Transferrin Receptor II cobas c systems), вариант исполнения 150 тестов


...ты в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и крови на модулях биохимических cobas c (STFR2/ Tina-quant Soluble Transferrin Receptor II cobas c systems), ...т исполнения 100 тестов

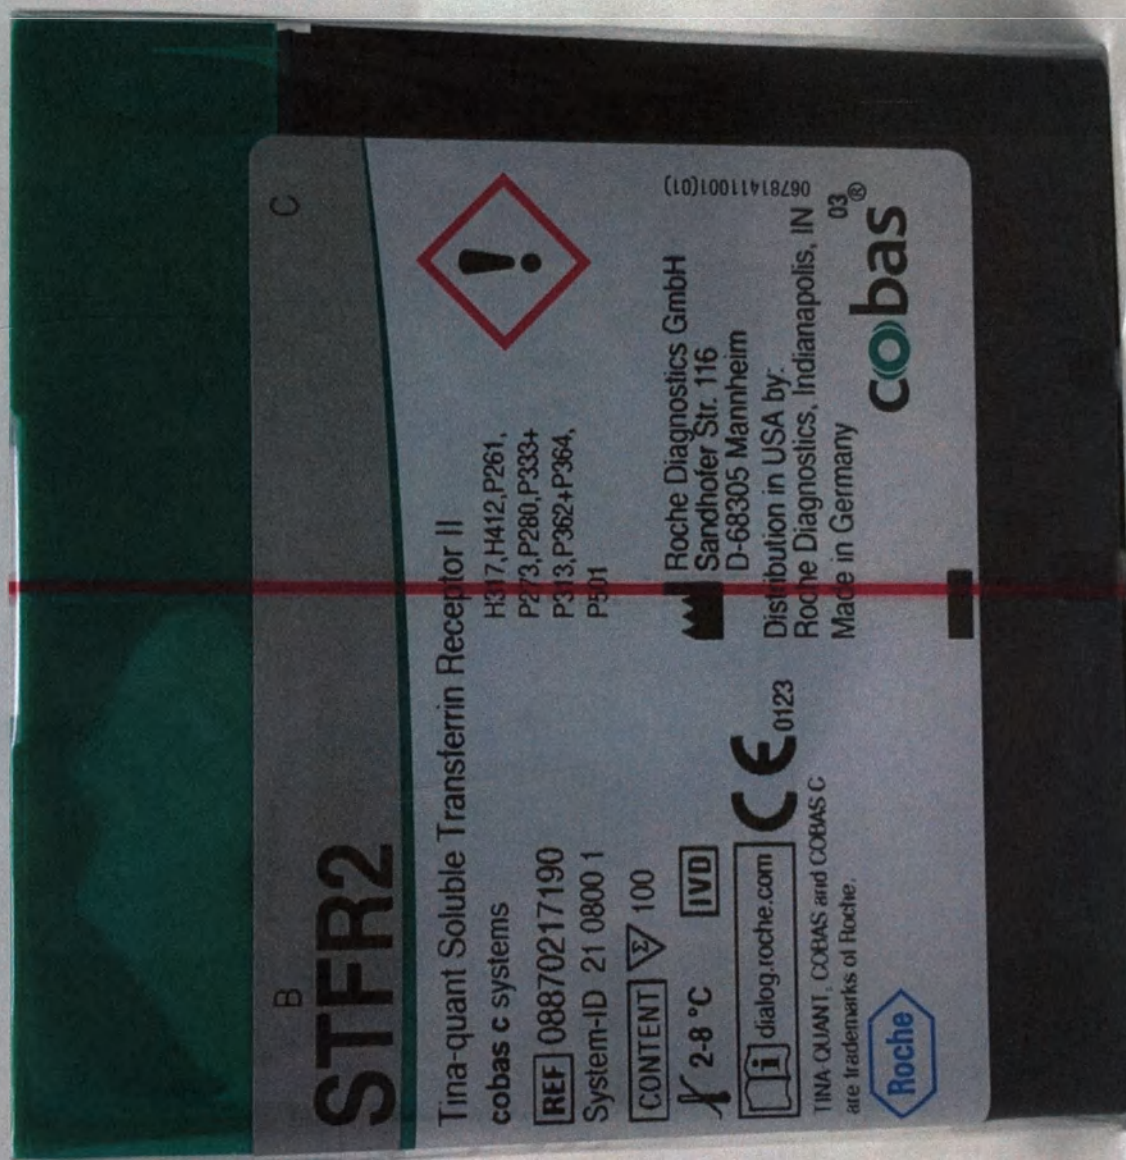

кассеты в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и крови на модулях биохимических cobas c (STFR2/ Tina-quant Soluble Transferrin Receptor II cobas c systems), исполнения 100 тестов



кассеты в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и крови на модулях биохимических cobas c (STFR2/ Tina-quant Soluble Transferrin Receptor II cobas c systems), для исполнения 100 тестов

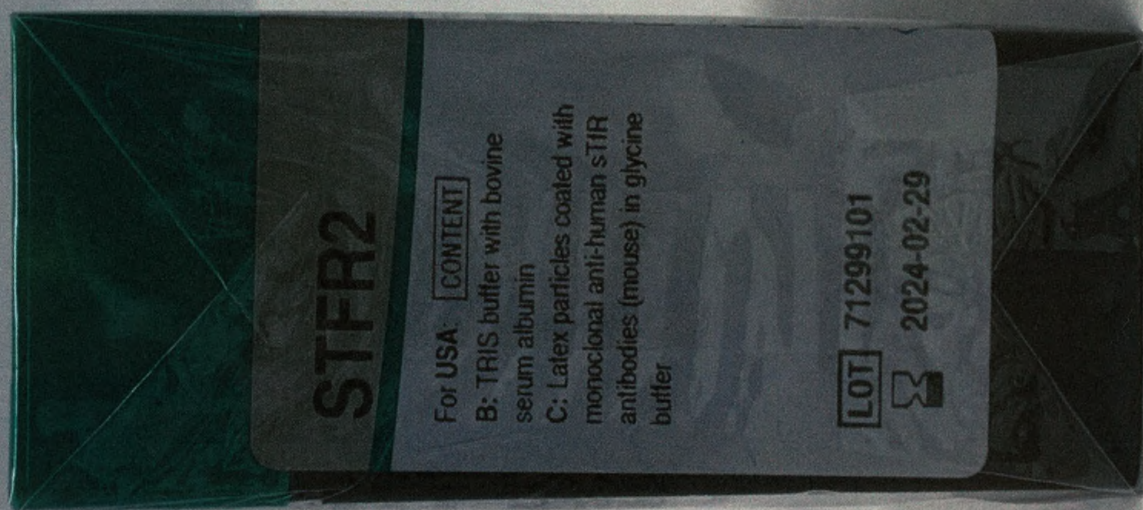

ды в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и
крови на модулях биохимических cobas c (STFR2/ Tina-quant Soluble Transferrin Receptor II cobas c systems),
исполнения 100 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения растворимого рецептора трансферрина (sTfR) в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas c (STFR2/ Tina-quant Soluble Transferrin Receptor II cobas c systems), вариант исполнения 100 тестов

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 08870217190

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
13 листа (ов)



по доверенности
от 30.01.2023 г.