
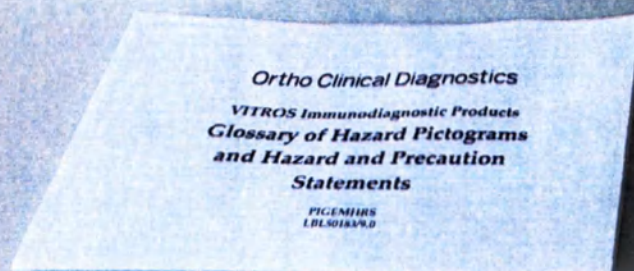


Фотографическое изображение медицинского изделия

Реагенты VITROS Витамин В12/Фолат в кассете 3 (VITROS Vitamin B12/Folate Reagent Pack 3) для количественного иммунодиагностического определения витамина В12 с тестом VITROS Витамин В12 или фолевой кислоты с тестом VITROS Фолат методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS

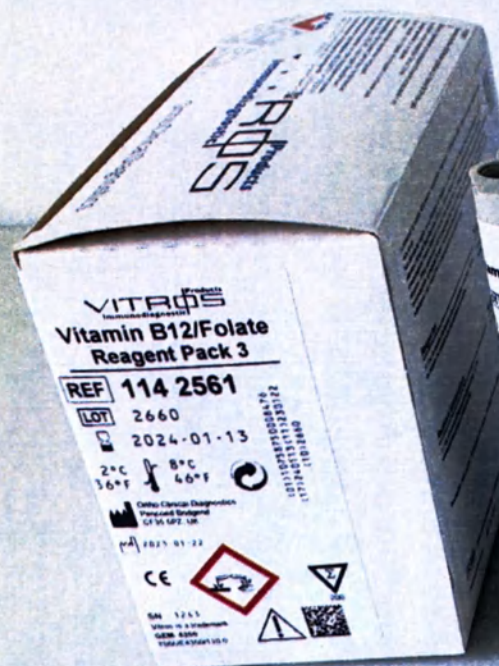

114 2561

Реагенты VITROS Витамин B12/Фолат в кассете 3 (VITROS Vitamin B12/ Folate Reagent Pack 3) для количественного иммунодиагностического определения витамина B12 с тестом VITROS Витамин B12 или фолиевой кислоты с тестом VITROS Фолат методом усиленной

хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS, в составе: 1. Реагенты в кассете 3, 1 кассета. 2. Дополнительная идентификационная карта (для использования с реагентами в кассете 3) – 1 шт. 3. Глоссарий с предупреждающими символами и фразами - 1 шт.


Назначение: Для совместного использования с Реагентами VITROS Витамин B12 в кассете для количественного определения витамина B12 или с Реагентами VITROS Фолат в кассете для количественного определения фолиевой кислоты на анализаторах серии VITROS (VITROS ECi/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600).

Регистрационное удостоверение в РФ: _____

Уполномоченная организация на территории РФ: ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия, 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, дер. Сколково, ул. Новая, дом. 100, стр. 9

Версия _____

Реагенты VITROS Витамин B12/Фолат в кассете 3. Кассета с реагентами.

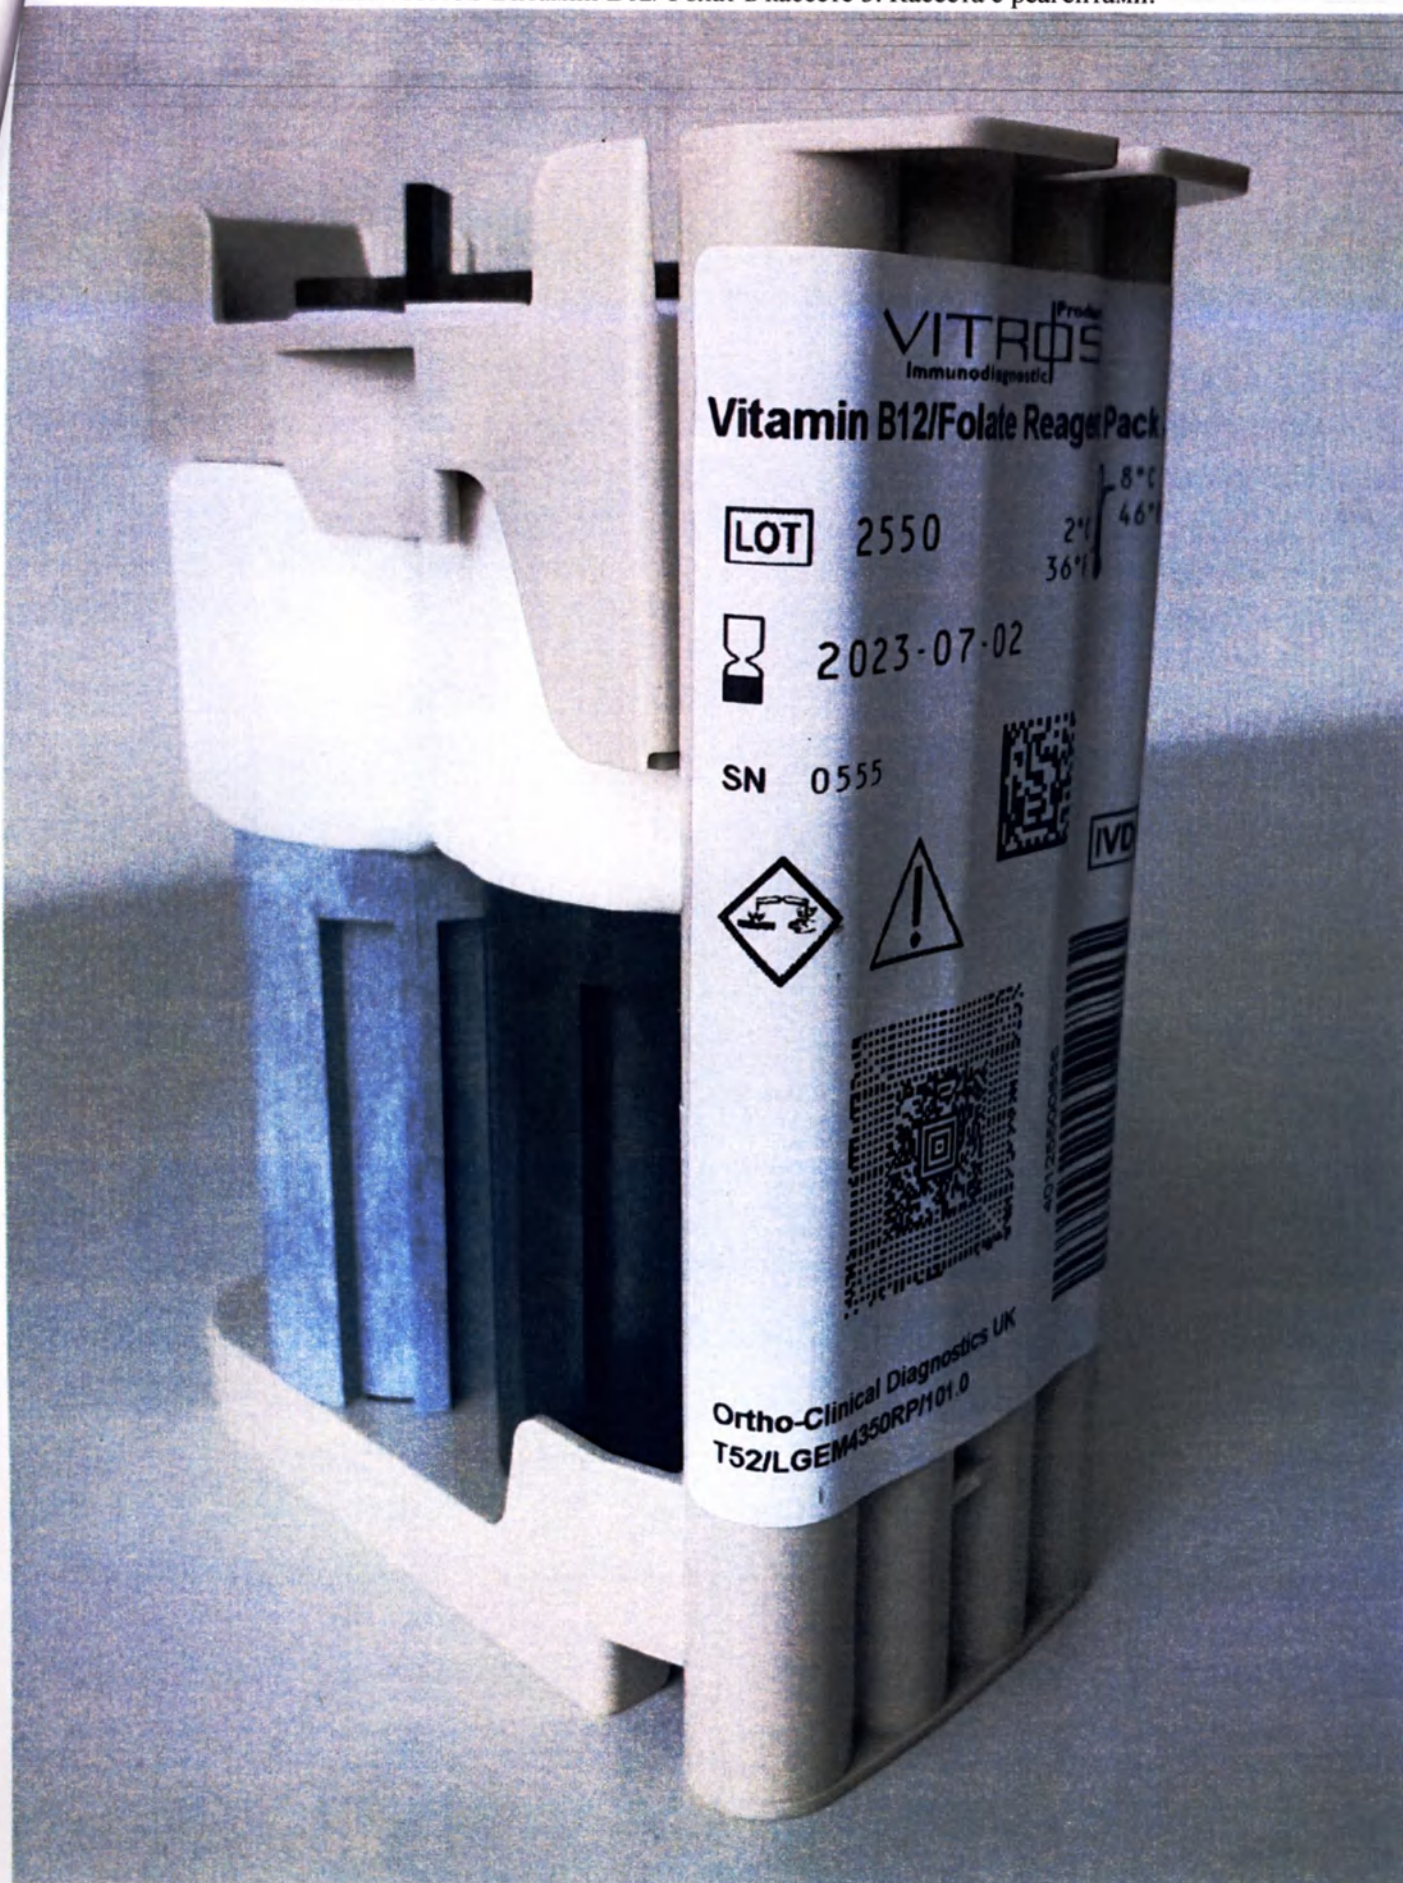

ВСЕГО 4 лист а
«9» сентября 2024 г.
Генеральный Директор
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс»

Сергеенко В.К.

