

«УТВЕРЖДАЮ»

Лидер по регистрации

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

А.П. Харитонова



«19» января 2024 г.

Фотографические изображения

«Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ Omni Legend с принадлежностями, варианты исполнения: с шириной ПЭТ детектора: 16, 32 см»

Производства:

««ДжиИ Медикал Системз Израиль, Фанкшинл Имэджинг», Израиль (GE Medical Systems Israel, Functional Imaging) 4 Hayozma Street, 30200 Tirat Hacarmel, Israel



Рис. 1. Транспортная упаковка

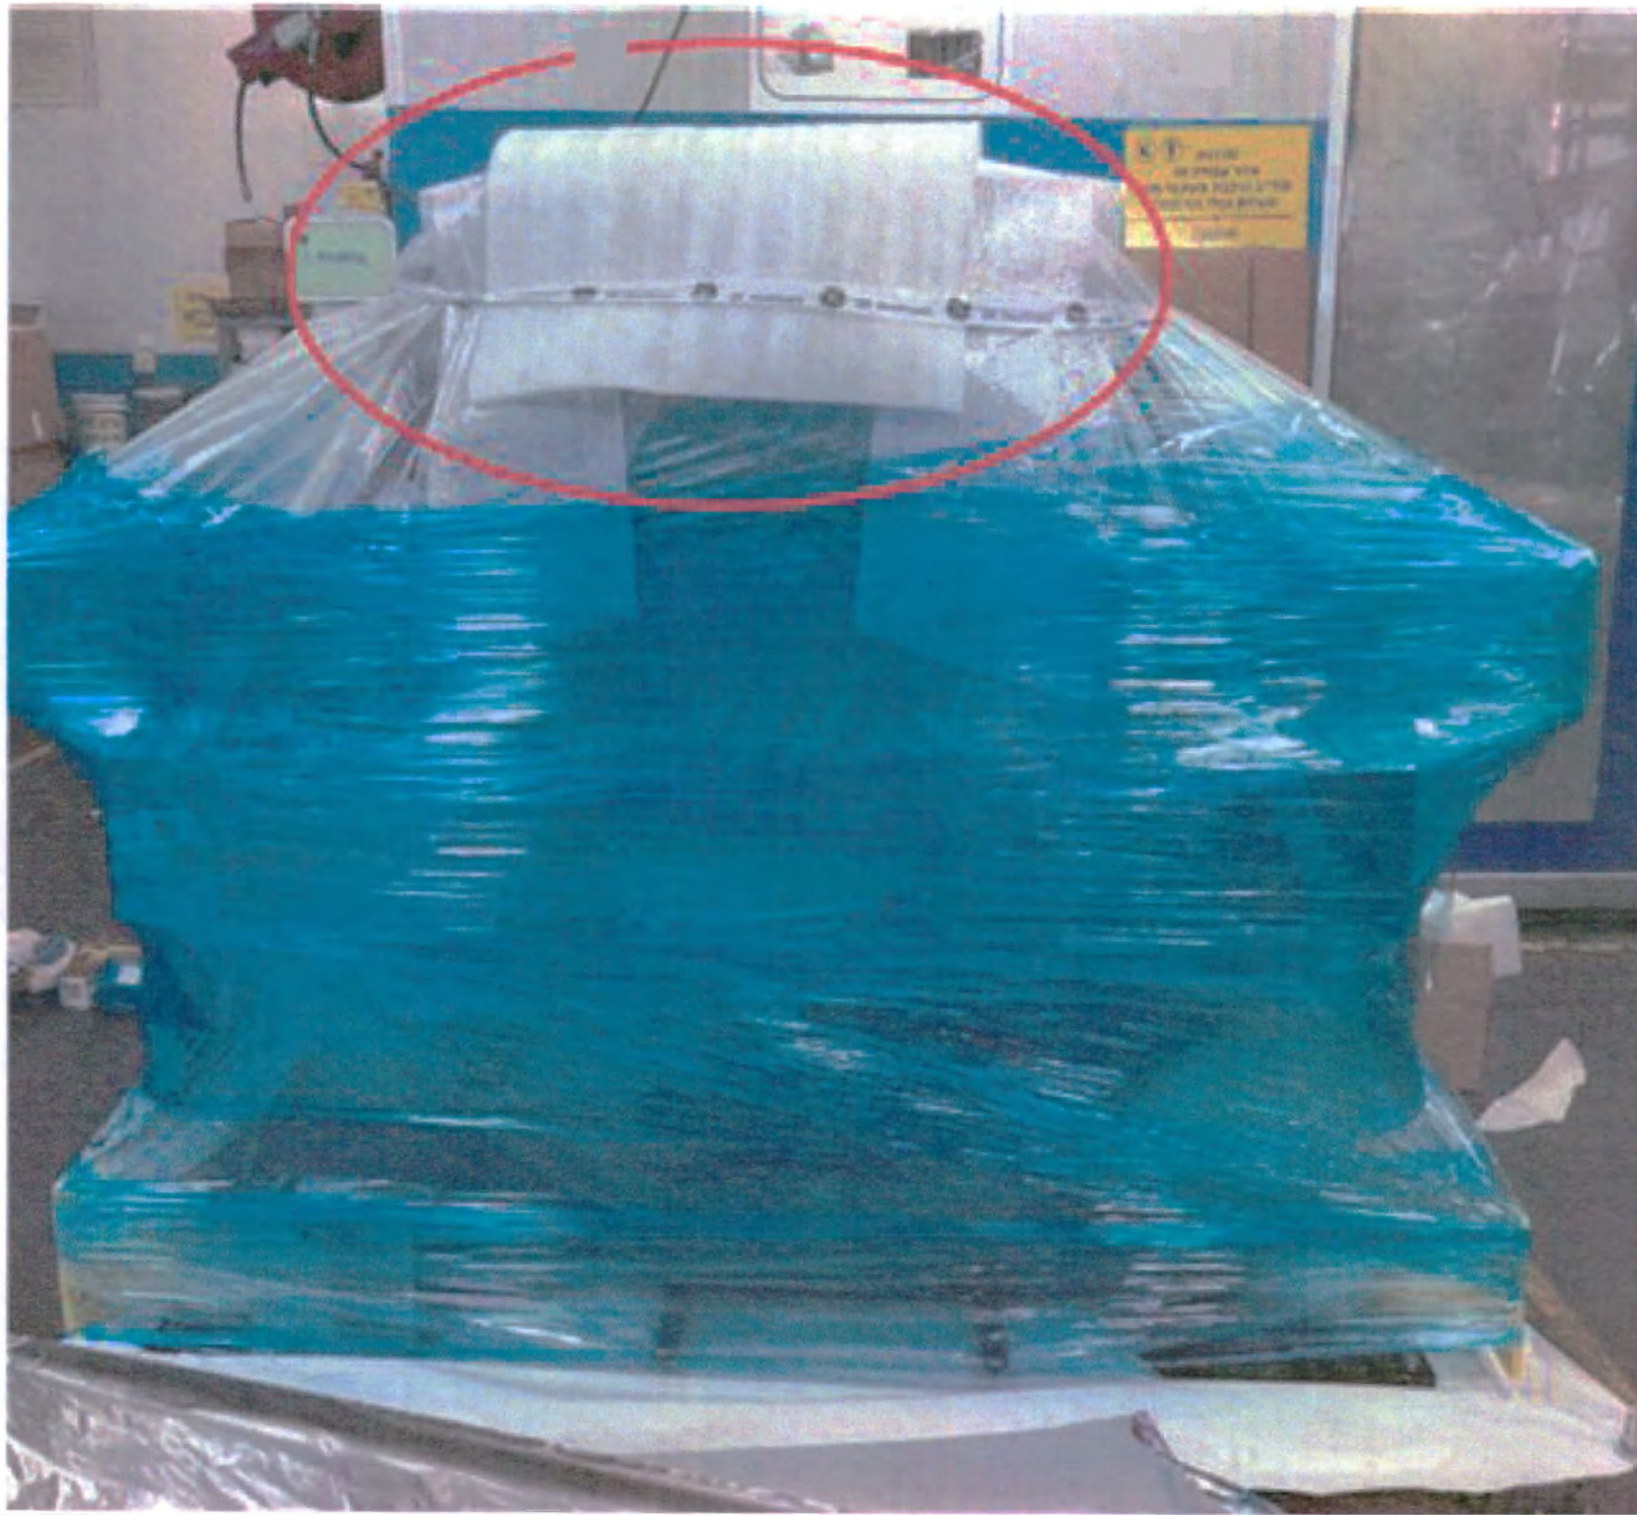






Рис. 4. Генри ПЭТ

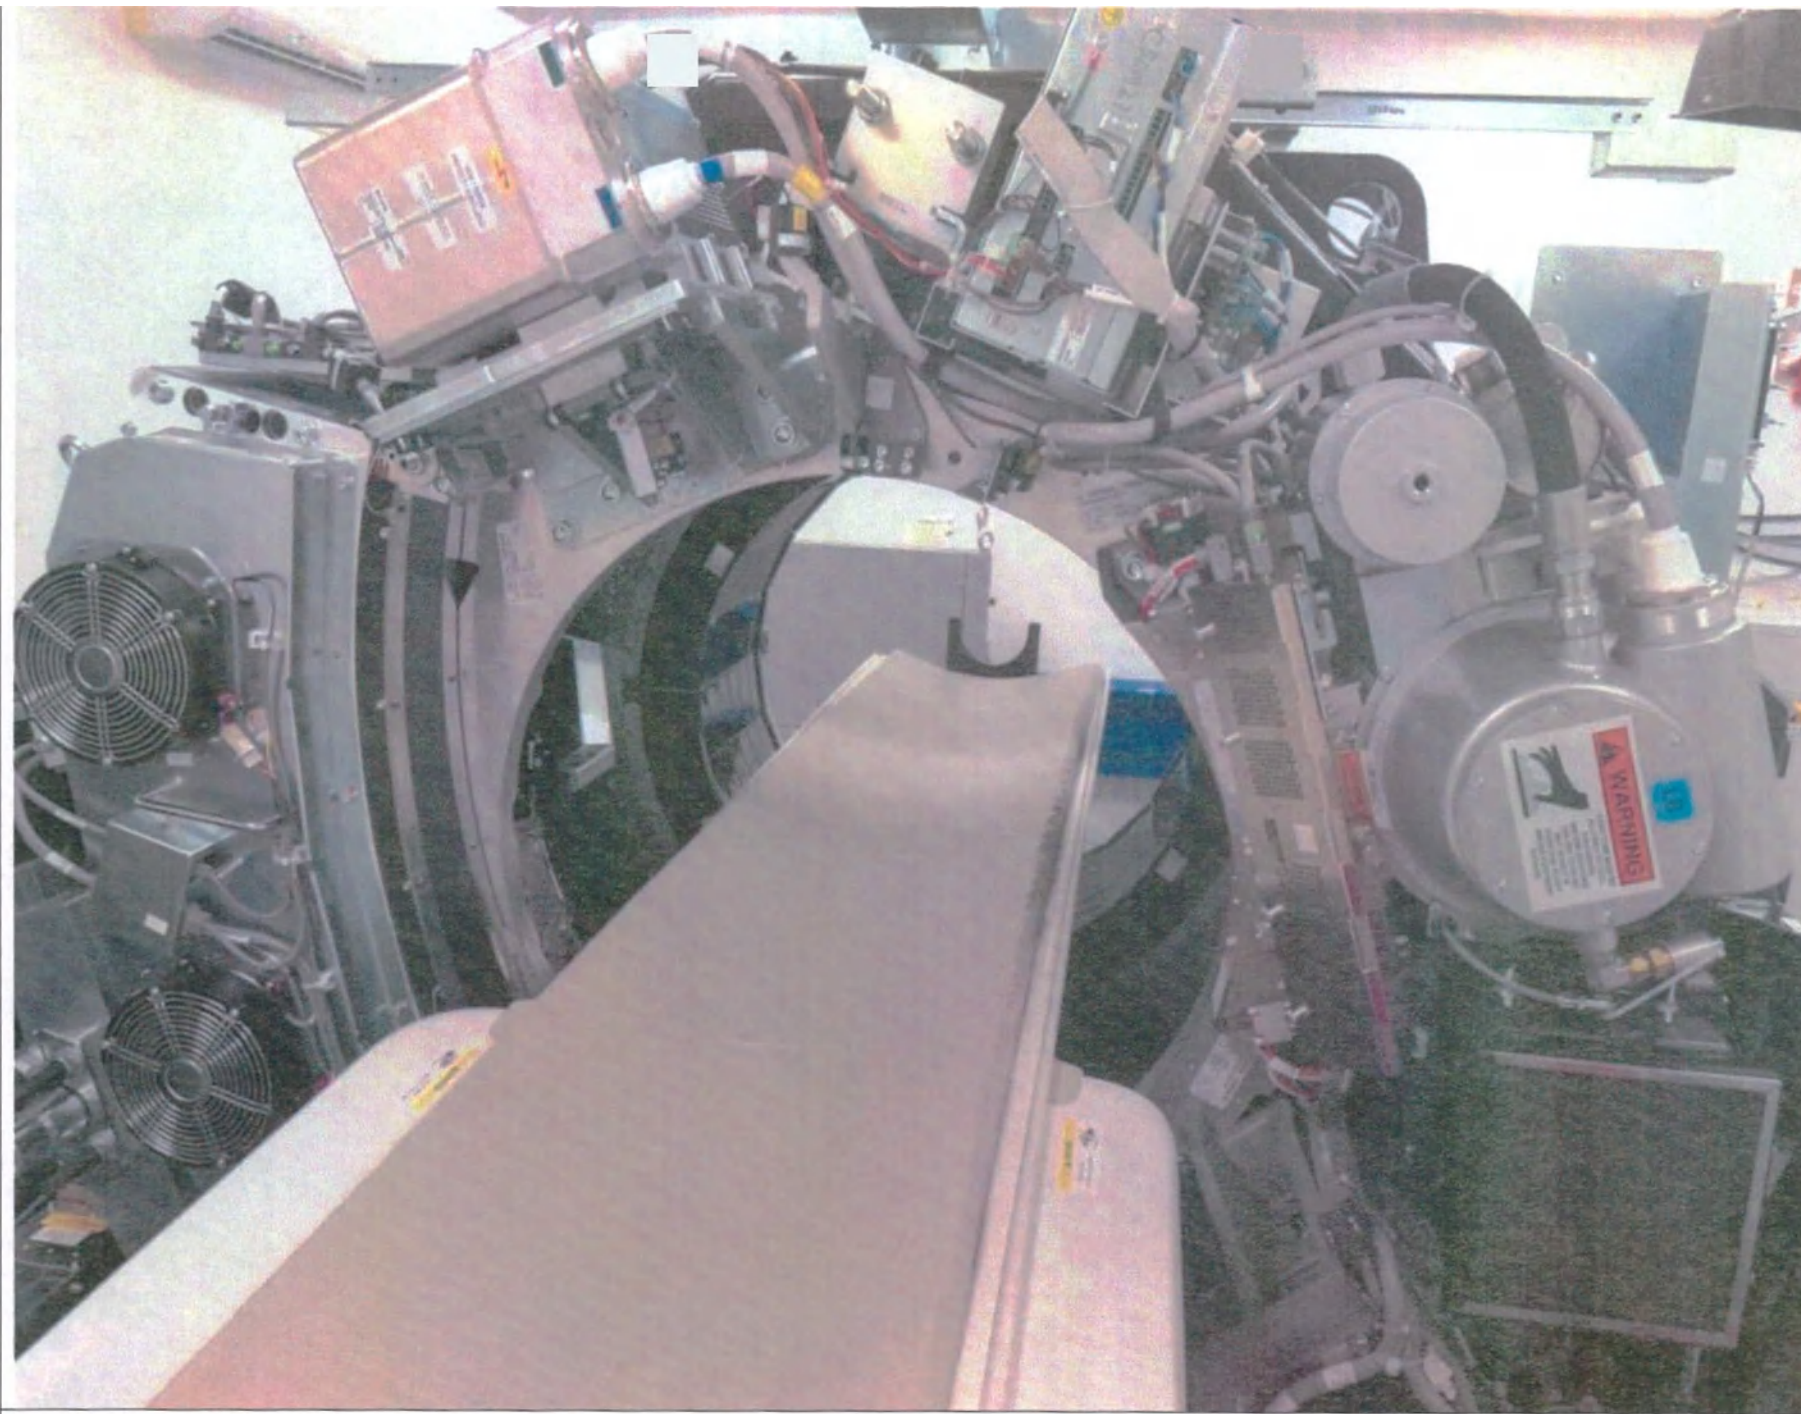


Рис. 5. Гентри КТ.

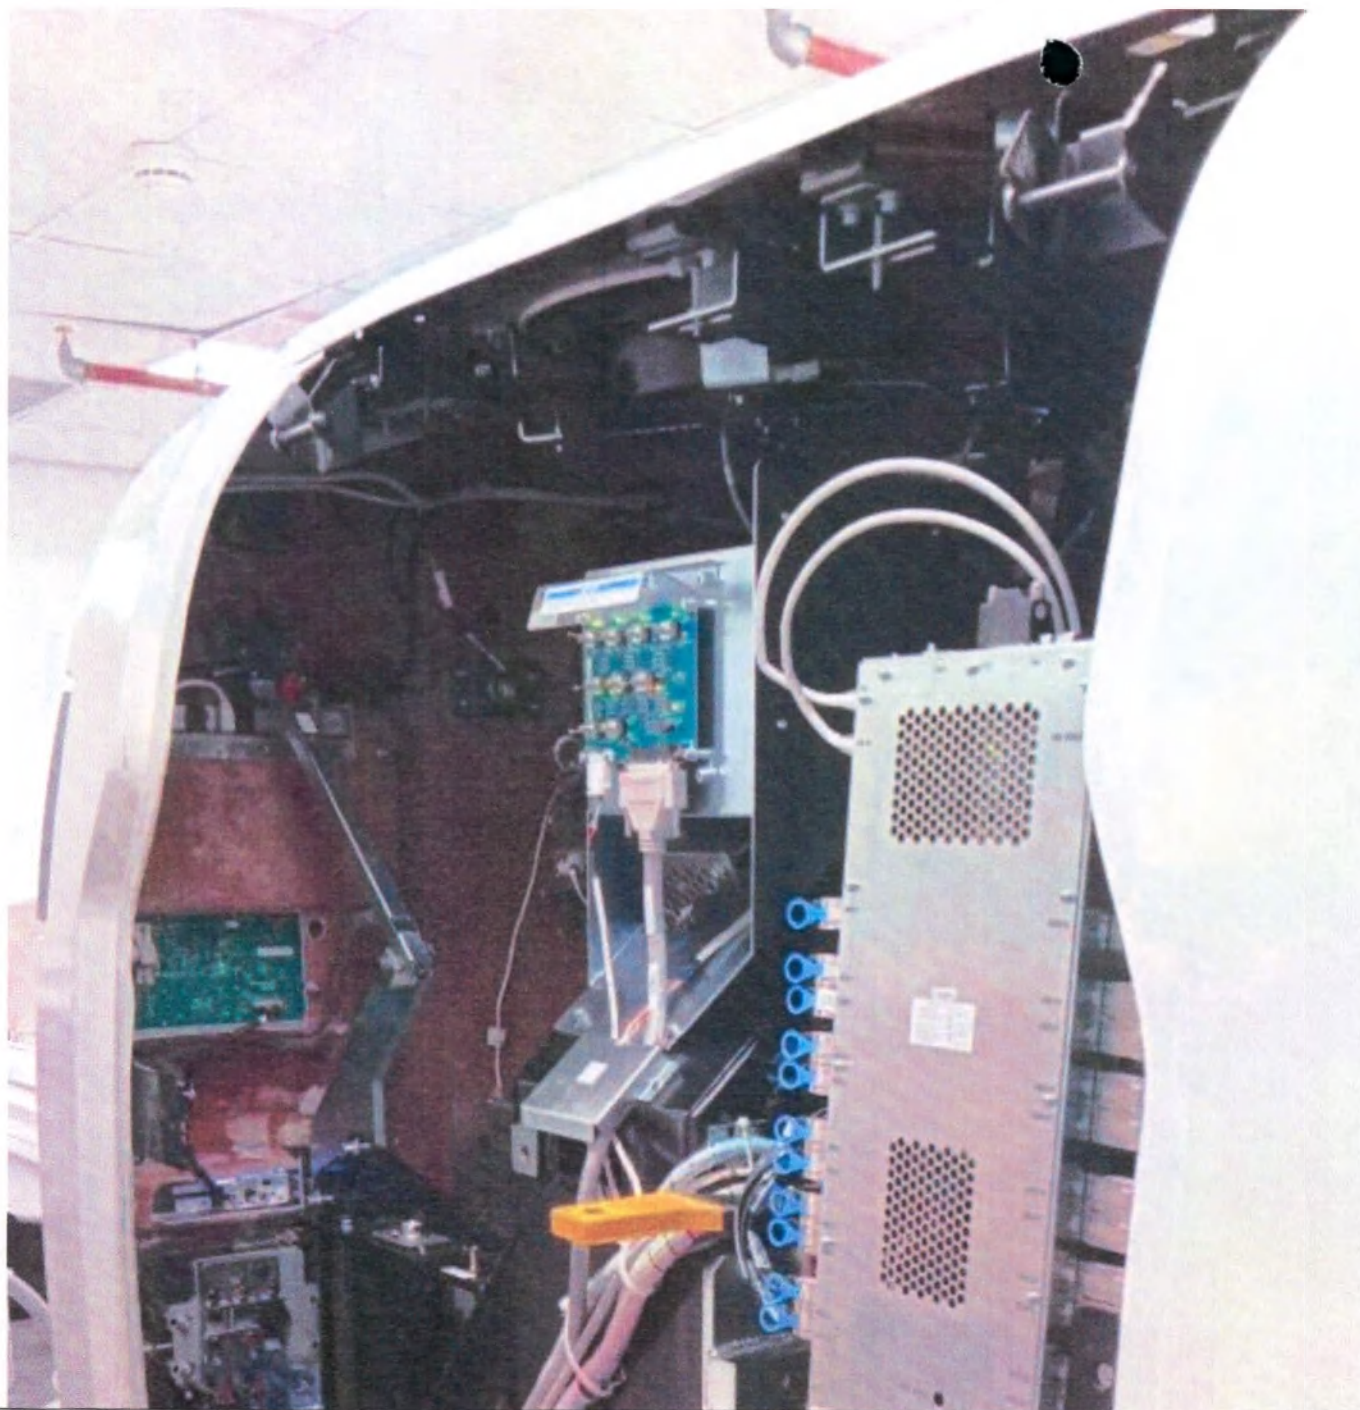


Рис. 6. Гентри КТ.

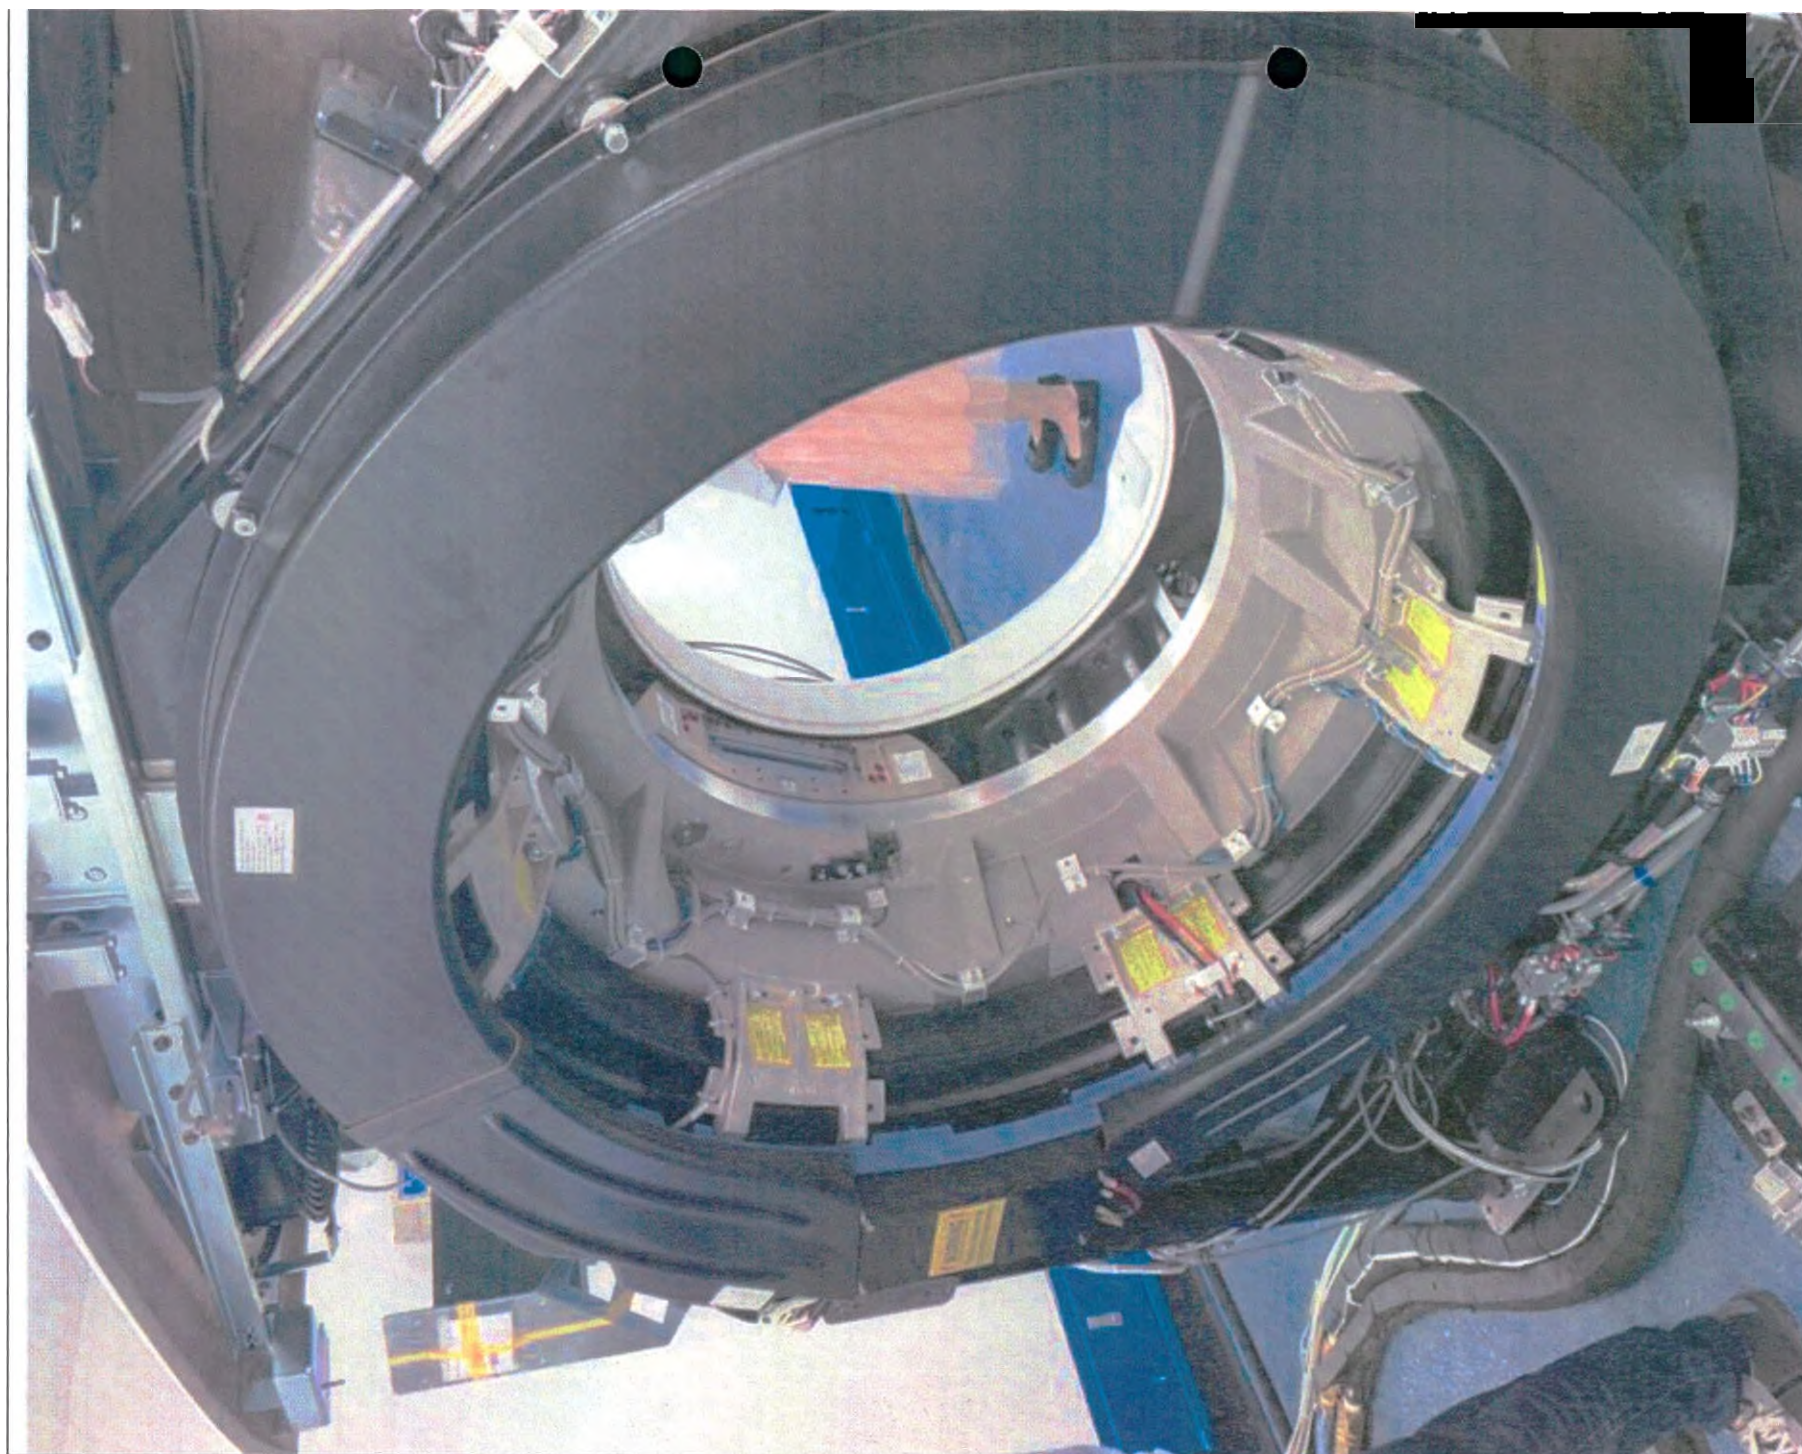


Рис. 7. Гентри КТ.



Рис. 8. Стол для пациента.



Рис. 9. Консоль управления (не более 4 шт.)

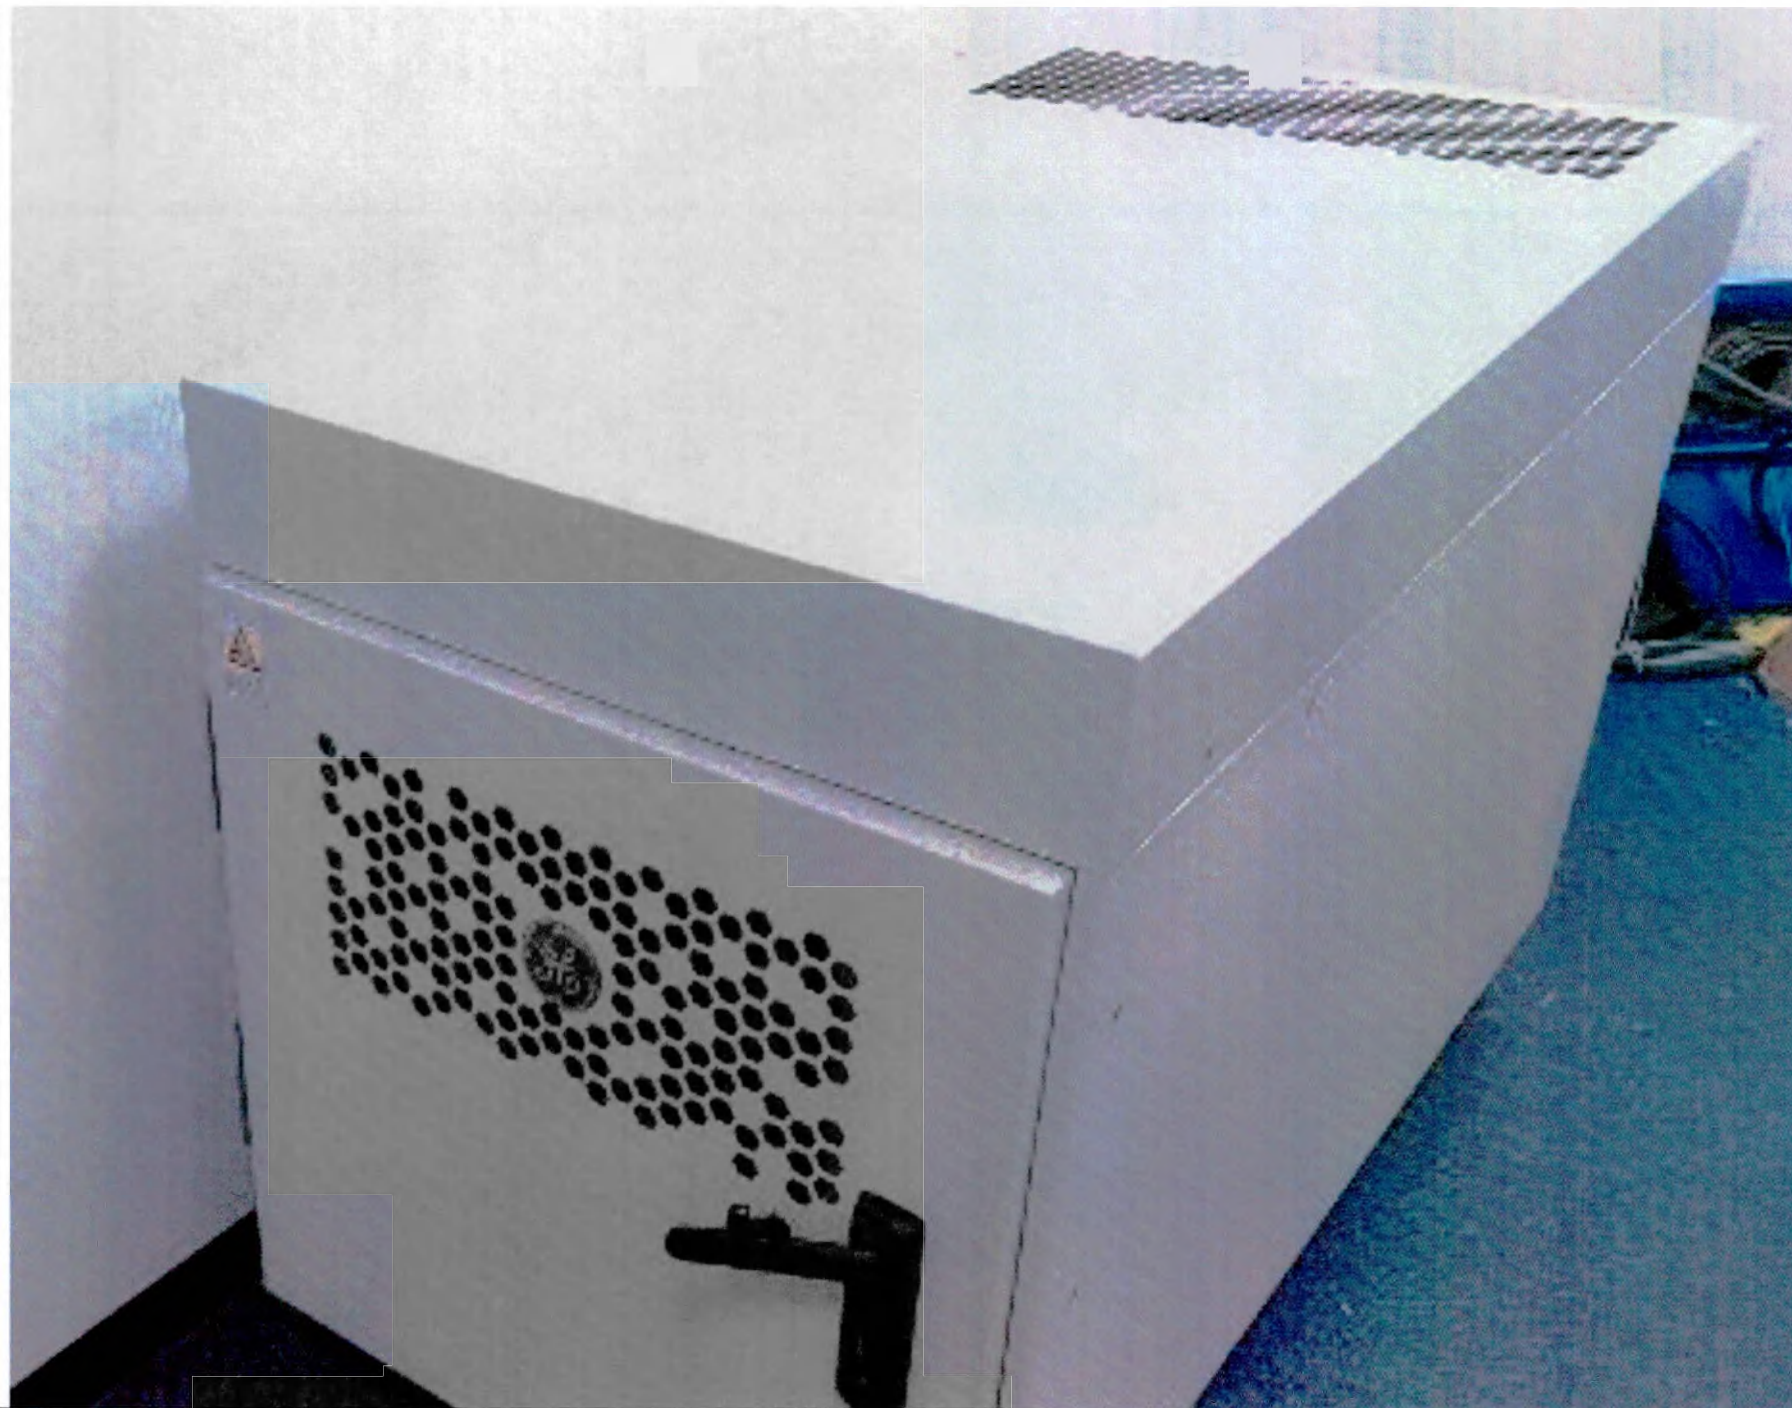


Рис. 10. Контроллер сбора и реконструкции данных ПЭТ (не более 4 шт.).



Рис. 11. Контроллер сбора и реконструкции данных ПЭТ (не более 4 шт.).



Рис. 12. Мониторы (не более 10 шт.).

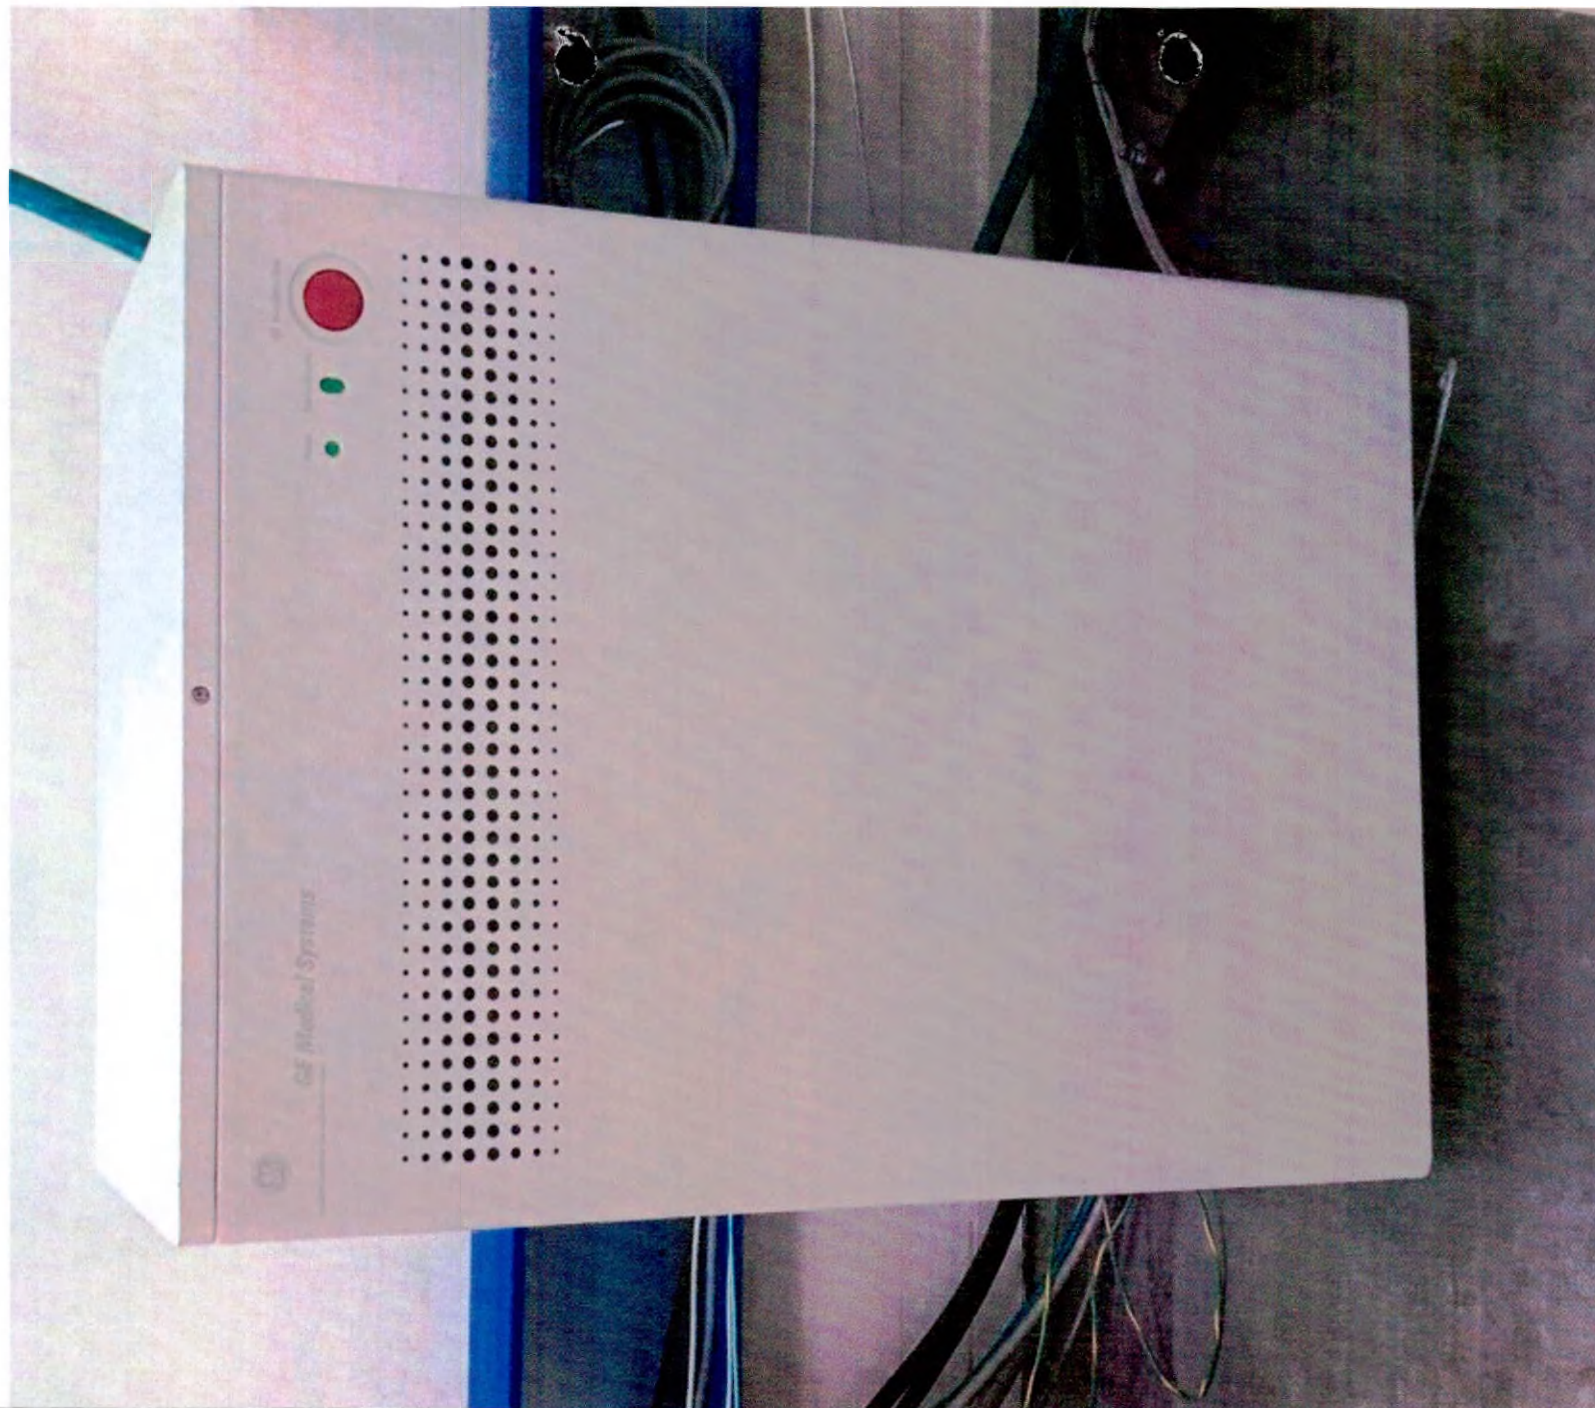


Рис. 13. Шкаф питания распределительный (не более 4 шт.).



Рис. 14. Рабочая станция (не более 10 шт.) (при необходимости)



Рис. 15. Панель управления (не более 4 шт.)

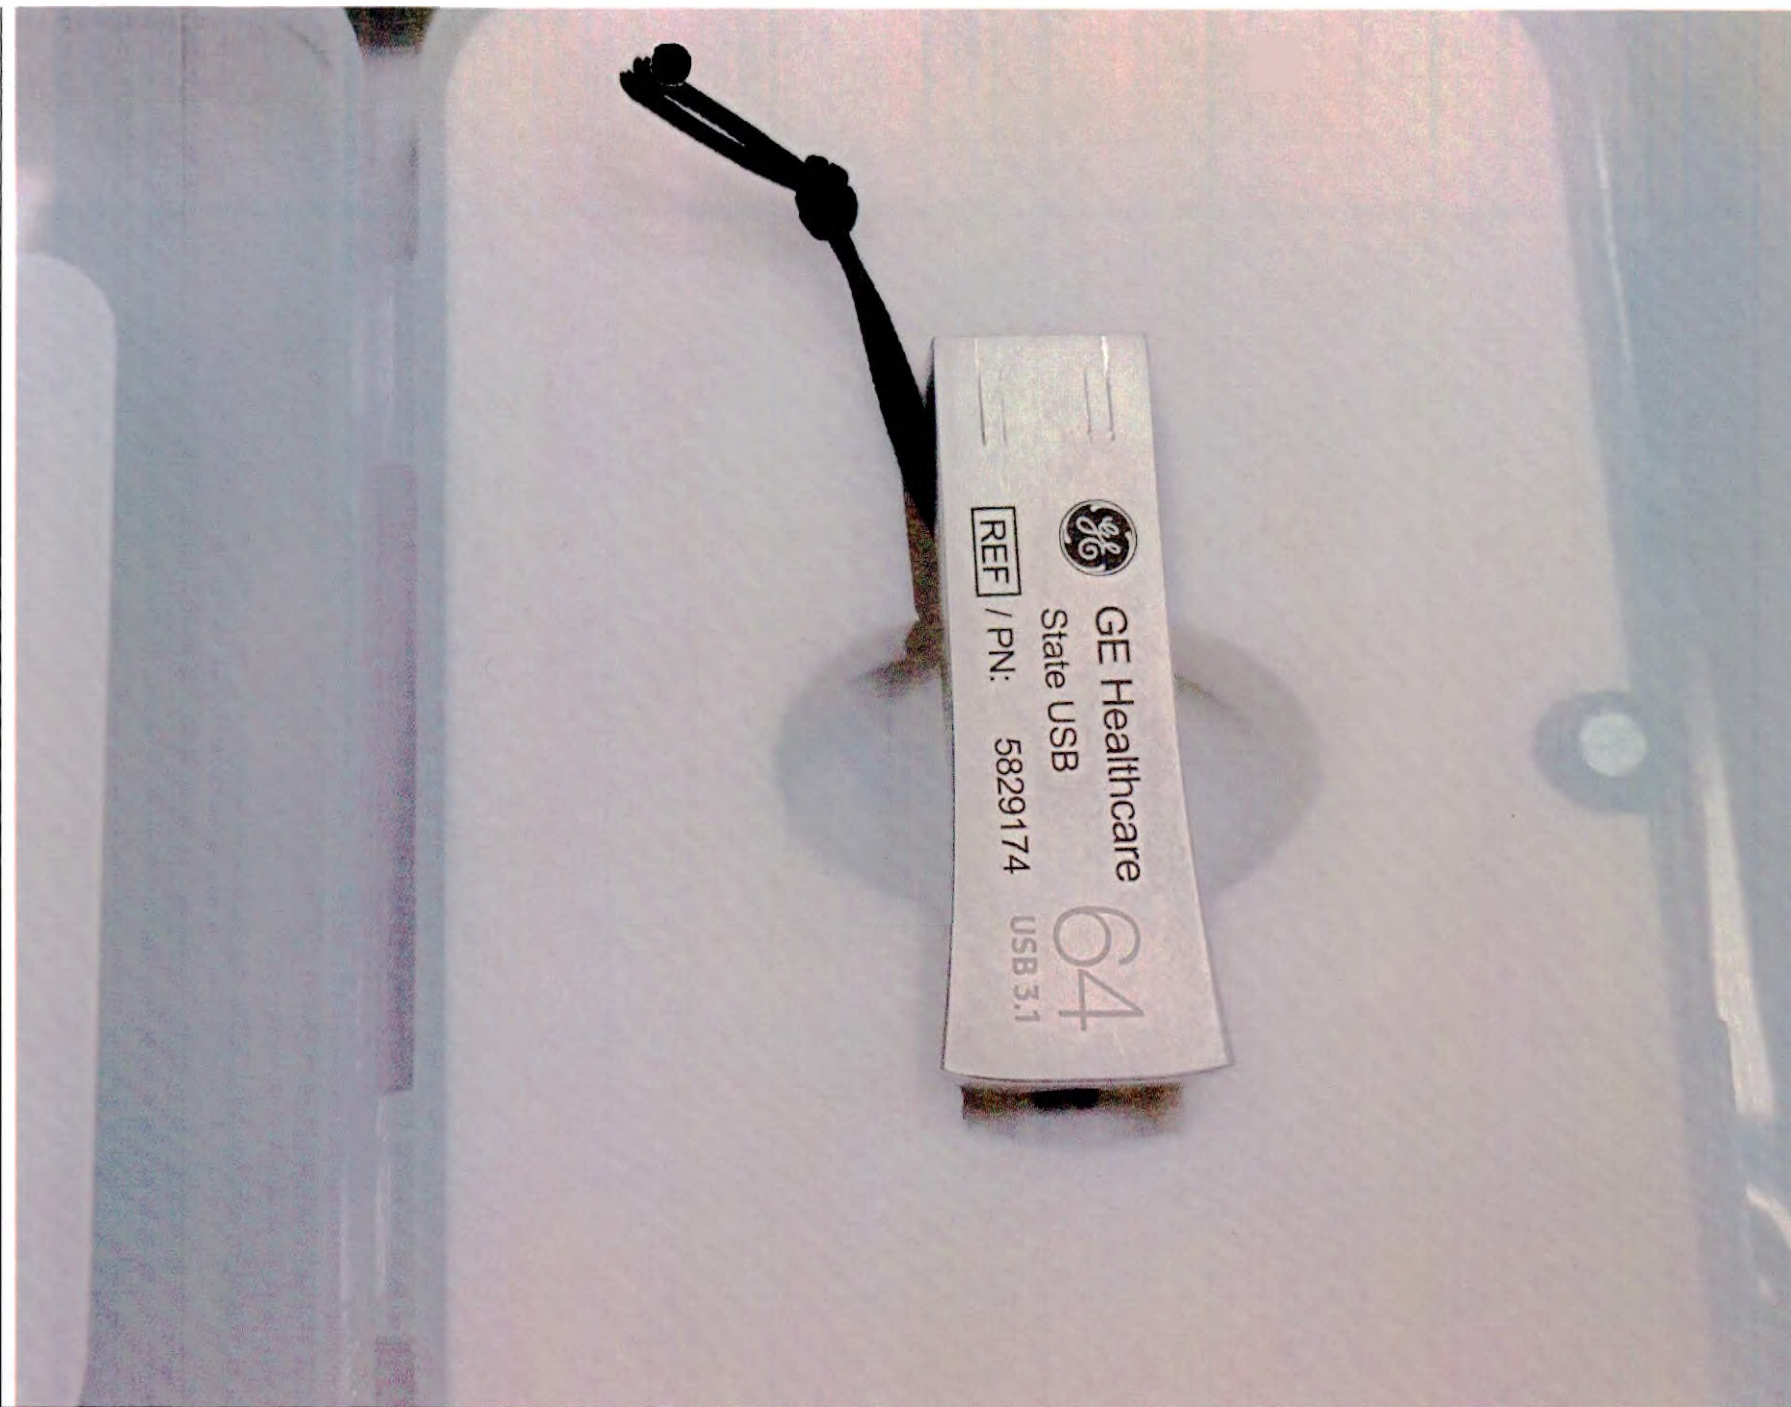


Рис. 16. Руководство пользователя (не более 10 шт.)

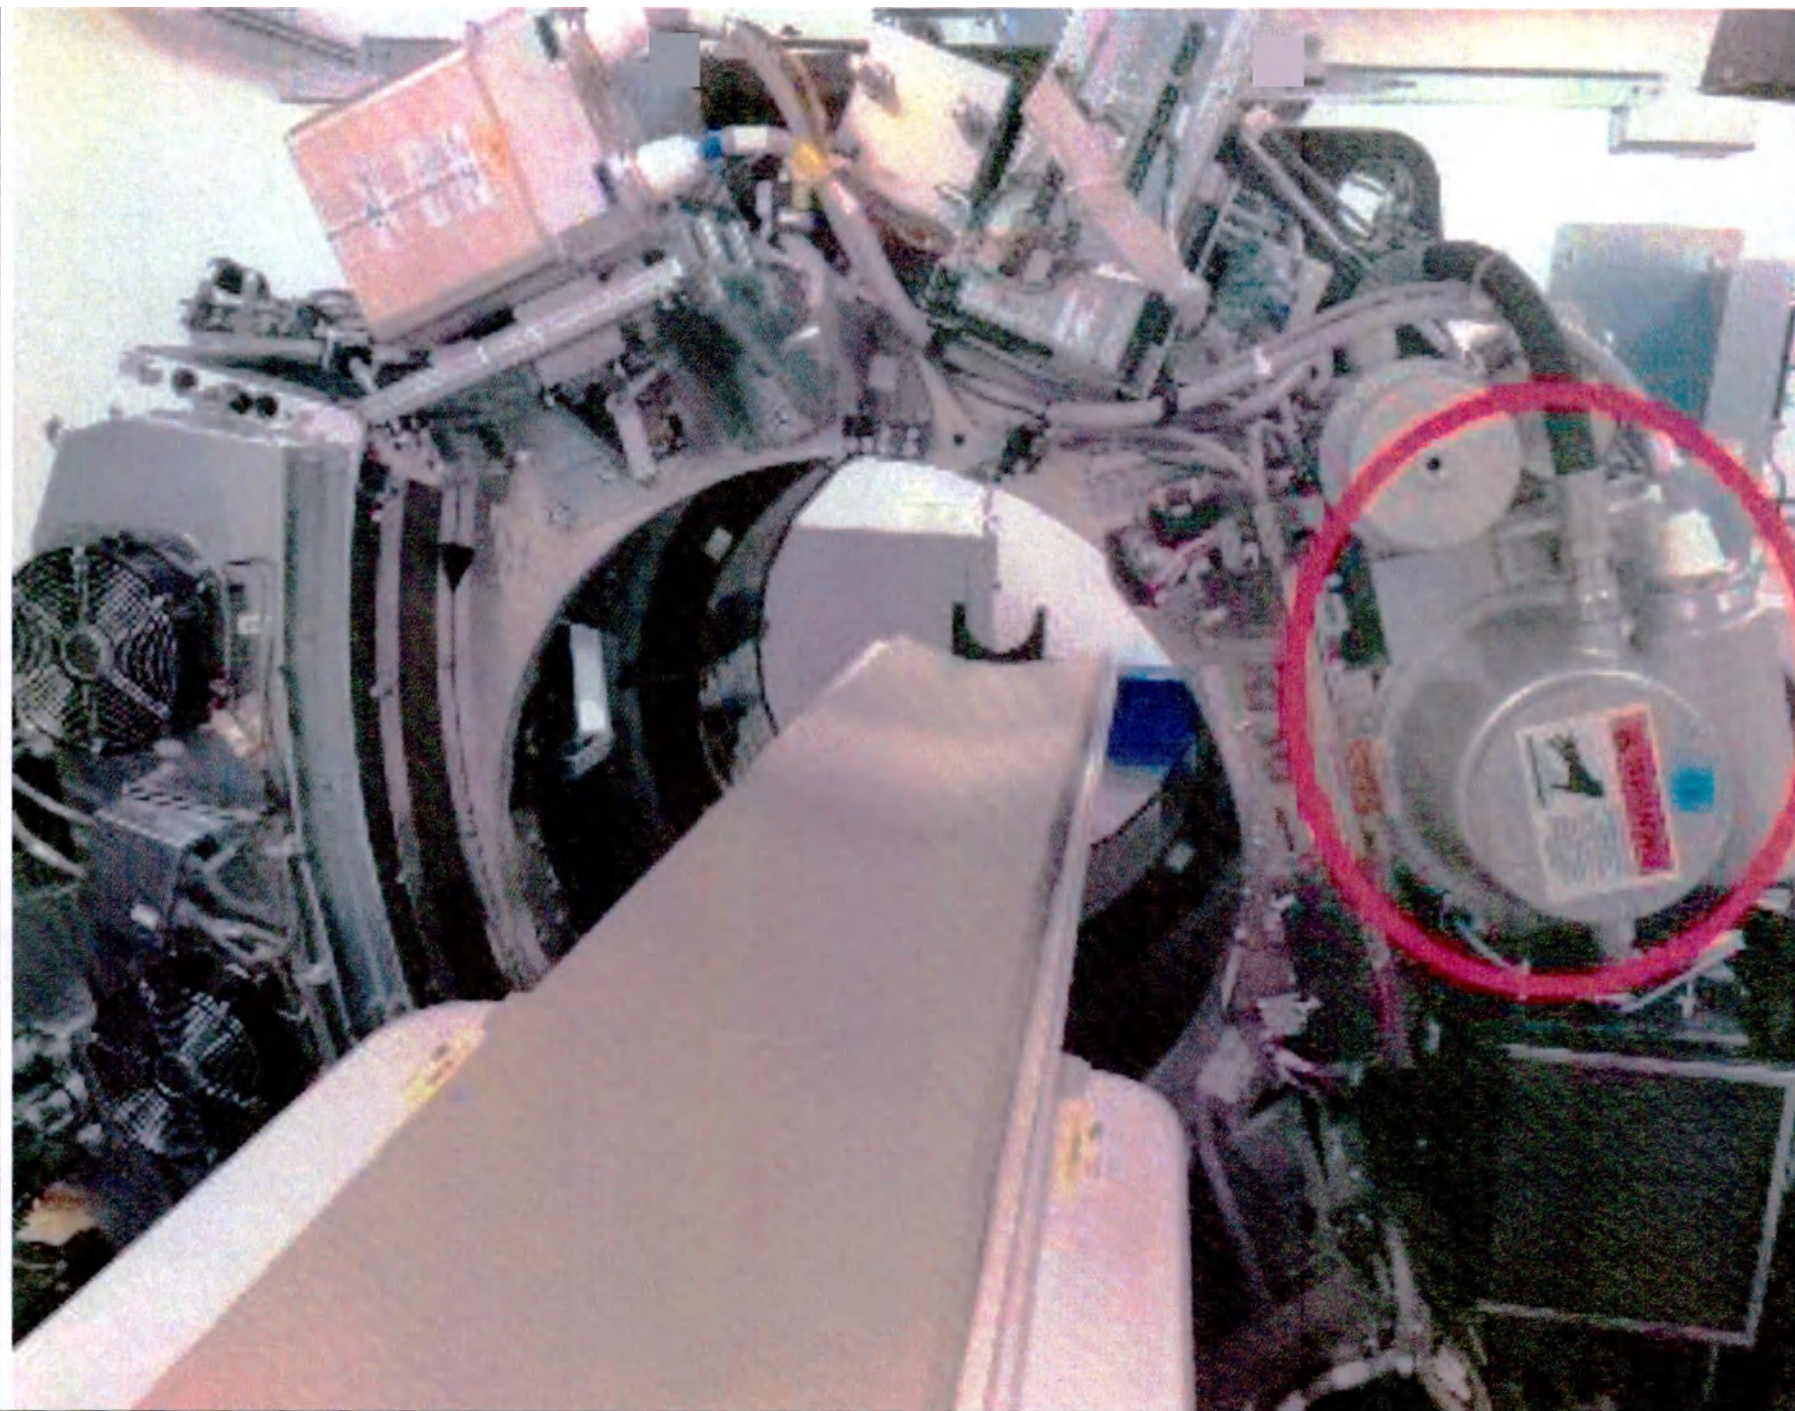


Рис. 17. Рентгеновский излучатель.



Рис. 18. Принадлежности: Щиты силовые электрические (не более 10 шт.).



Рис. 19. Электрораспределительная панель (не более 10 шт.).



Рис. 20. Устройства для охлаждения системы (не более 6 шт.).



Рис. 21. Устройства для охлаждения системы (не более 6 шт.).



Рис. 22. Система инъекционная для КТ MEDRAD Stellant D с рабочей станцией Certegra, РУ №РЗН 2014/1499 (не более 4 шт.) (при необходимости).

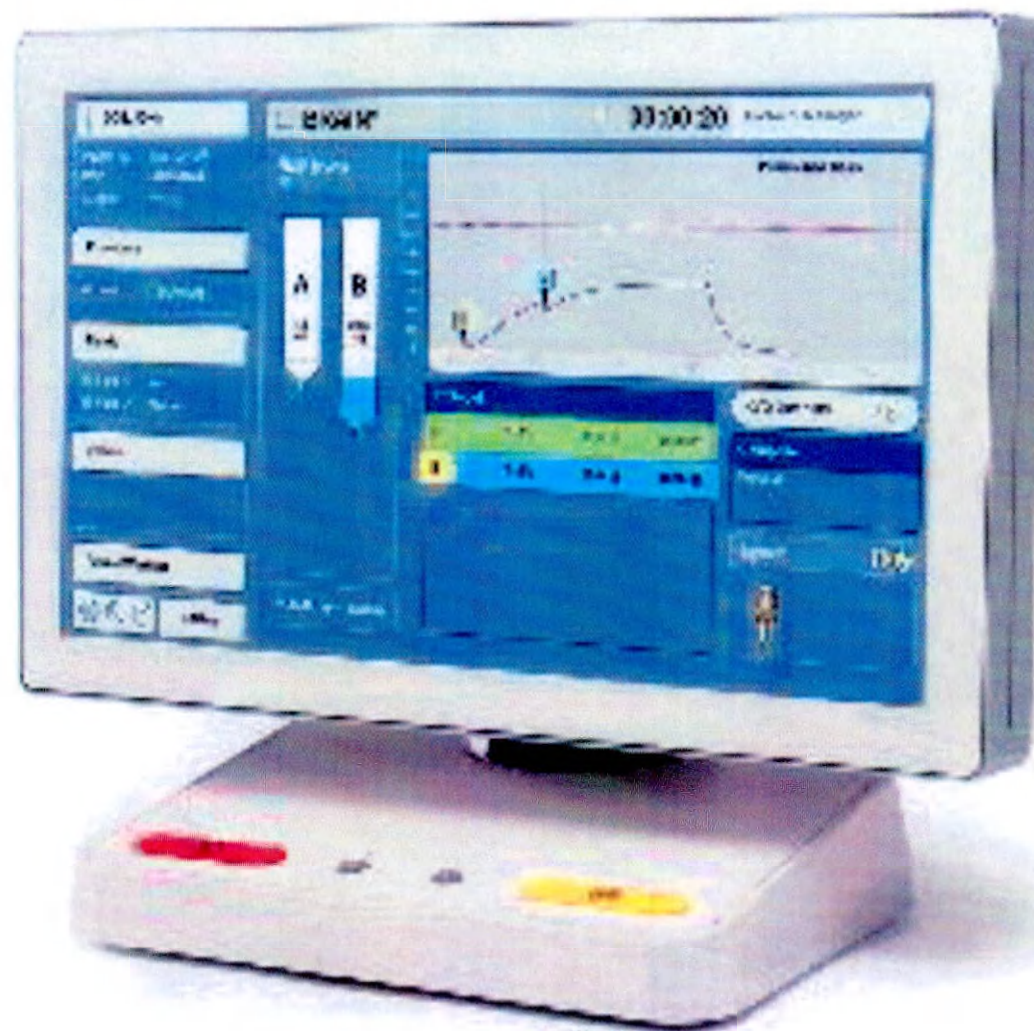


Рис. 23. Система инъекционная для КТ MEDRAD Stellant D с рабочей станцией Certegra, РУ №РЗН 2014/1499 (не более 4 шт.) (при необходимости).



Рис. 24. Система инъекционная для КТ MEDRAD Stellant D с рабочей станцией Certegra, РУ №РЗН 2014/1499 (не более 4 шт.) (при необходимости).



Рис. 25. Система инъекционная для КТ MEDRAD Stellant D с рабочей станцией Certegra, РУ №РЗН 2014/1499 (не более 4 шт.) (при необходимости).



Рис. 26. Инжекторы ангиографические для компьютерной и магнитно-резонансной томографии XD, модель: XD 8000 CT Motion с принадлежностями, РУ № РЗН 2015/2800 (не более 4 шт.) (при необходимости).



Рис. 27. Система инъекционная MEDRAD Salient с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12881 (не более 4 шт.) (при необходимости).



Рис. 28. Система инъекционная MEDRAD Salient с принадлежностями, РУ № ФСЗ 2012/12881 (не более 4 шт.) (при необходимости).



Рис. 29. Кардиосинхронизатор медицинский, вариант исполнения 7800 с принадлежностями, РУ №РЗН 2016/4384 (при необходимости).



Рис. 30. Кардиосинхронизатор медицинский, вариант исполнения 7800 с принадлежностями, РУ №РЗН 2016/4384 (при необходимости).



Рис. 31. Кардиосинхронизатор медицинский, вариант исполнения 7800 с принадлежностями, РУ №РЗН 2016/4384 (при необходимости).



Рис. 32. Система синхронизации с дыханием RGSC с принадлежностями, РУ №РЗН 2019/8648 (не более 10 шт.) (при необходимости).



Рис. 33. Система синхронизации с дыханием RGSC с принадлежностями, РУ №РЗН 2019/8648 (не более 10 шт.) (при необходимости).



Рис. 34. Система синхронизации с дыханием RGSC с принадлежностями, РУ №РЗН 2019/8648 (не более 10 шт.) (при необходимости).



Рис. 35. Система синхронизации с дыханием пациента RPM с принадлежностями, РУ №ФСЗ 2011/09721 (не более 10 шт.) (при необходимости).



Рис. 36. Система лазерная для разметки пациента DORADO с принадлежностями, РУ №ФСЗ 2010/08507 (не более 5 шт.) (при необходимости).



Рис. 37. Система лазерная для разметки пациента DORADO с принадлежностями, РУ №ФСЗ 2010/08507 (не более 5 шт.) (при необходимости).



Рис. 38. Система лазерная для разметки пациента DORADO с принадлежностями, РУ №ФСЗ 2010/08507 (не более 5 шт.) (при необходимости).



Рис. 39. Осушитель воздуха (не более 6 шт.).



Рис. 40. Осушитель воздуха (не более 6 шт.).



Рис. 41. Дисплей гентри (не более 5 шт.).

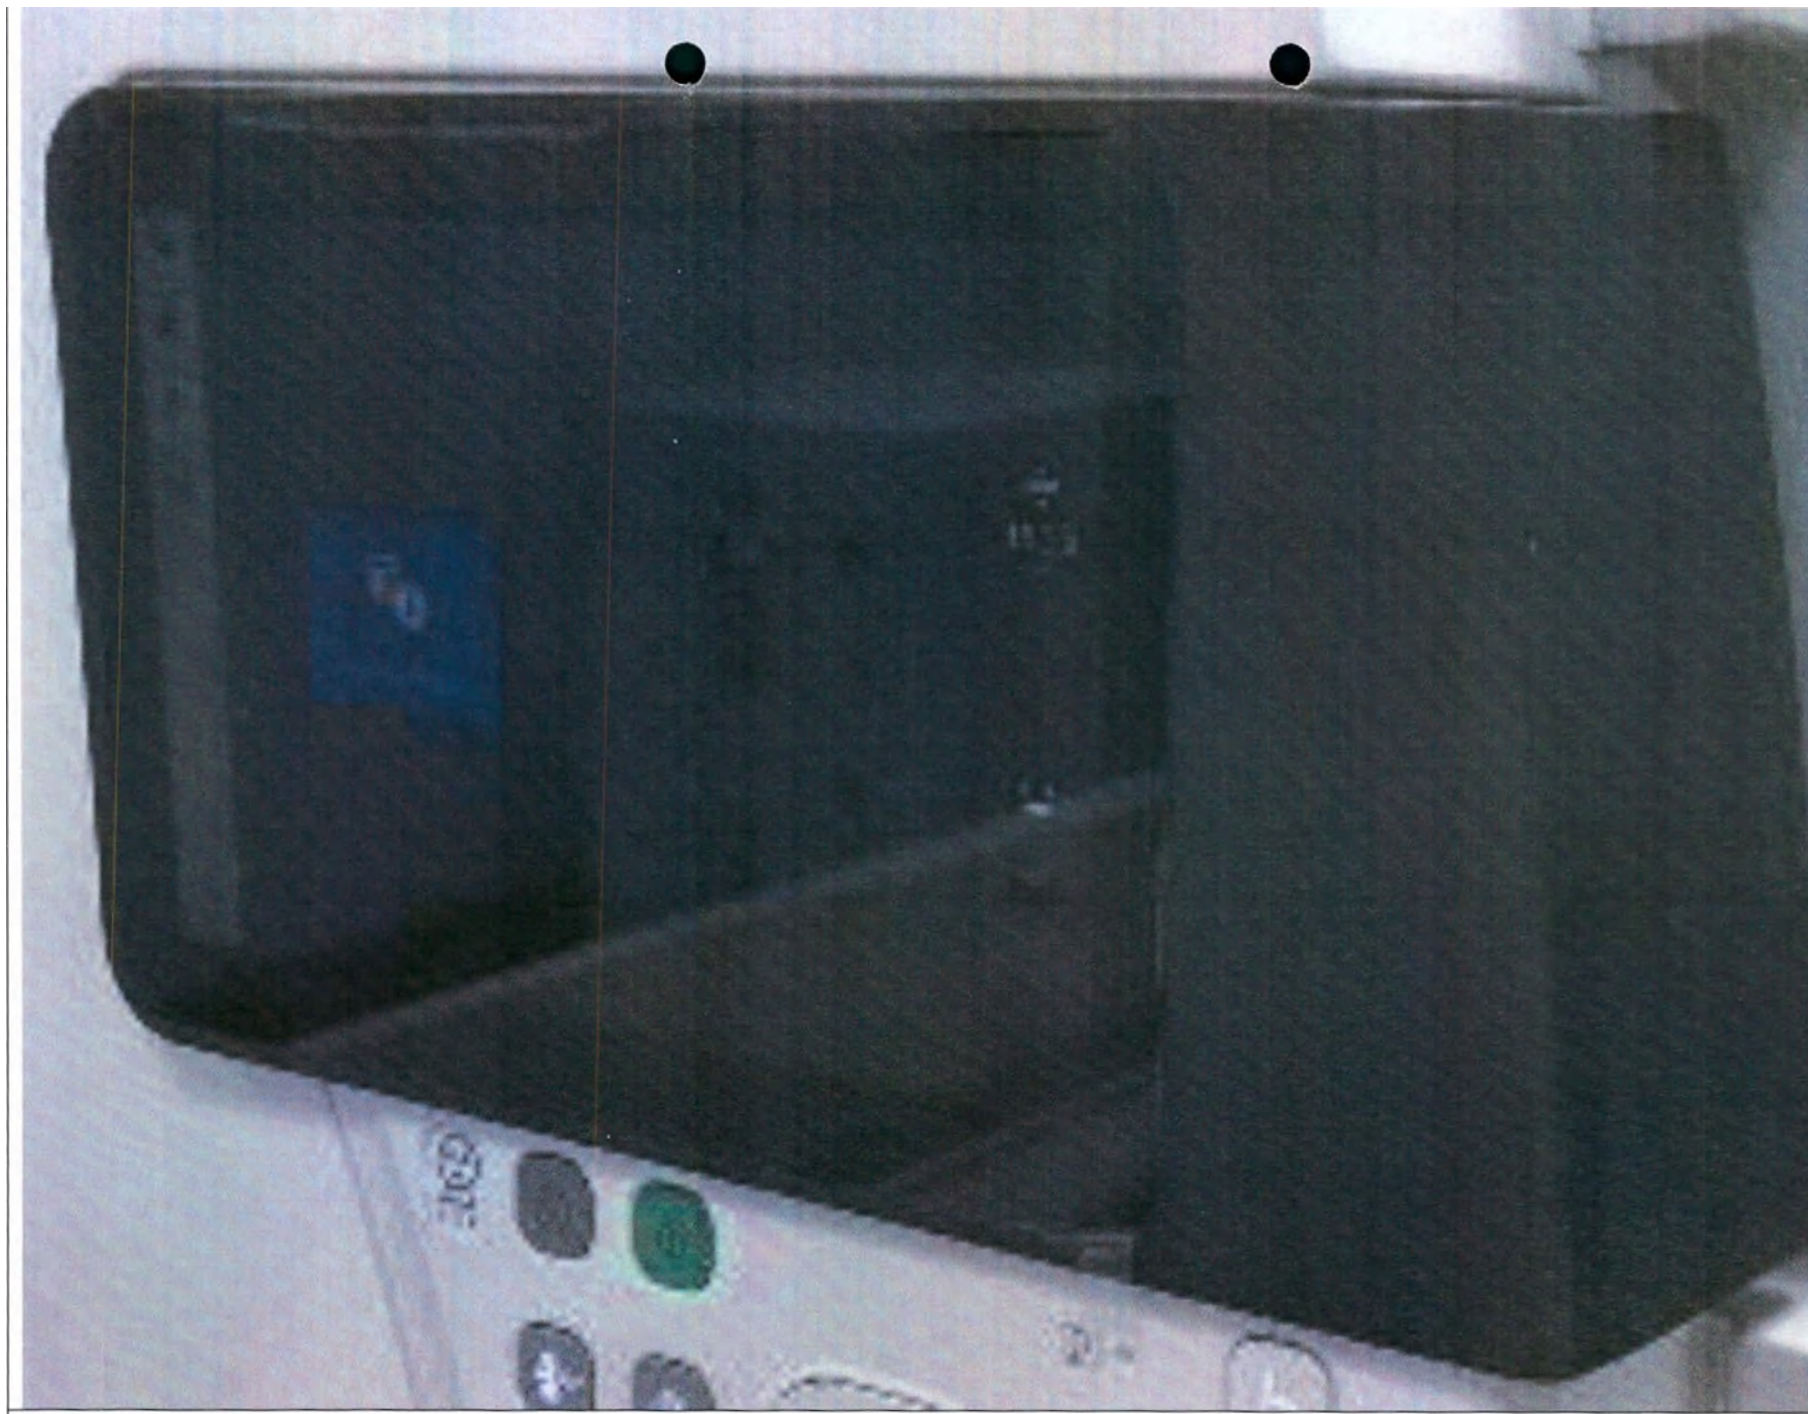


Рис. 42. Дисплей гентри (не более 5 шт.).



Рис. 43. Крышки гентри (не более 8 шт.).



Рис. 44. Крышки гентри (не более 8 шт.).

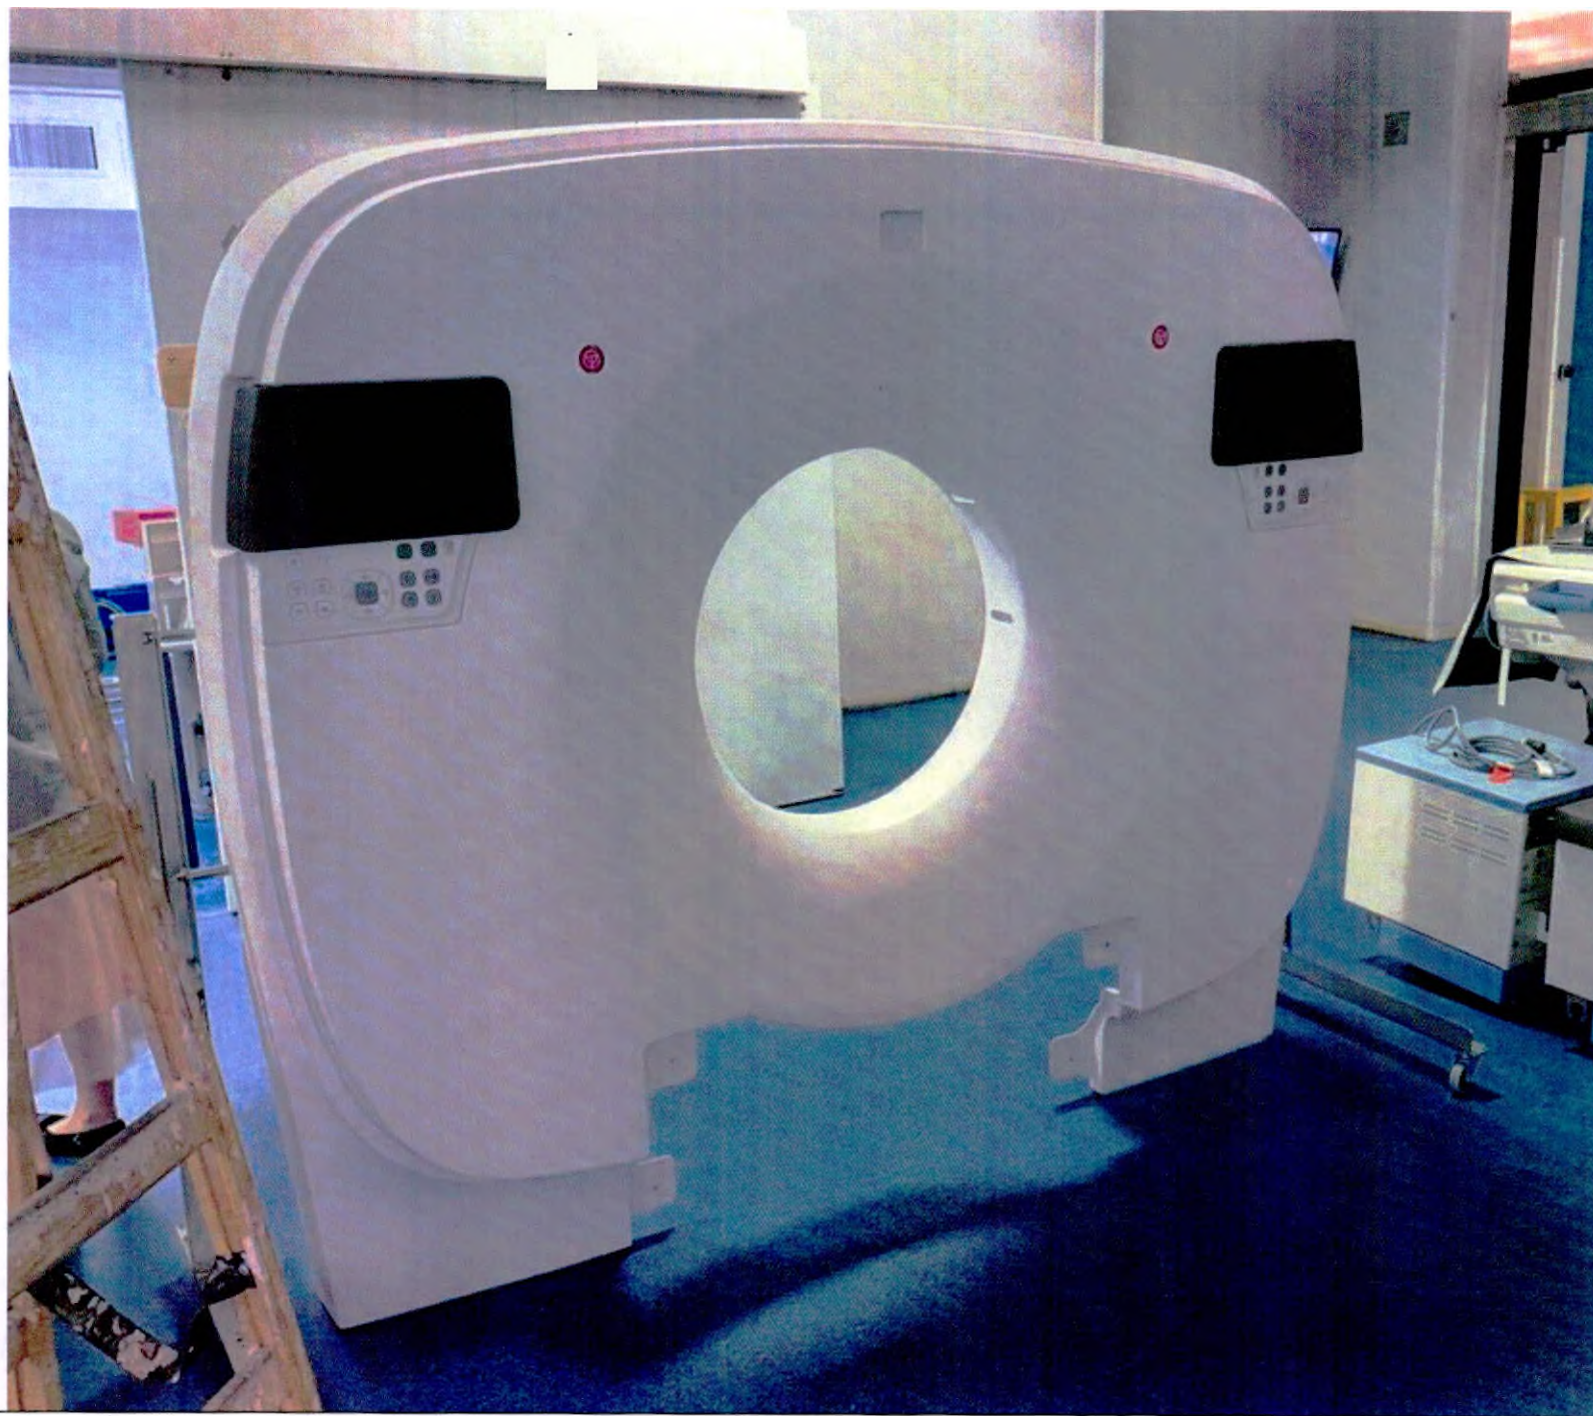


Рис. 45. Крышки гентри (не более 8 шт.).

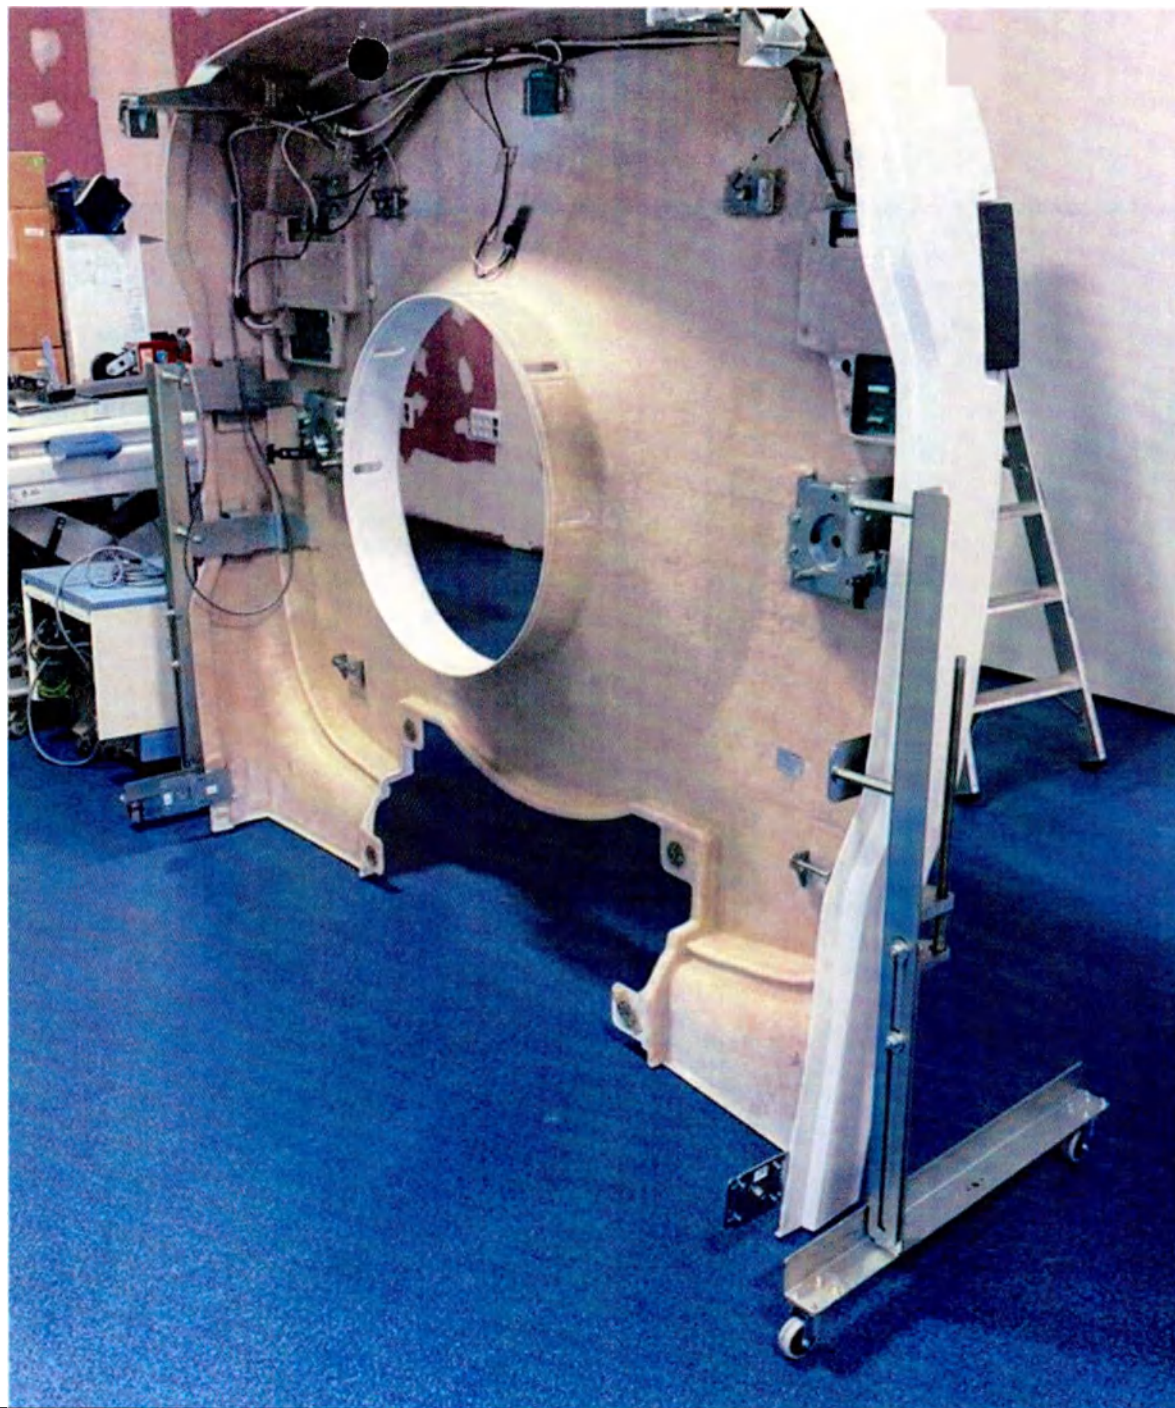


Рис. 46. Крышки гентри (не более 8 шт.).



Рис. 47. Крышки стола для пациента (не более 8 шт.).



Рис. 48. Плоская накладка на стол (не более 2 шт.).

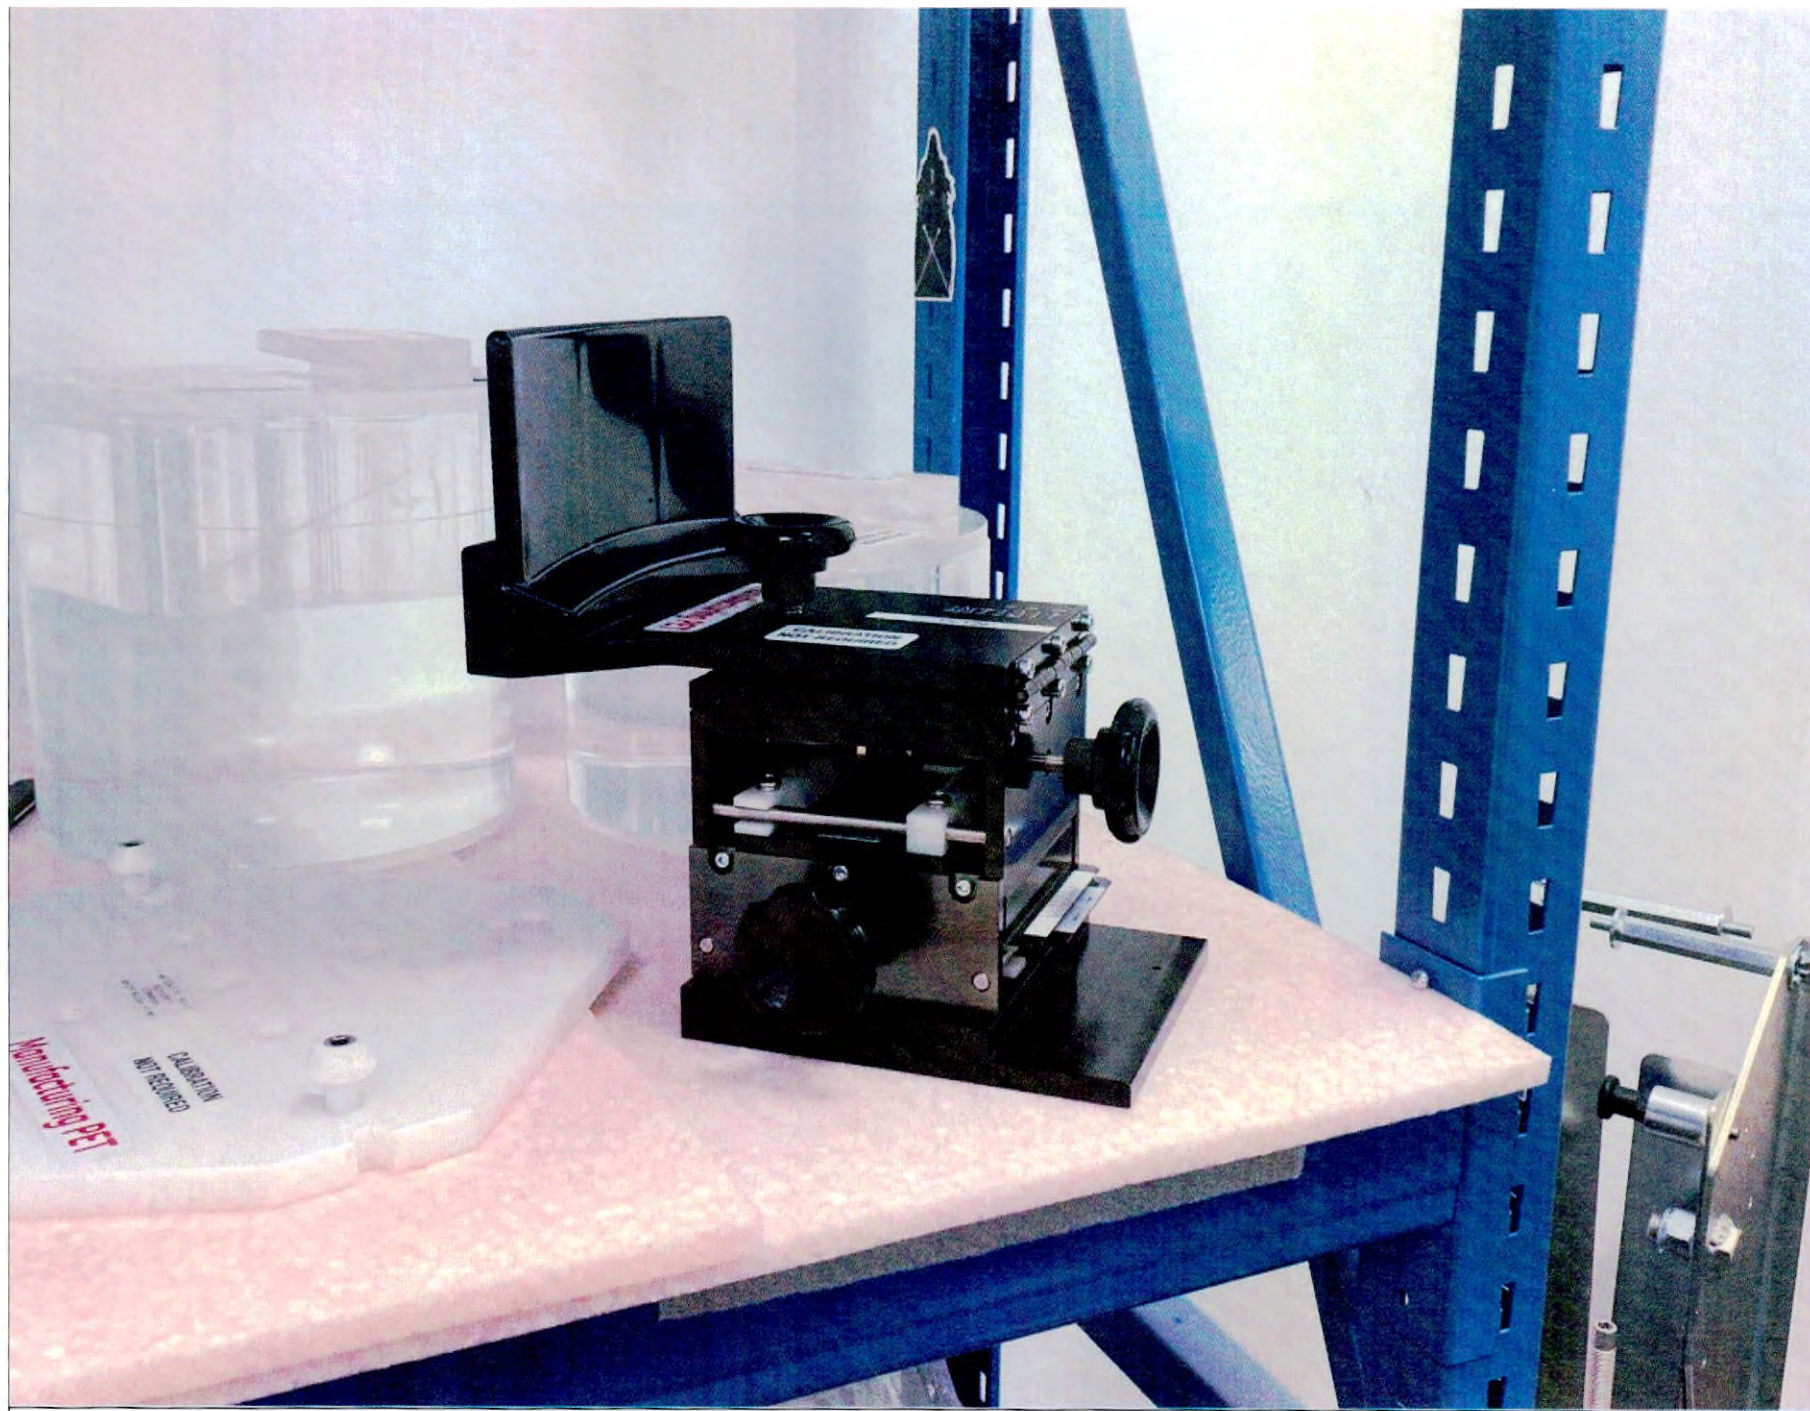


Рис. 49. Устройство для крепления к столу принадлежностей для сканирования (не более 4 шт.).



Рис. 50. Устройство для крепления к столу принадлежностей для сканирования (не более 4 шт.).

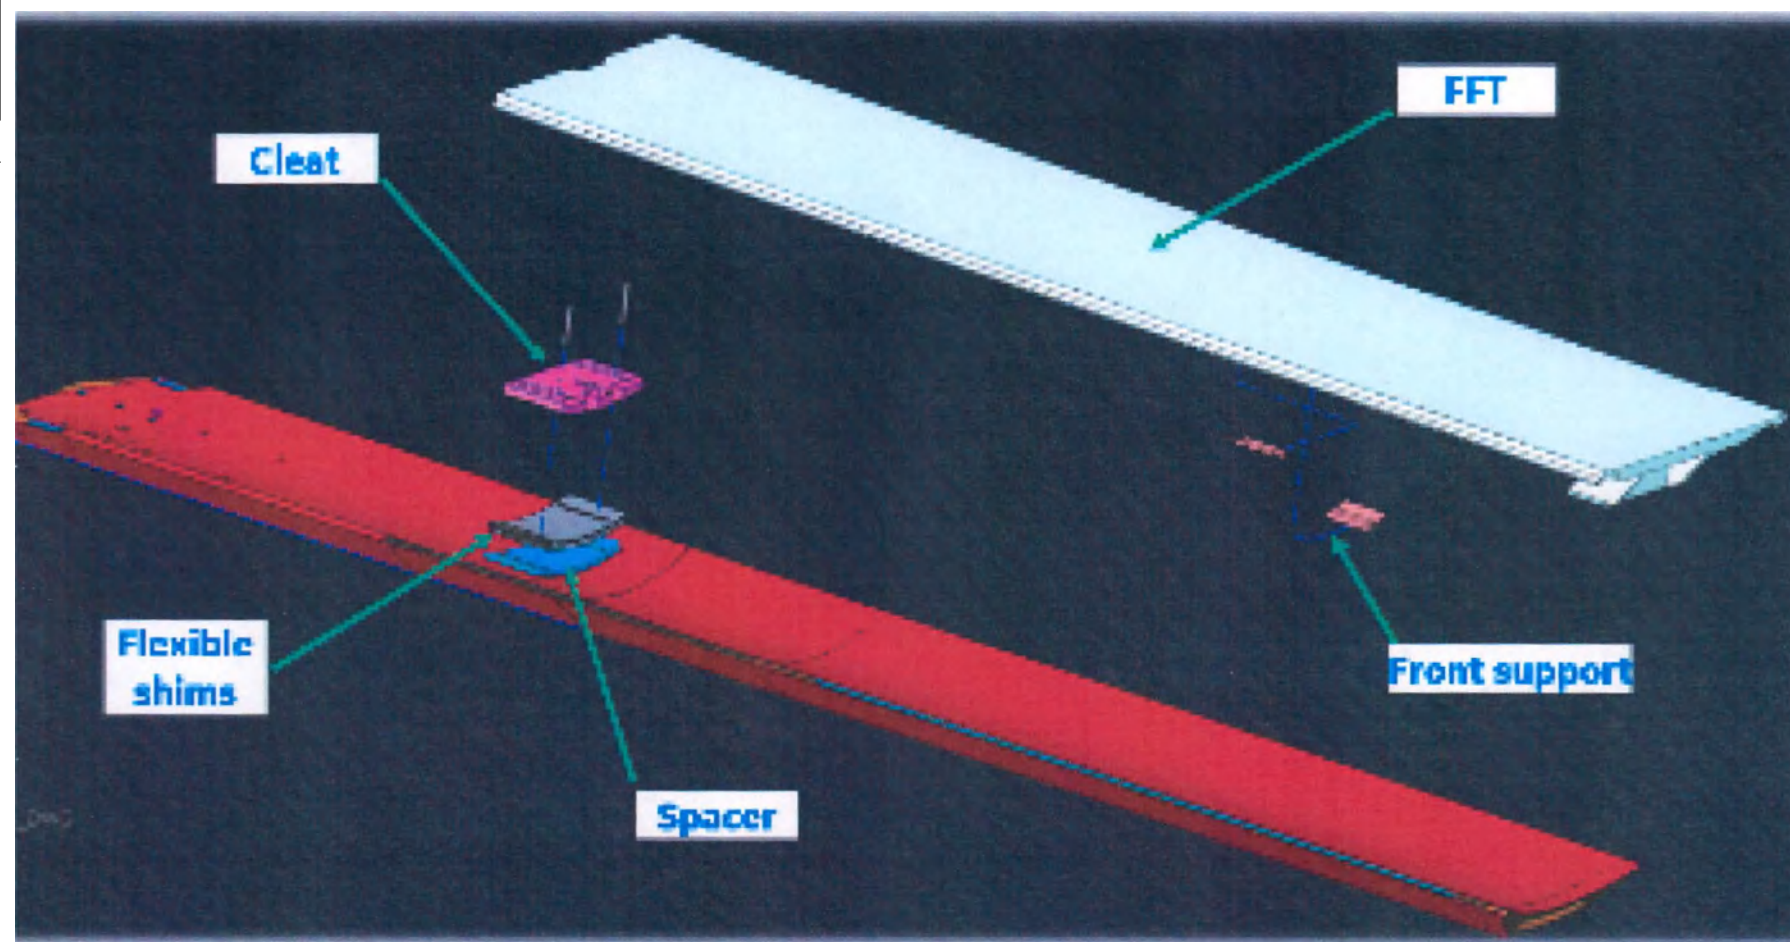


Рис. 51. Крепления для установки плоской накладки на стол (не более 4 шт.).

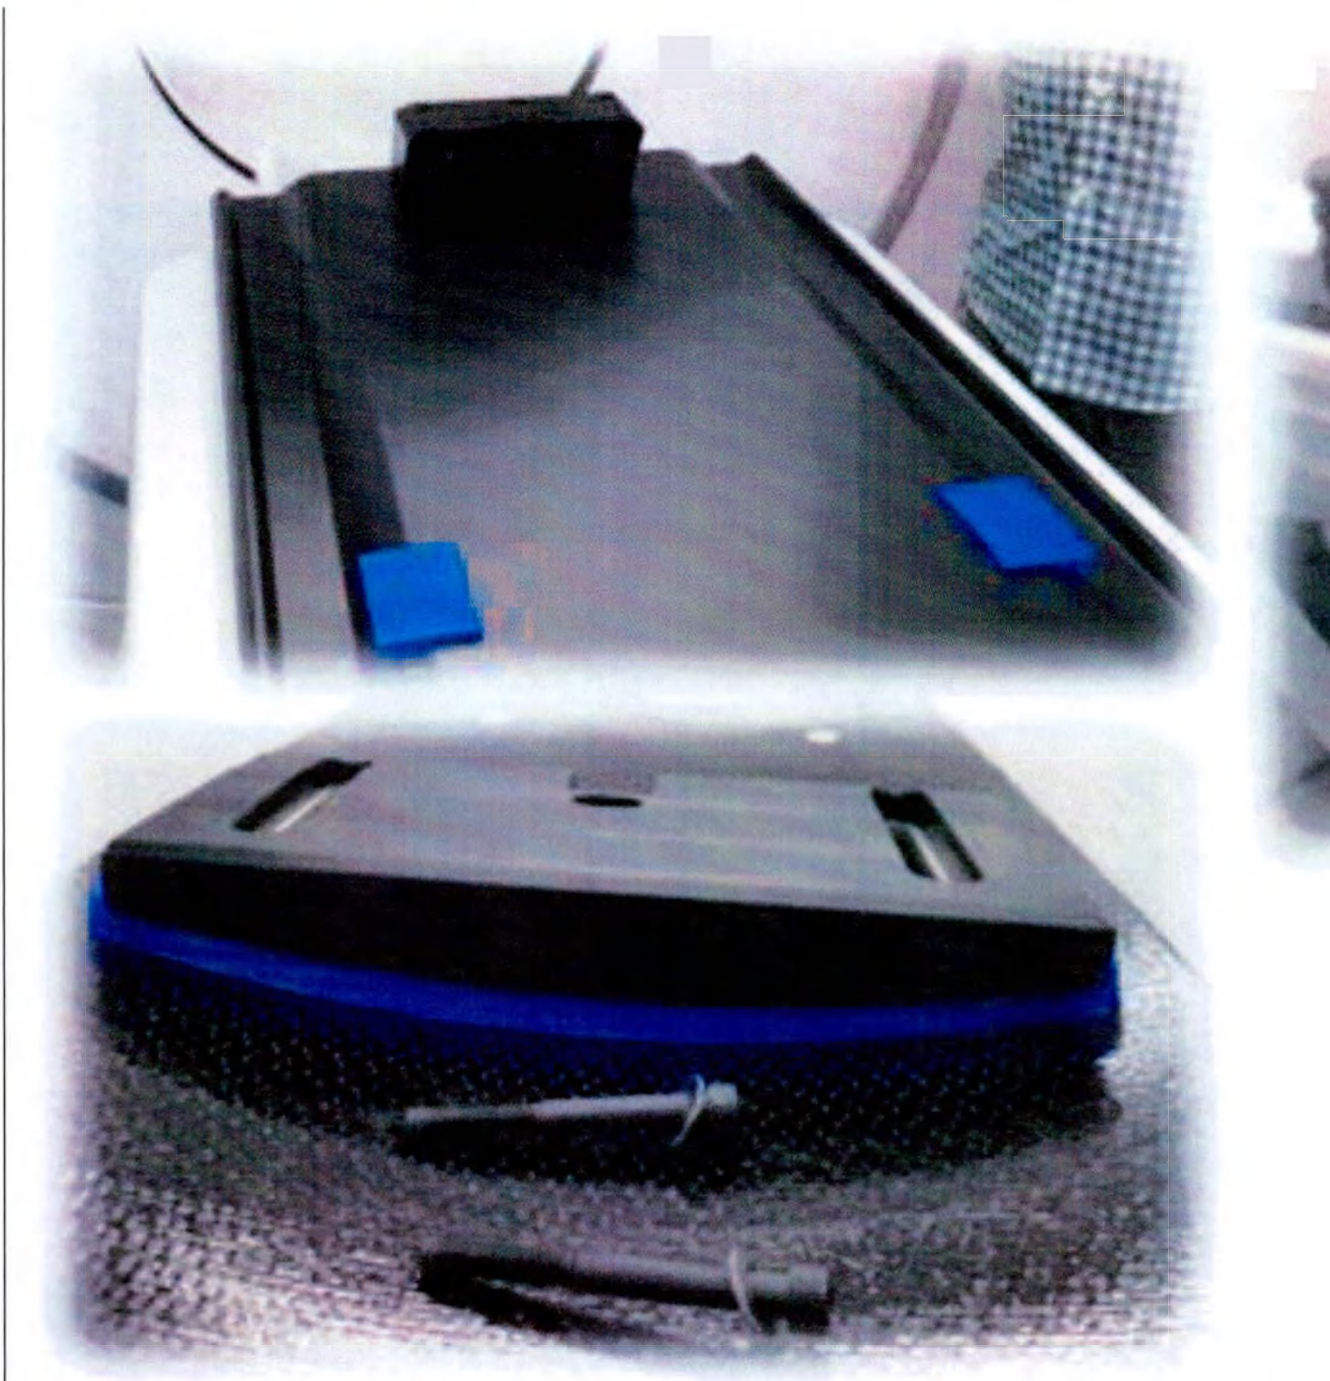


Рис. 52. Крепления для установки плоской накладки на стол (не более 4 шт.).

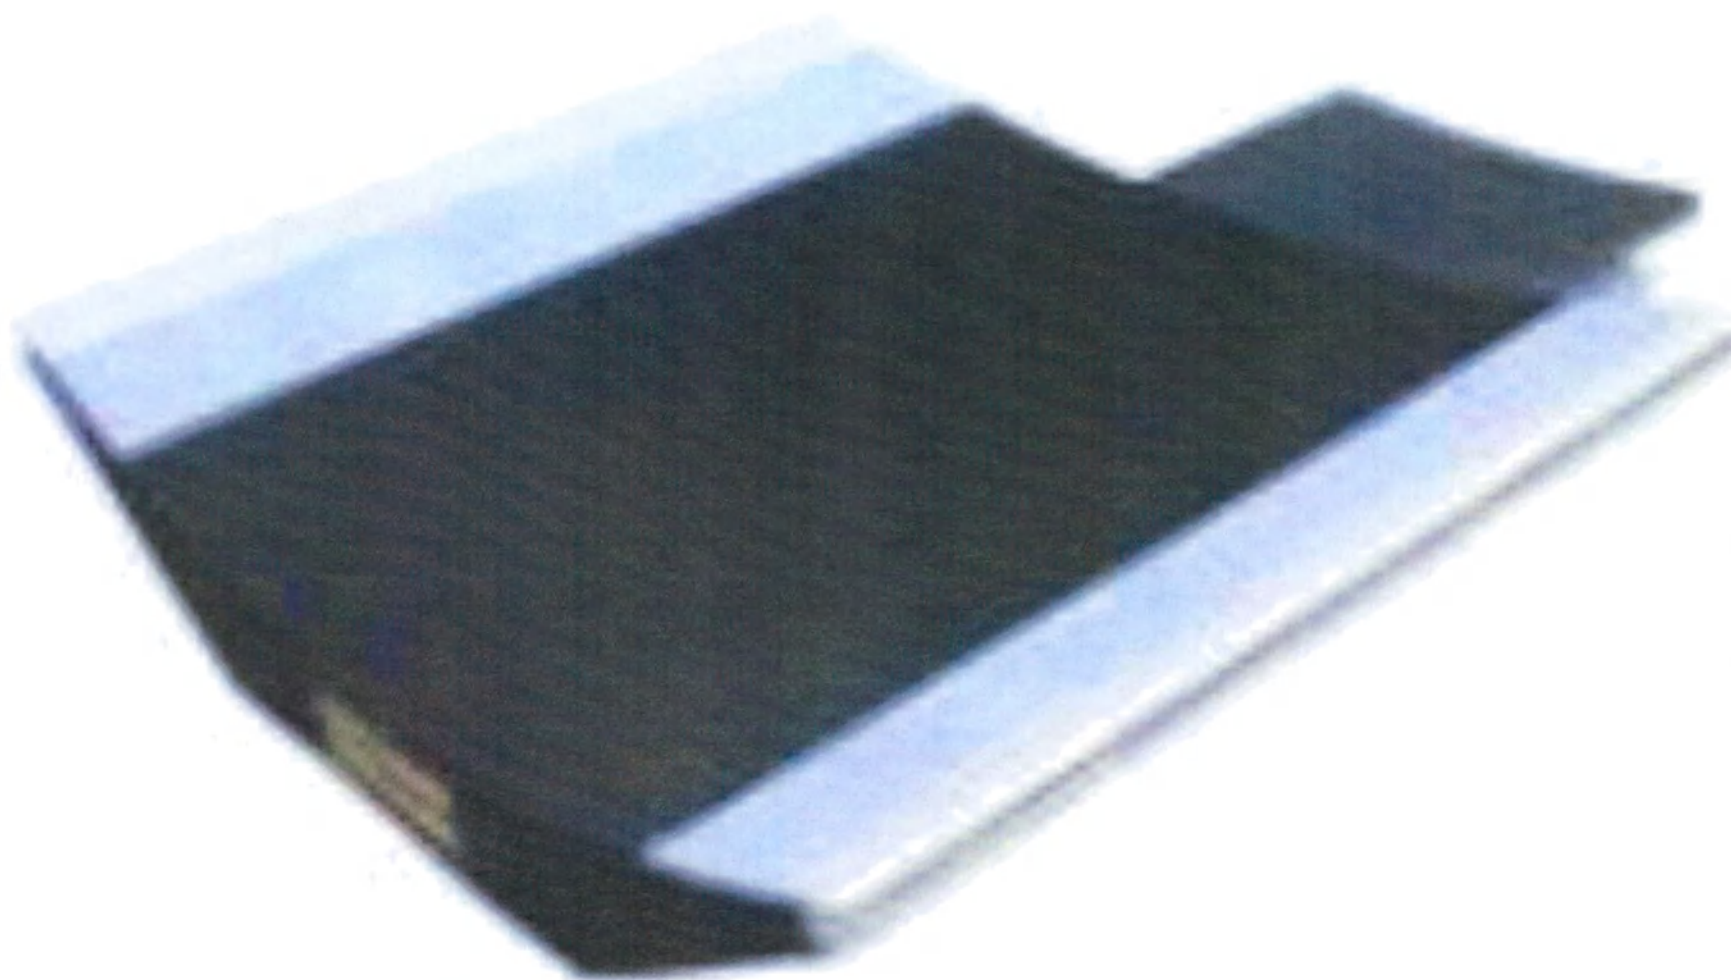


Рис. 53. Удлинитель стола для пациента (не более 2 шт.).



Рис. 54. Удлинитель стола для пациента (не более 2 шт.).

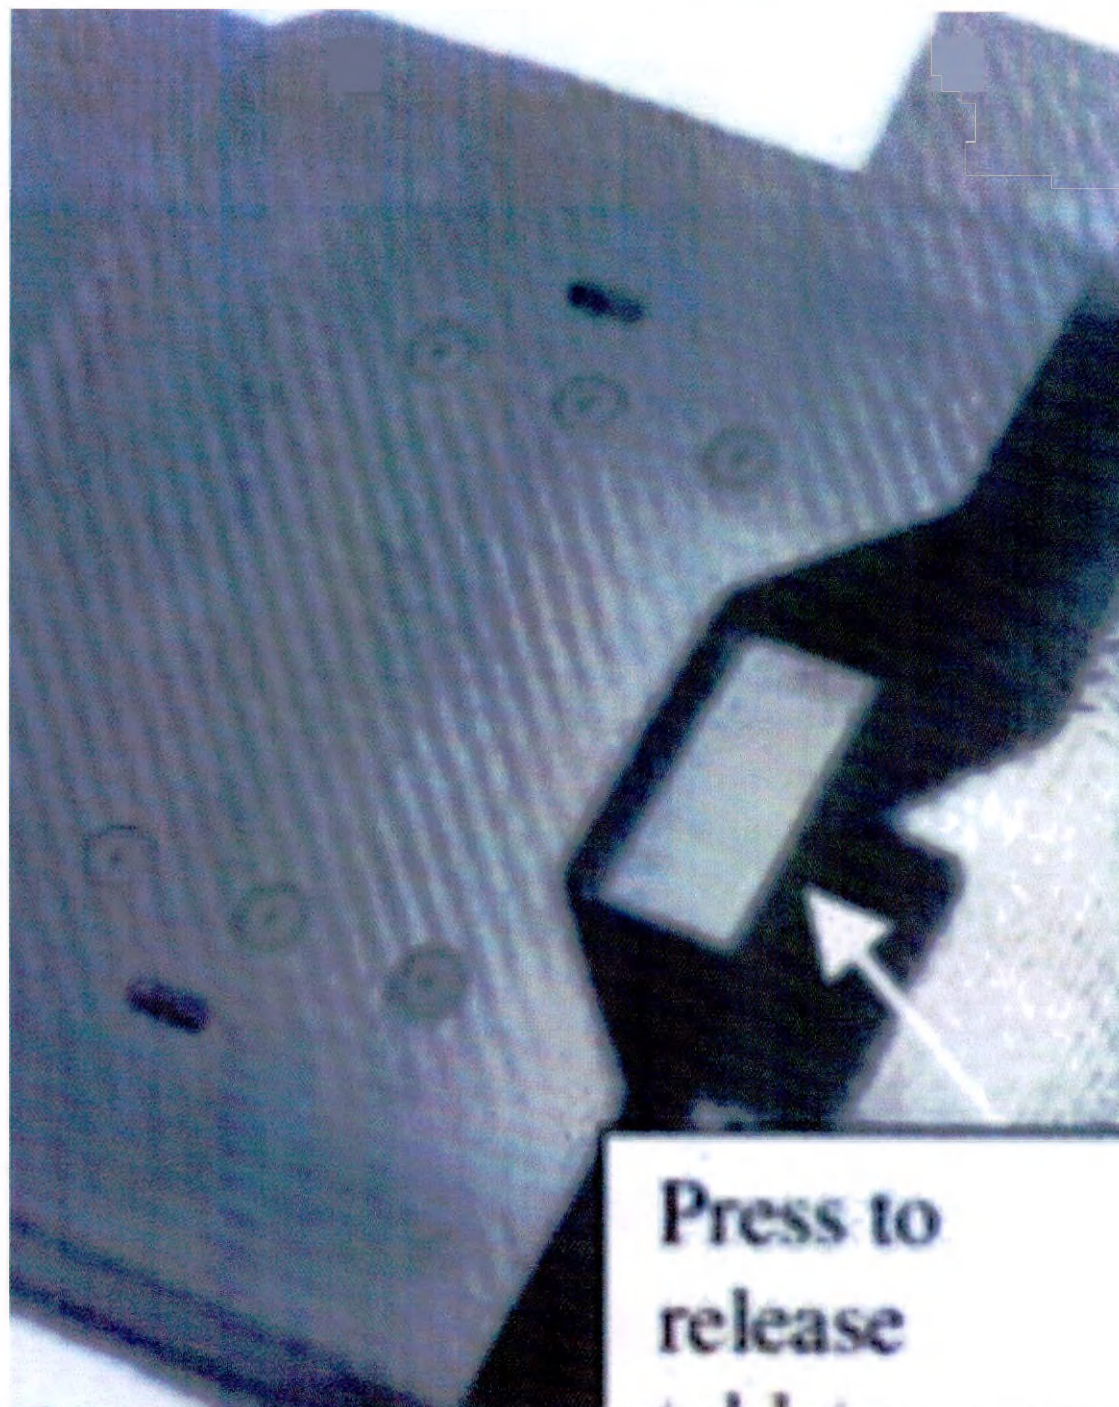


Рис. 55. Удлинитель стола для пациента (не более 2 шт.).

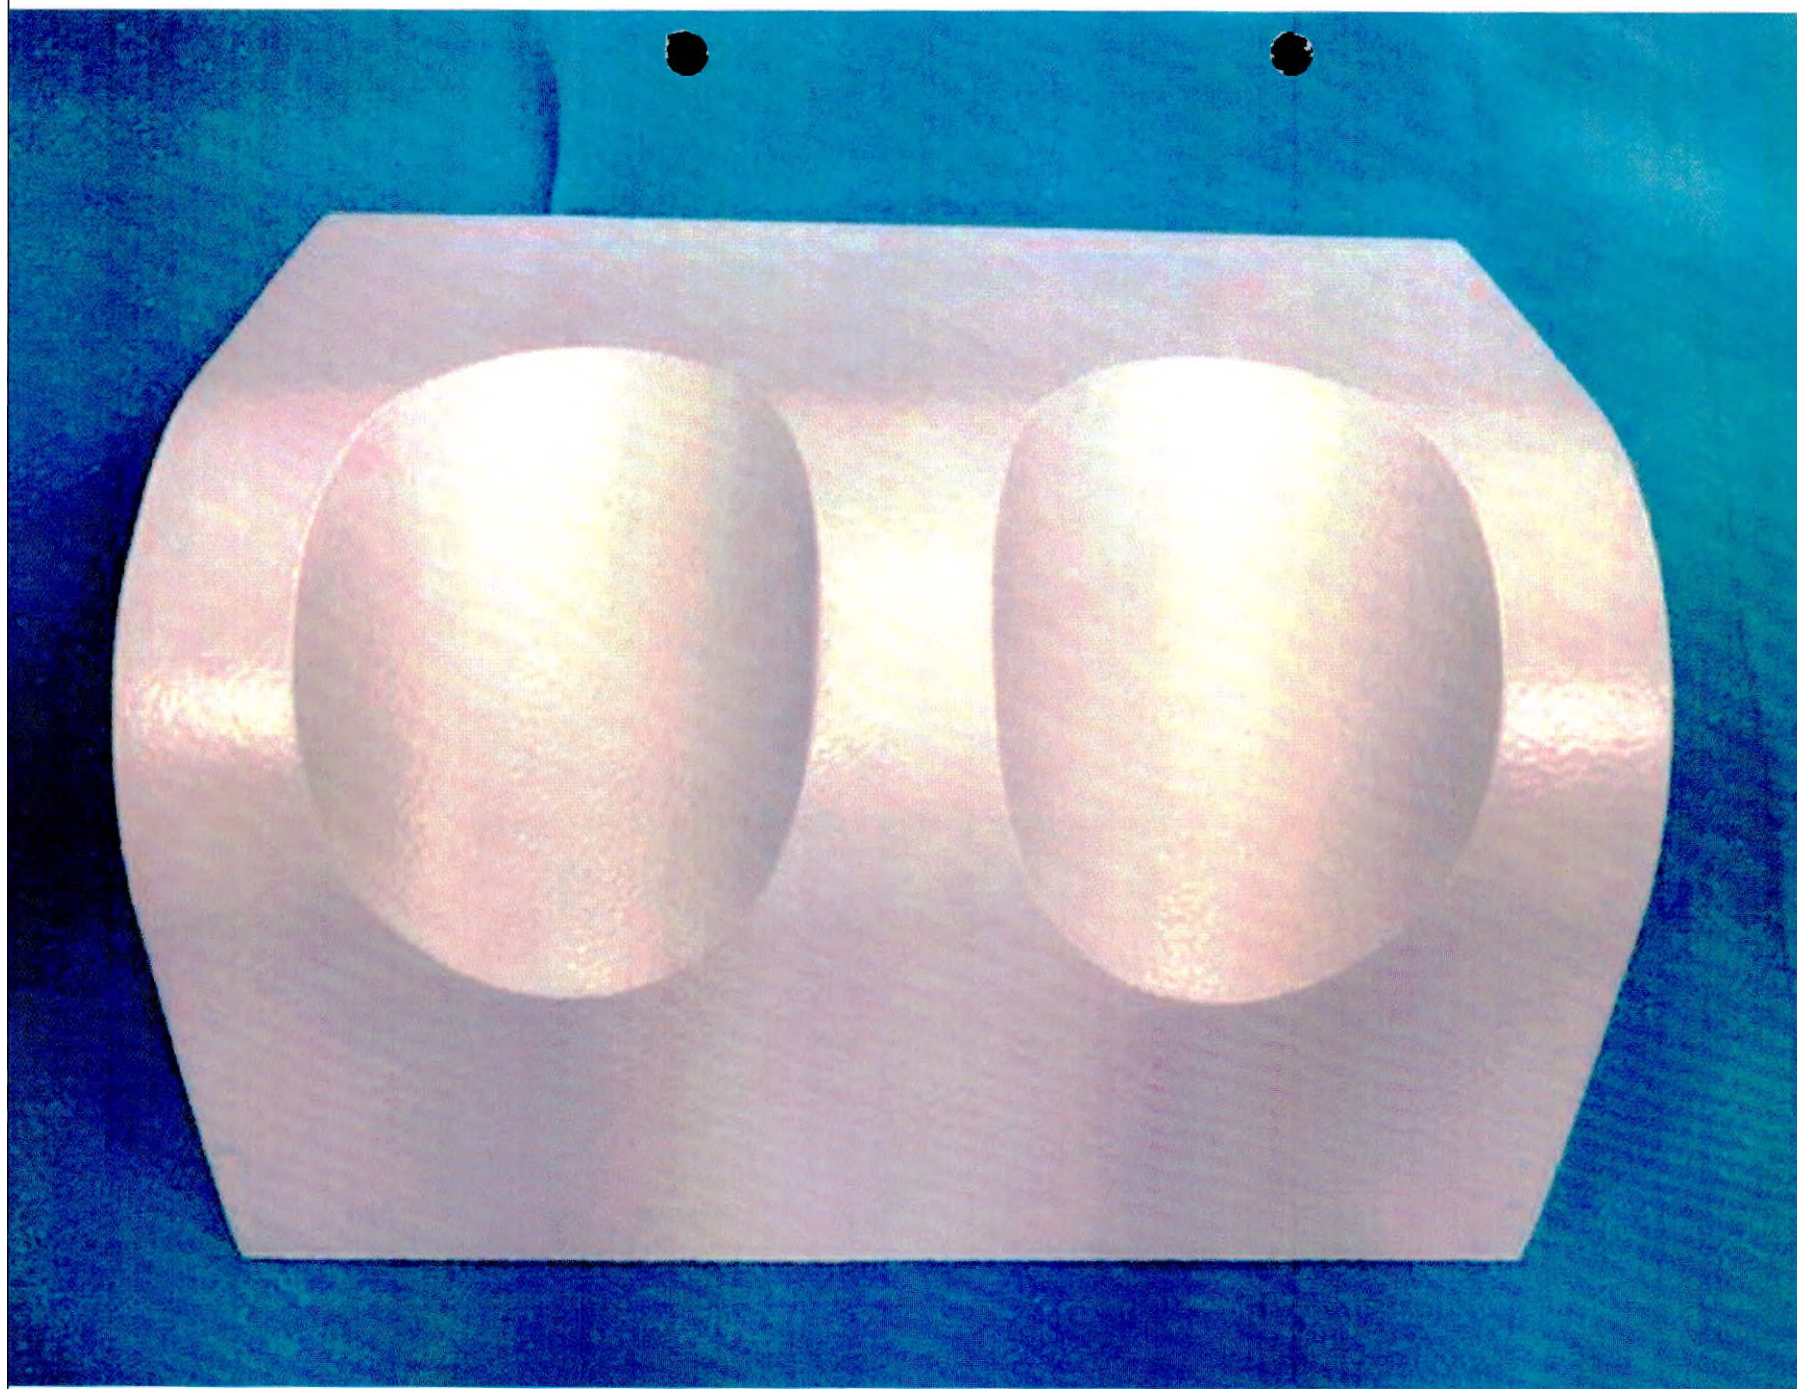


Рис. 56. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов (не более 10 шт.).

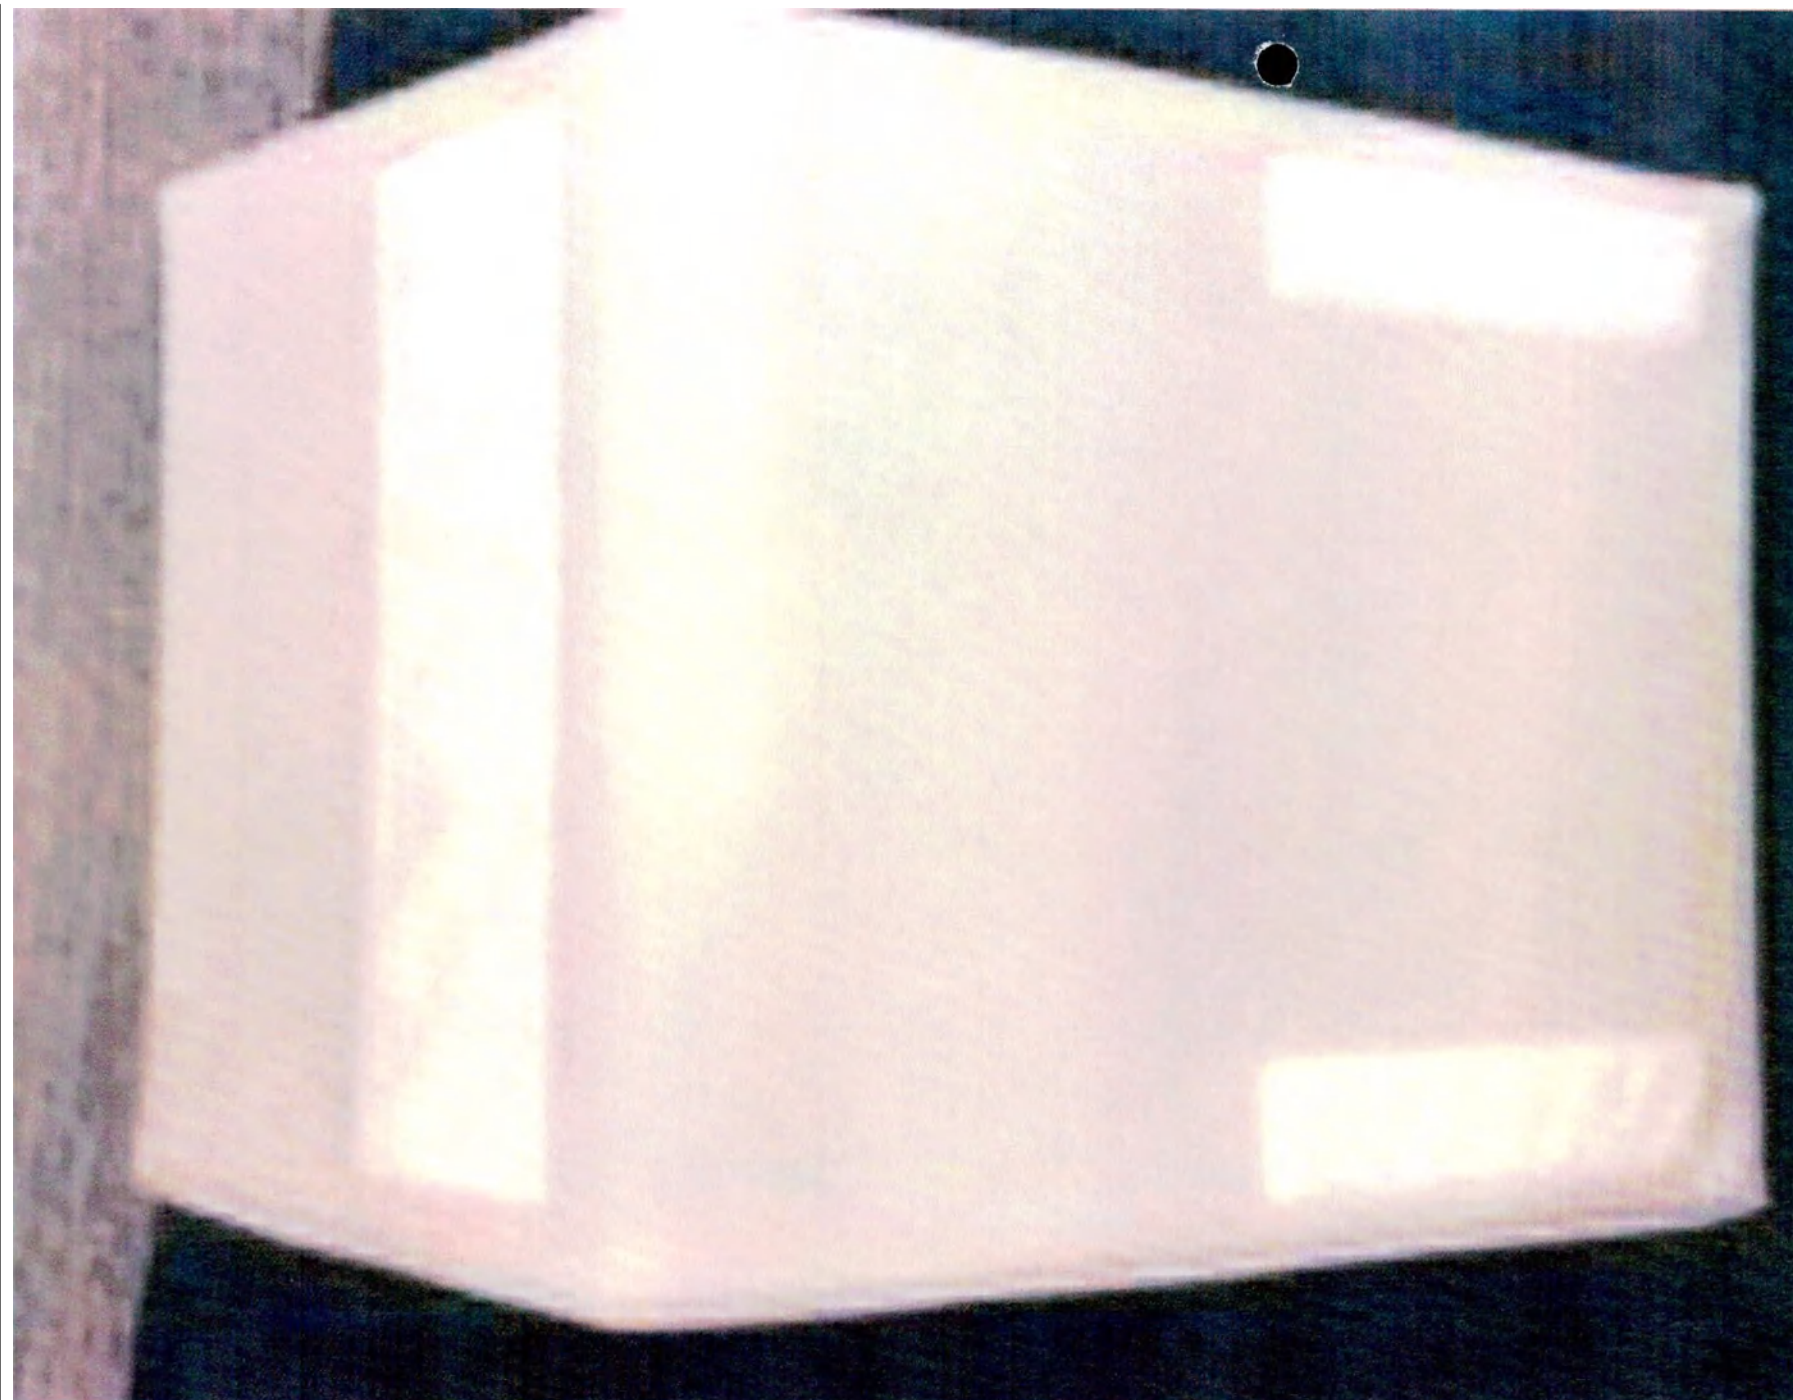


Рис. 57. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов (не более 10 шт.).

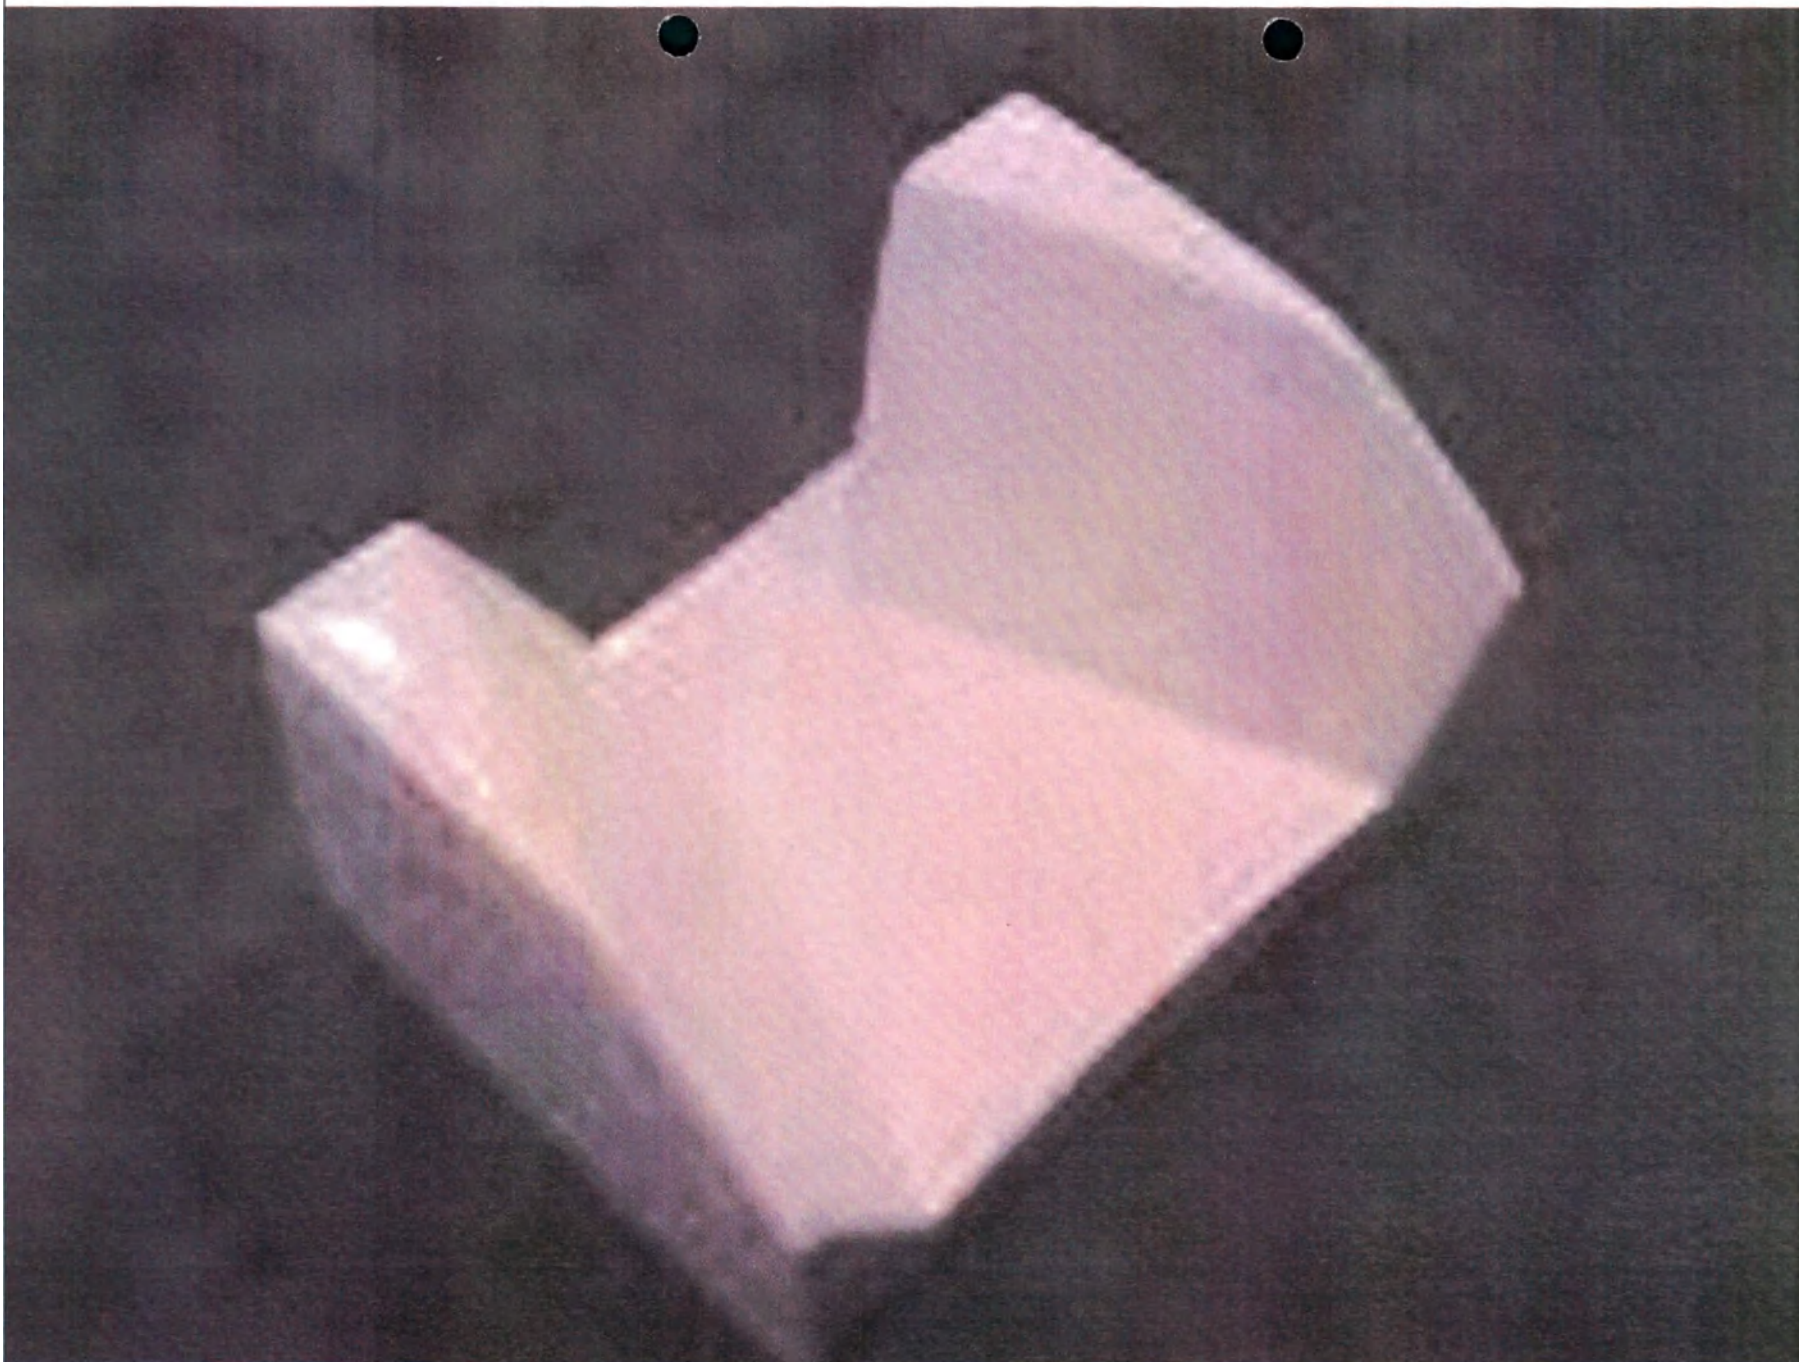


Рис. 58. Приспособления для фиксации и позиционирования пациентов (не более 10 шт.).



Рис. 59. Ремни для фиксации пациента (не более 10 шт.).



Рис. 60. Ремни для фиксации пациента (не более 10 шт.).

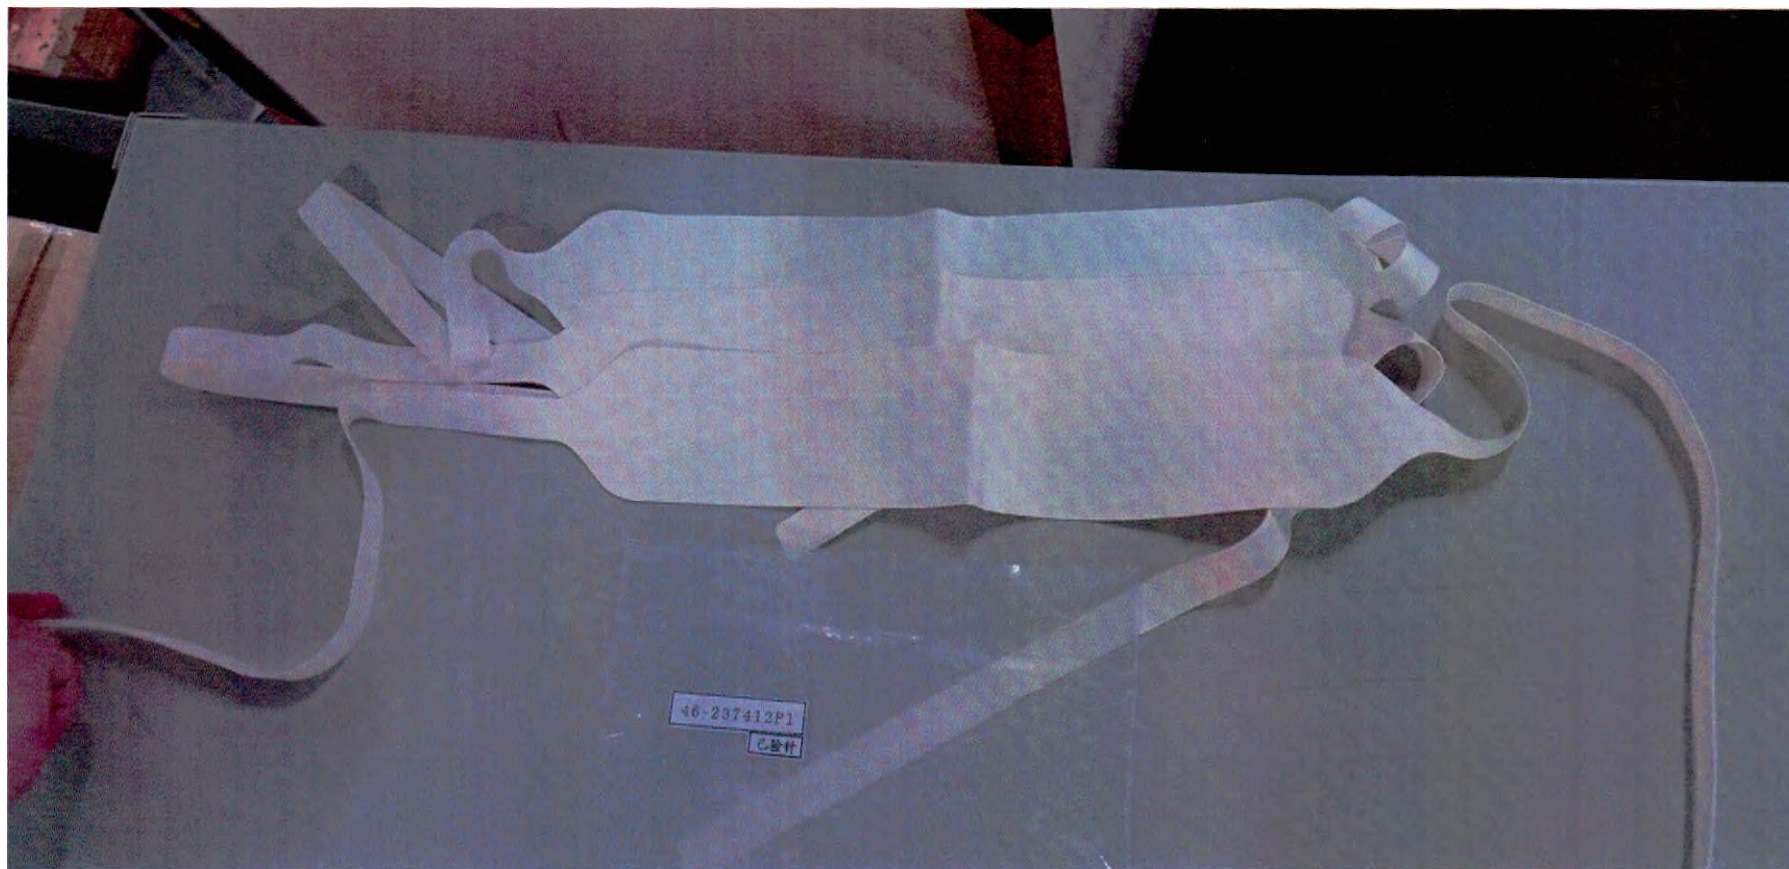


Рис. 61. Ремни для фиксации пациента (не более 10 шт.).

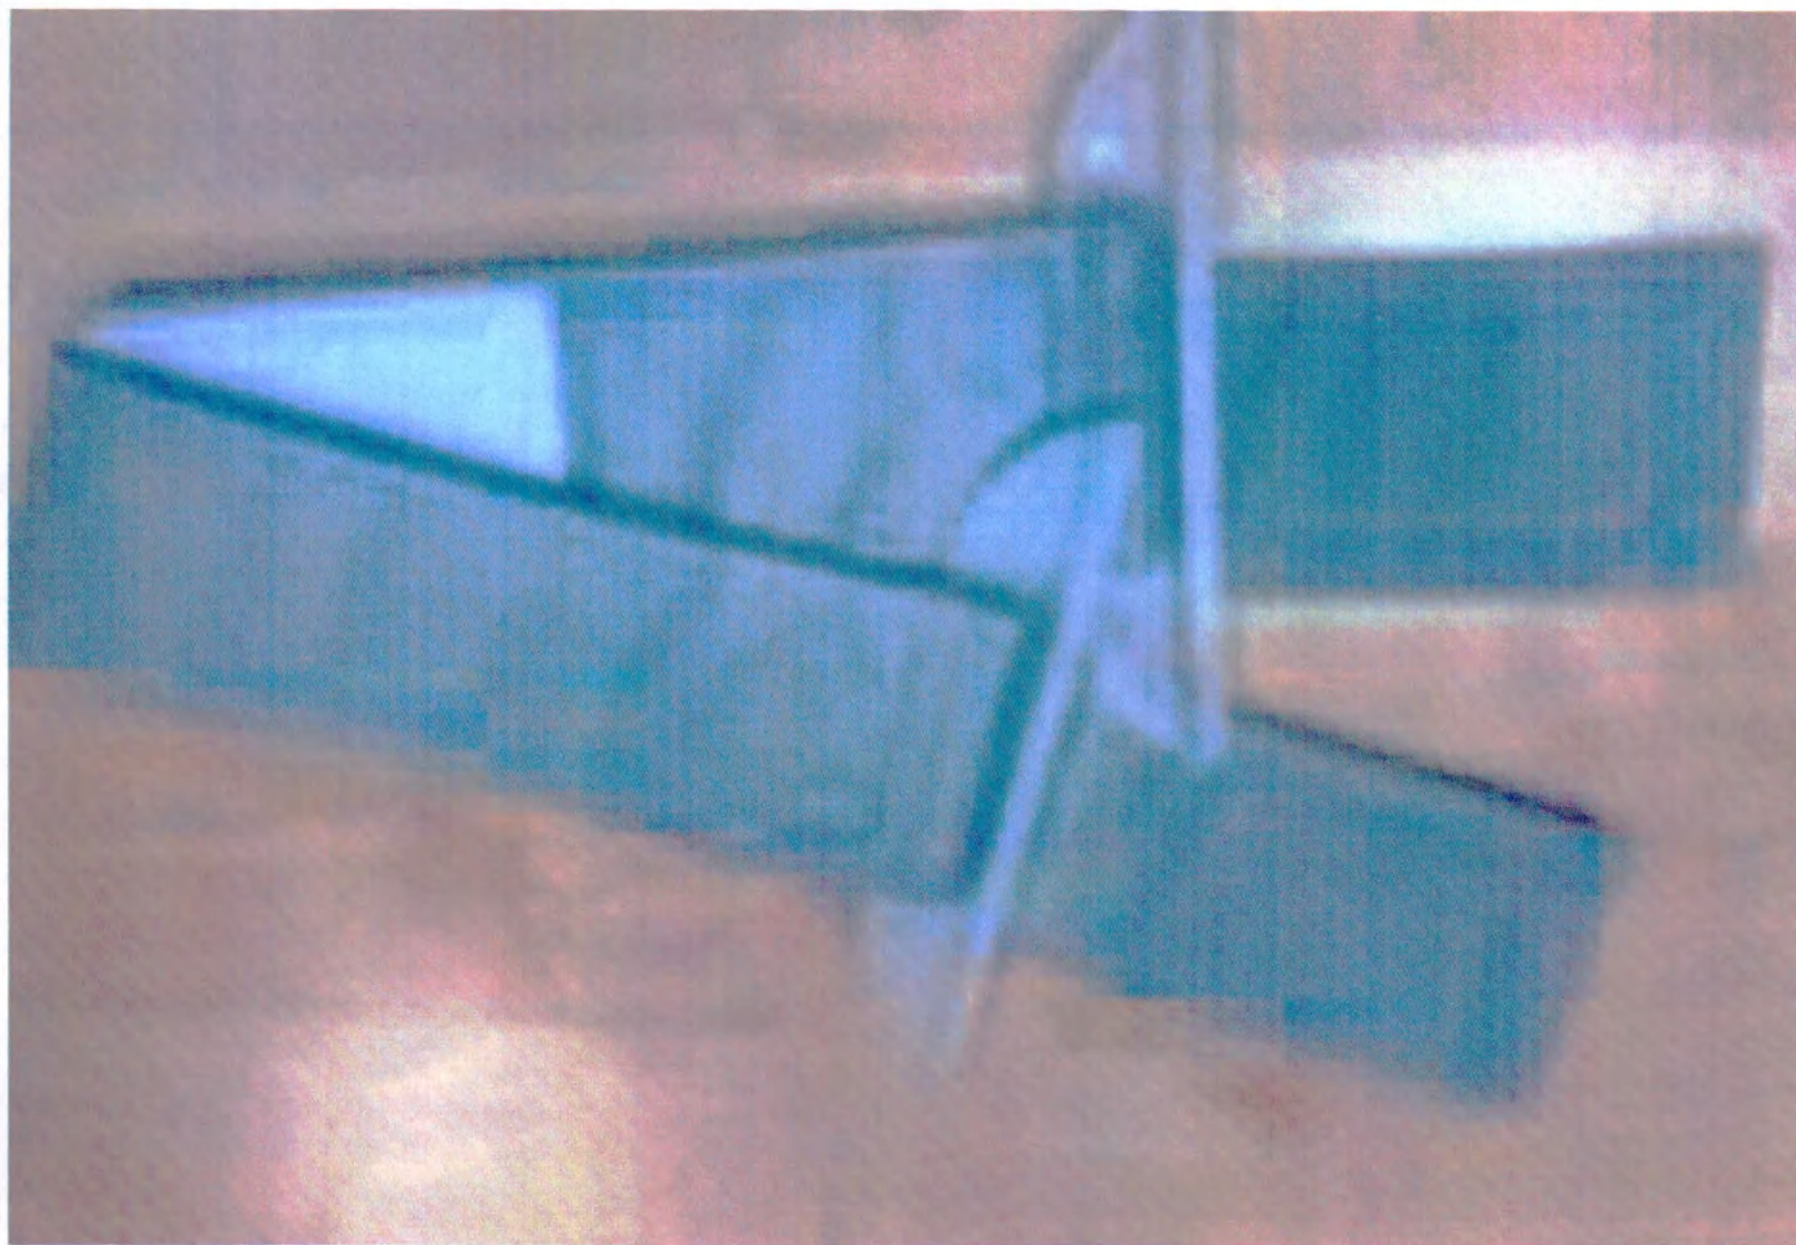


Рис. 62. Ремни для фиксации пациента (не более 10 шт.).

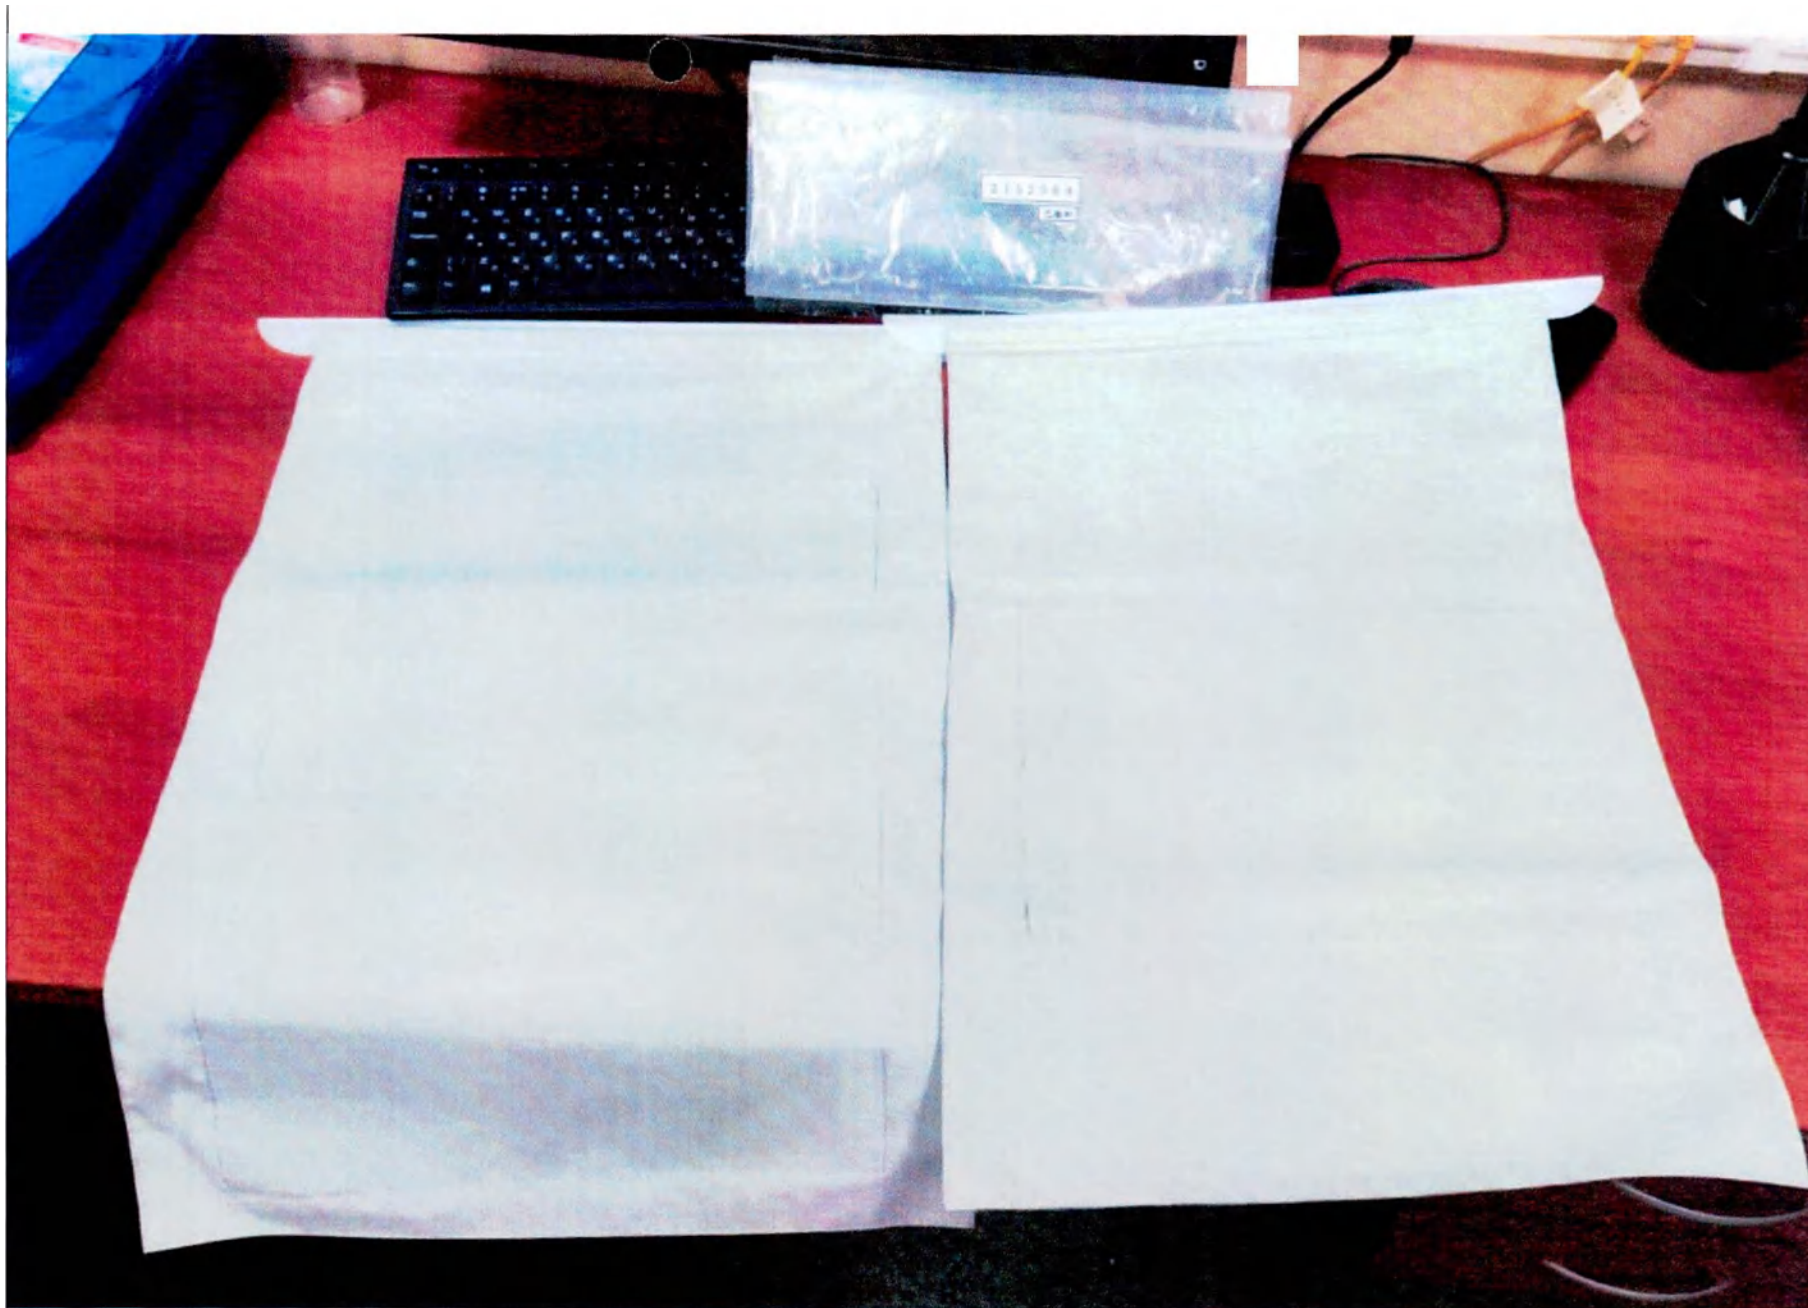


Рис. 63. Ремни для фиксации пациента (не более 10 шт.).

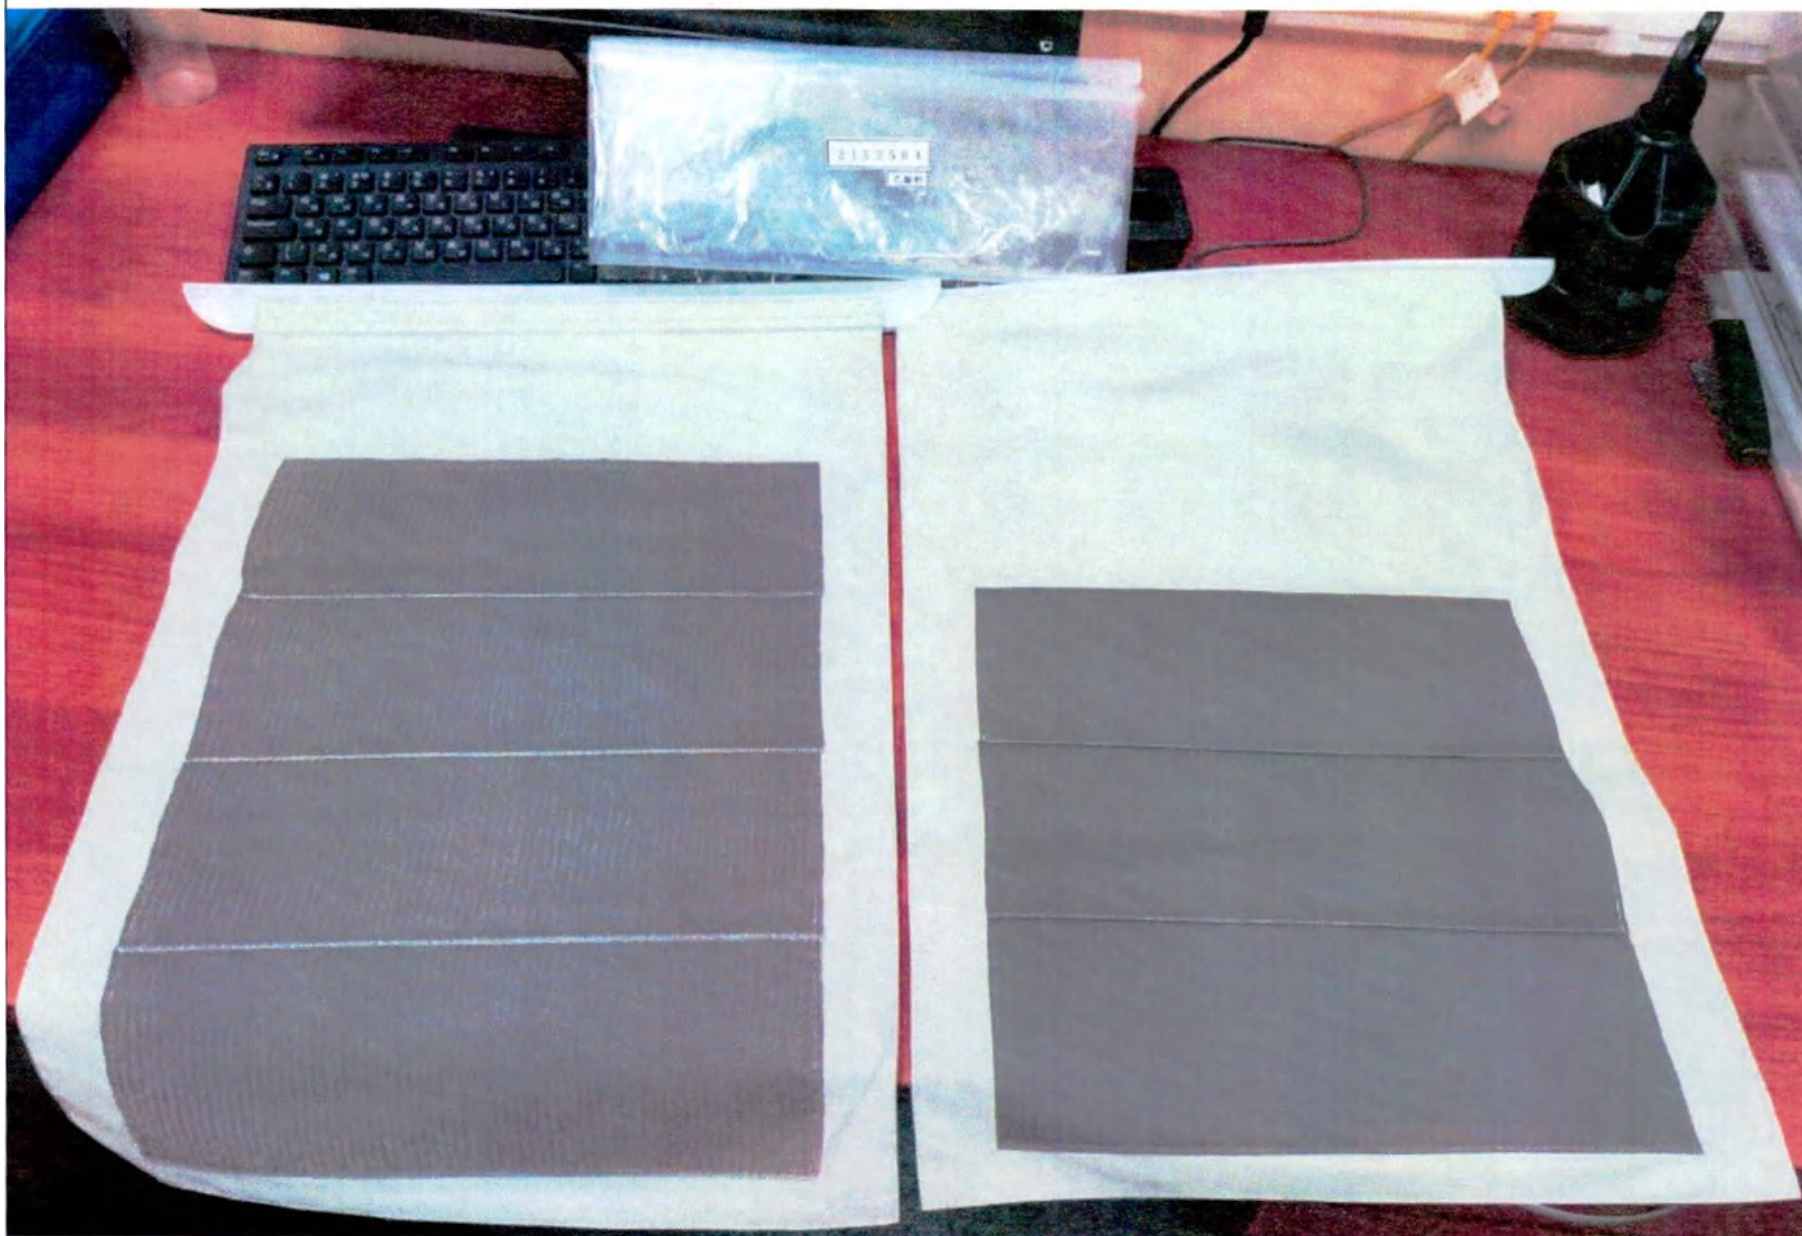


Рис. 64. Ремни для фиксации пациента (не более 10 шт.).



Рис. 65. Подголовник (не более 4 шт.).

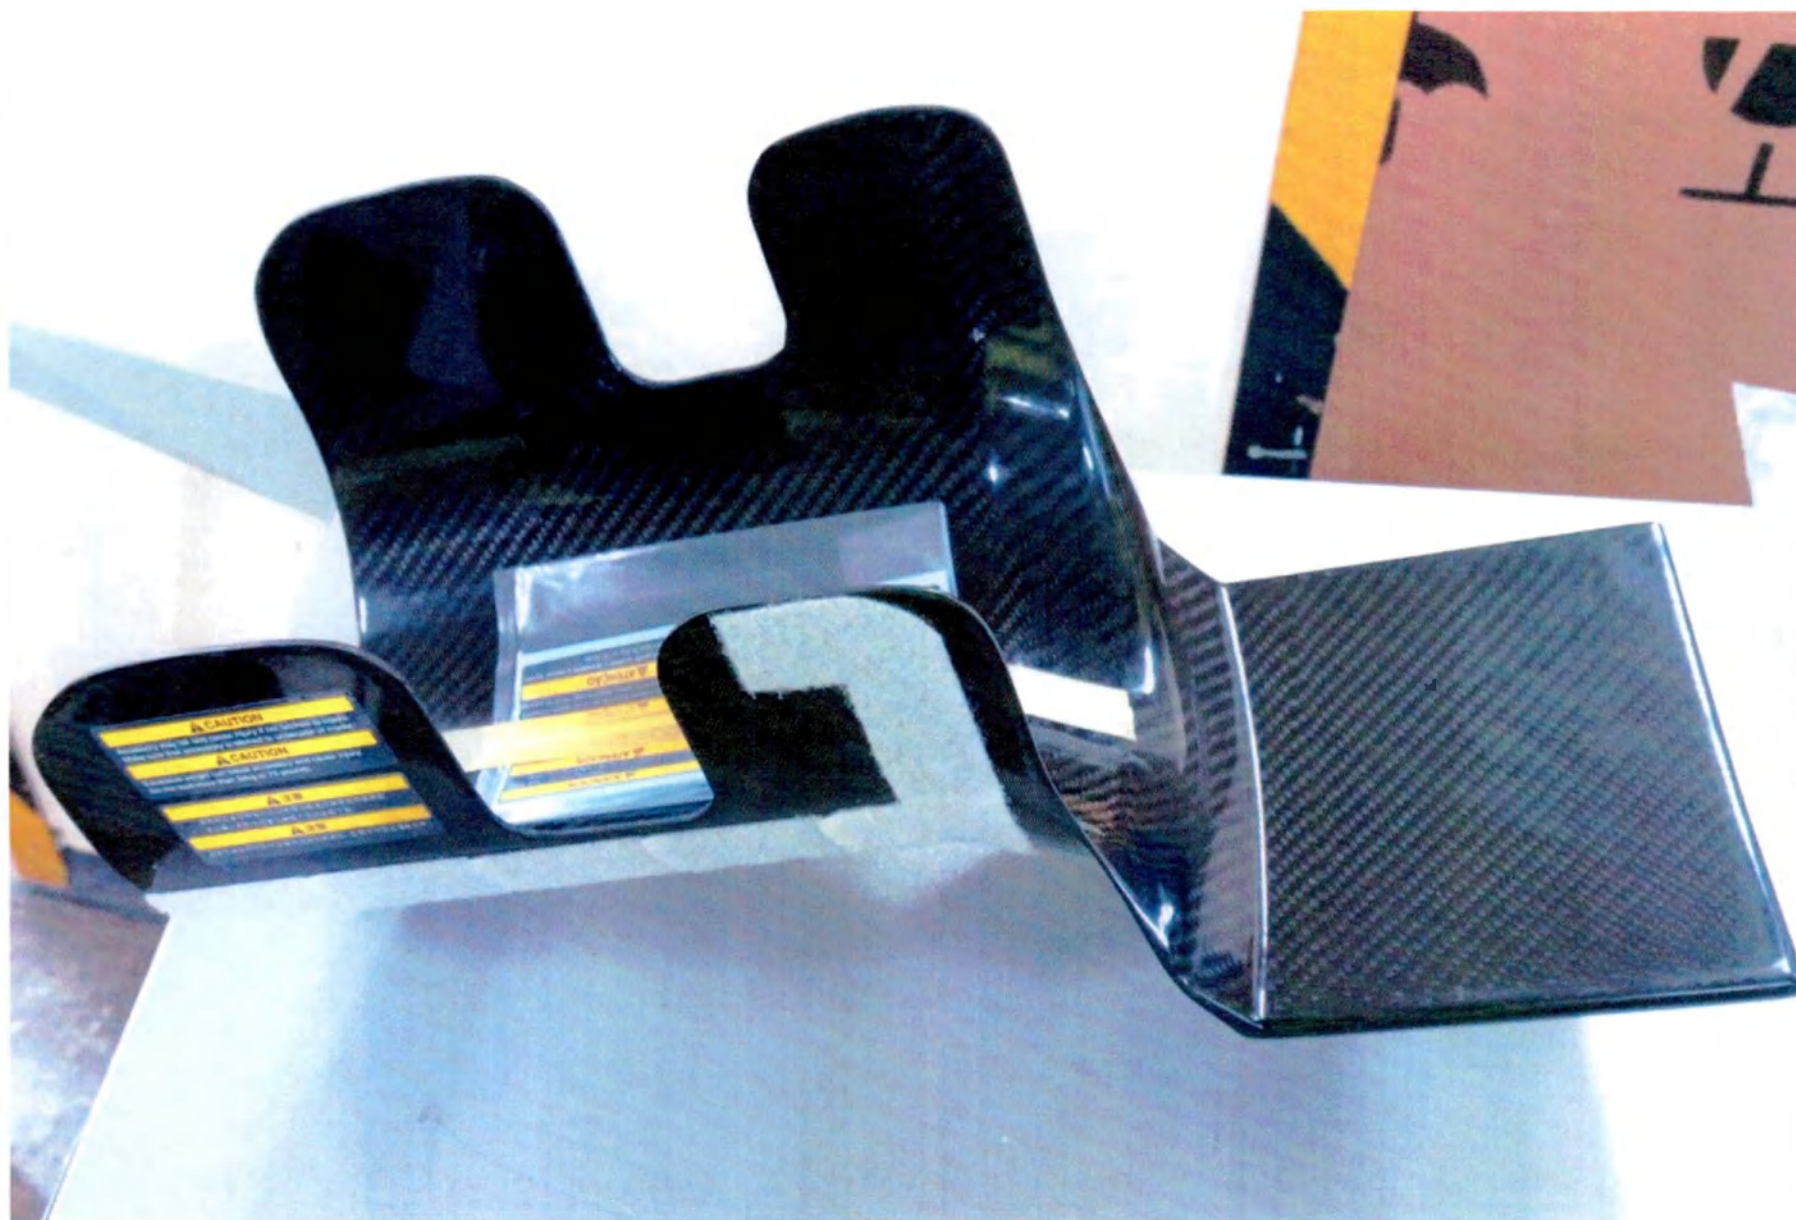


Рис. 66. Подголовник (не более 4 шт.).



Рис. 67. Опора для рук пациента (не более 6 шт.).



Рис. 68. Опора для рук пациента (не более 6 шт.).



Рис. 69. Подлокотники (не более 6 шт.).



Рис. 70. Фантомы (не более 10 шт.).

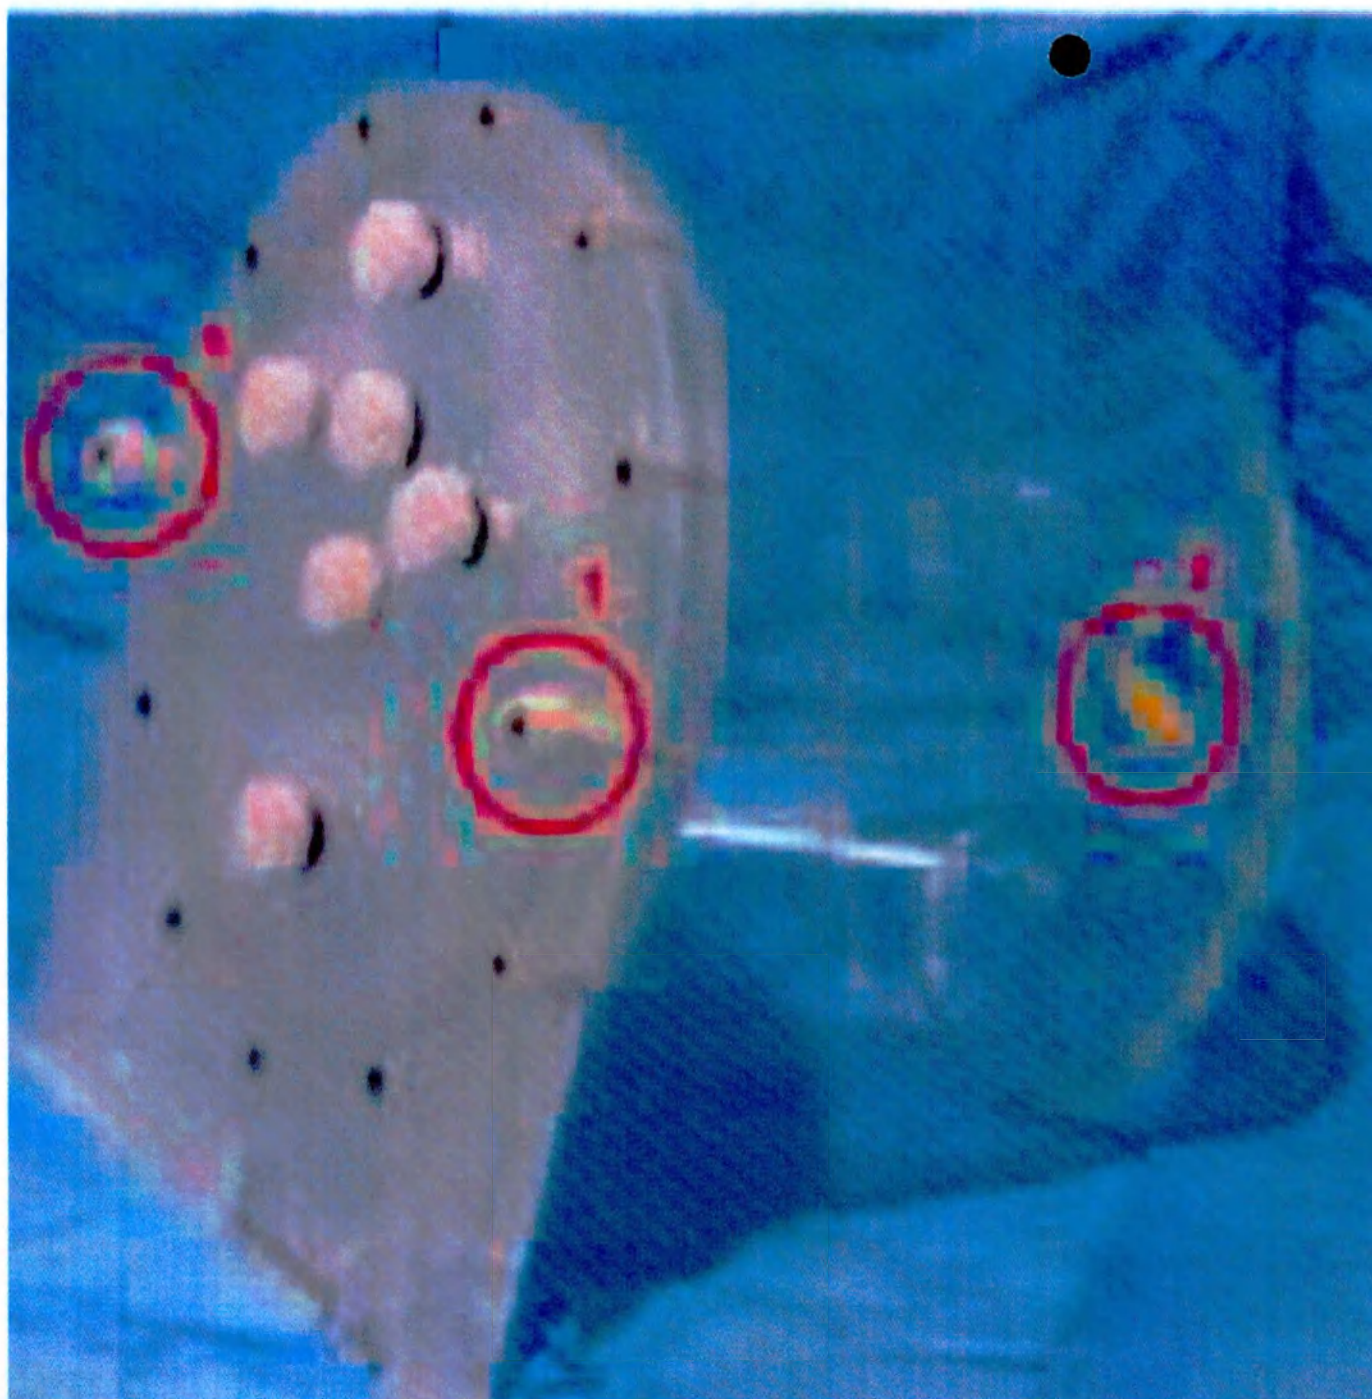


Рис. 71. Фантомы (не более 10 шт.).

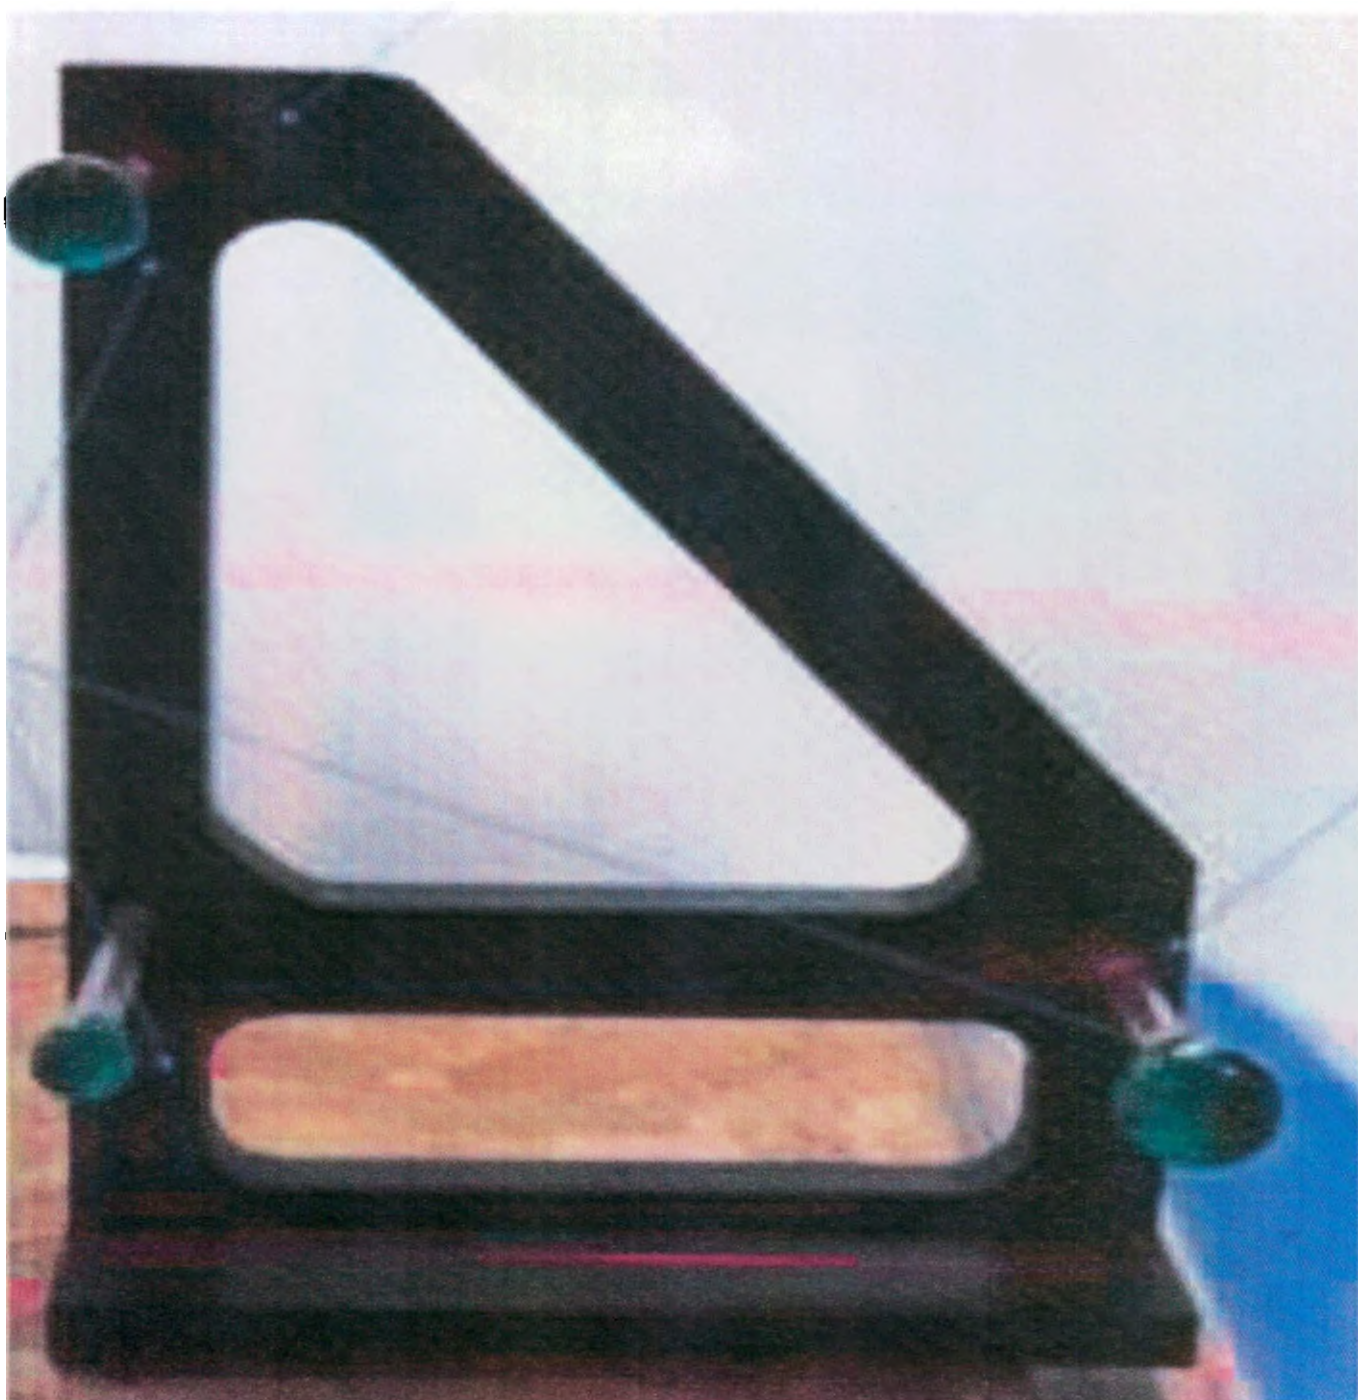


Рис. 72. Фантомы (не более 10 шт.).

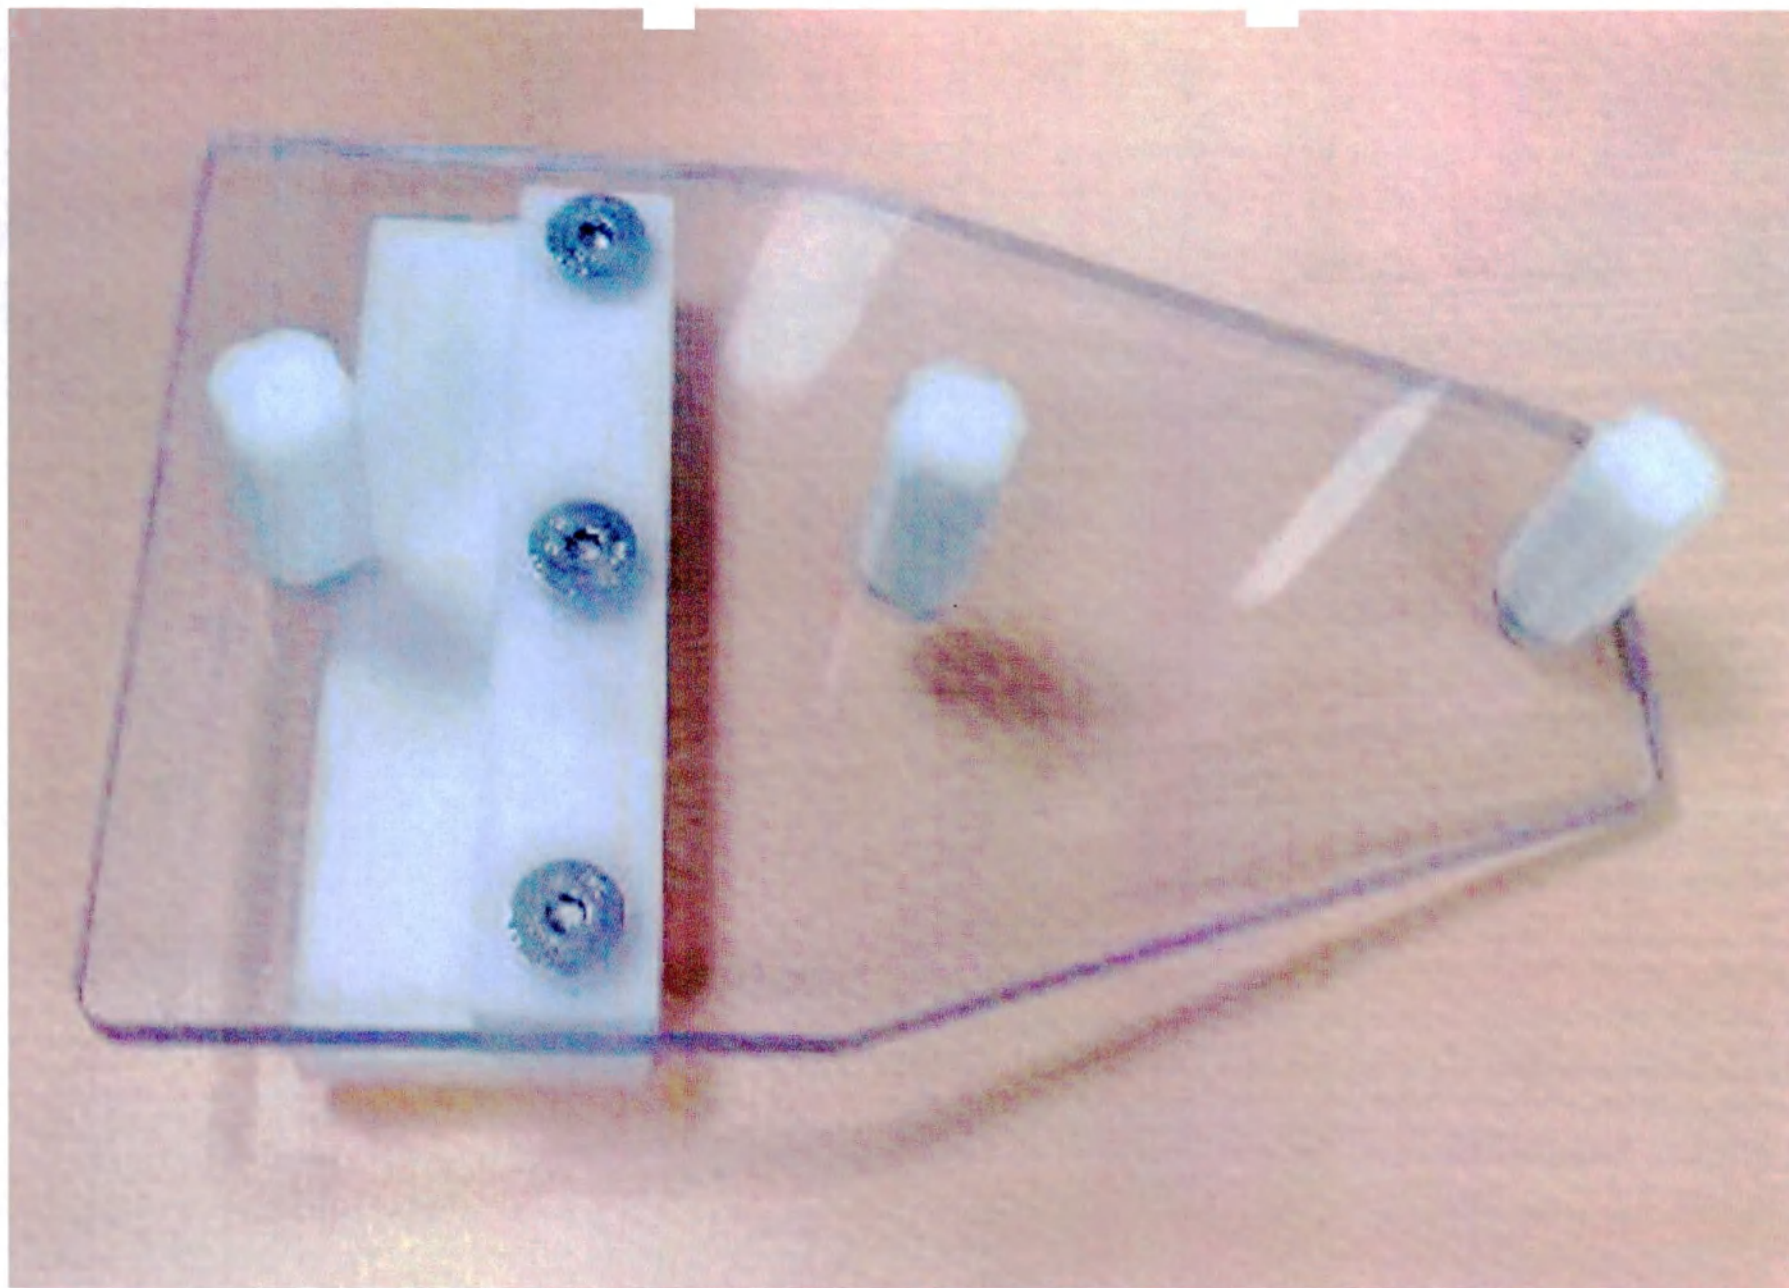


Рис. 73. Фантомы (не более 10 шт.).



Рис. 74. Держатель фантома (не более 6 шт.).

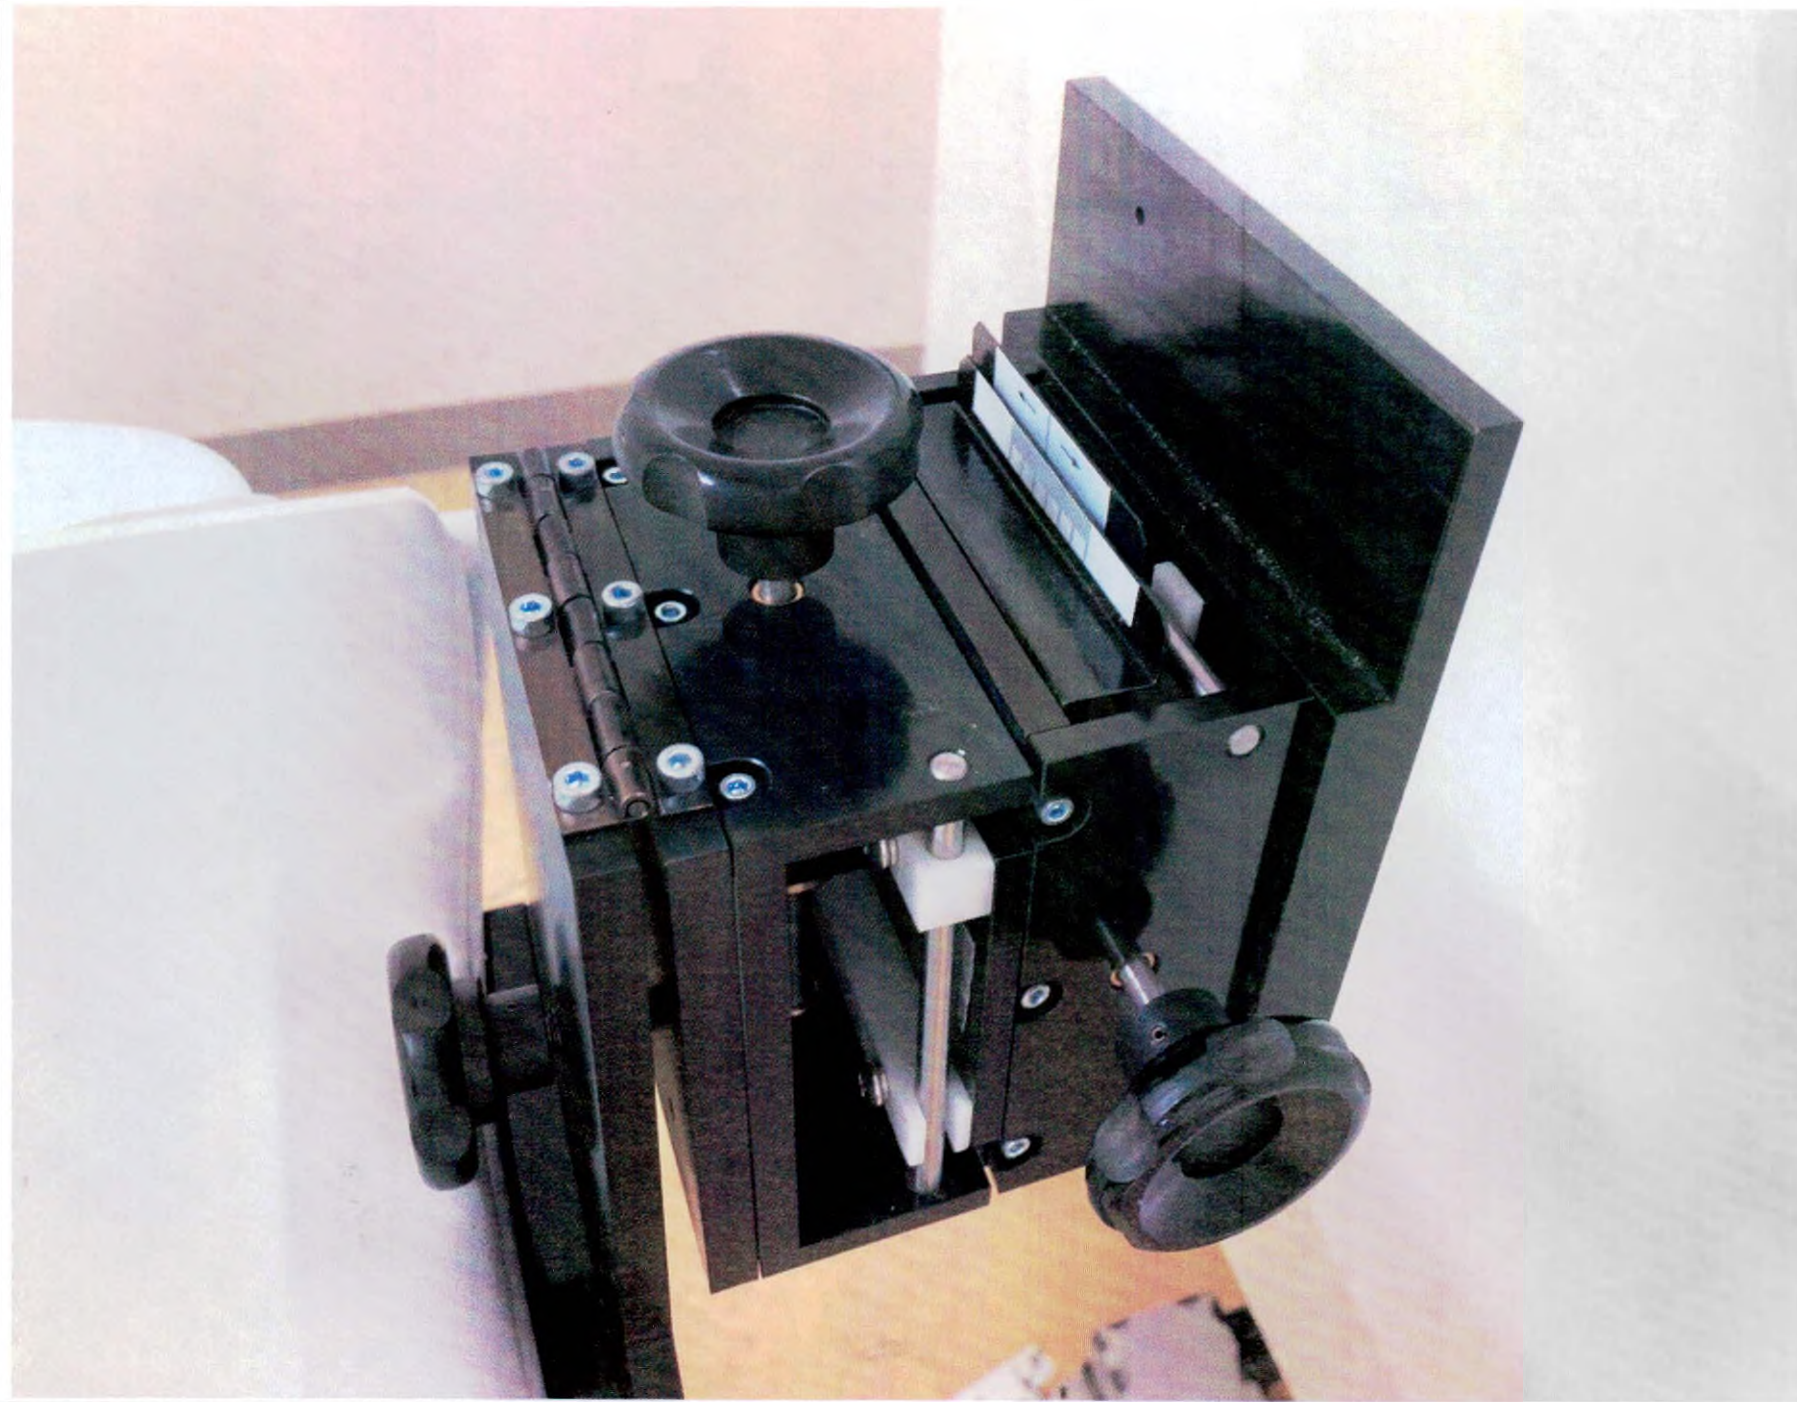


Рис. 75. Держатель фантома (не более 6 шт.).



Рис. 76. Источники калибровочные (не более 6 шт.)

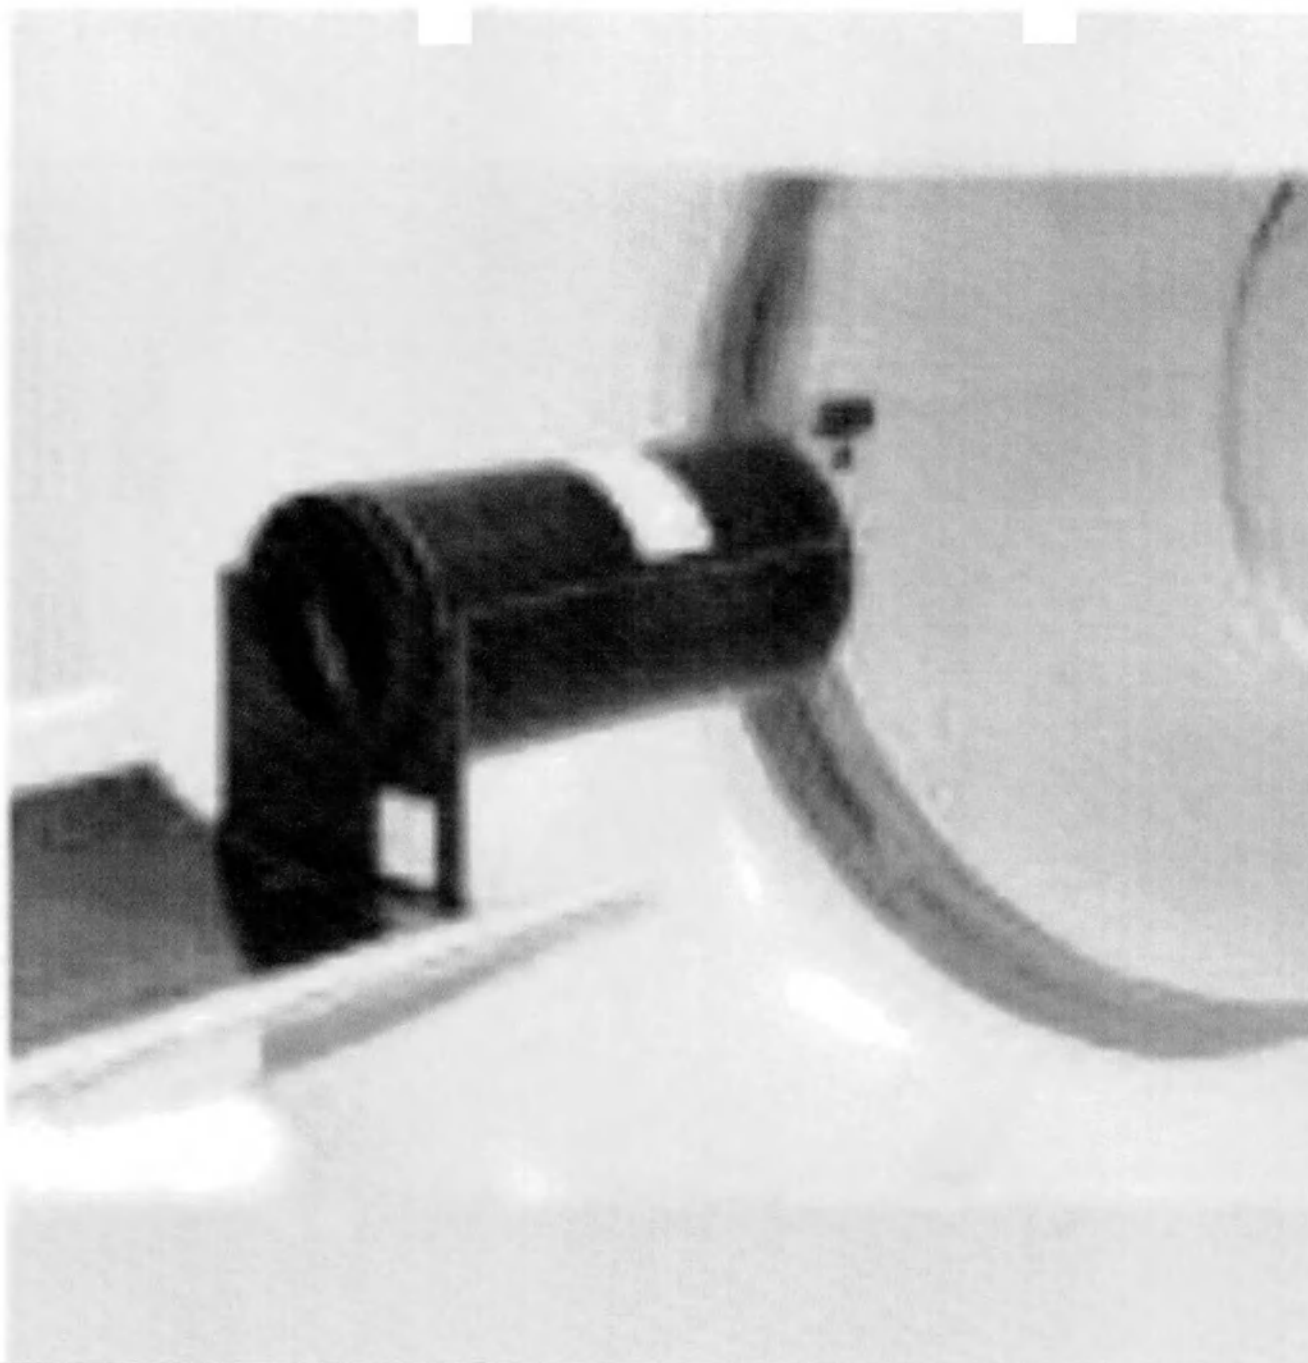


Рис. 77. Источники калибровочные (не более 6 шт.)



Рис. 78. Контейнер для хранения источника калибровочного (не более 6 шт.).

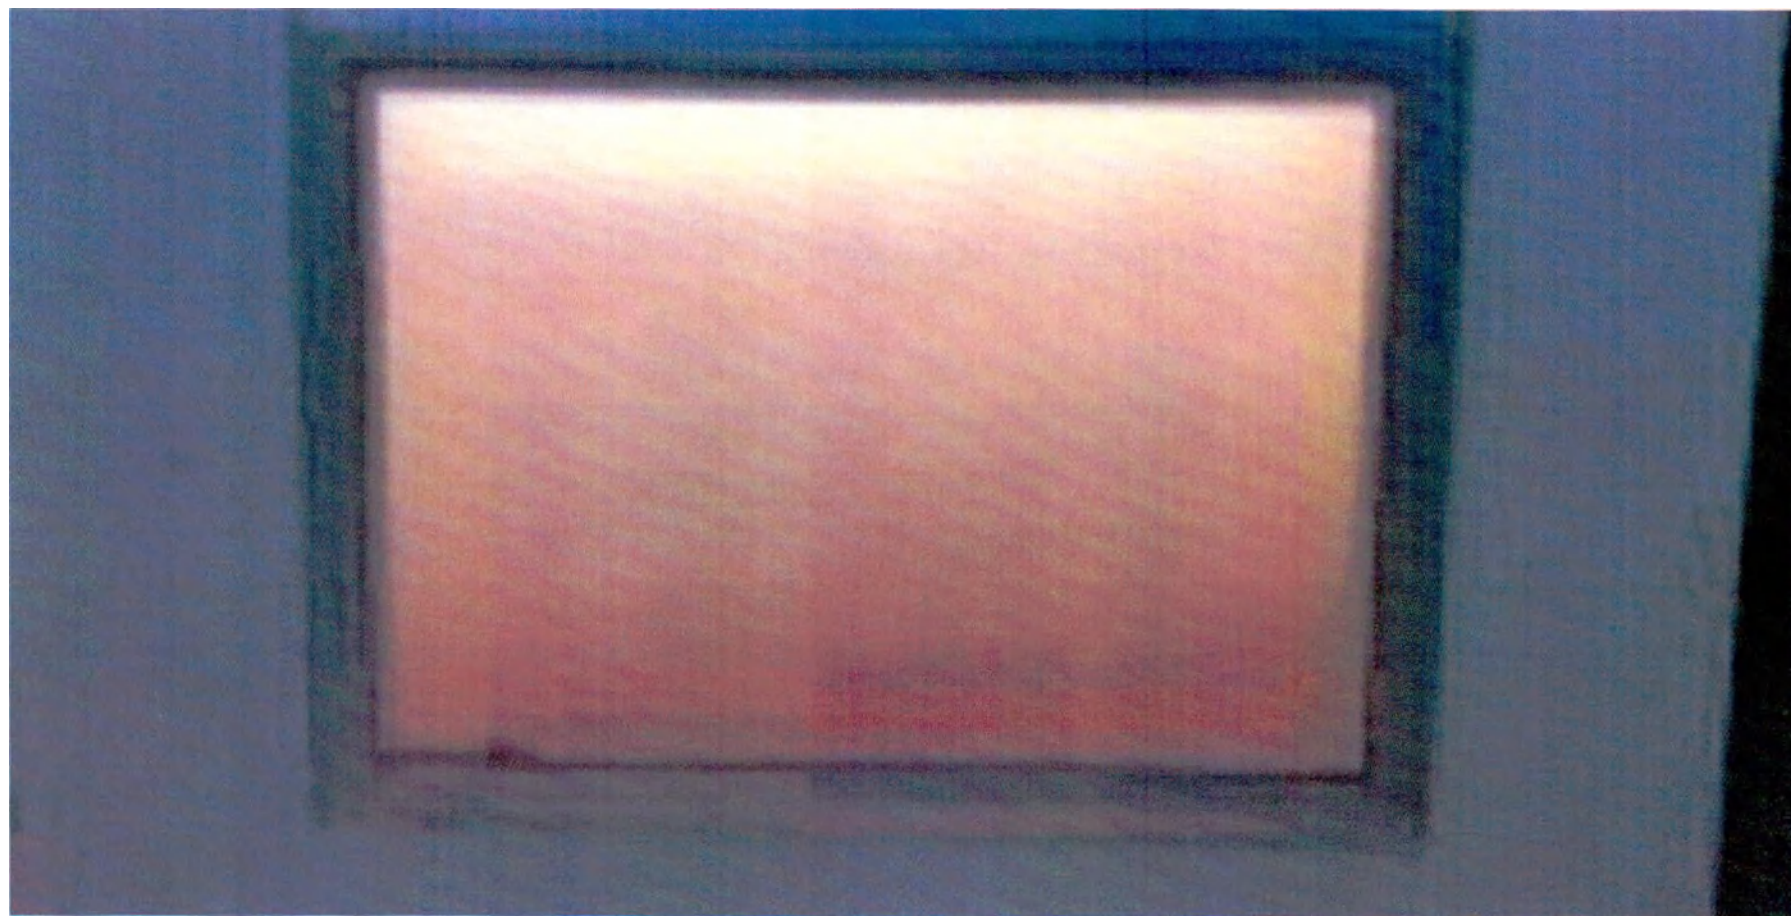


Рис. 79. Рентгенозащитное стекло (не более 4 шт.).



Рис. 80. Рентгенозащитное стекло (не более 4 шт.).

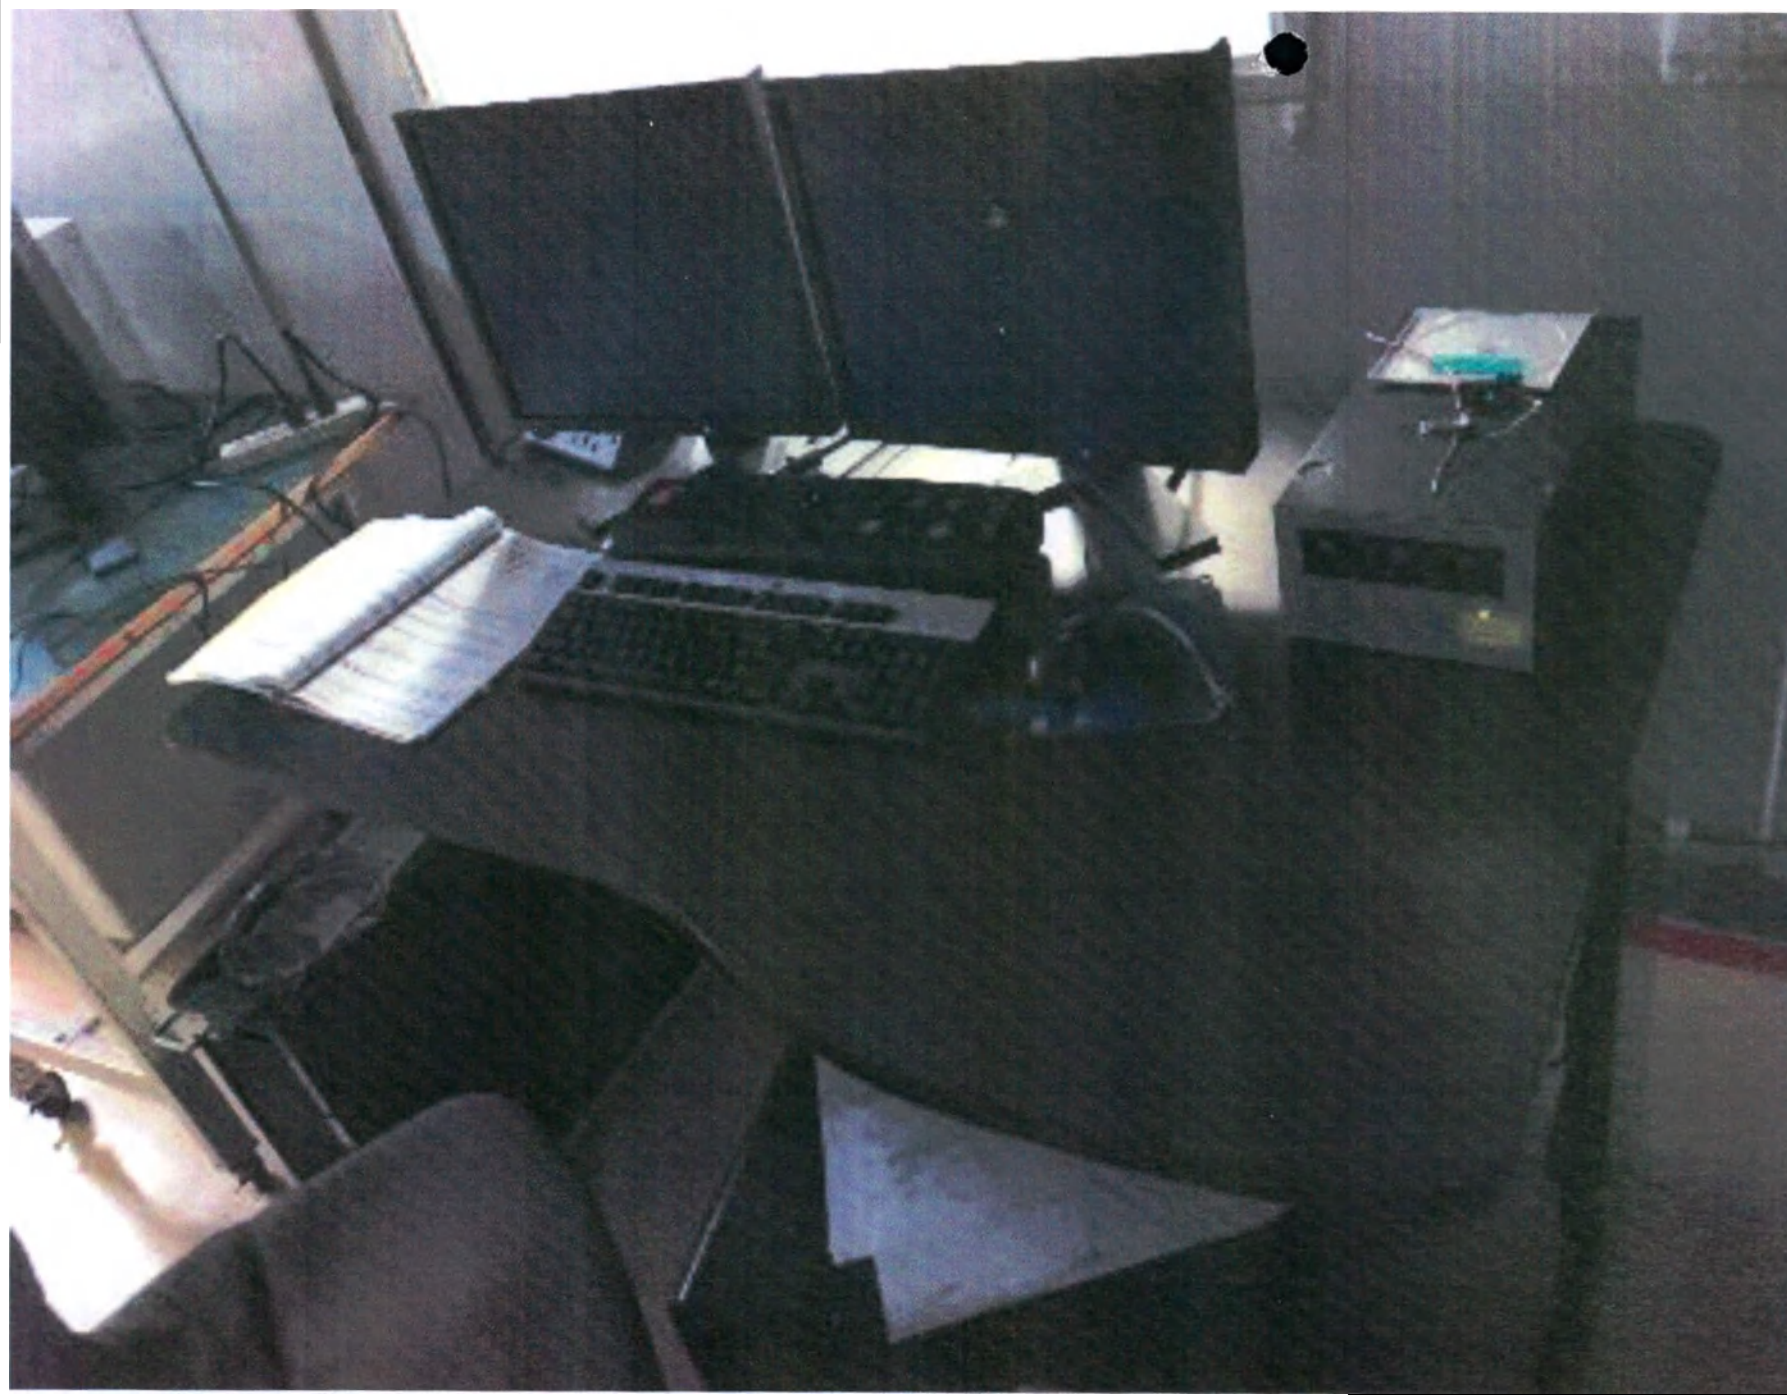


Рис. 81. Стол для консоли оператора (не более 4 шт.).

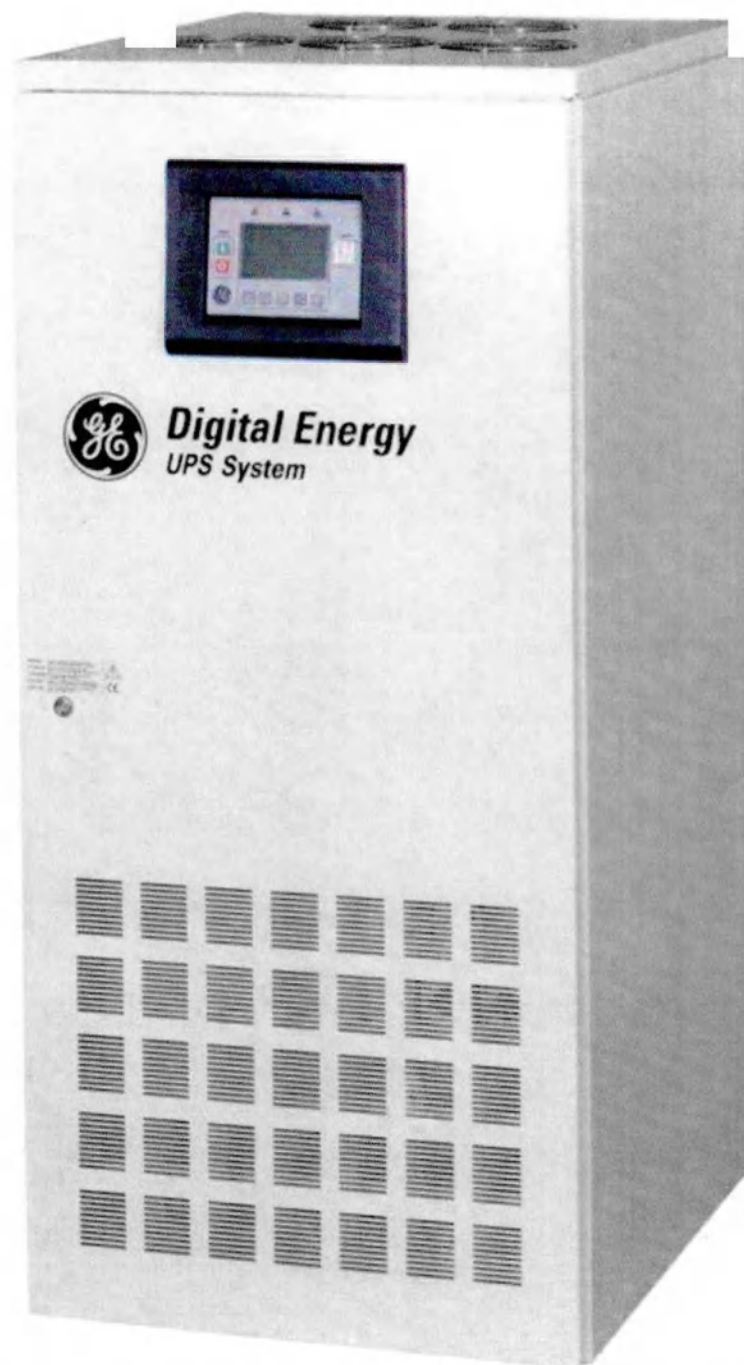


Рис. 82. Источник бесперебойного питания (не более 10 шт.).

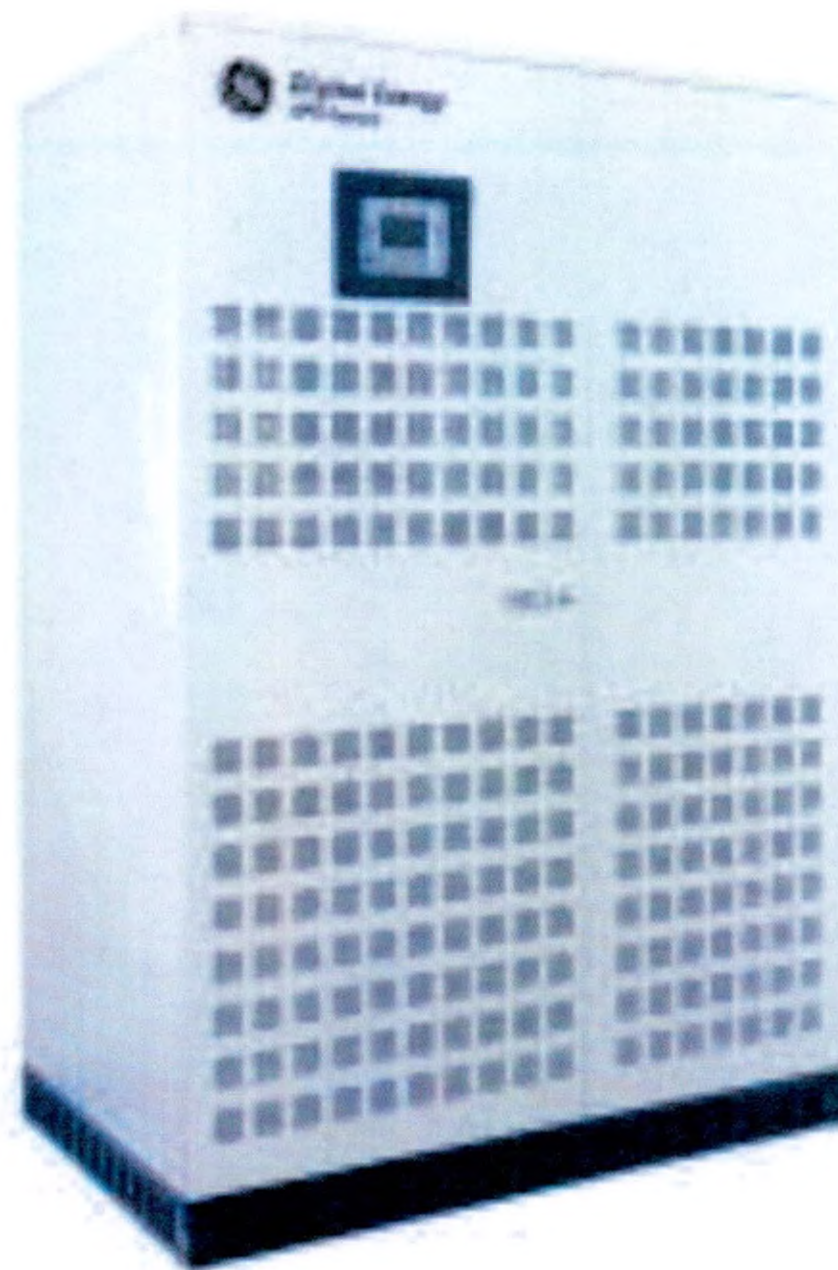


Рис. 83. Источник бесперебойного питания (не более 10 шт.).

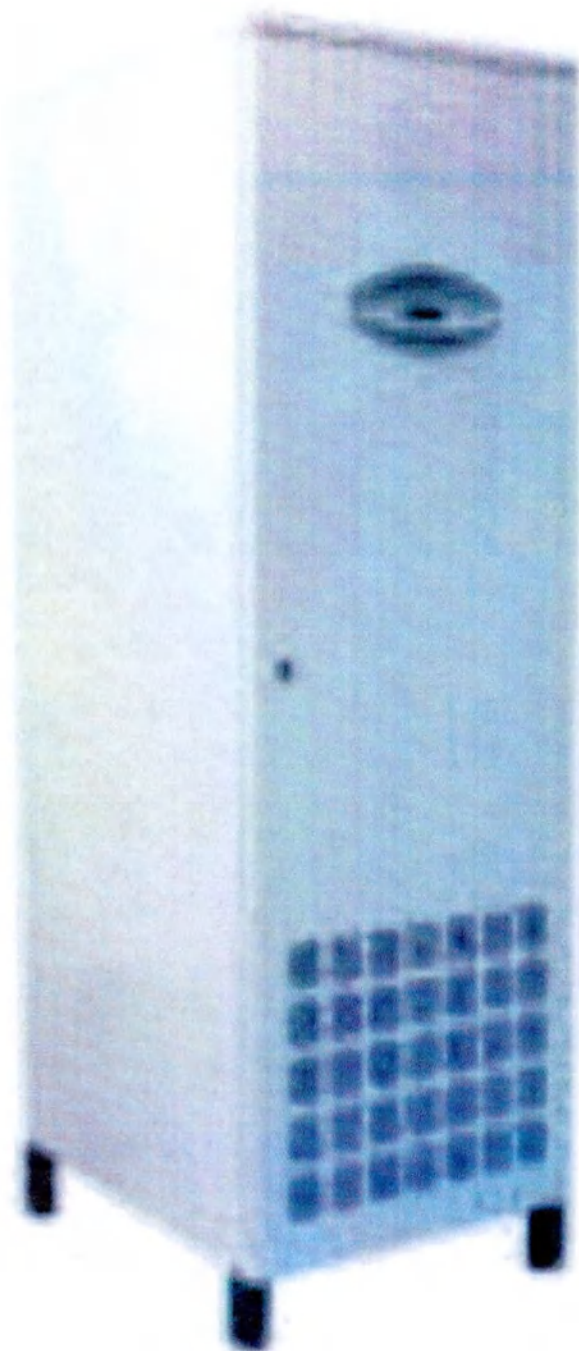


Рис. 84. Источник бесперебойного питания (не более 10 шт.).



Рис. 85. Источник бесперебойного питания (не более 10 шт.).



Рис. 86. Источник бесперебойного питания (не более 10 шт.).

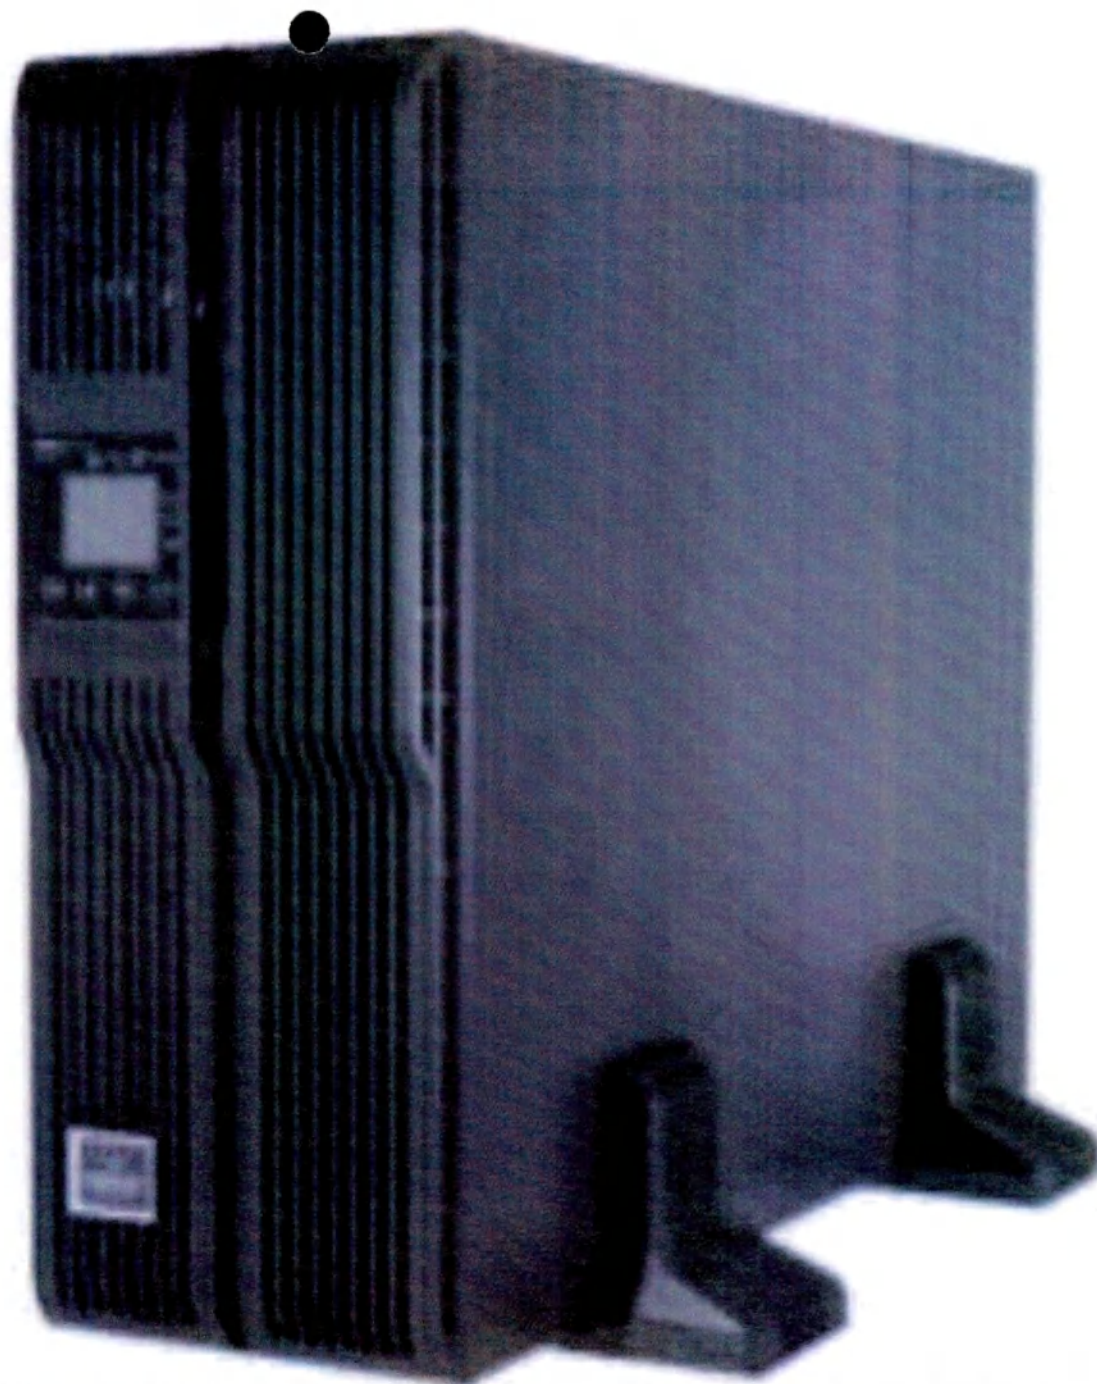


Рис. 87. Источник бесперебойного питания (не более 10 шт.).



Рис. 88. Источник бесперебойного питания (не более 10 шт.).

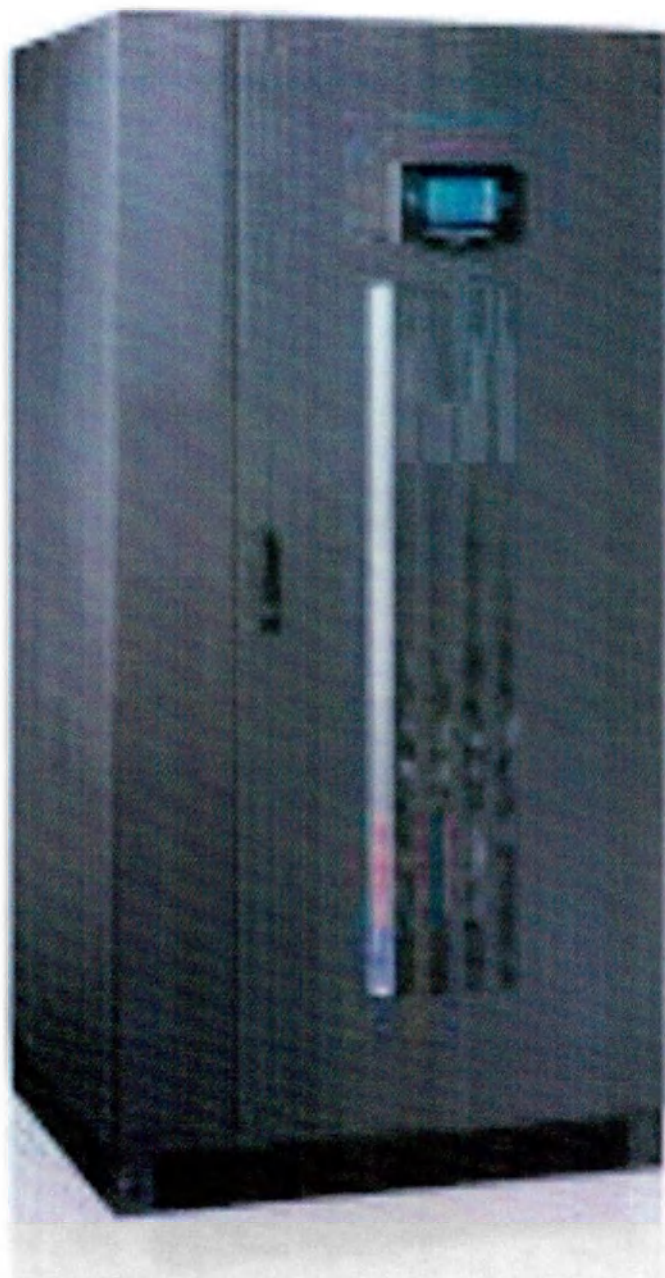


Рис. 89. Источник бесперебойного питания (не более 10 шт.).



Рис. 90. Источник бесперебойного питания (не более 10 шт.).



Рис. 91. Внешнее архивное устройство (не более 6 шт.).

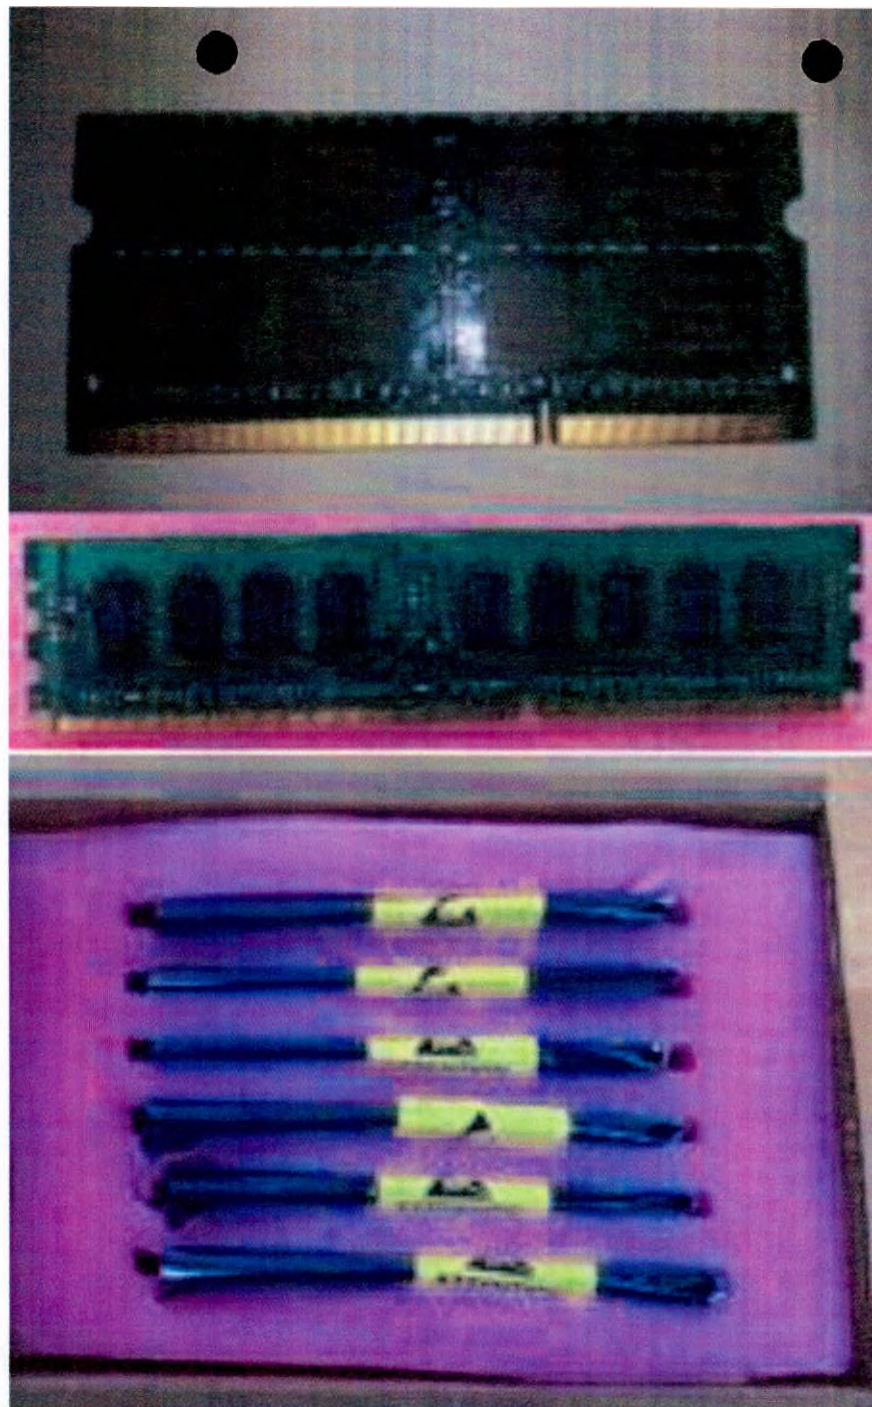


Рис. 92. Блоки оперативной памяти (не более 6 шт.).



Рис. 93. Увеличение оперативной памяти для рабочей станции (не более 4 шт.).



Рис. 94. Устройство для записи CD и DVD дисков (не более 4 шт.).



Рис. 95. Устройство для записи CD и DVD дисков (не более 4 шт.).

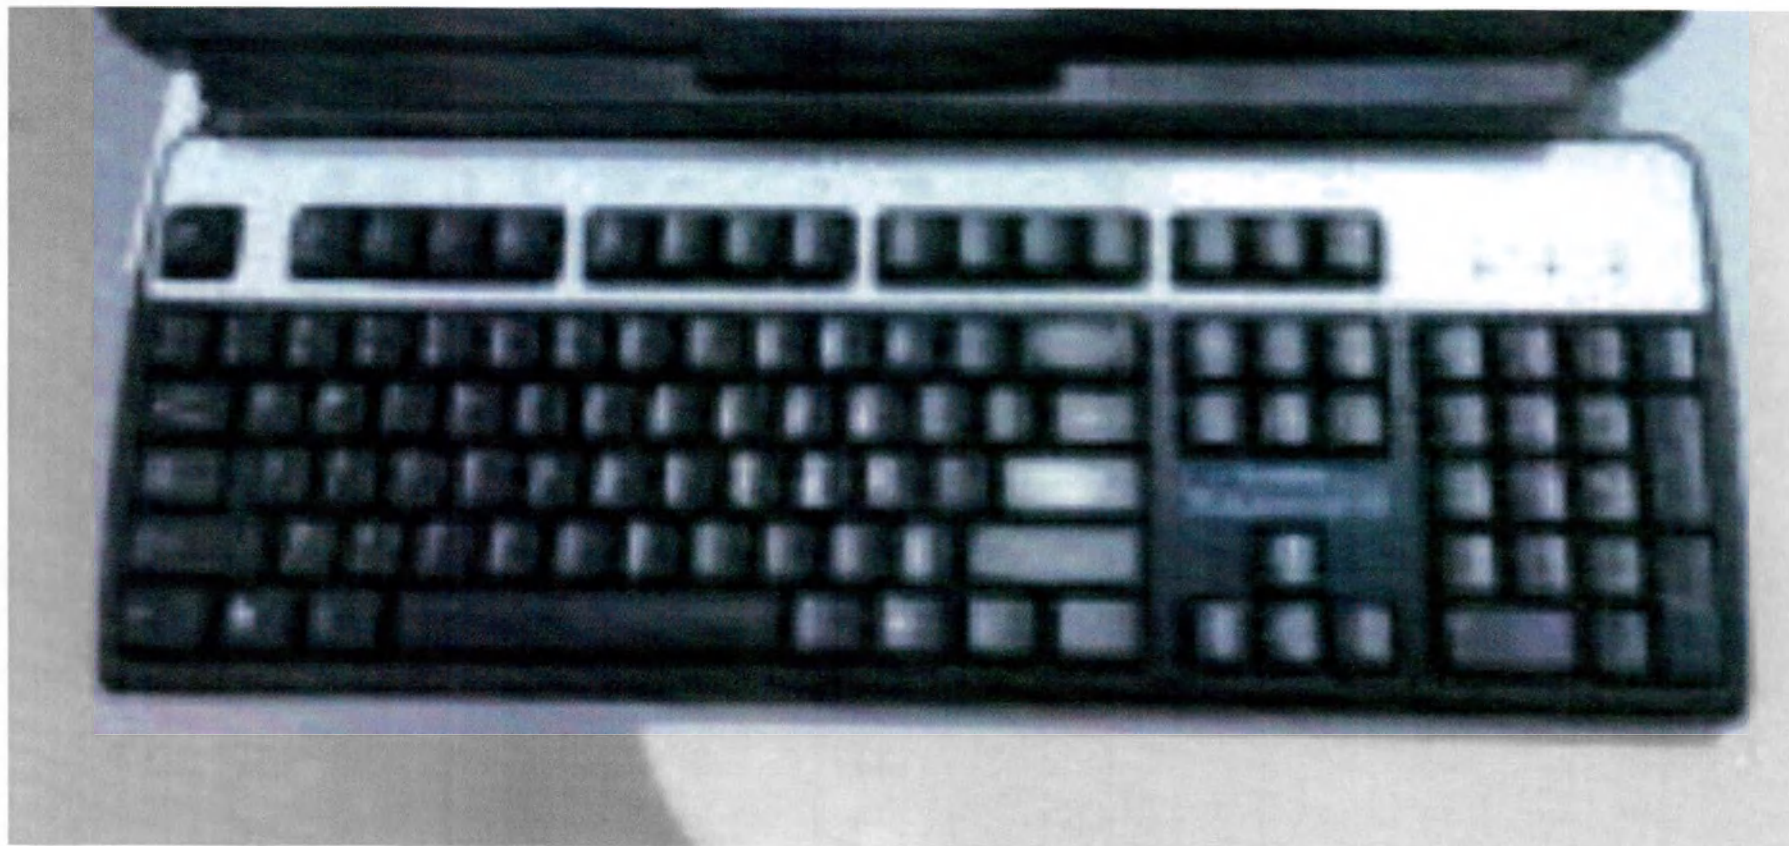


Рис. 96. Клавиатура (не более 10 шт.).

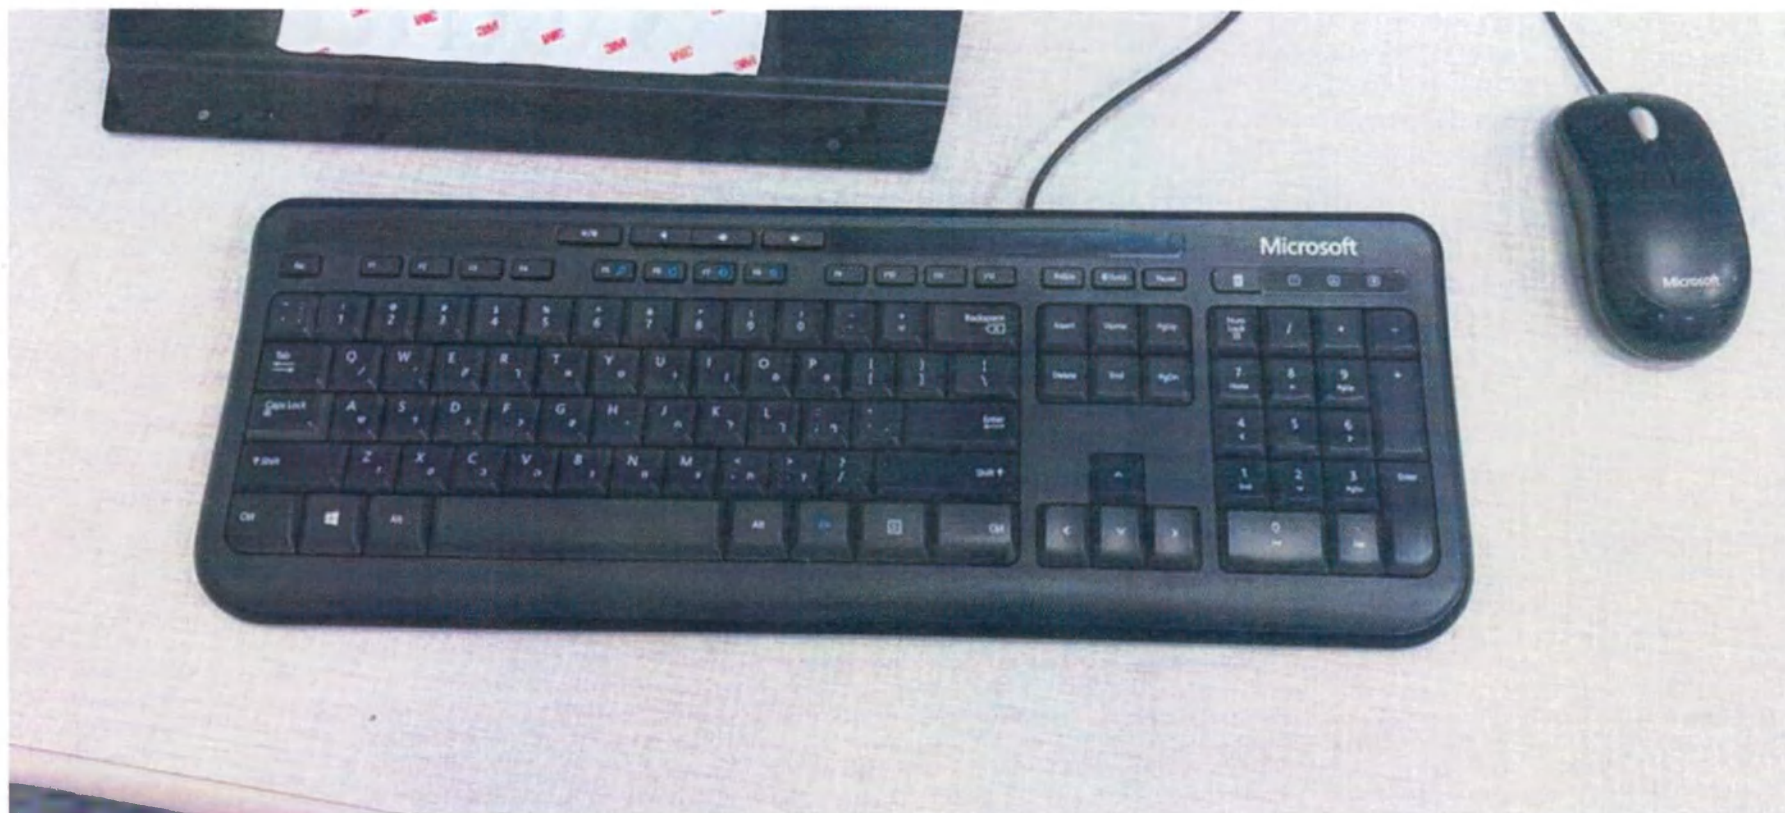


Рис. 97. Клавиатура (не более 10 шт.).



Рис. 98. Наклейки для клавиатуры (не более 100 шт.).



Рис. 99. Наклейки для корпуса гентри и помещения сканирования (не более 100 шт.).



Рис. 100. Сканер штрих-кода



Рис. 101. Принтер для печати медицинских изображений (не более 4 шт.).

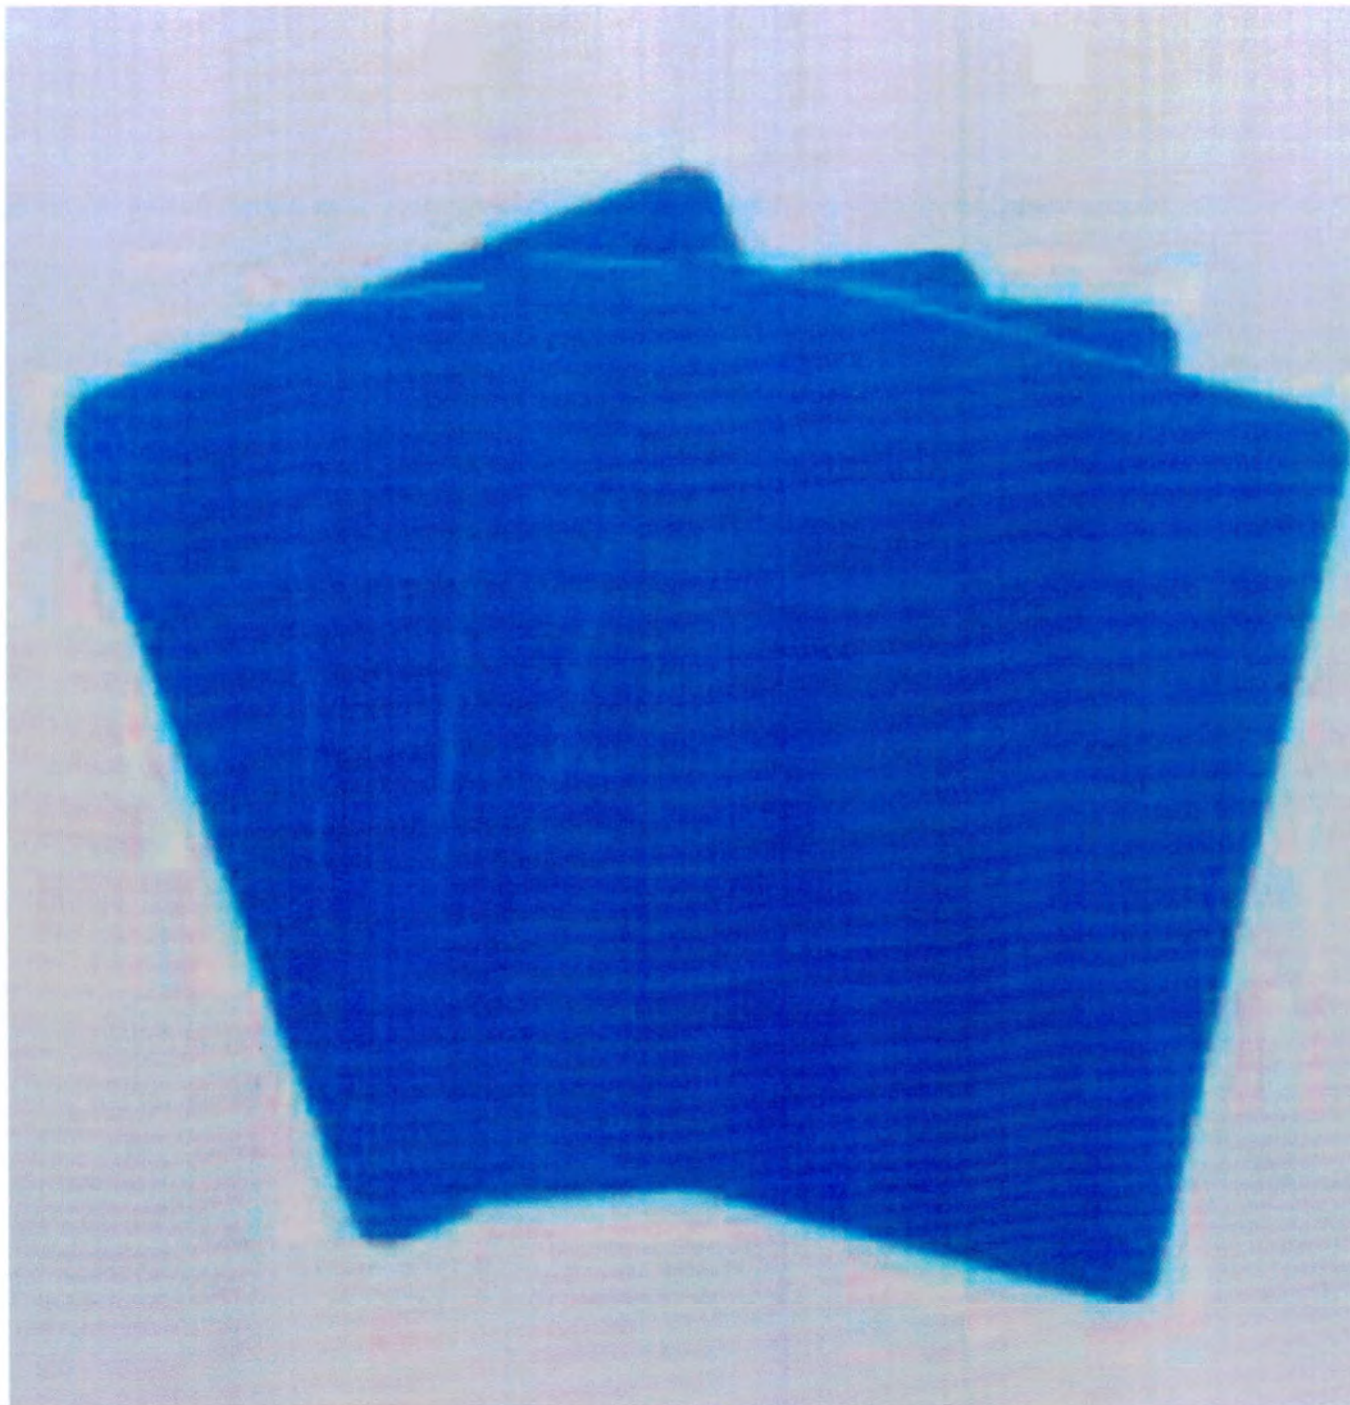


Рис. 102. Пленки для принтера для печати медицинских изображений (не более 100 шт.).



Рис. 103. Пленки для принтера для печати медицинских изображений (не более 100 шт.).



Рис. 104. Пленки для принтера для печати медицинских изображений (не более 100 шт.).

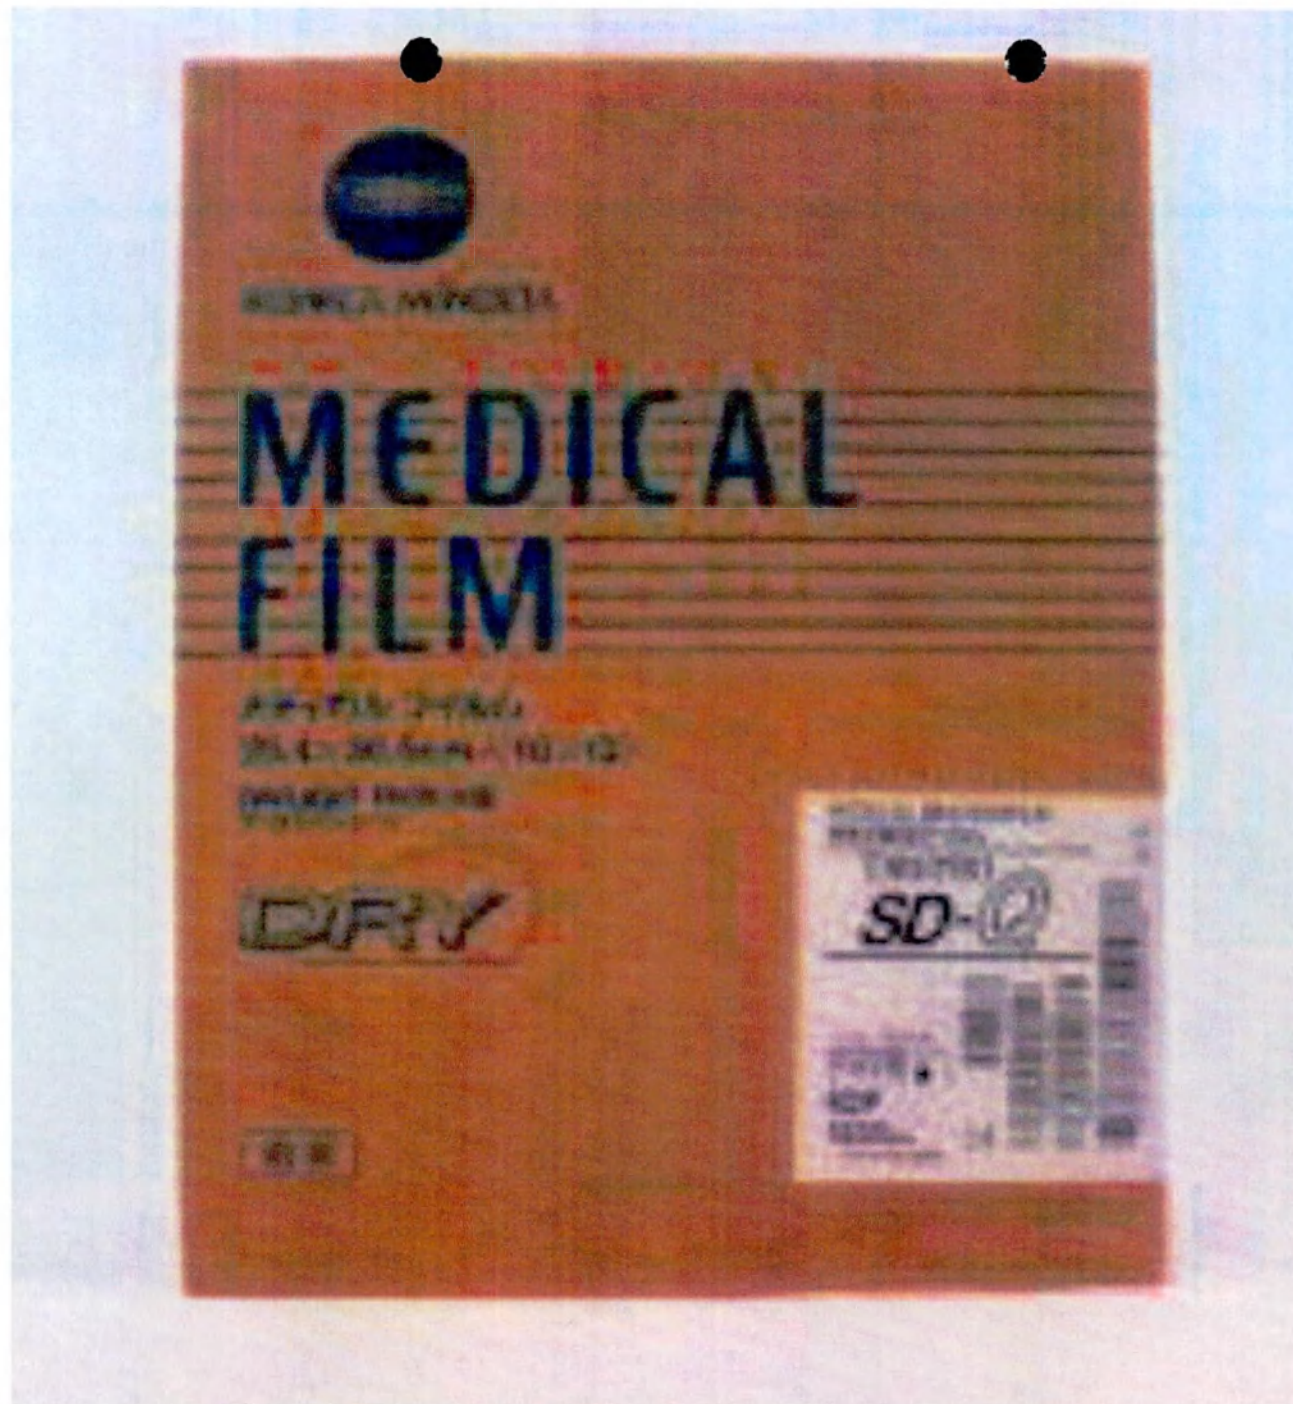


Рис. 105. Пленки для принтера для печати медицинских изображений (не более 100 шт.).



Рис. 106. Приспособления для монтажа (не более 4 шт.)



Рис. 107. Приспособления для монтажа (не более 4 шт.)

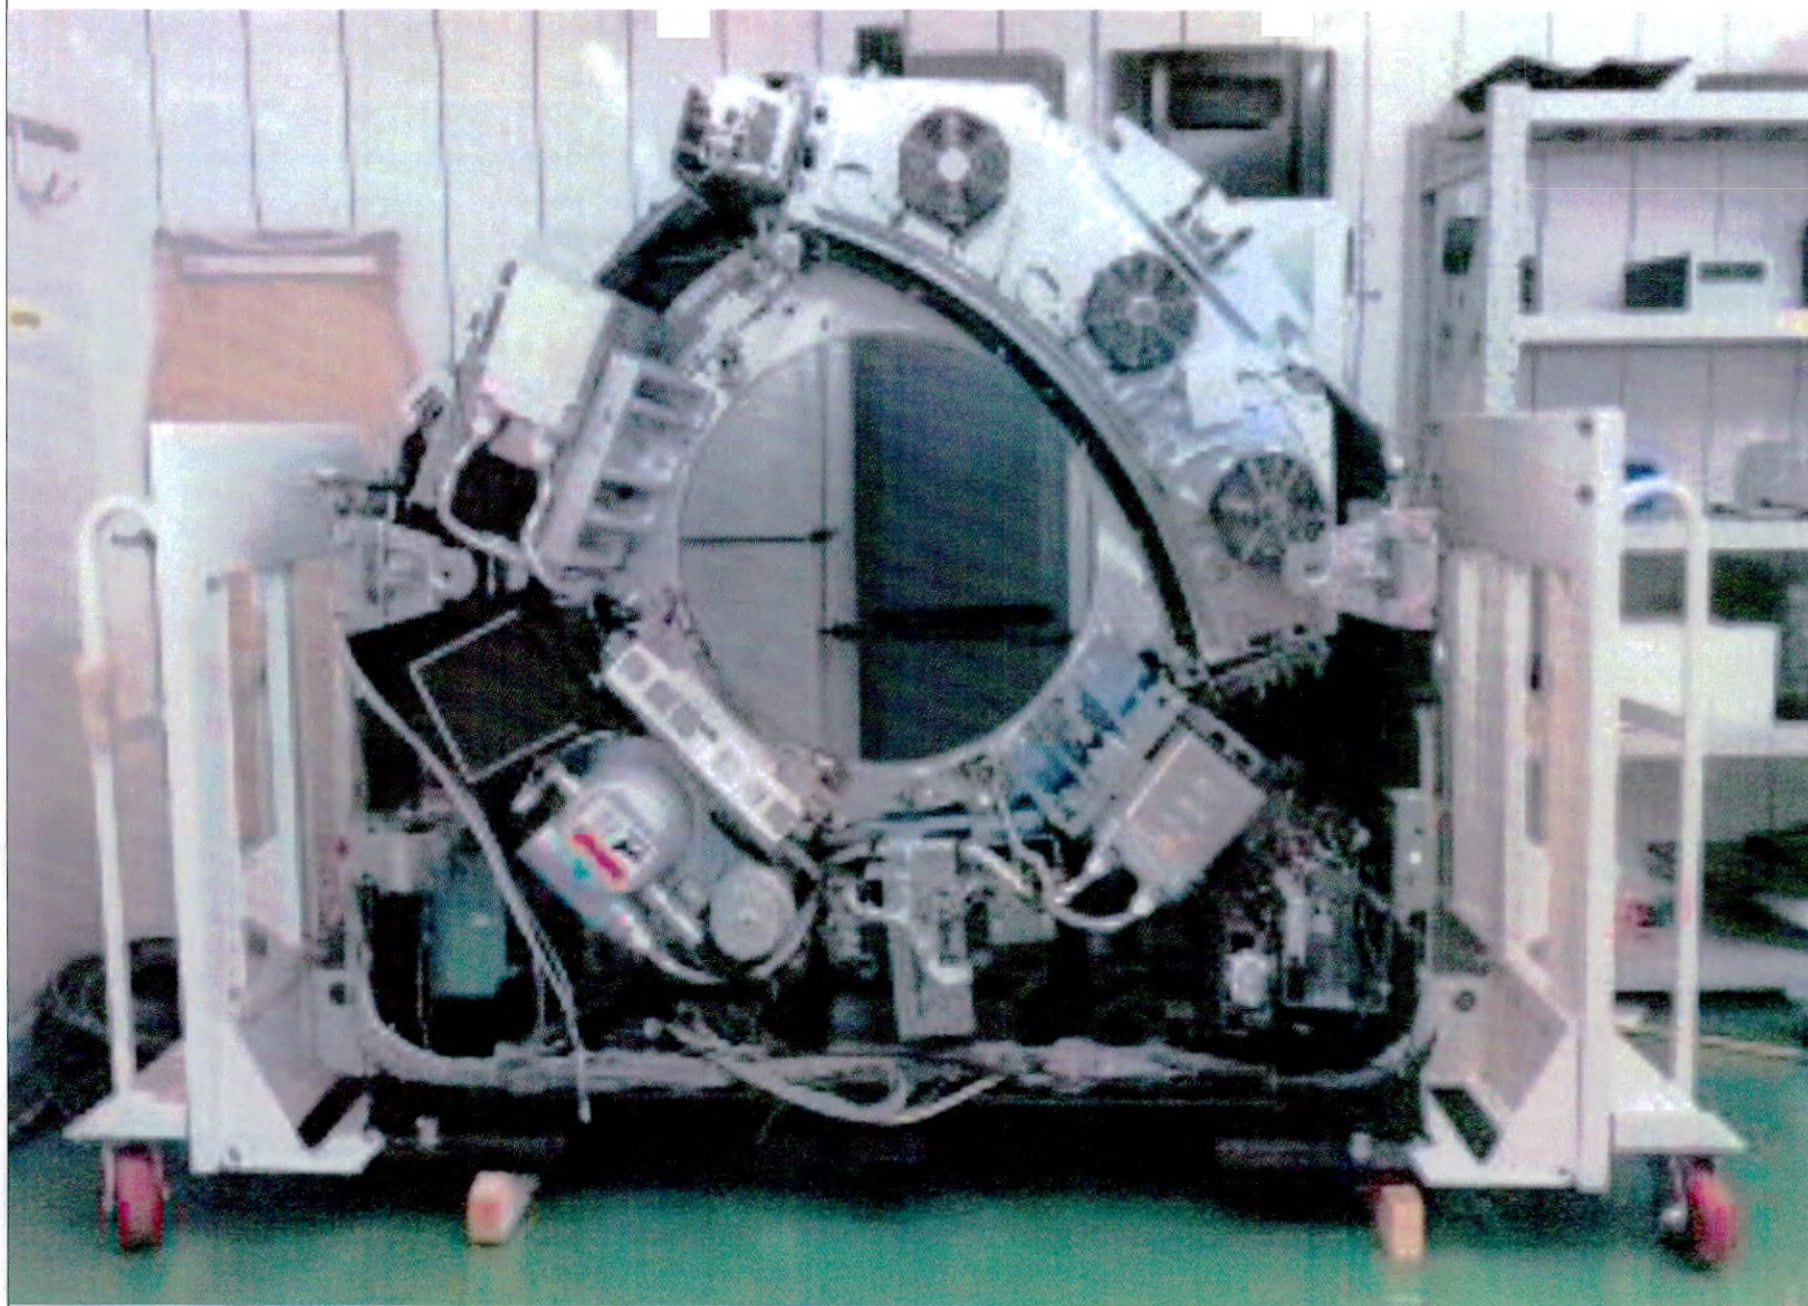


Рис. 108. Транспортировочные тележки (не более 12 шт.).



Рис. 109. Транспортировочные тележки (не более 12 шт.).

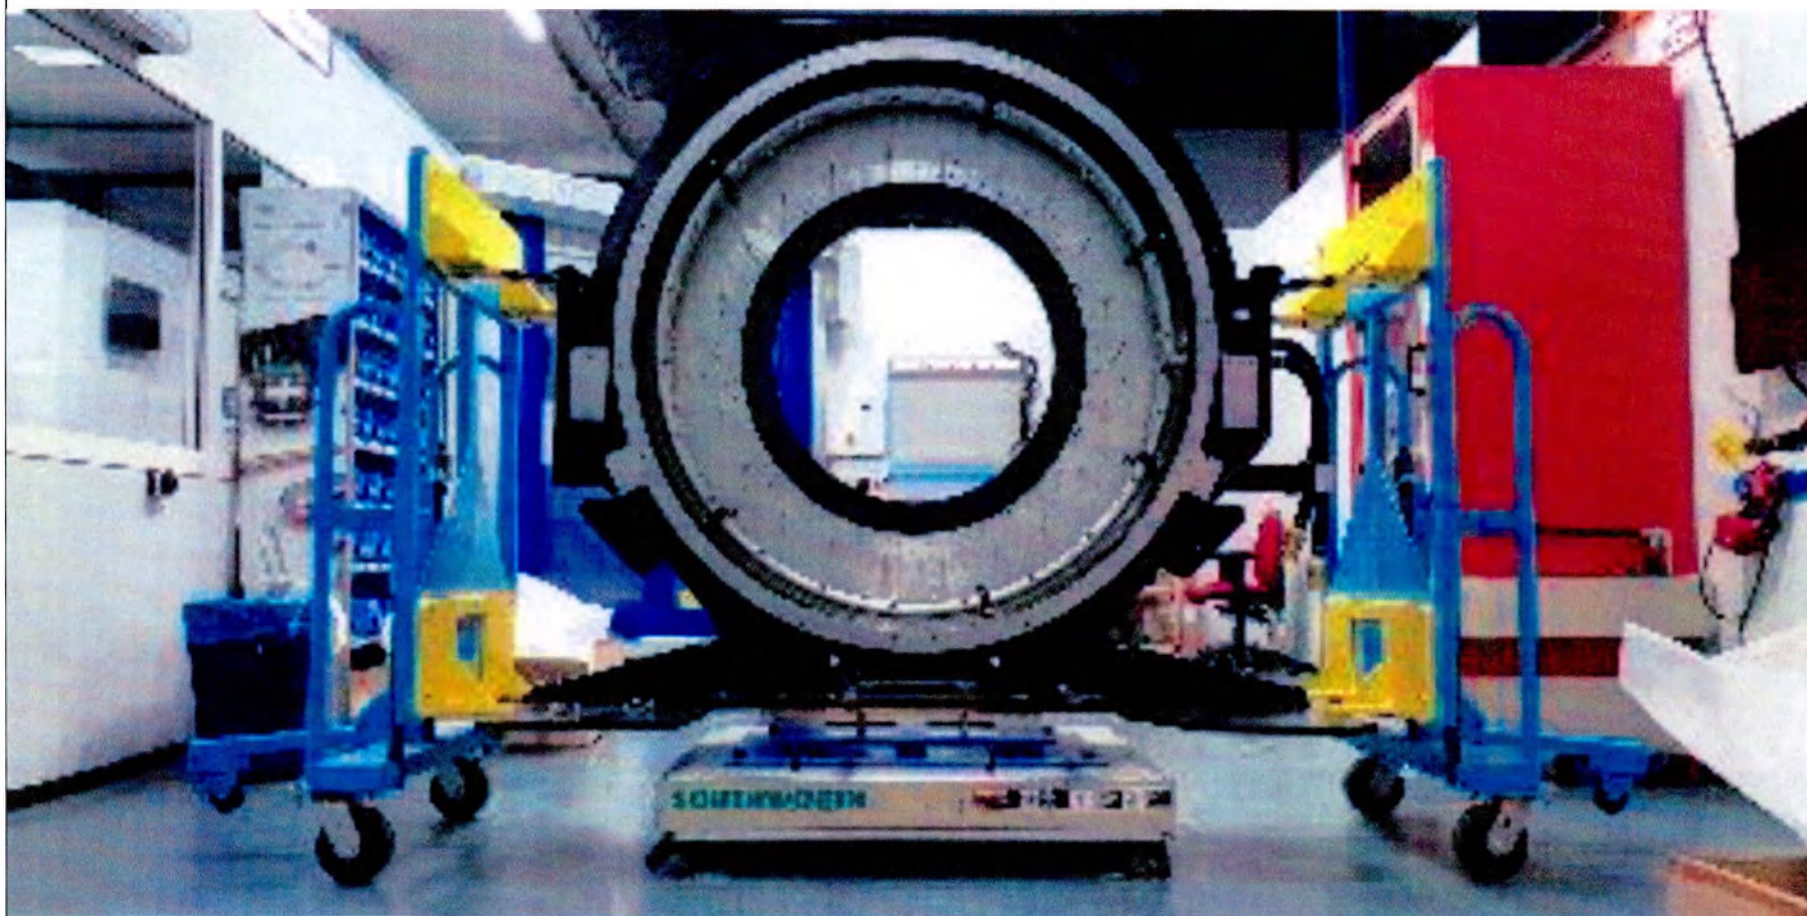


Рис. 110. Транспортировочные тележки (не более 12 шт.).



Рис. 111. Транспортировочные тележки (не более 12 шт.).



Рис. 112. Транспортировочные тележки (не более 12 шт.).

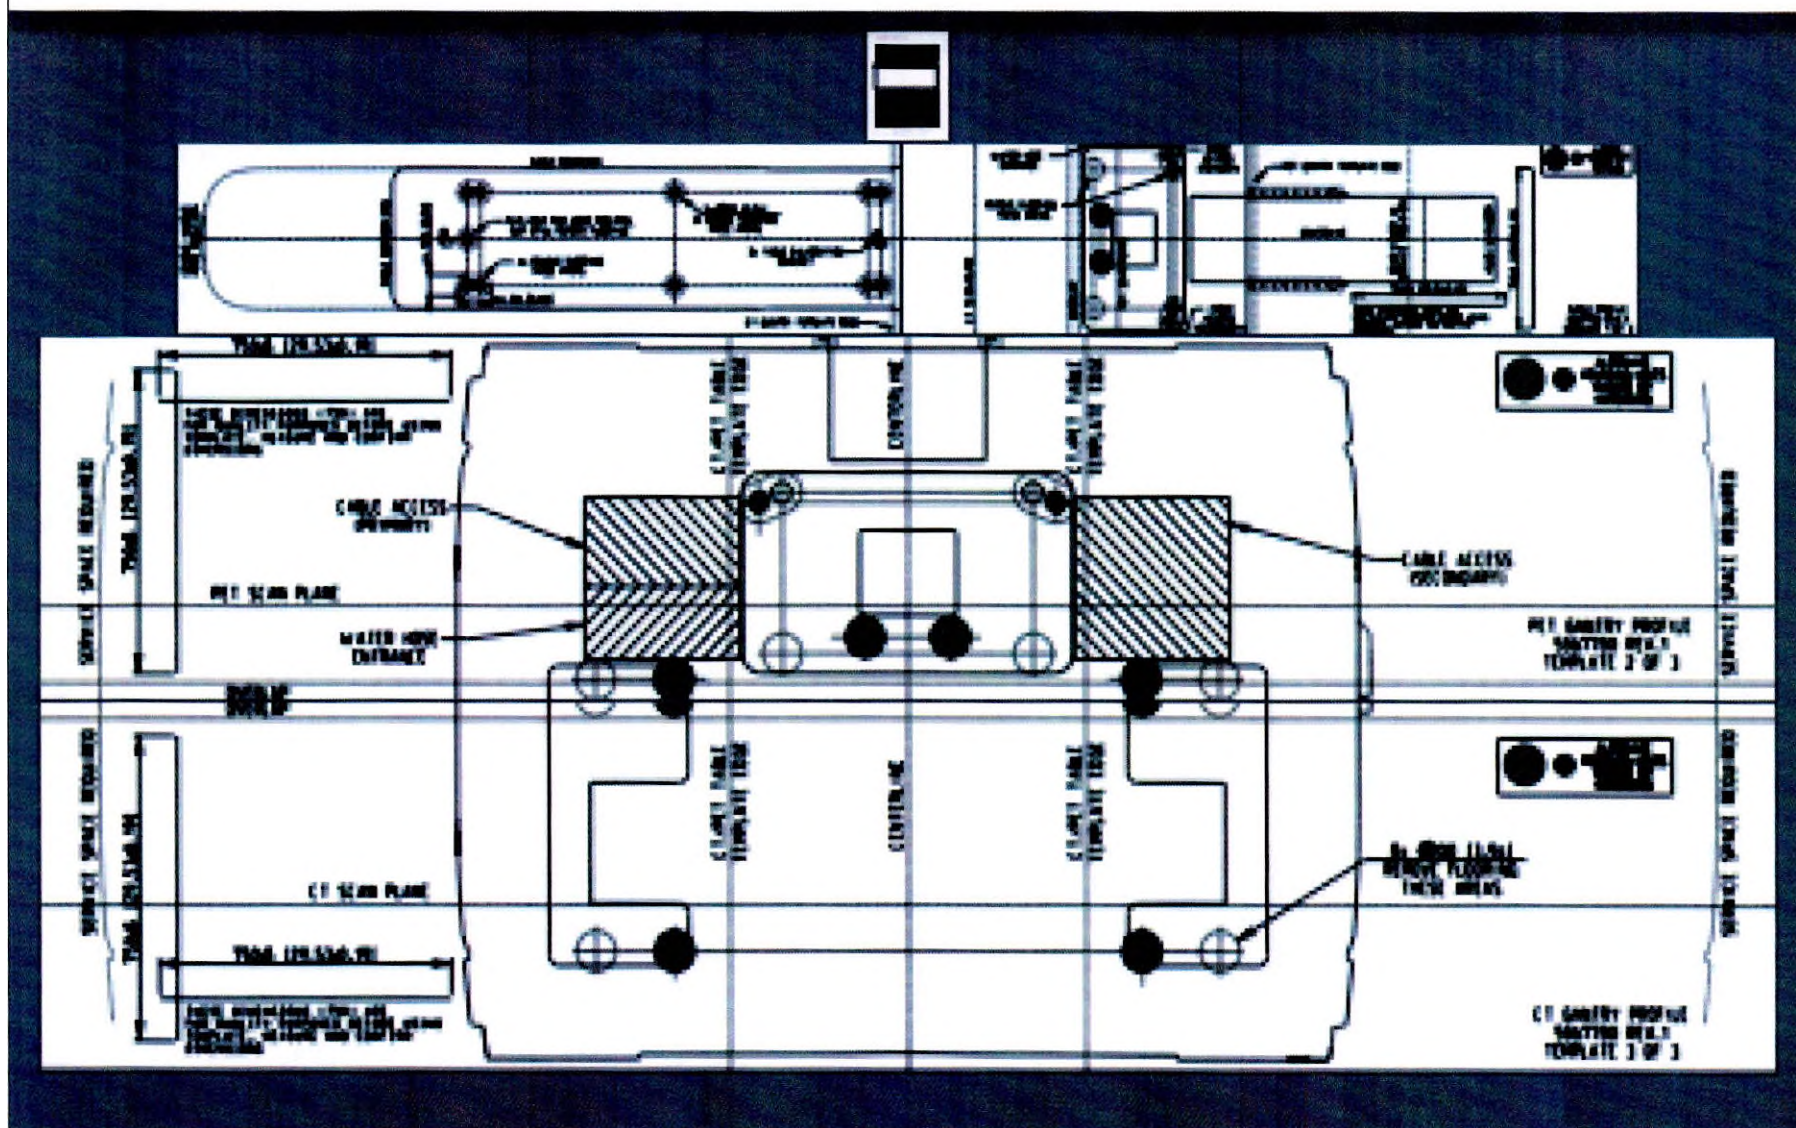


Рис. 113. Шаблон для размещения на месте установки (не более 10 шт.).



Рис. 114. Шаблон для размещения на месте установки (не более 10 шт.).



Рис. 115. Шаблон для размещения на месте установки (не более 10 шт.).



Рис. 116. Кабели соединительные (не более 10 шт.).

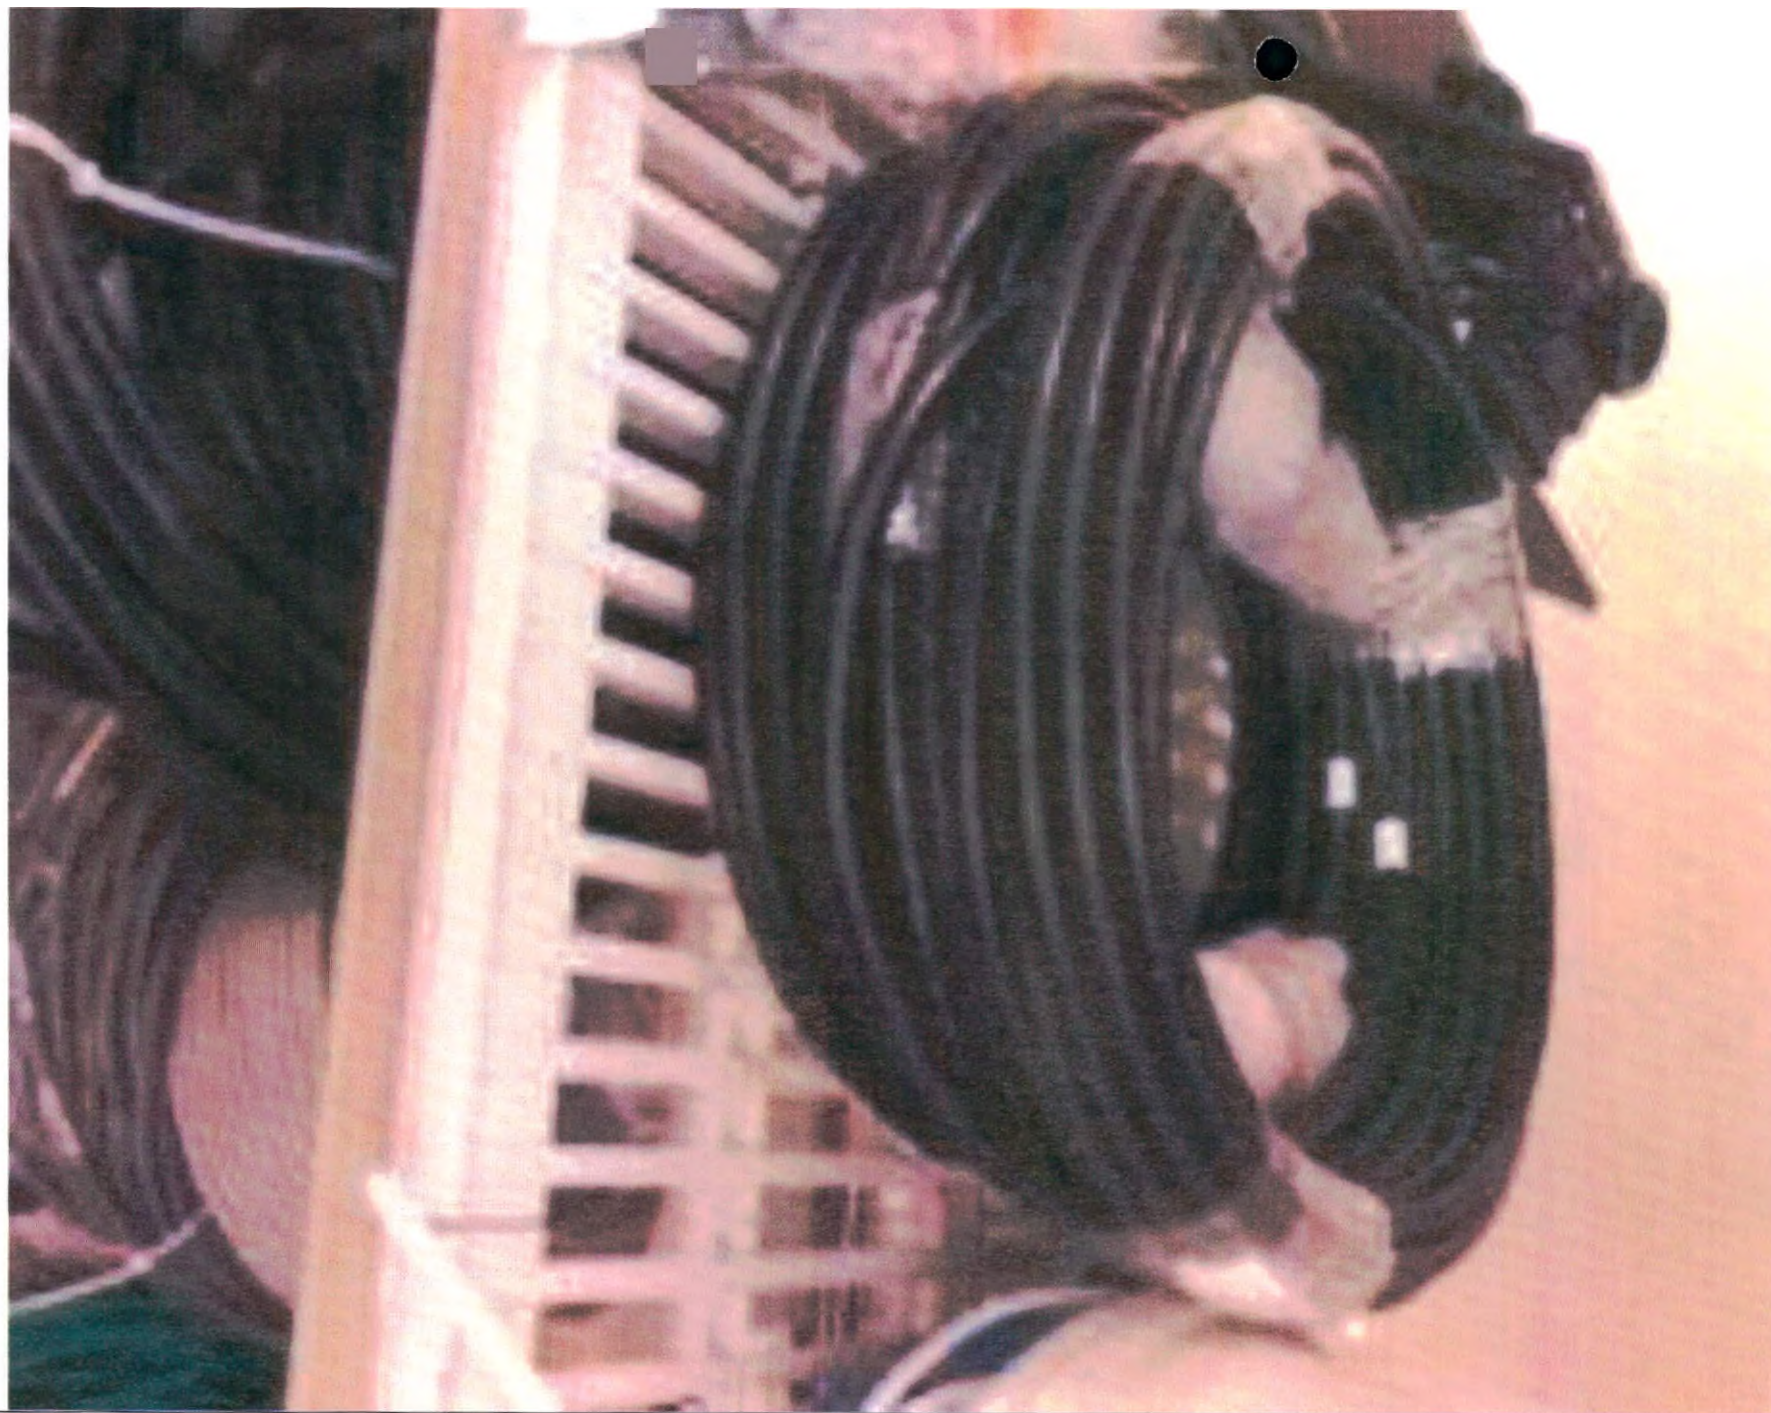


Рис. 117. Кабели для подключения (не более 10 шт.).



Рис. 118. Кабели для системы охлаждения ПЭТ гентри (не более 10 шт.)



Рис. 119. Система удаленной связи с пациентом (не более 10 шт.).



Рис. 120. Система удаленной связи с пациентом (не более 10 шт.).



Рис. 121. Система удаленной связи с пациентом (не более 10 шт.).



Рис. 122. Система удаленной связи с пациентом (не более 10 шт.).



Рис. 123. Опция 64-х канального детектора (не более 10 шт.), Программный пакет Certificate for Virtual Items (не более 10 шт.).

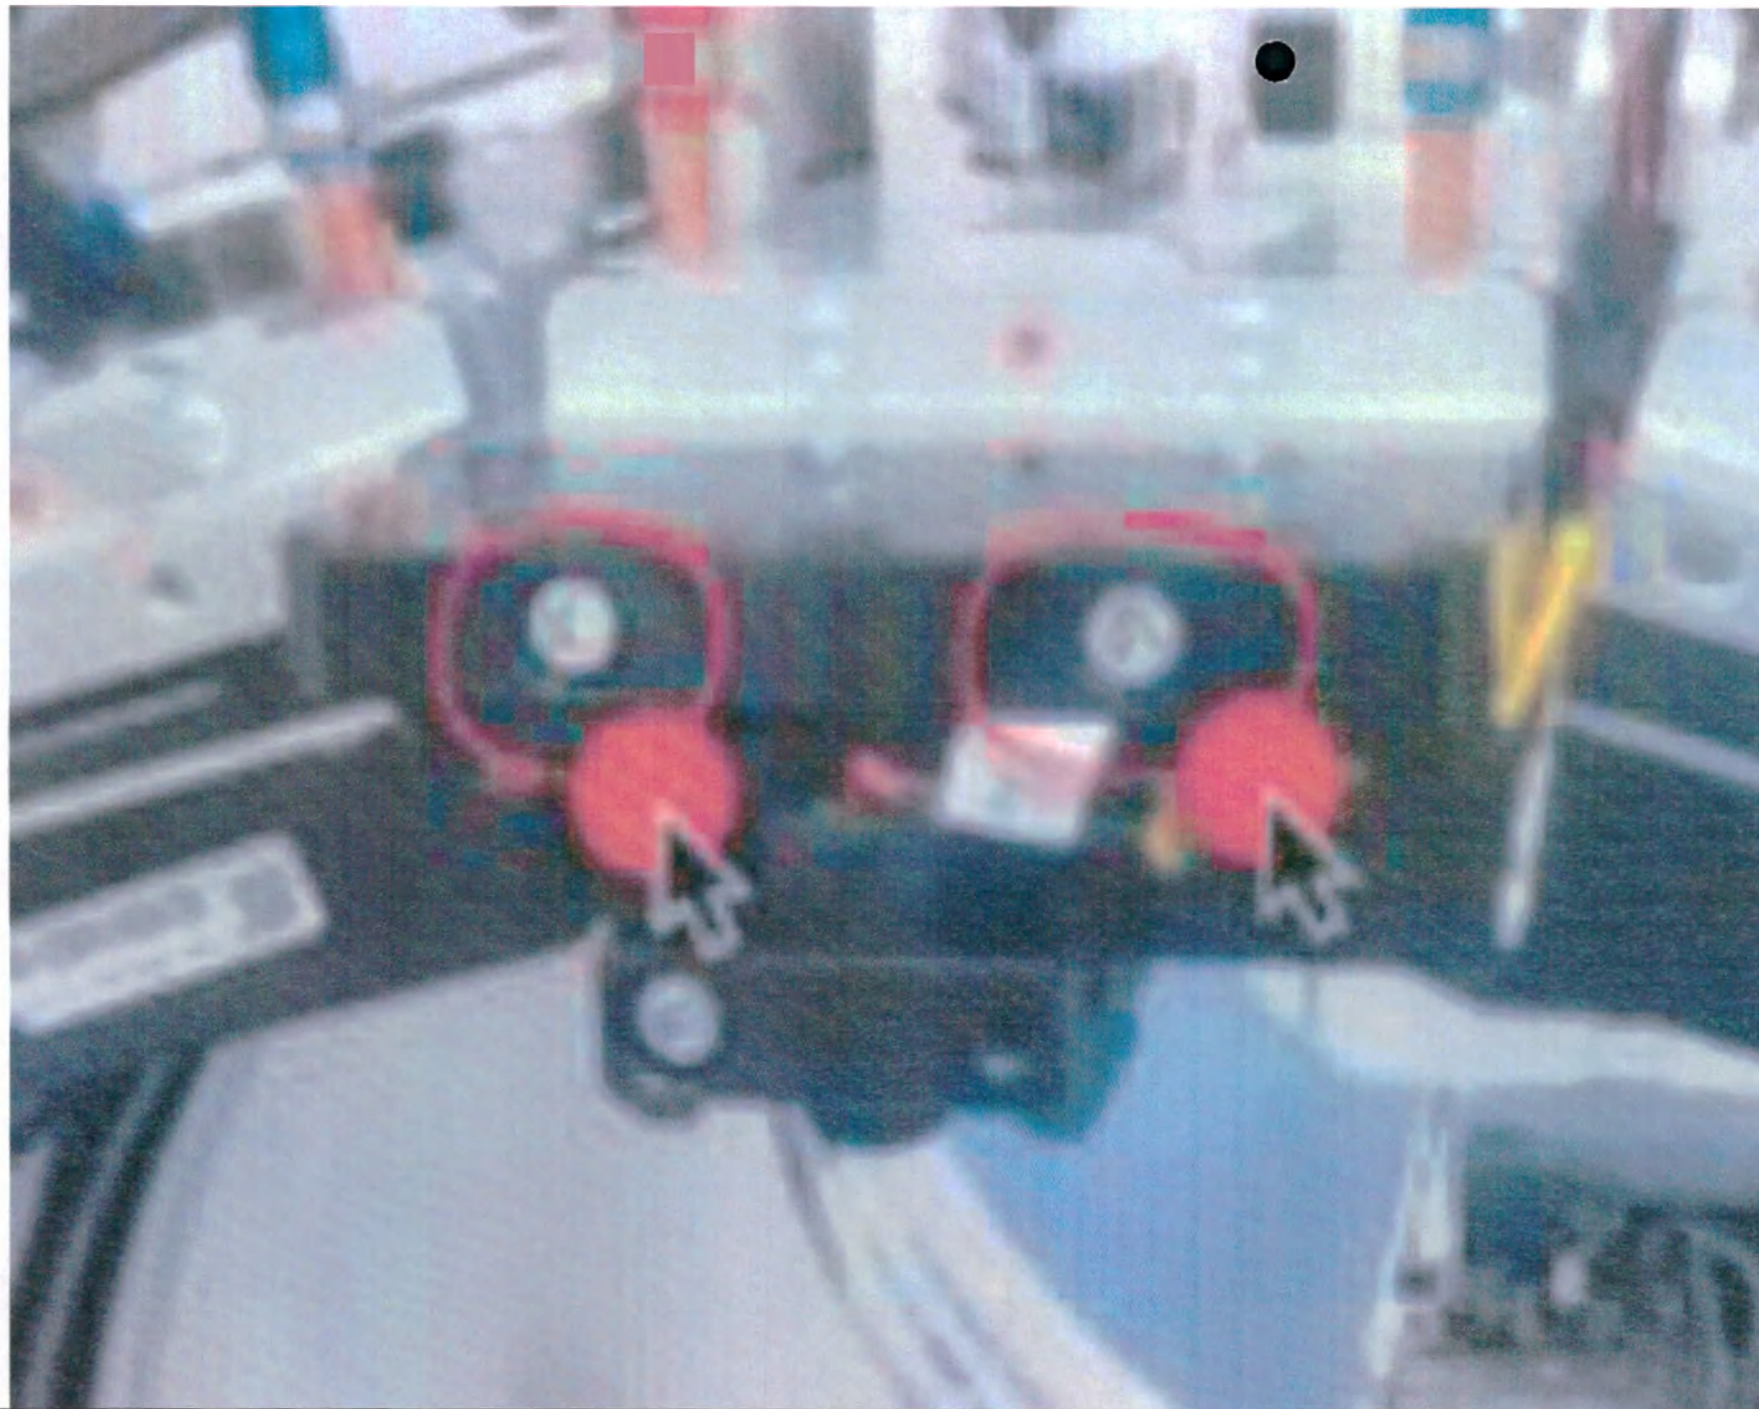


Рис. 124. Лазер гентри для позиционирования пациентов (не более 10 шт.)

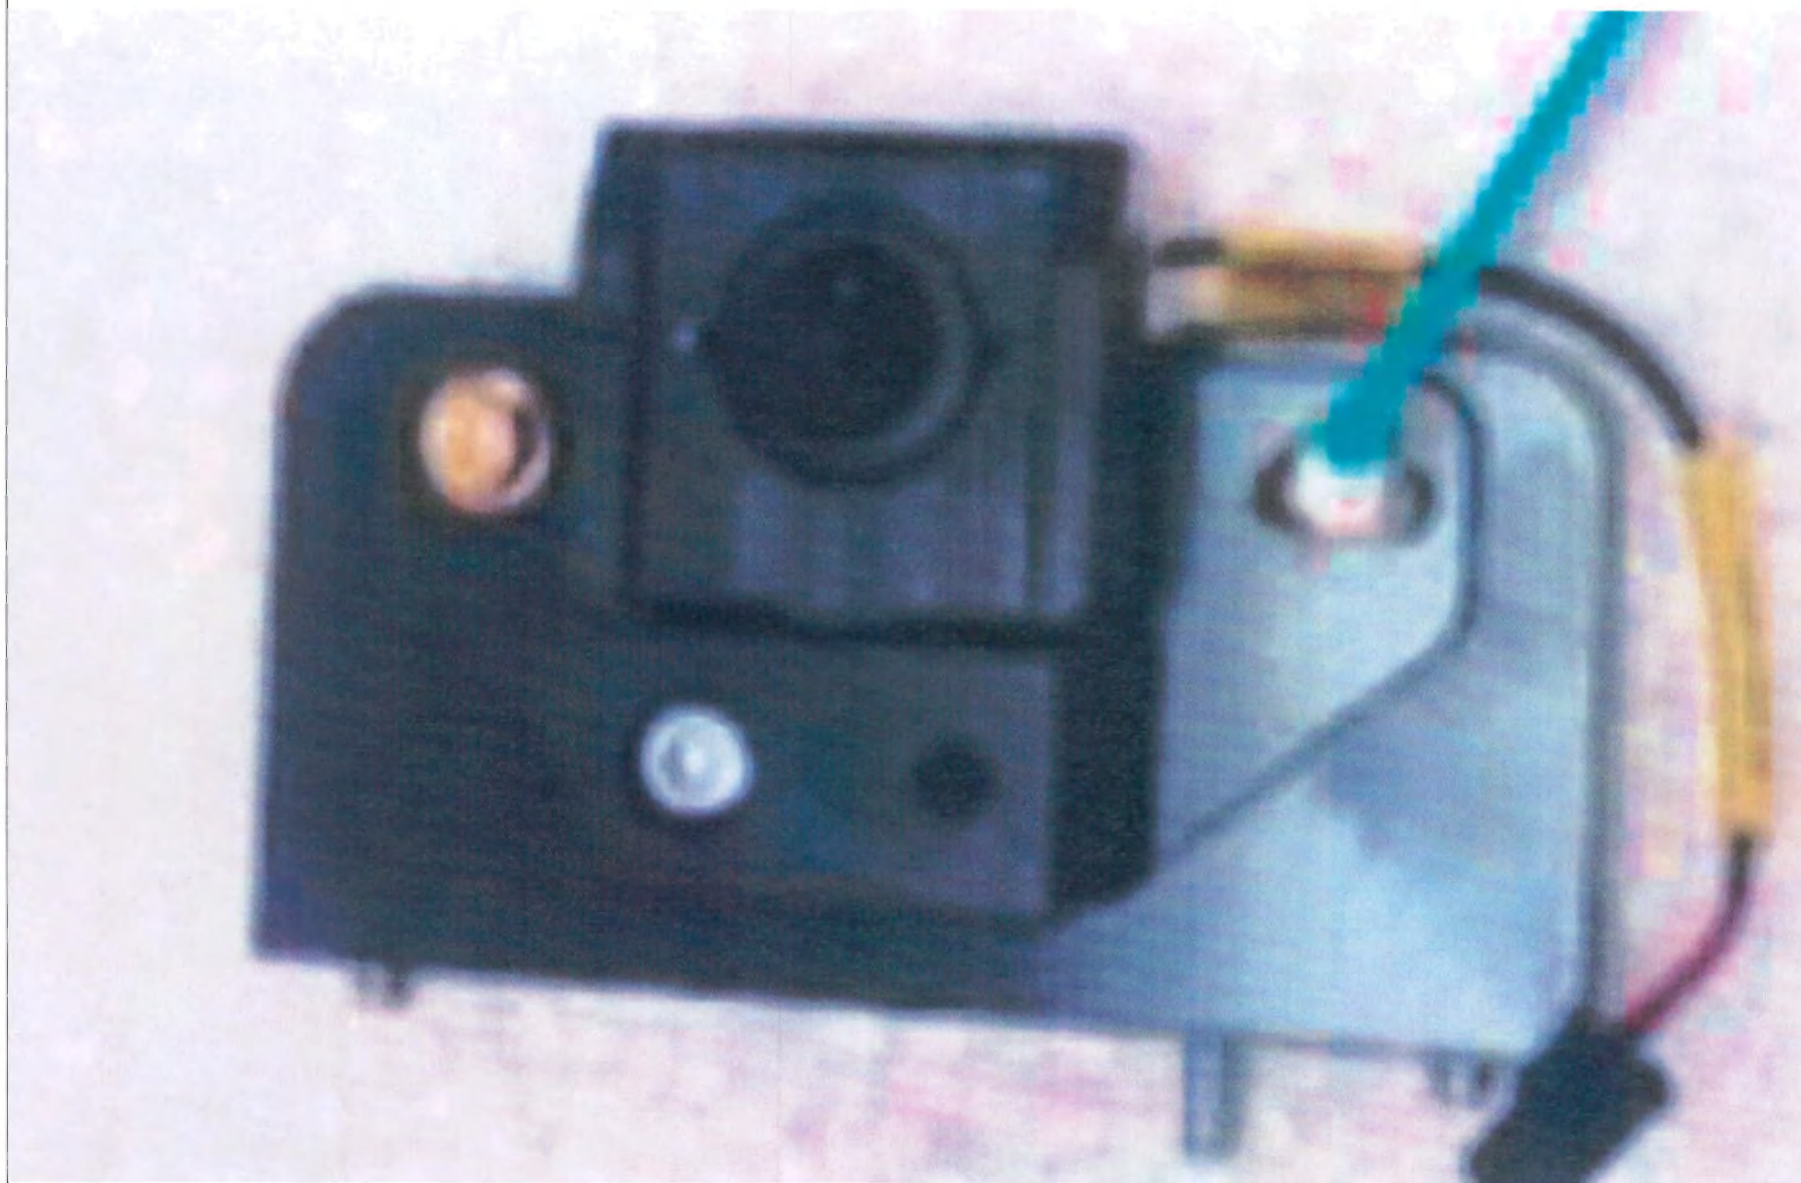


Рис. 125. Лазер гентри для позиционирования пациентов (не более 10 шт.)

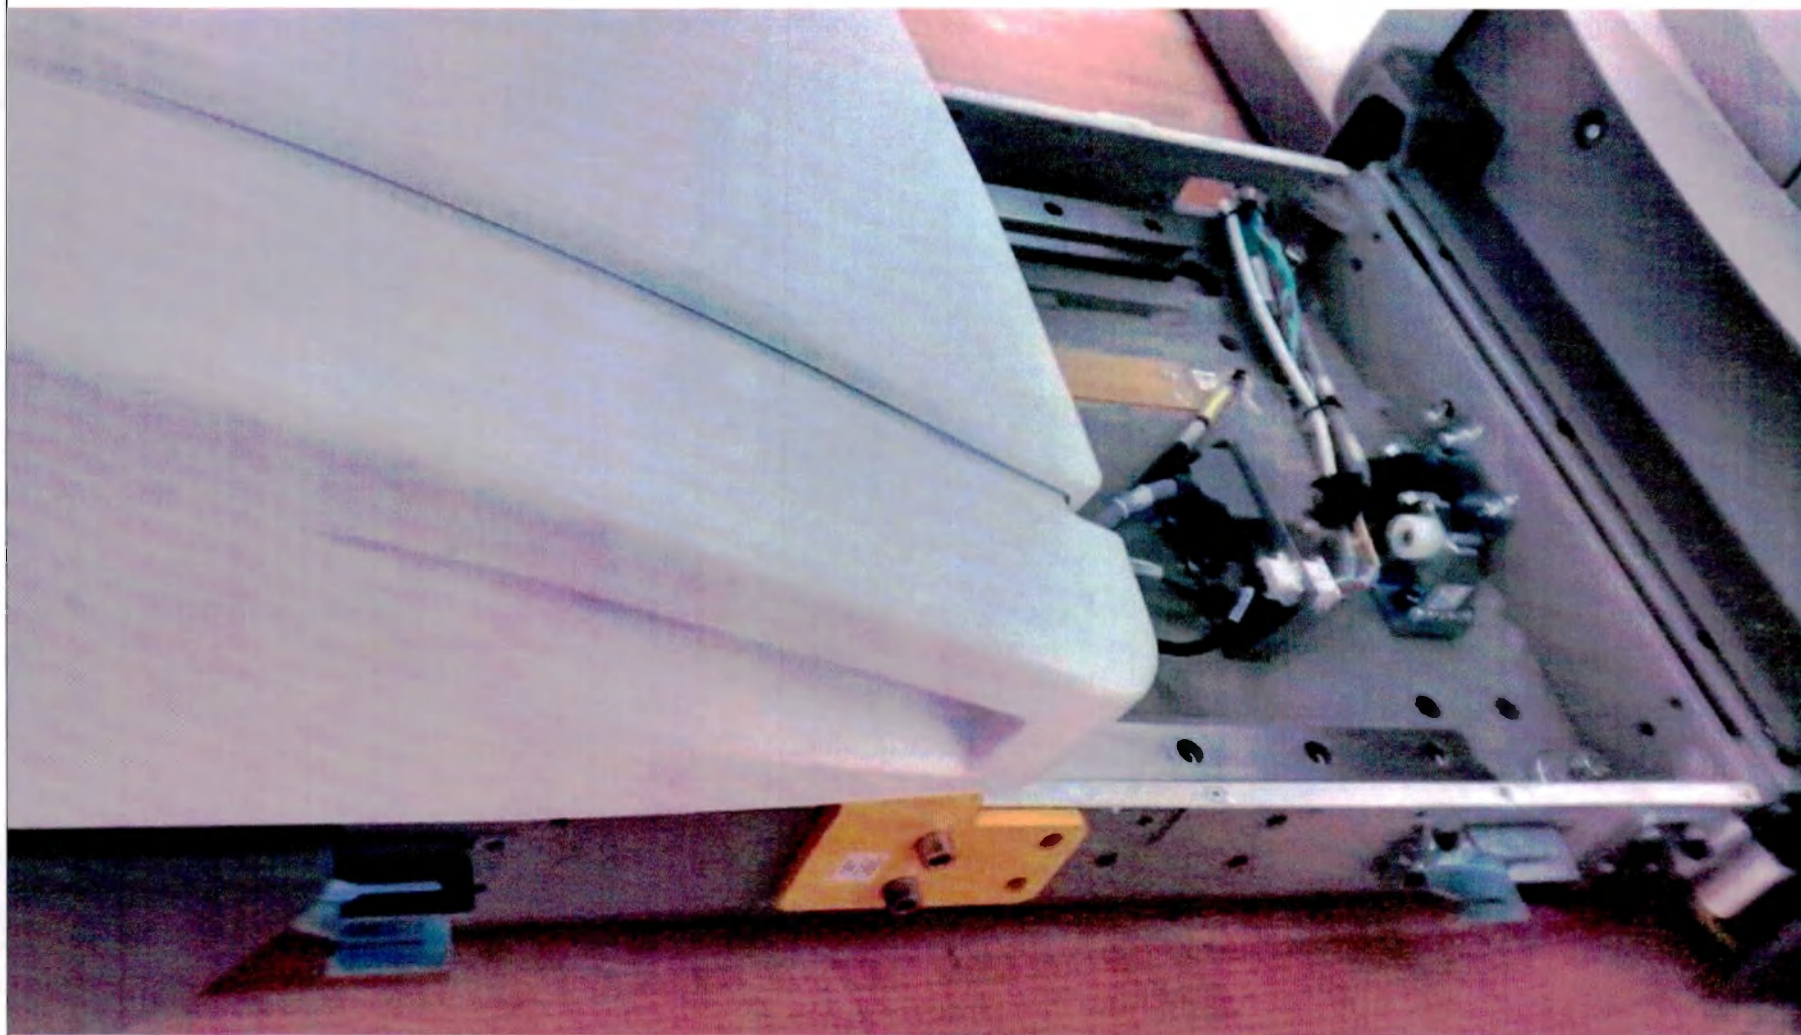


Рис. 126. Крепления для установки в мобильный модуль (не более 10 шт.).

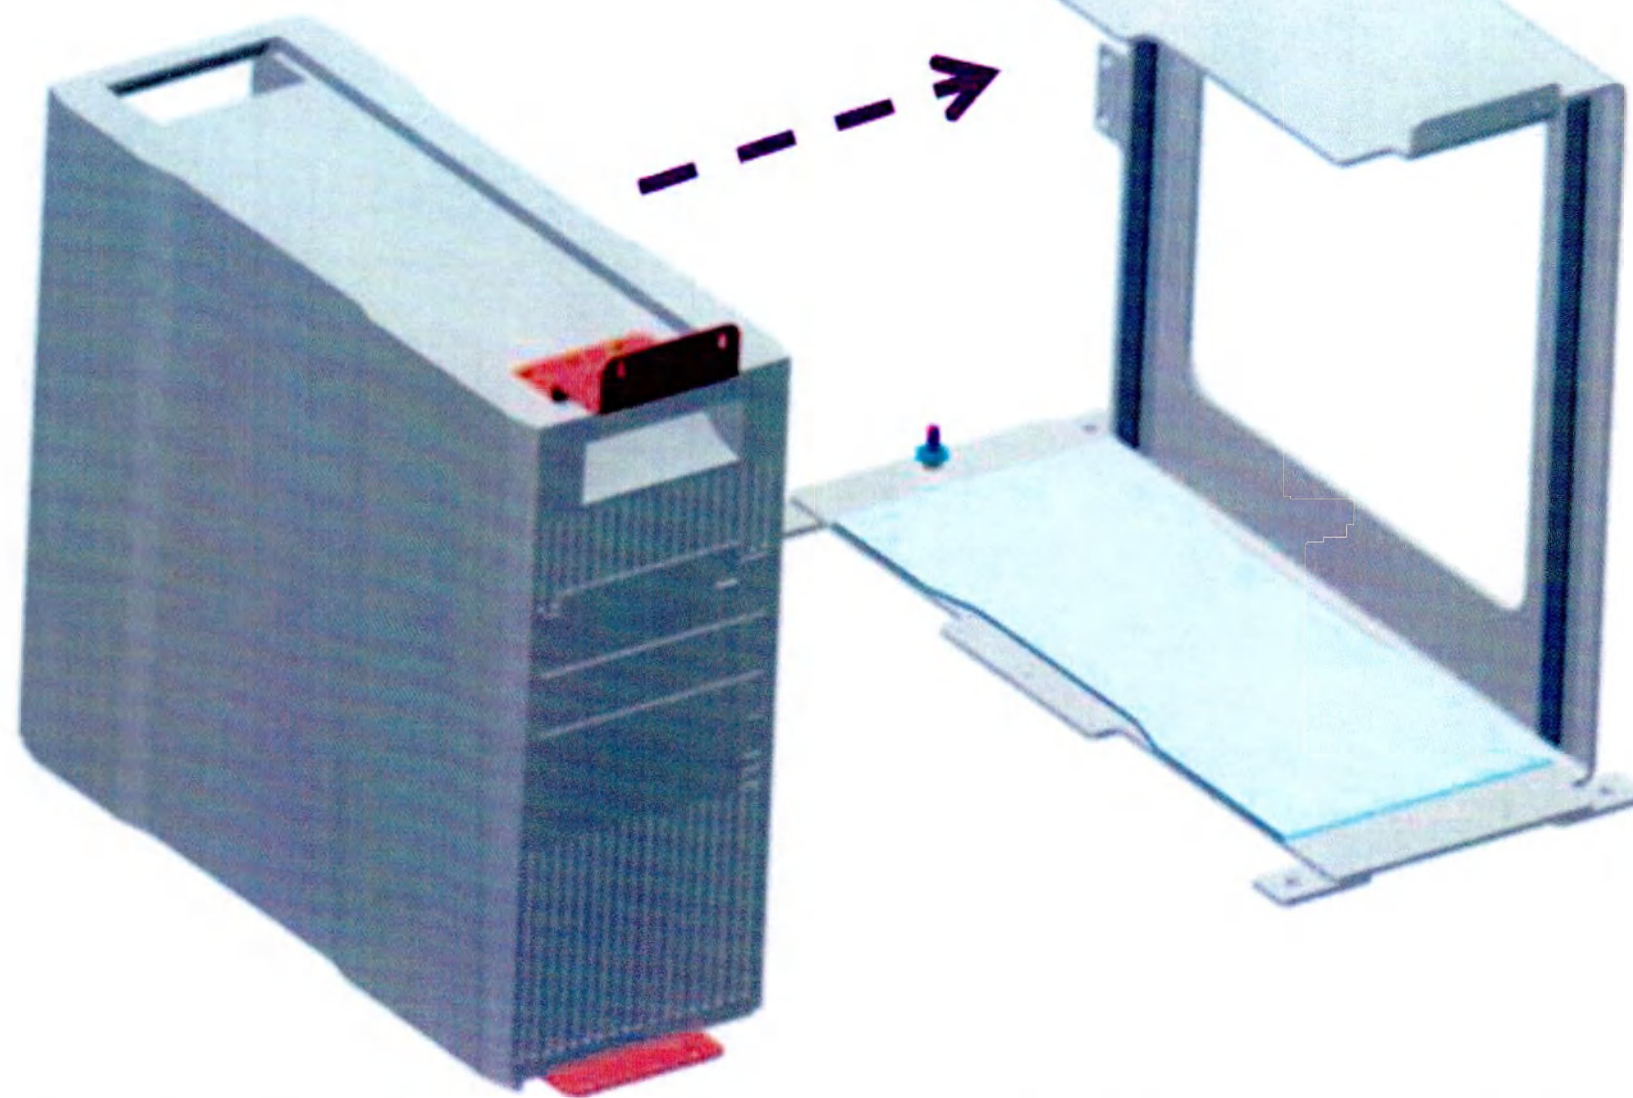


Рис. 127. Крепления для установки в мобильный модуль (не более 10 шт.).

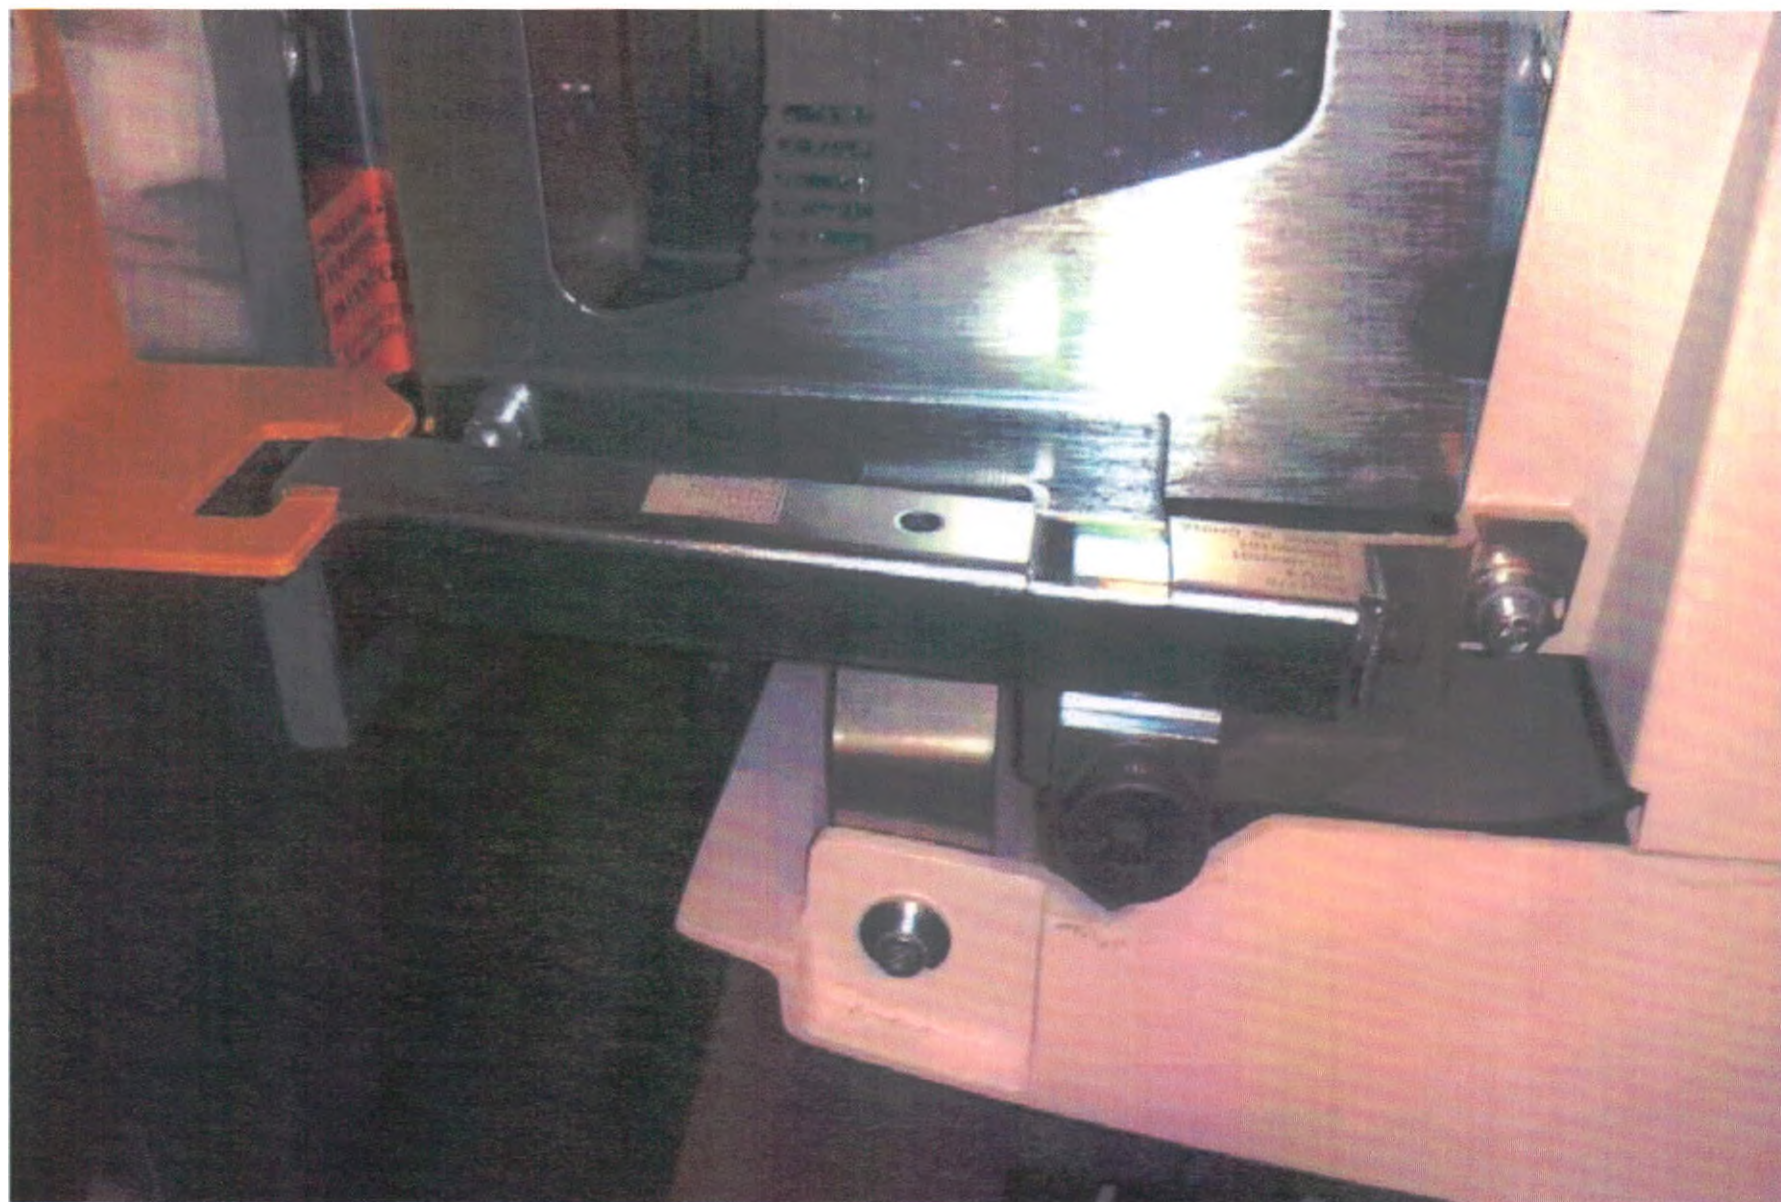


Рис. 128. Крепления для установки в мобильный модуль (не более 10 шт.).



Рис. 129. Комплект программ для реконструкции изображений (не более 10 шт.).

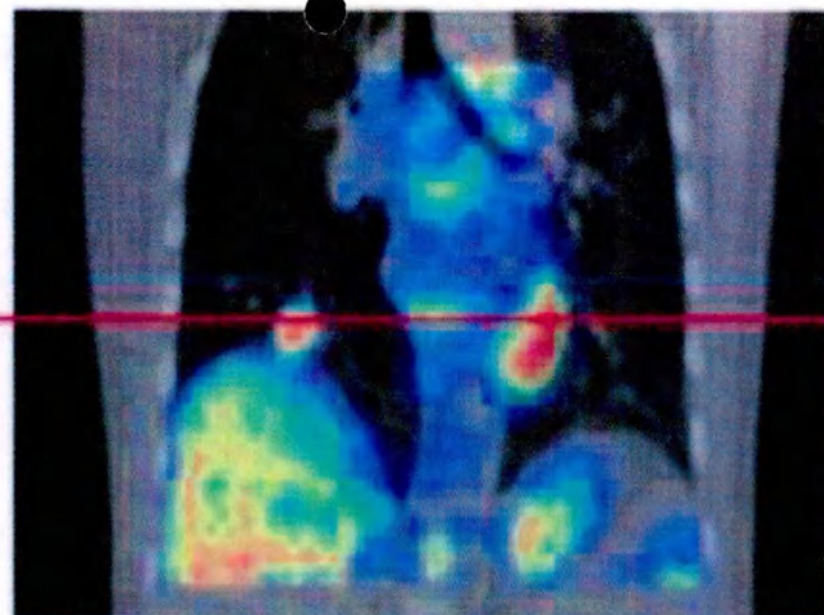
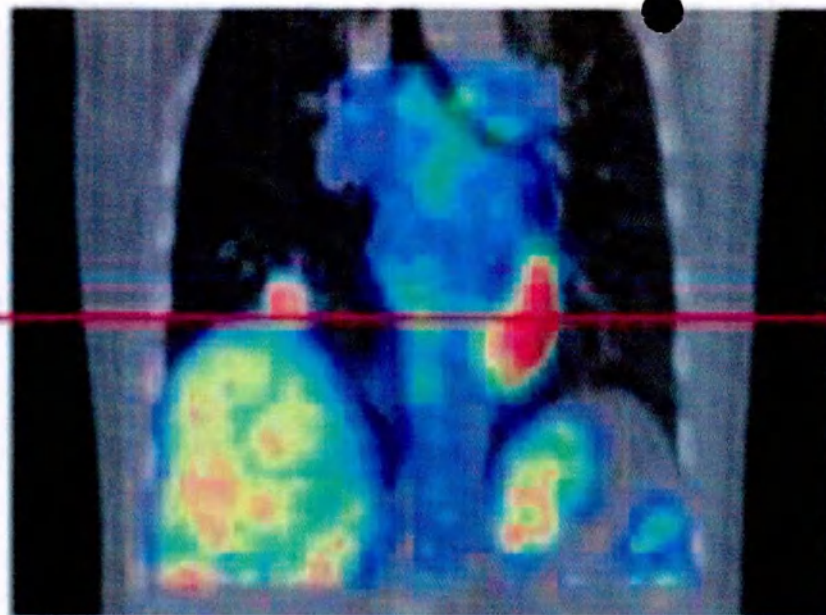


Рис. 130. Комплект программ для реконструкции изображений (не более 10 шт.).

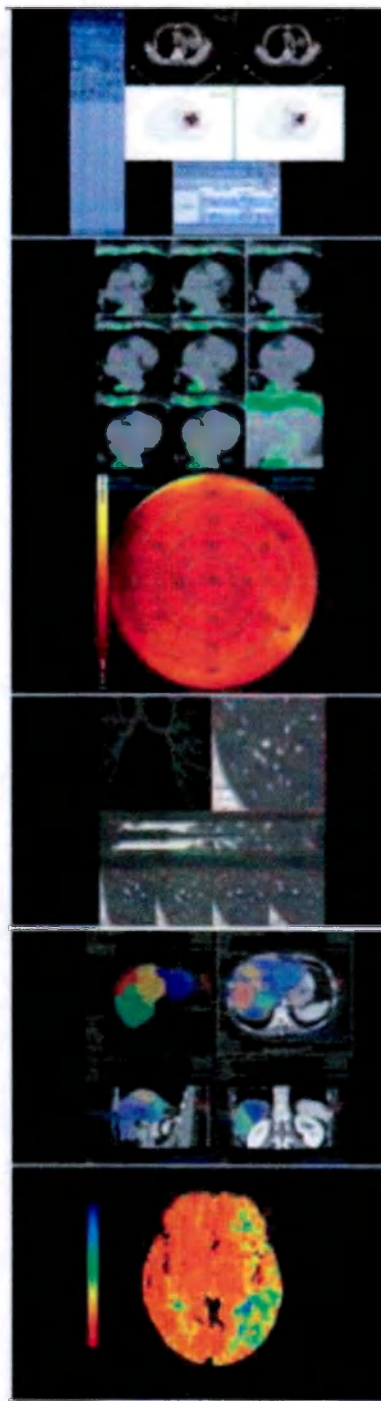


Рис. 131. Комплект программ для реконструкции изображений (не более 10 шт.).

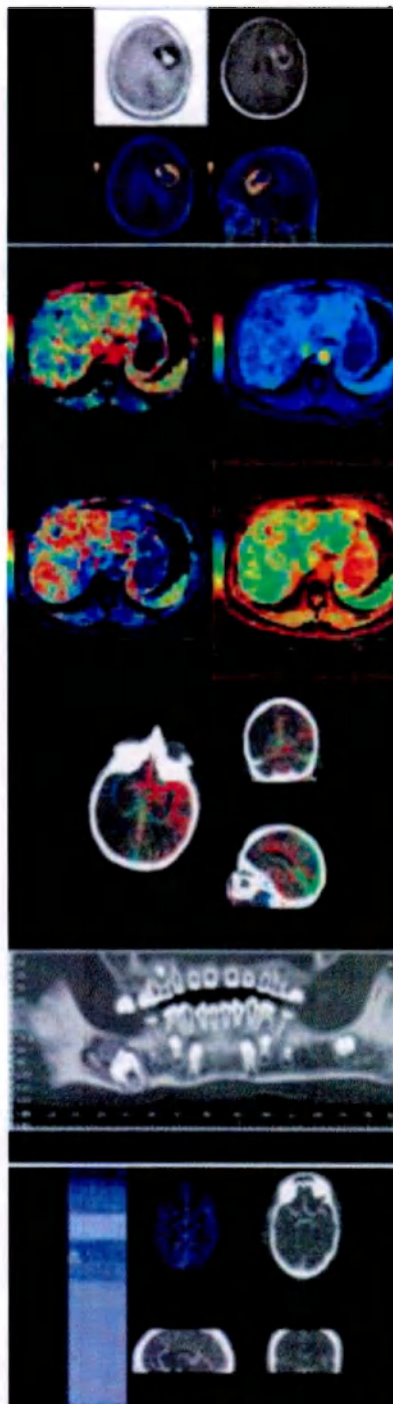


Рис. 132. Комплект программ для реконструкции изображений (не более 10 шт.).

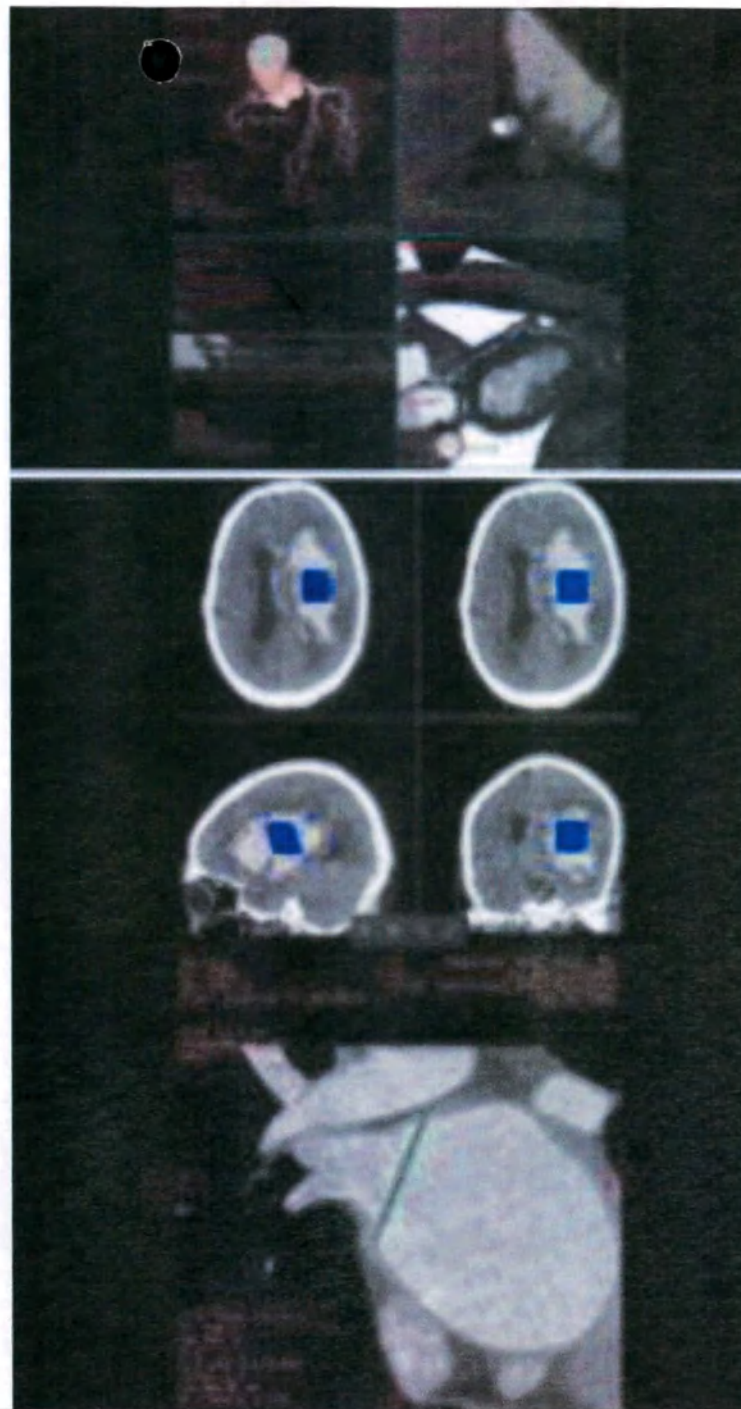


Рис. 133. Комплект программ для реконструкции изображений (не более 10 шт.).

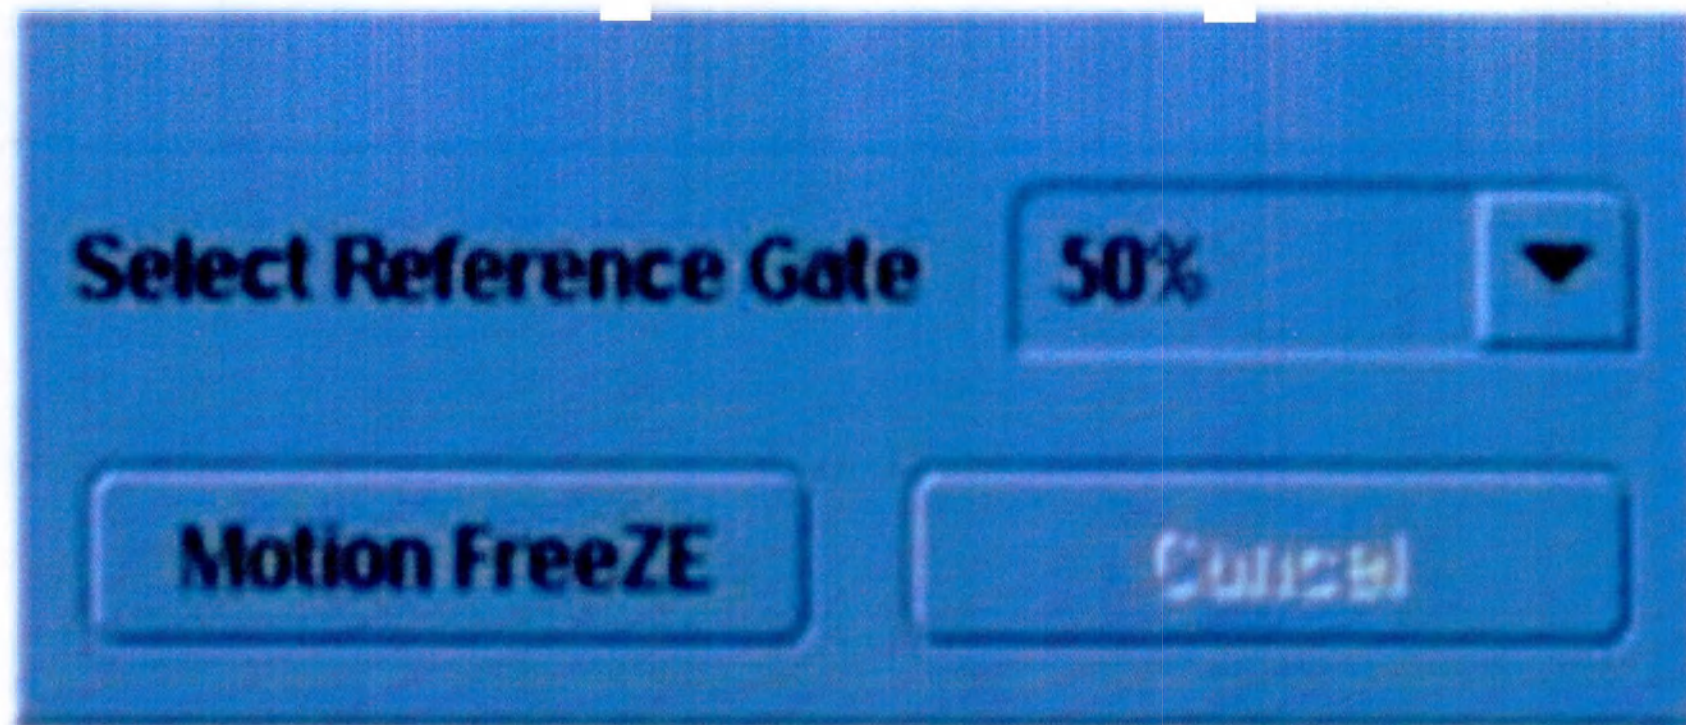


Рис. 134. Комплект программ для реконструкции изображений (не более 10 шт.).

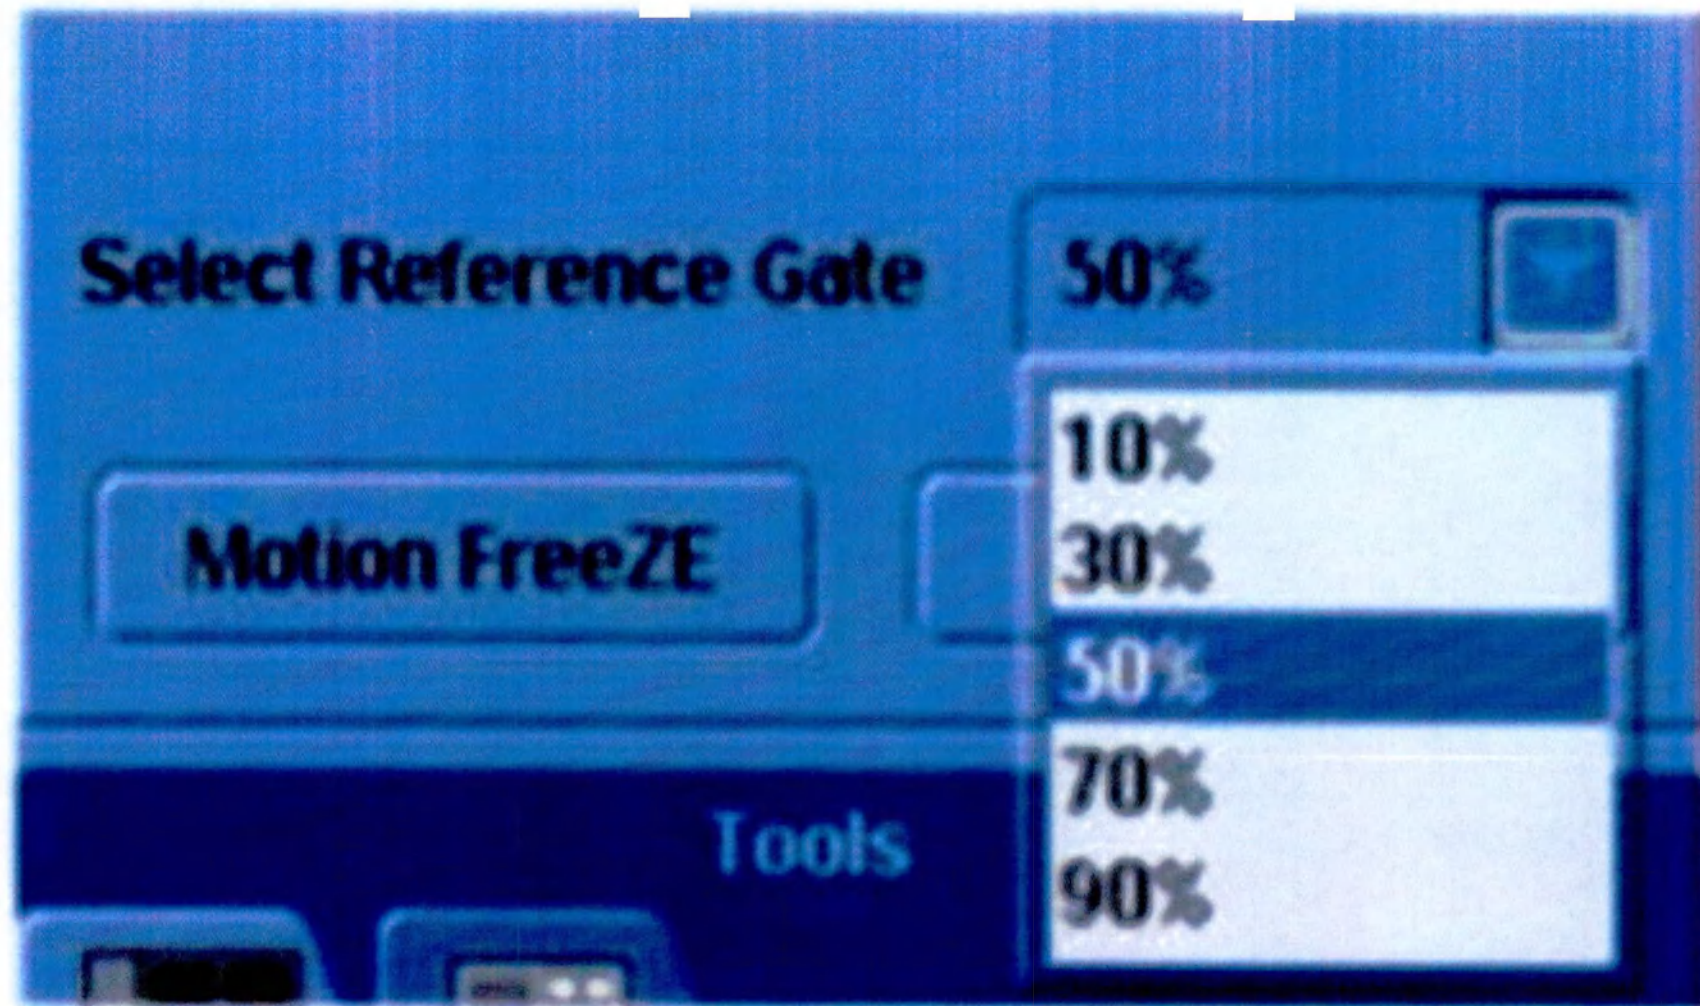


Рис. 135. Комплект программ для реконструкции изображений (не более 10 шт.).

Series	Type	Images	Description	M...	Manu...	MPPS	ArchL...	Tr...
404	STATIC	153	+SAu-Static	PT	GE M...			
404	PROSP	153	Non diagnostic CTAC-Static VPHD-CTAC 3.75 T...	CT	GE M...			
405	STATIC	153	+S-Static	PT	GE M...			
407	STATIC	153	+SAd-Static	PT	GE M...			
408	STATIC	153	+S-Static VPHD	PT	GE M...			
409	STATIC	153	+S-Stress Static Emission	PT	GE M...			
410	STATIC	153	+S-Stress Static VPHD	PT	GE M...			
411	STATIC	153	+S-Stress Static VPHD	PT	GE M...			
903	REPLAY	4	Rest Static Emission	R...	GE M...			

Рис. 136. Комплект программ для реконструкции изображений (не более 10 шт.).

ASiR-V Setup

Ref ASiR-V AR50

Off

On

AR10 10%

AR20 20%

AR30 30%

AR40 40%

AR50 50%



Flip/Rotate

None

FLR

FTB

FTB/FLR

OK

Рис. 137. Комплект программ для реконструкции изображений (не более 10 шт.).



Рис. 138. Комплект программ для реконструкции изображений (не более 10 шт.).



Рис. 139. Комплект программ Elite Package для реконструкции изображений (не более 10 шт.).

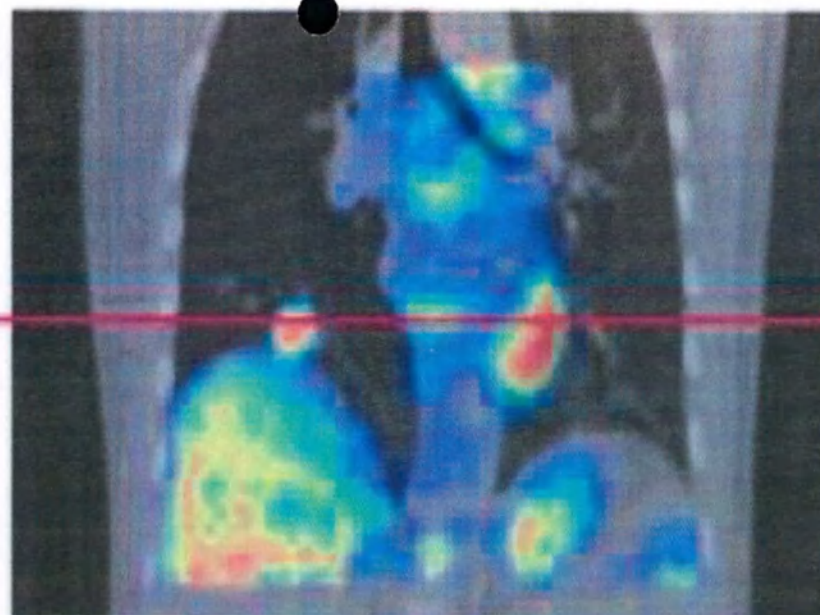
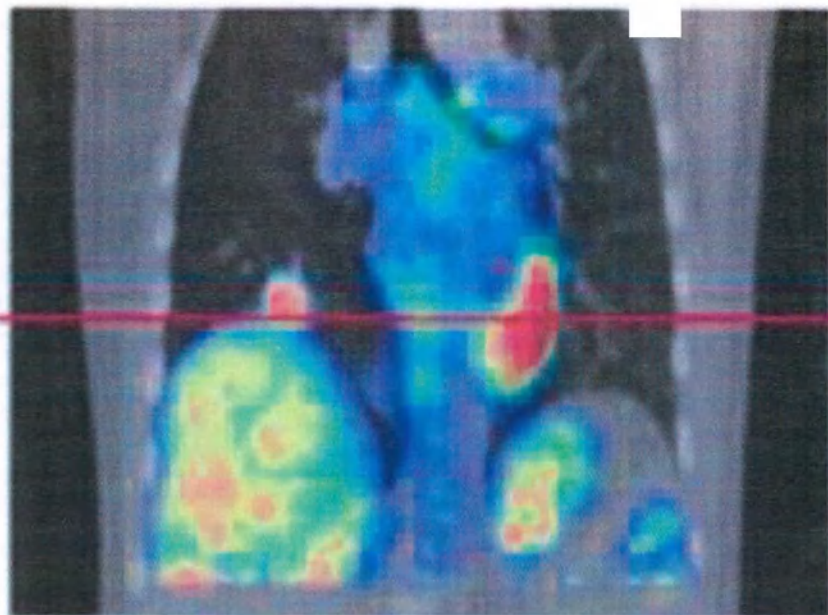


Рис. 140. Комплект программ Elite Package для реконструкции изображений (не более 10 шт.).

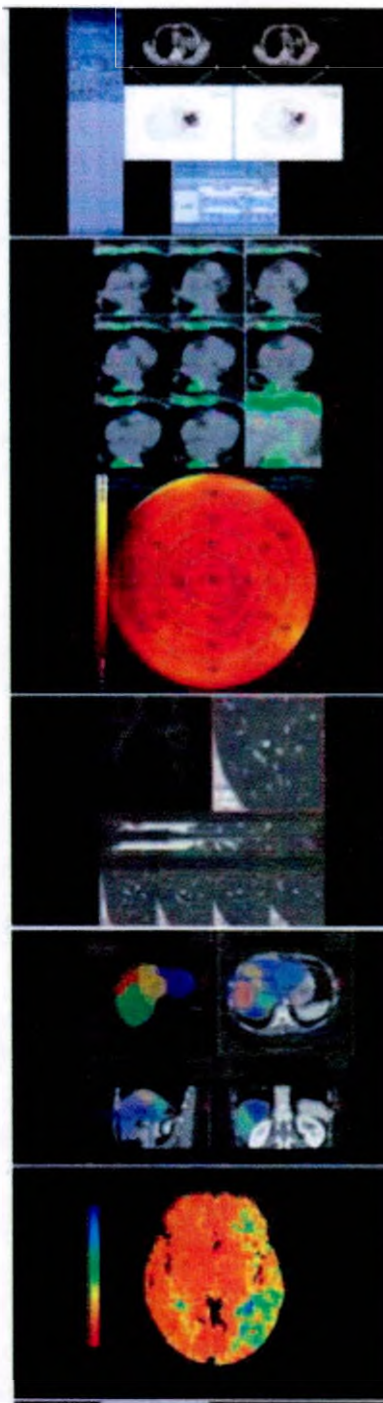


Рис. 141. Комплект программ Elite Package для реконструкции изображений (не более 10 шт.)..

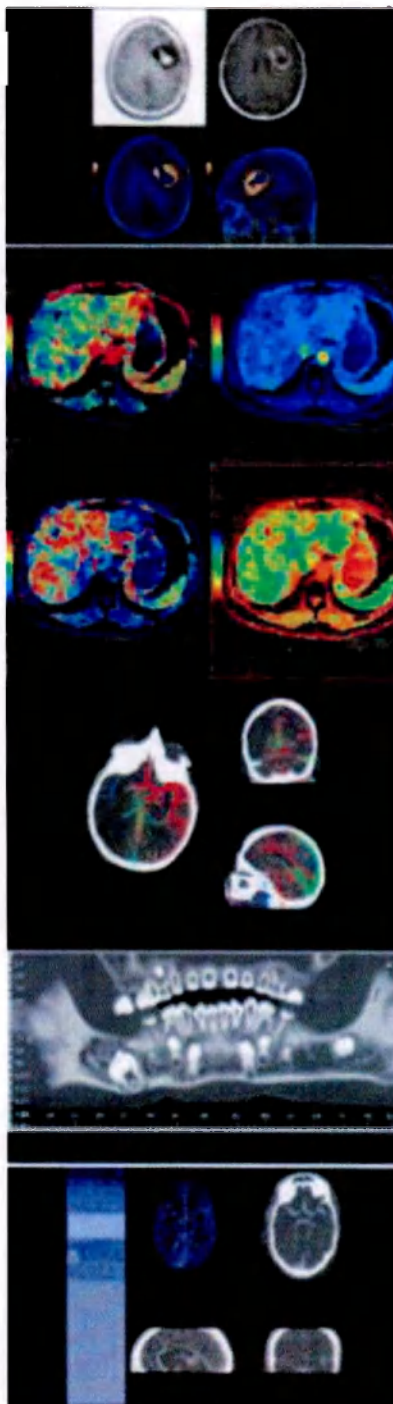


Рис. 142. Комплект программ Elite Package для реконструкции изображений (не более 10 шт.).

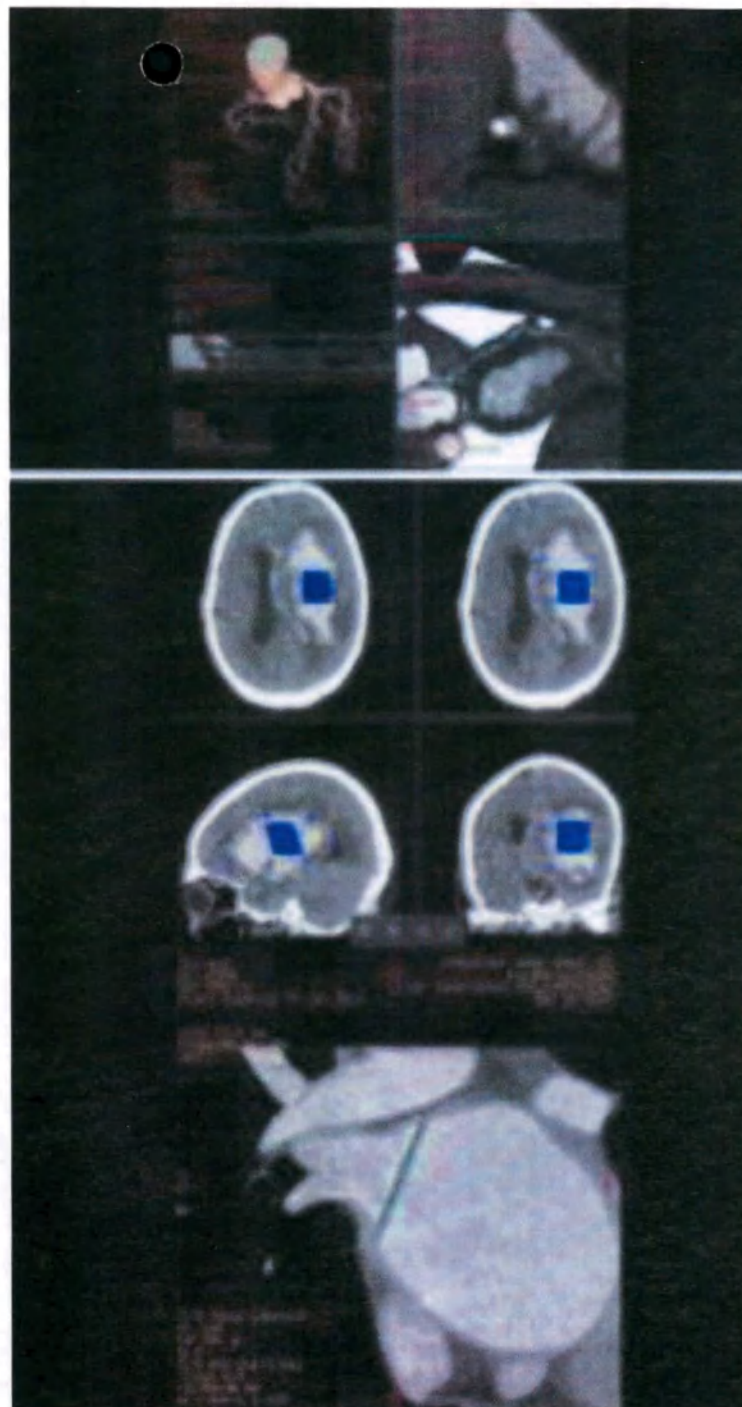


Рис. 143. Комплект программ Elite Package для реконструкции изображений (не более 10 шт.)..

Series	Type	Images	Description	ML	Manu	MPPS	ArchL	Tr...
404	STATIC	153	+SAu-Static	PT	GE M...			
404	PROSP	153	Non diagnostic CTAC-Static VPHD-CTAC 3.75 T...	CT	GE M...			
405	STATIC	153	+S-Static	PT	GE M...			
407	STATIC	153	+SAd-Static	PT	GE M...			
408	STATIC	153	+S-Static VPHD	PT	GE M...			
409	STATIC	153	+S-Stress Static Emission	PT	GE M...			
410	STATIC	153	+S-Stress Static VPHD	PT	GE M...			
411	STATIC	153	+S-Stress Static VPHD	PT	GE M...			
903	REPLAY	4	Rest Static Emission	R...	GE M...			

Рис. 144. Комплект программ Elite Package для реконструкции изображений (не более 10 шт.)..

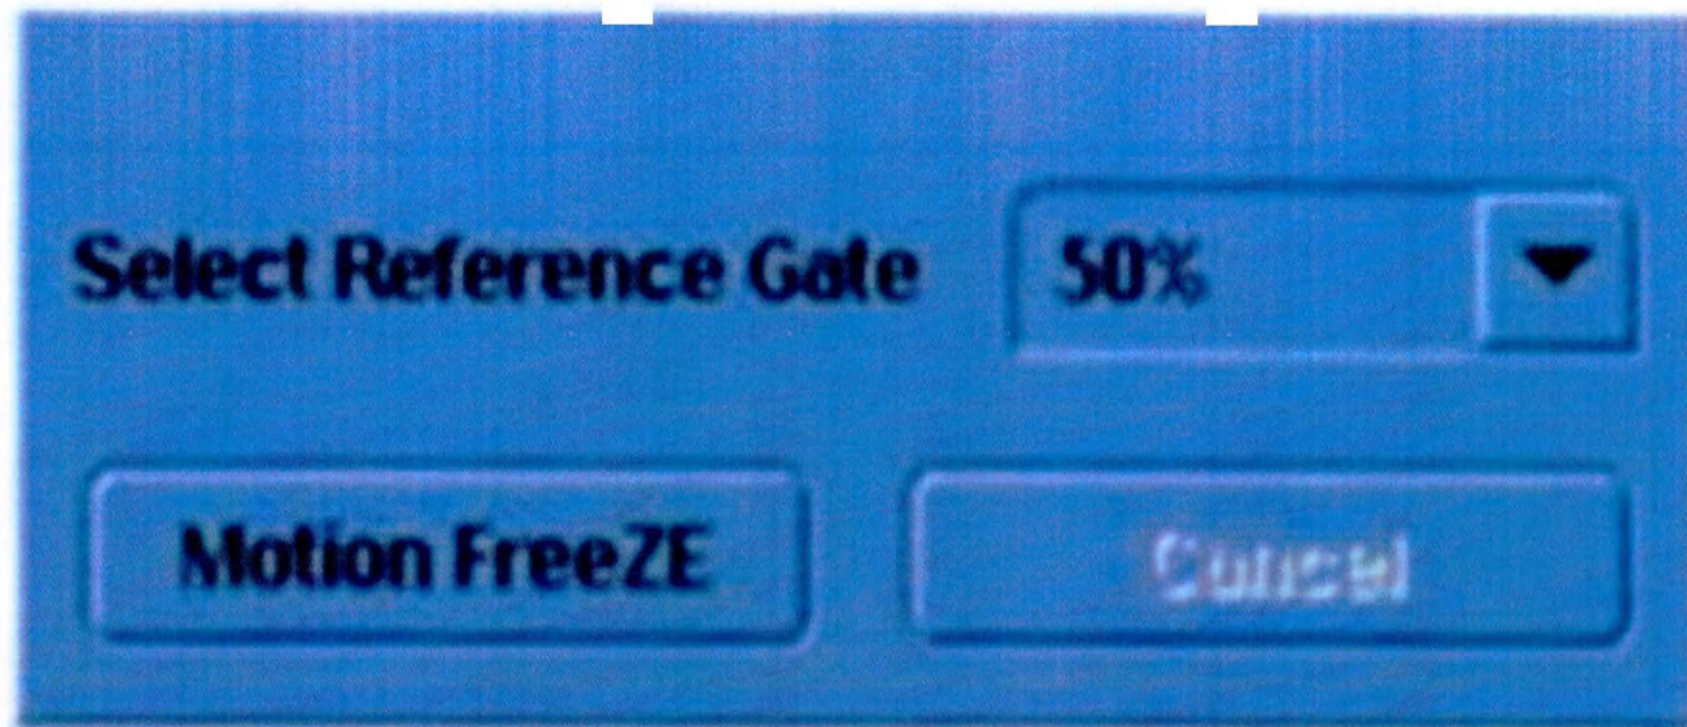


Рис. 145. Комплект программ Elite Package для реконструкции изображений (не более 10 шт.)..

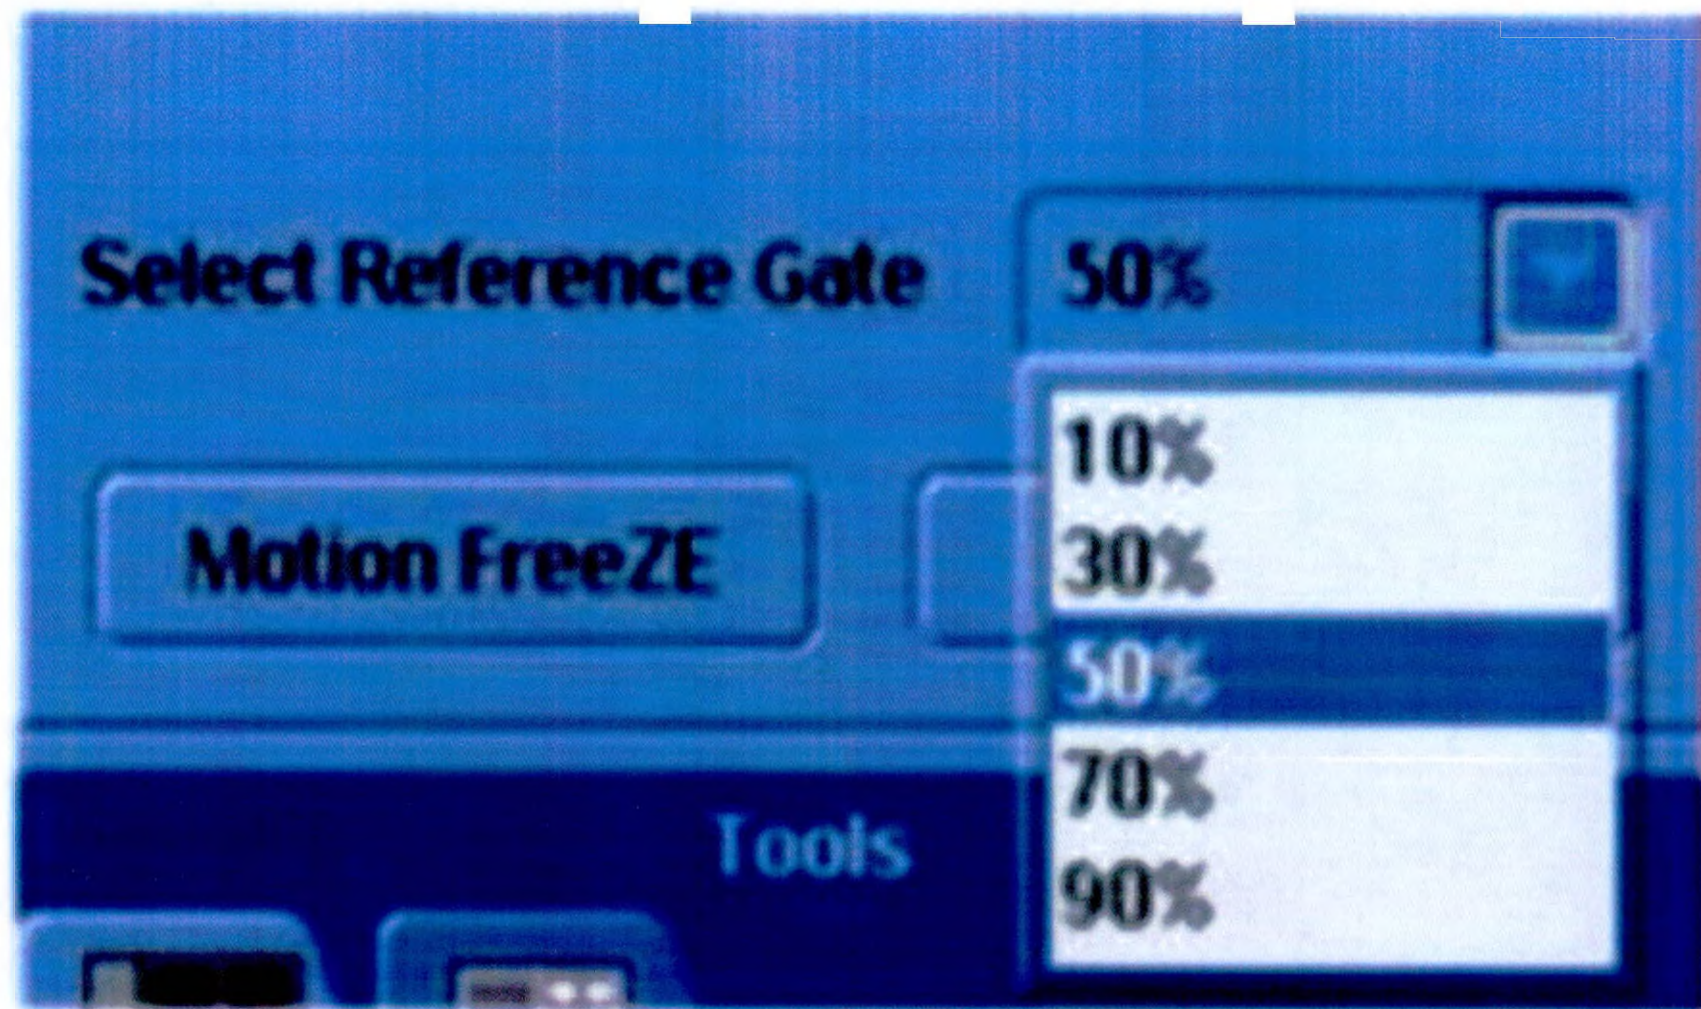


Рис. 146. Комплект программ Elite Package для реконструкции изображений (не более 10 шт.).

ASiR-V Setup

Ref ASiR-V AR50

Off

On

AR10 10%

AR20 20%

AR30 30%

AR40 40%

AR50 50%



Flip/Rotate

None

FLR

FTB

FTB/FLR

OK

Рис. 147. Комплект программ Elite Package для реконструкции изображений (не более 10 шт.).

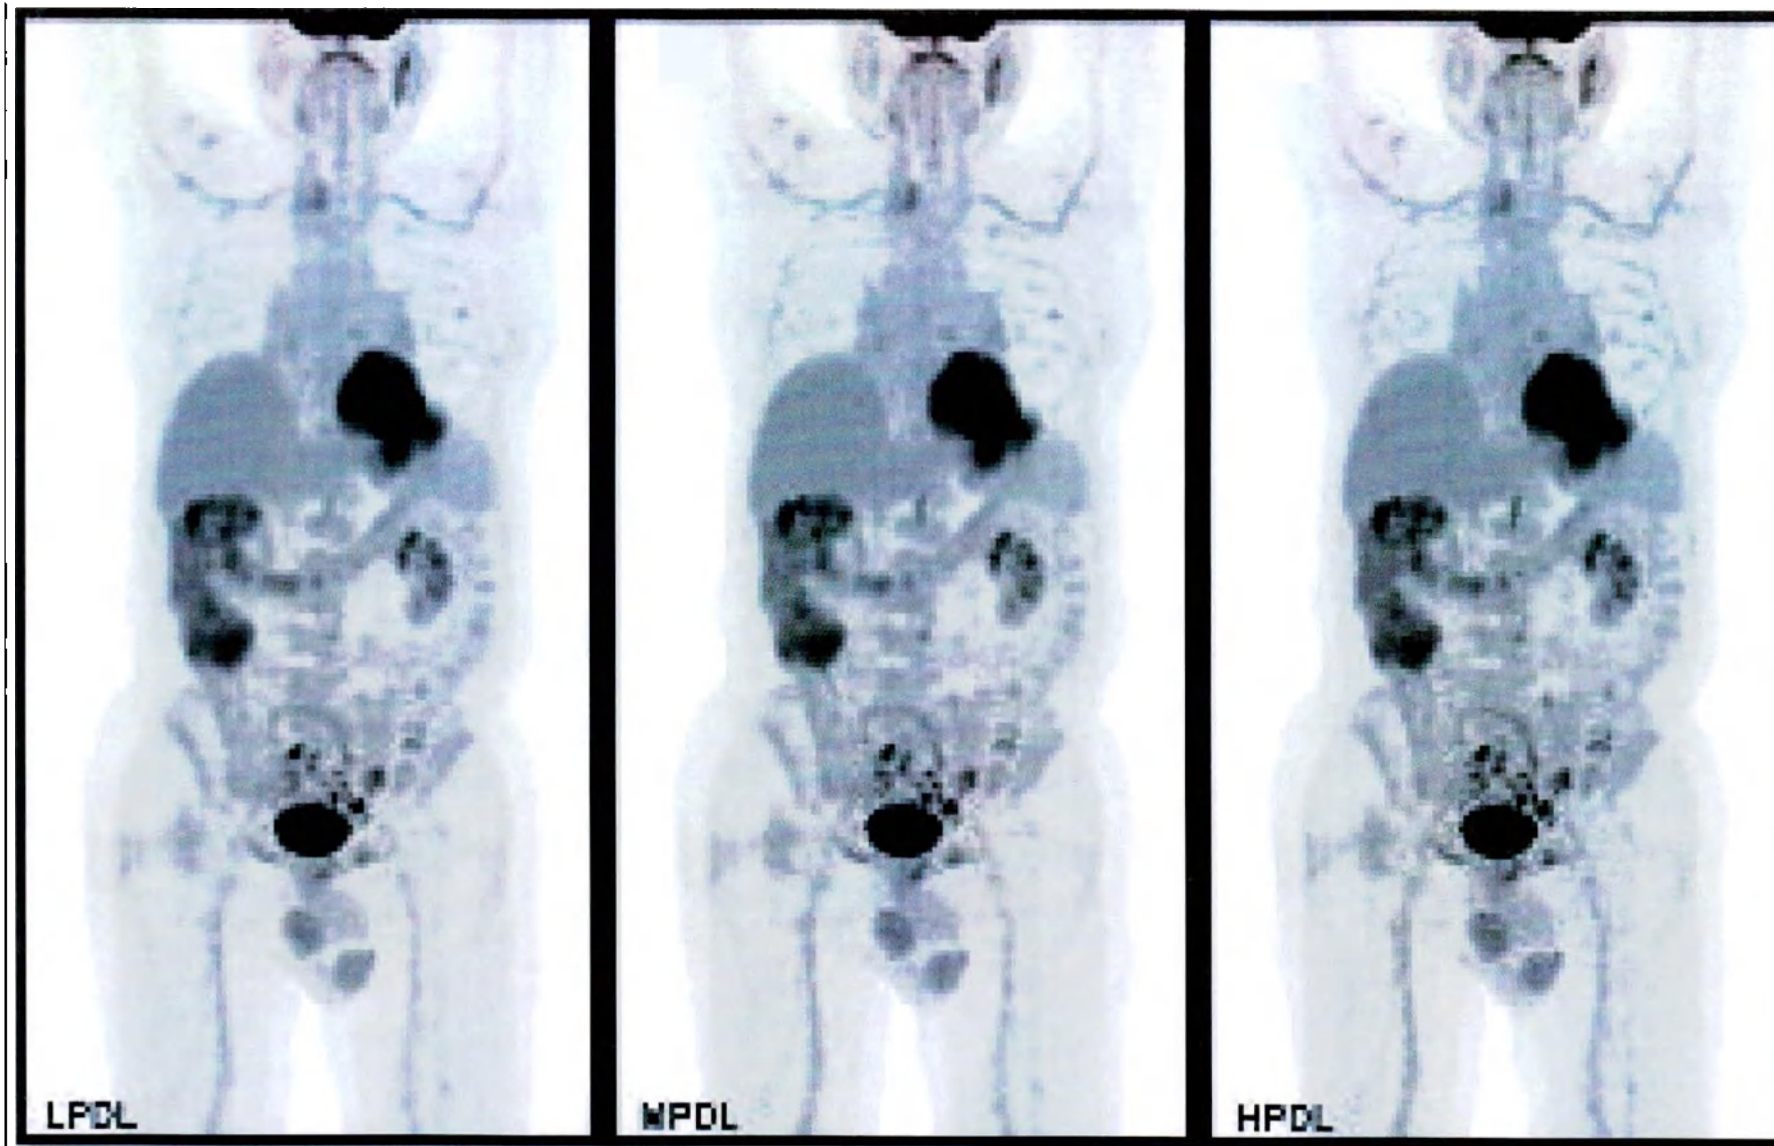


Рис. 148. Комплект программ Elite Package для реконструкции изображений (не более 10 шт.).

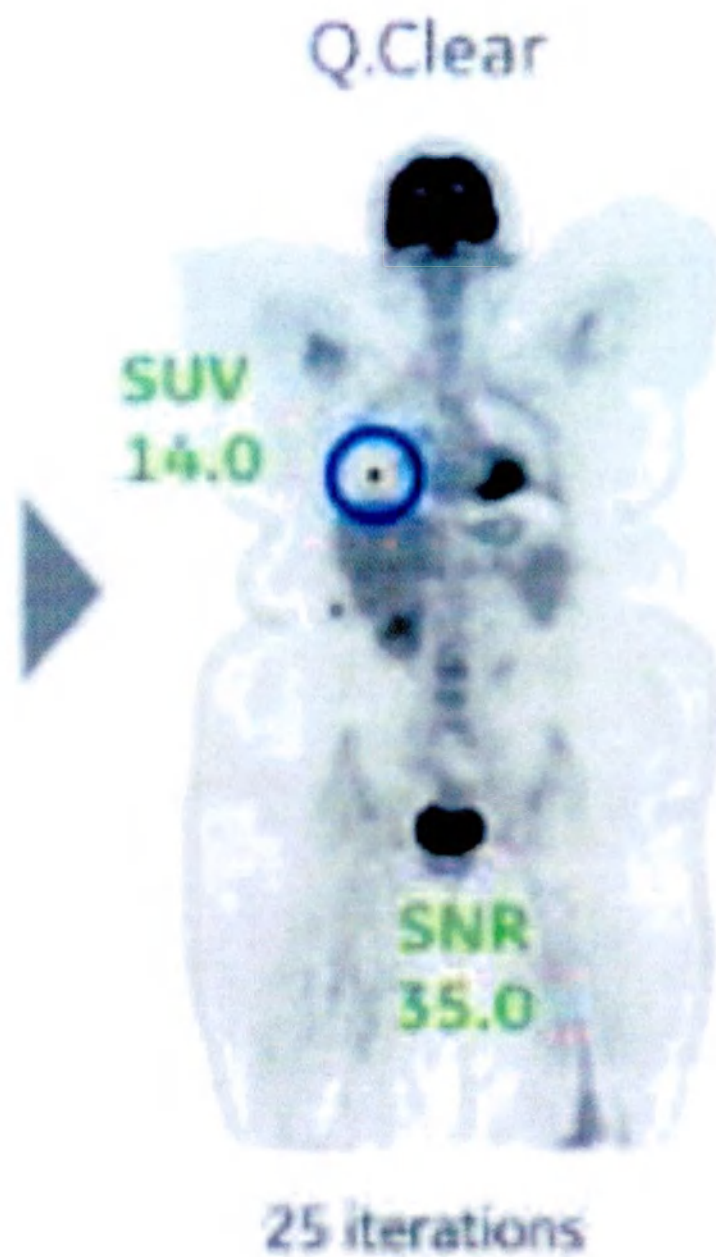


Рис. 150. Программный пакет Q.Clear для итеративного восстановления ПЭТ изображений (не более 10 шт.)..

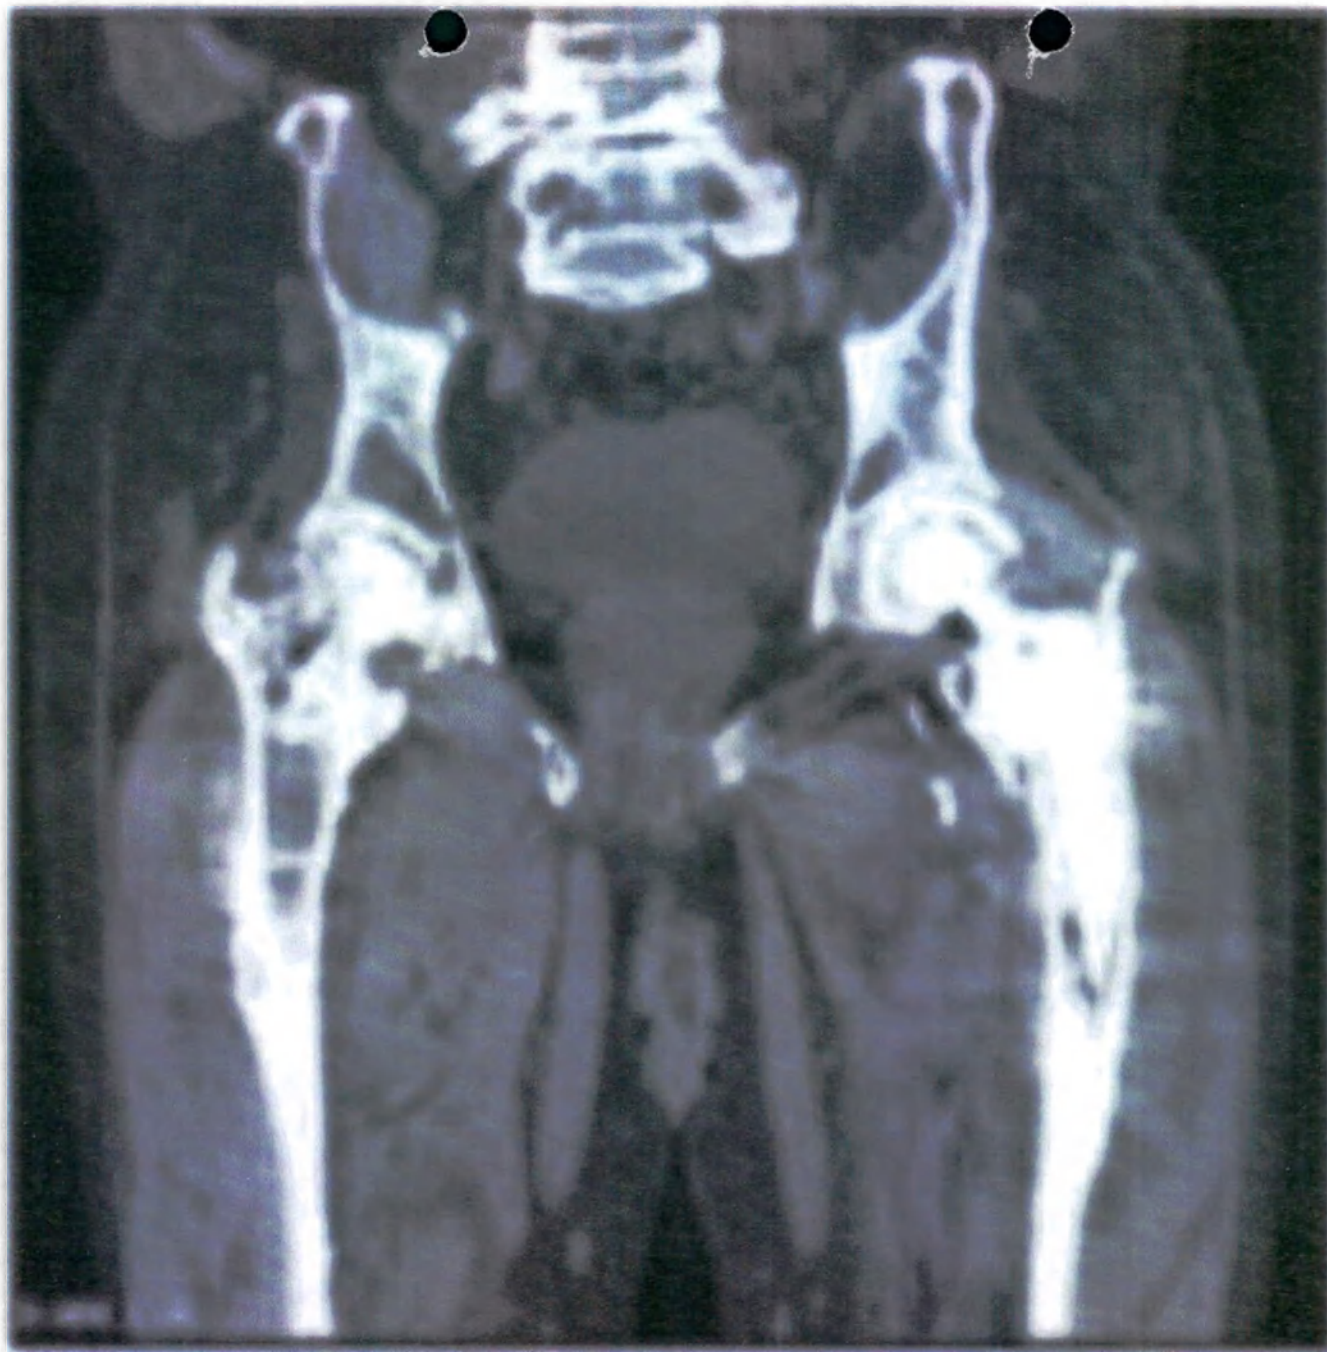


Рис. 151. Программный пакет Smart MAR для подавления артефактов от металлических предметов (не более 10 шт.).



Рис. 152. Программный пакет Q. Freeze (не более 10 шт.)..

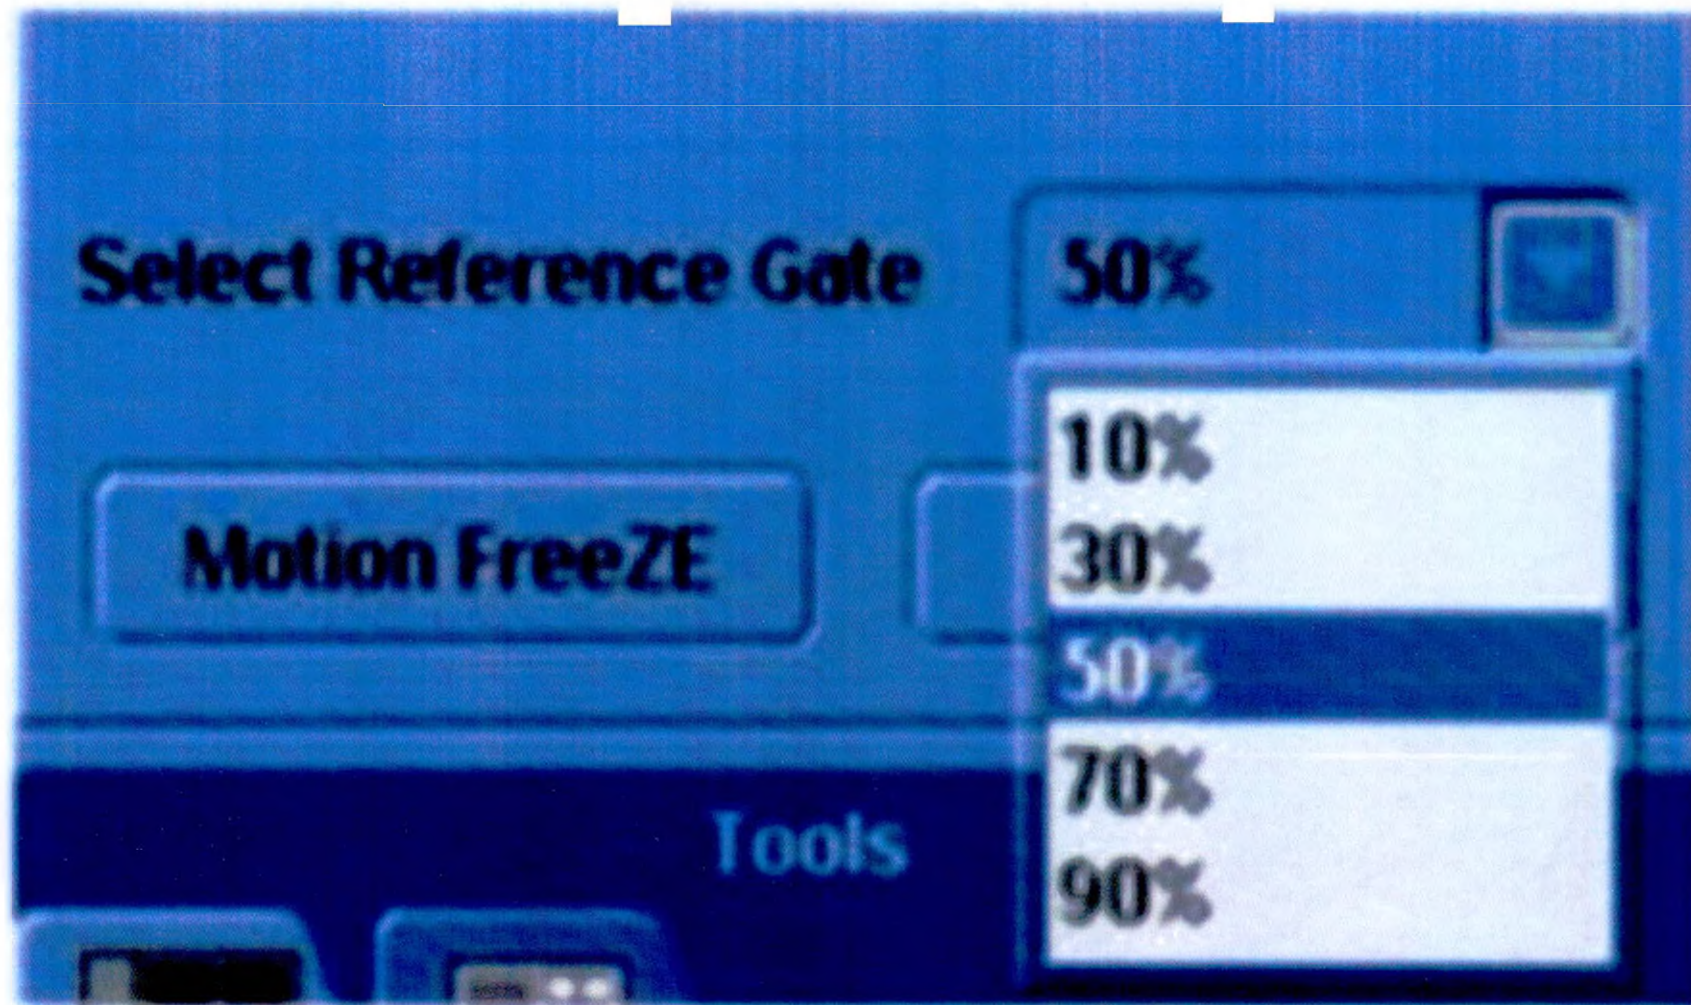


Рис. 153. Программный пакет Q. Freeze (не более 10 шт.)..

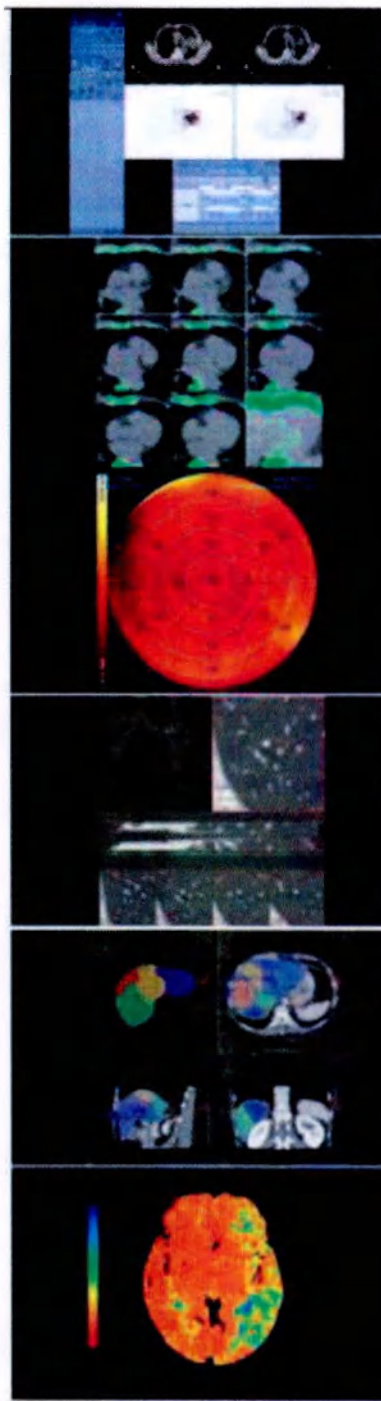


Рис. 154. Программный пакет Q. Static (не более 10 шт.).

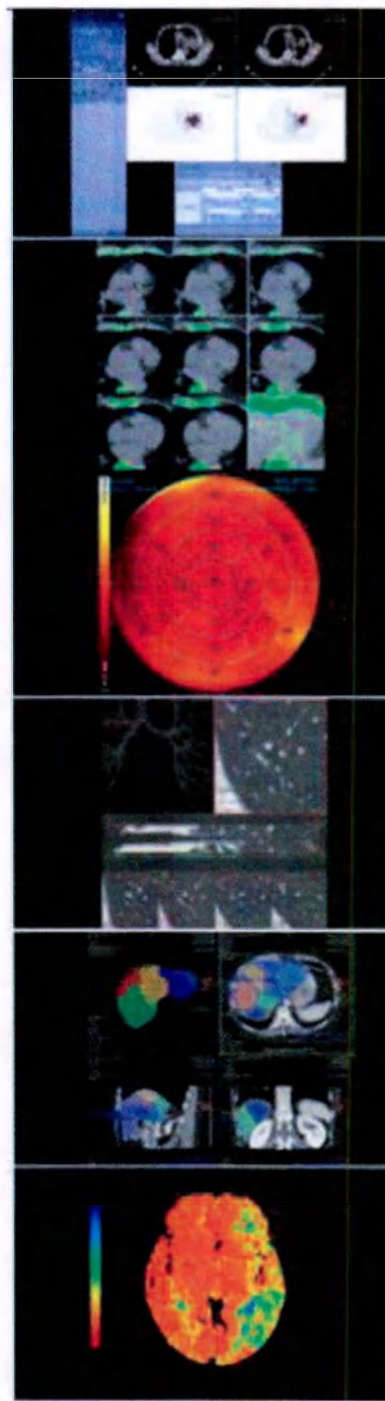


Рис. 155. Программный пакет Q. Static (не более 10 шт.).

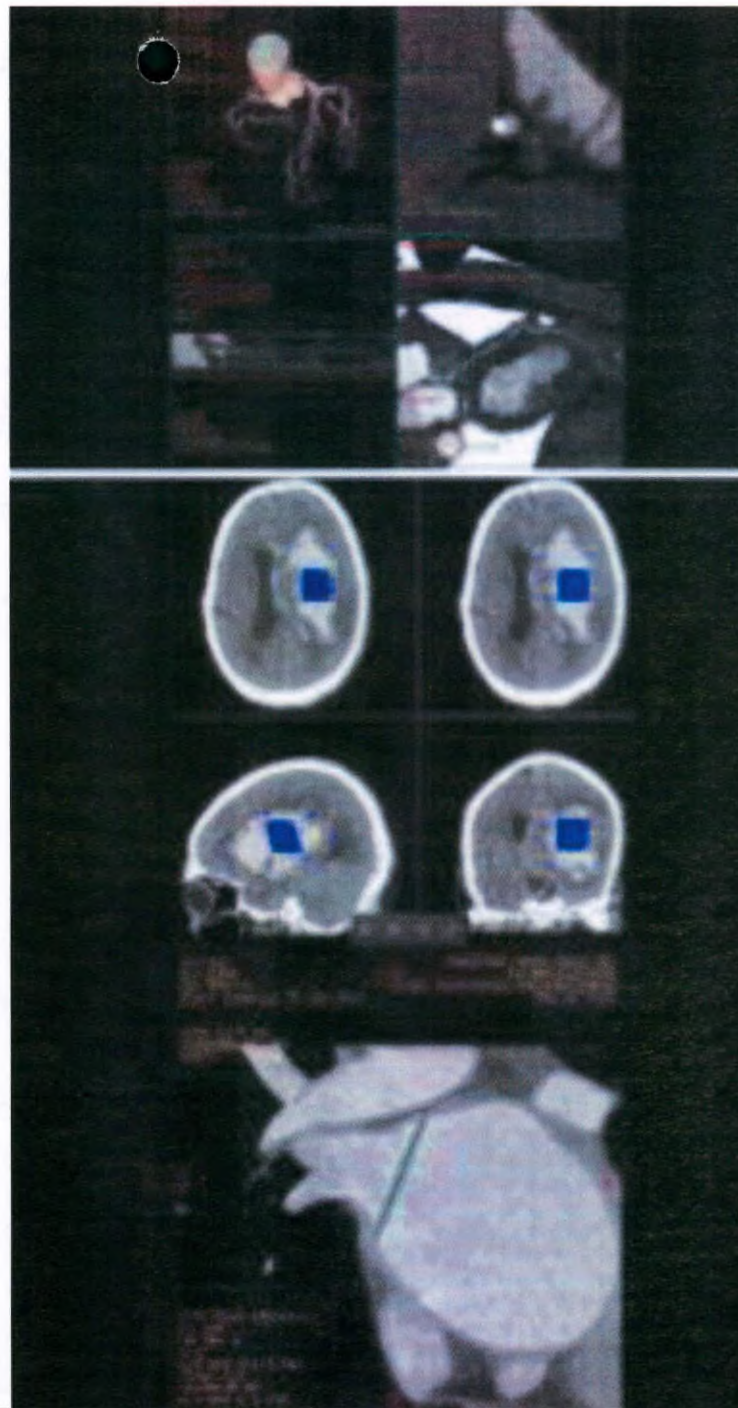


Рис. 157. Программный пакет Q. Static (не более 10 шт.).



Рис. 158. Программный пакет Motion Free для цифровой синхронизации ПЭТ (не более 10 шт.).

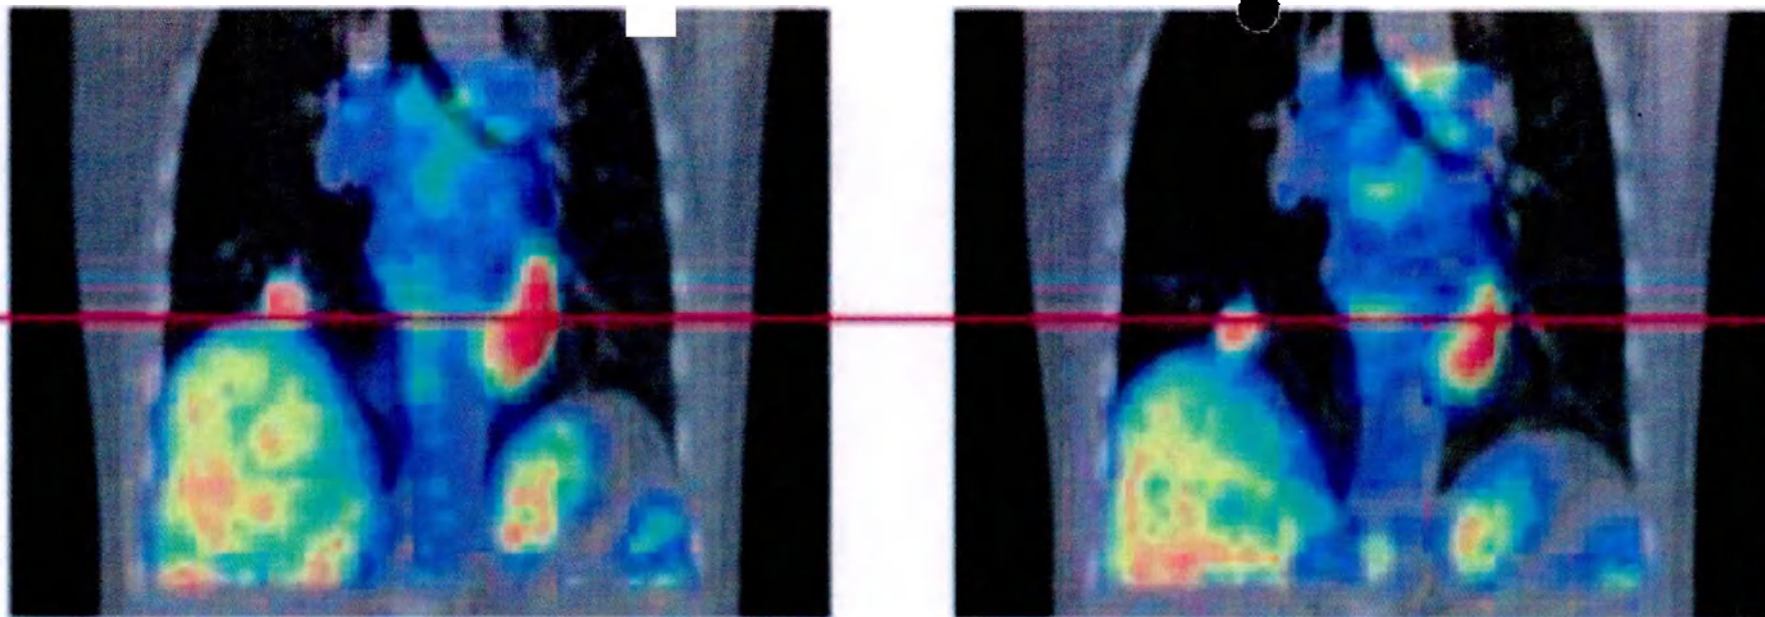


Рис. 159. Программный пакет Motion Free для цифровой синхронизации ПЭТ (не более 10 шт.).

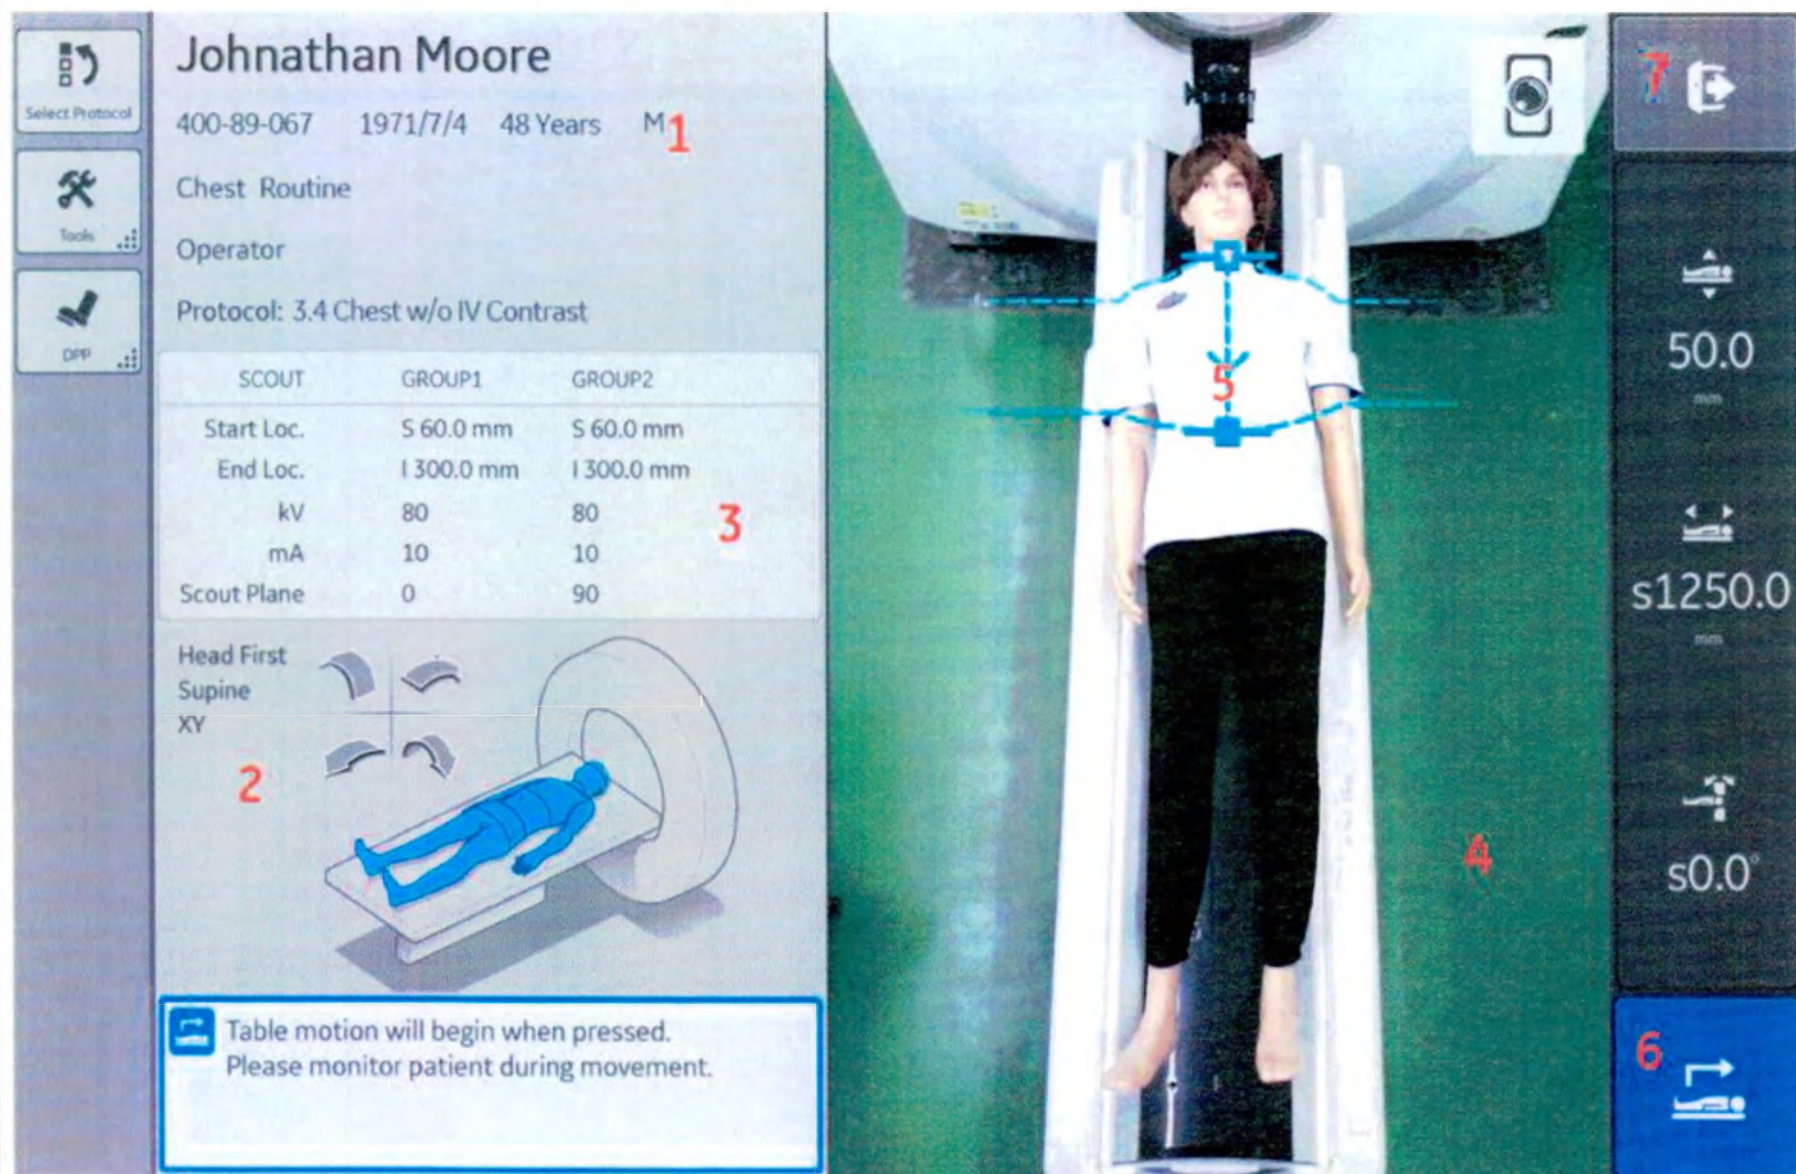


Рис. 160. Программный пакет Auto-Positioning (не более 10 шт.).



Рис. 161. Камера глубины для автоматического позиционирования пациента (не более 5 шт.)

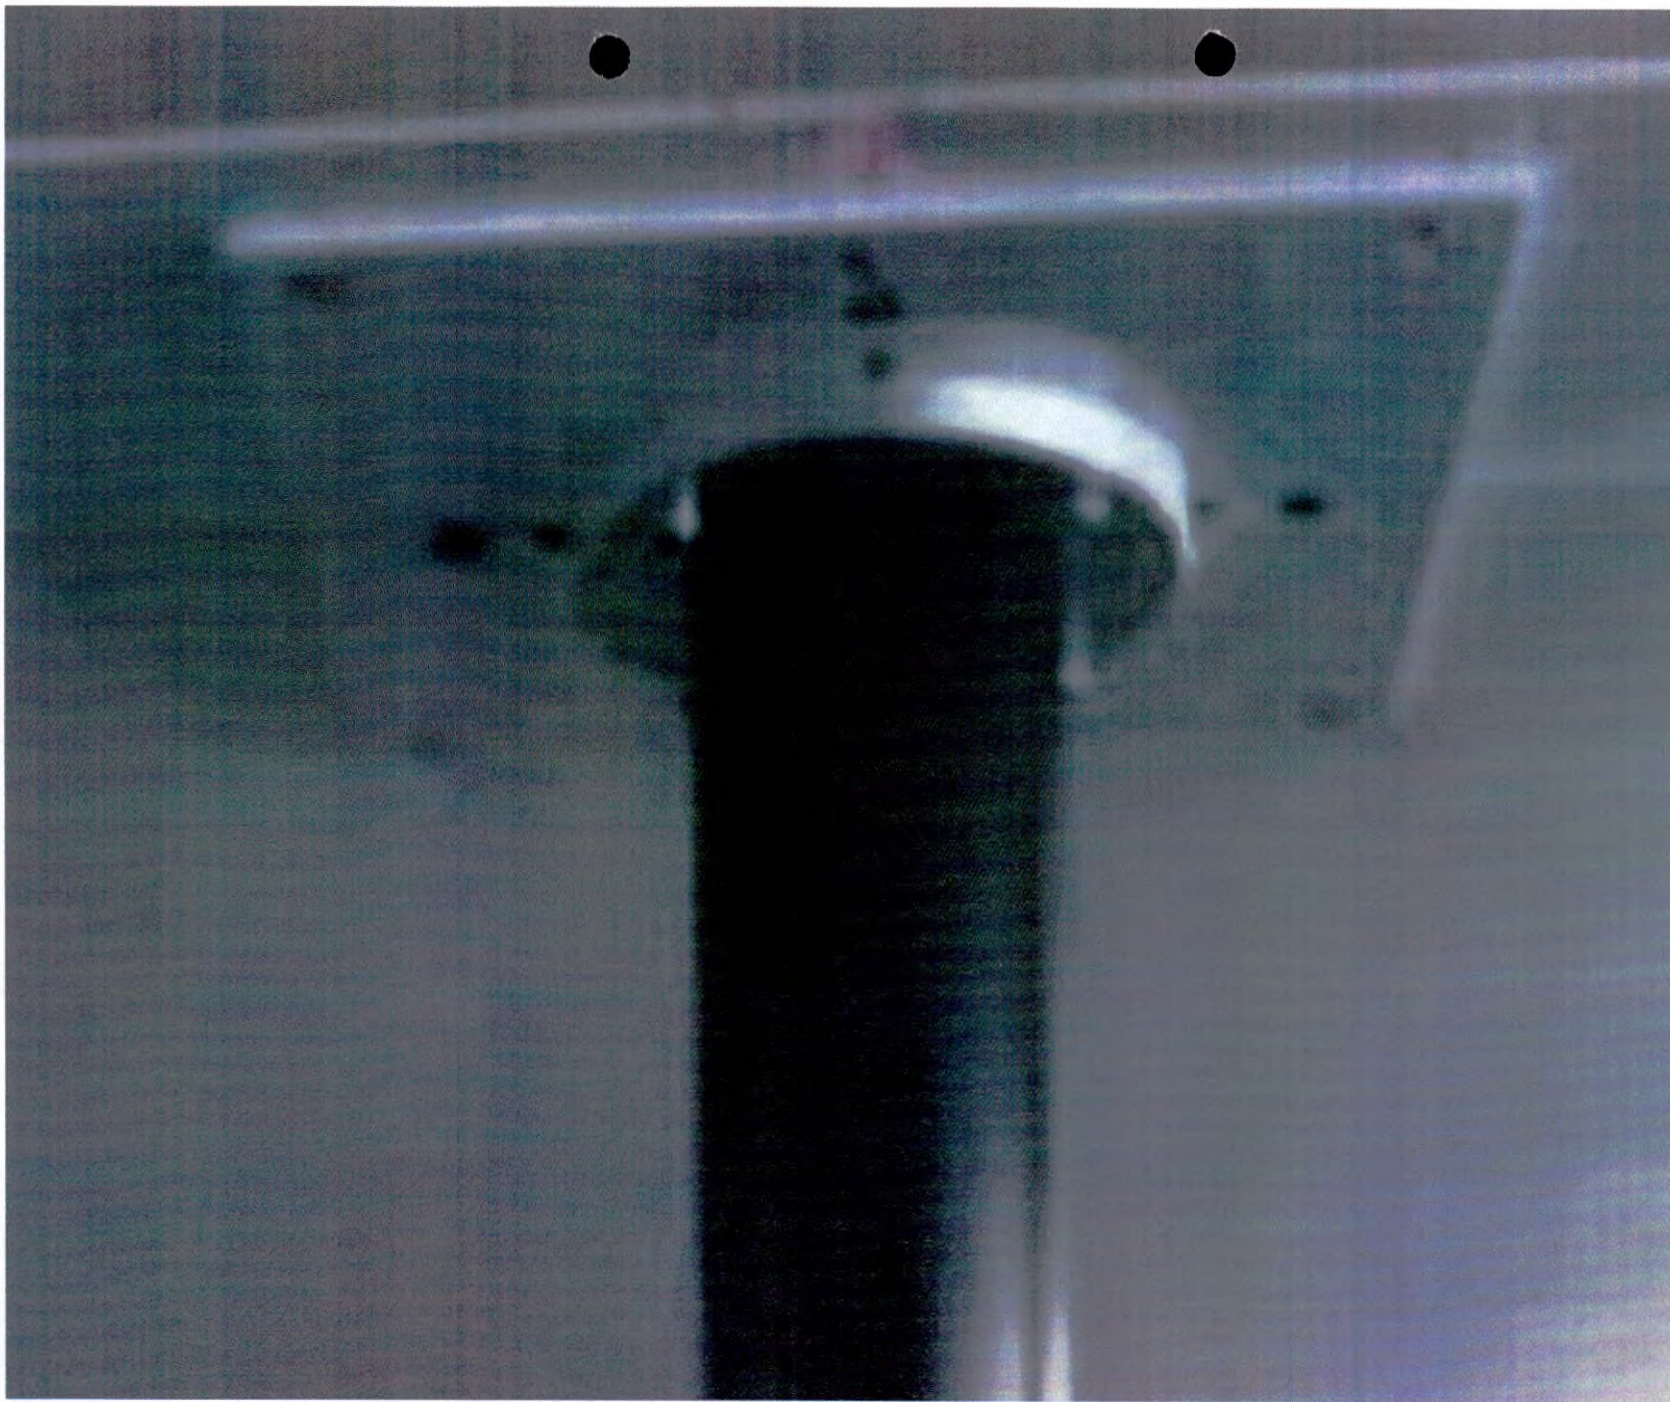


Рис. 162. Крепление для камеры глубины Xtream для автоматического позиционирования пациента

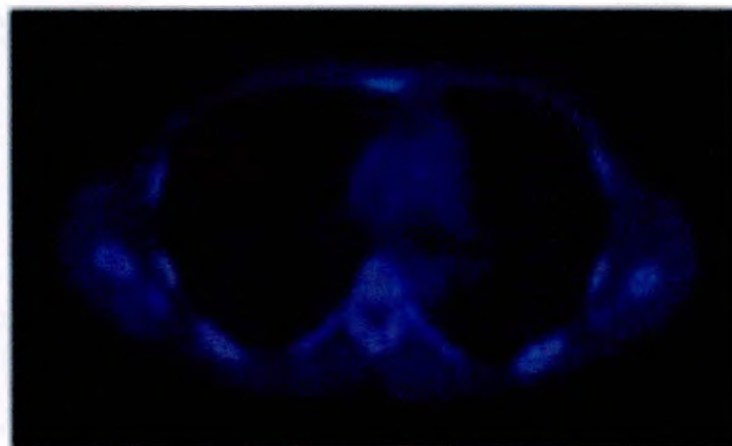
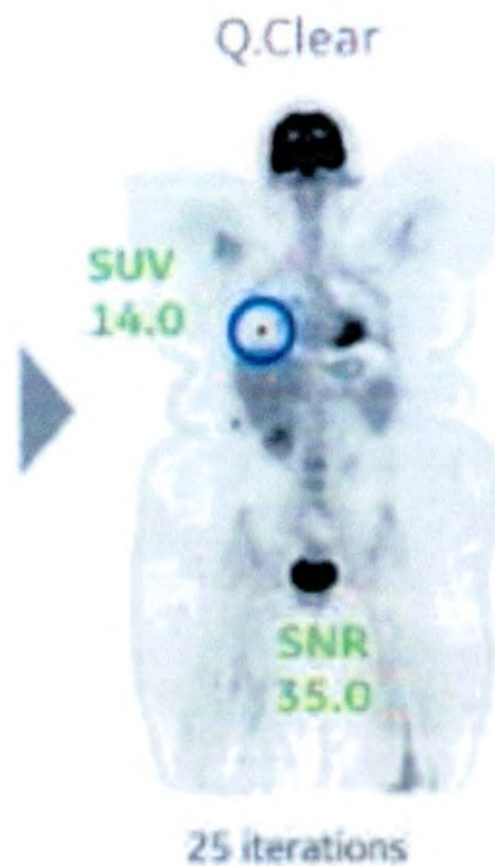


Рис. 163. Программный пакет Q.AC (не более 10 шт.).

Series	Type	Images	Description	ML	Manu...	MPPS	ArchL...	Tr...
404	STATIC	153	+S/nu-Static	PT	GE M...			
404	PROSP	153	Non diagnostic CTAC-Static VPHD-CTAC 3.75 T...	CT	GE M...			
405	STATIC	153	+S-Static	PT	GE M...			
407	STATIC	153	+SAd-Static	PT	GE M...			
408	STATIC	153	+S-Static VPHD	PT	GE M...			
409	STATIC	153	+S-Stress Static Emission	PT	GE M...			
410	STATIC	153	+S-Stress Static VPHD	PT	GE M...			
411	STATIC	153	+S-Stress Static VPHD	PT	GE M...			
903	REPLAY	4	Rest Static Emission	R...	GE M...			

Рис. 164. Программный пакет Q.AC (не более 10 шт.).

ASIR-V Setup

Ref ASIR-V AR50

Off

On

AR10 10%

AR20 20%

AR30 30%

AR40 40%

AR50 50%



Flip/Rotate

None

FLR

FTB

FTB/FLR

OK

Рис. 165. Программный пакет ASIR-V (не более 10 шт.).

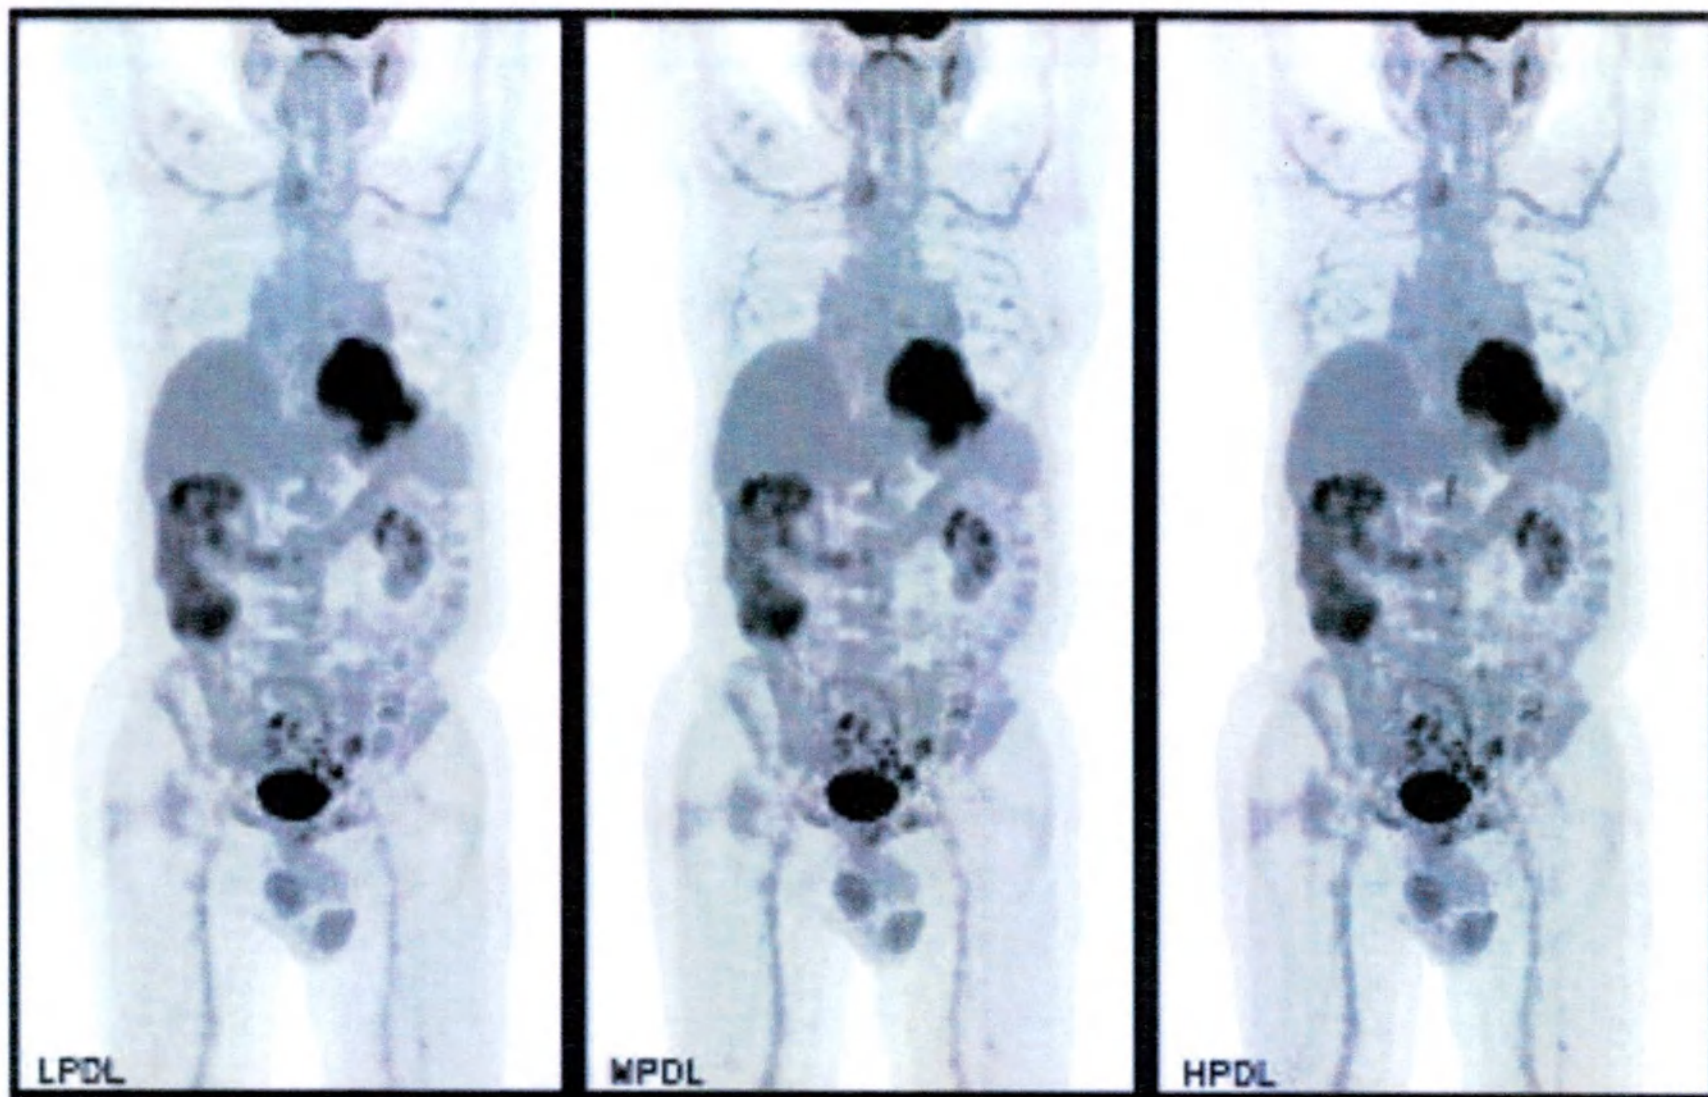


Рис. 166. Программный пакет DLT (не более 10 шт.).

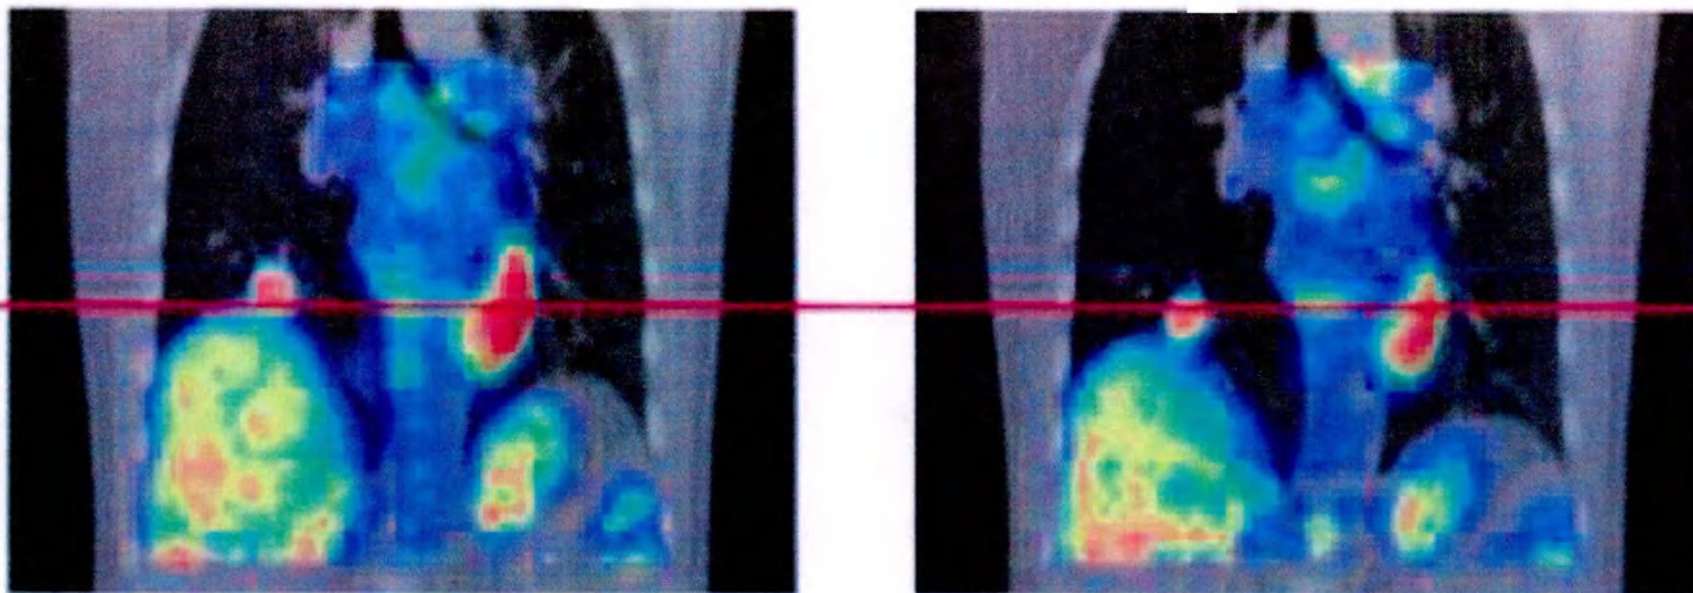


Рис. 167. Программный пакет Motion Match (не более 10 шт.).

Select the desired Image Thickness

Detector Coverage (mm)

40.0

Initial Thickness (mm)

0.05 0.25 0.5

Rotation Time (s)

0.05	0.37	0.4	0.72	0.46	0.97	0.5
0.4	0.7	0.8	0.9	1.0	2.0	

OK Cancel

Рис. 168. Программный пакет 0.35 rotation (не более 10 шт.).

☐ 16x8
 ☒ 8x4
 ☐ 4x2
 ☐ 2x1

Procedure Split Exam

Preset ▼ Reset

Series (1/2): - - Host Selection

Comments:
 Exam Split

Delete All Delete Add ->





Procedure	Images
CT THORAX WITH CONTRAST	0
CT PELVIS WITH CONTRAST	0
CT ABDOMEN W/ CONTRAST	0

Send Preset

Send Browser

Рис. 169. Программный пакет Prospective Exam Split (не более 10 шт.).



Рис. 170. Программный пакет Volume Shuttle (не более 10 шт.).

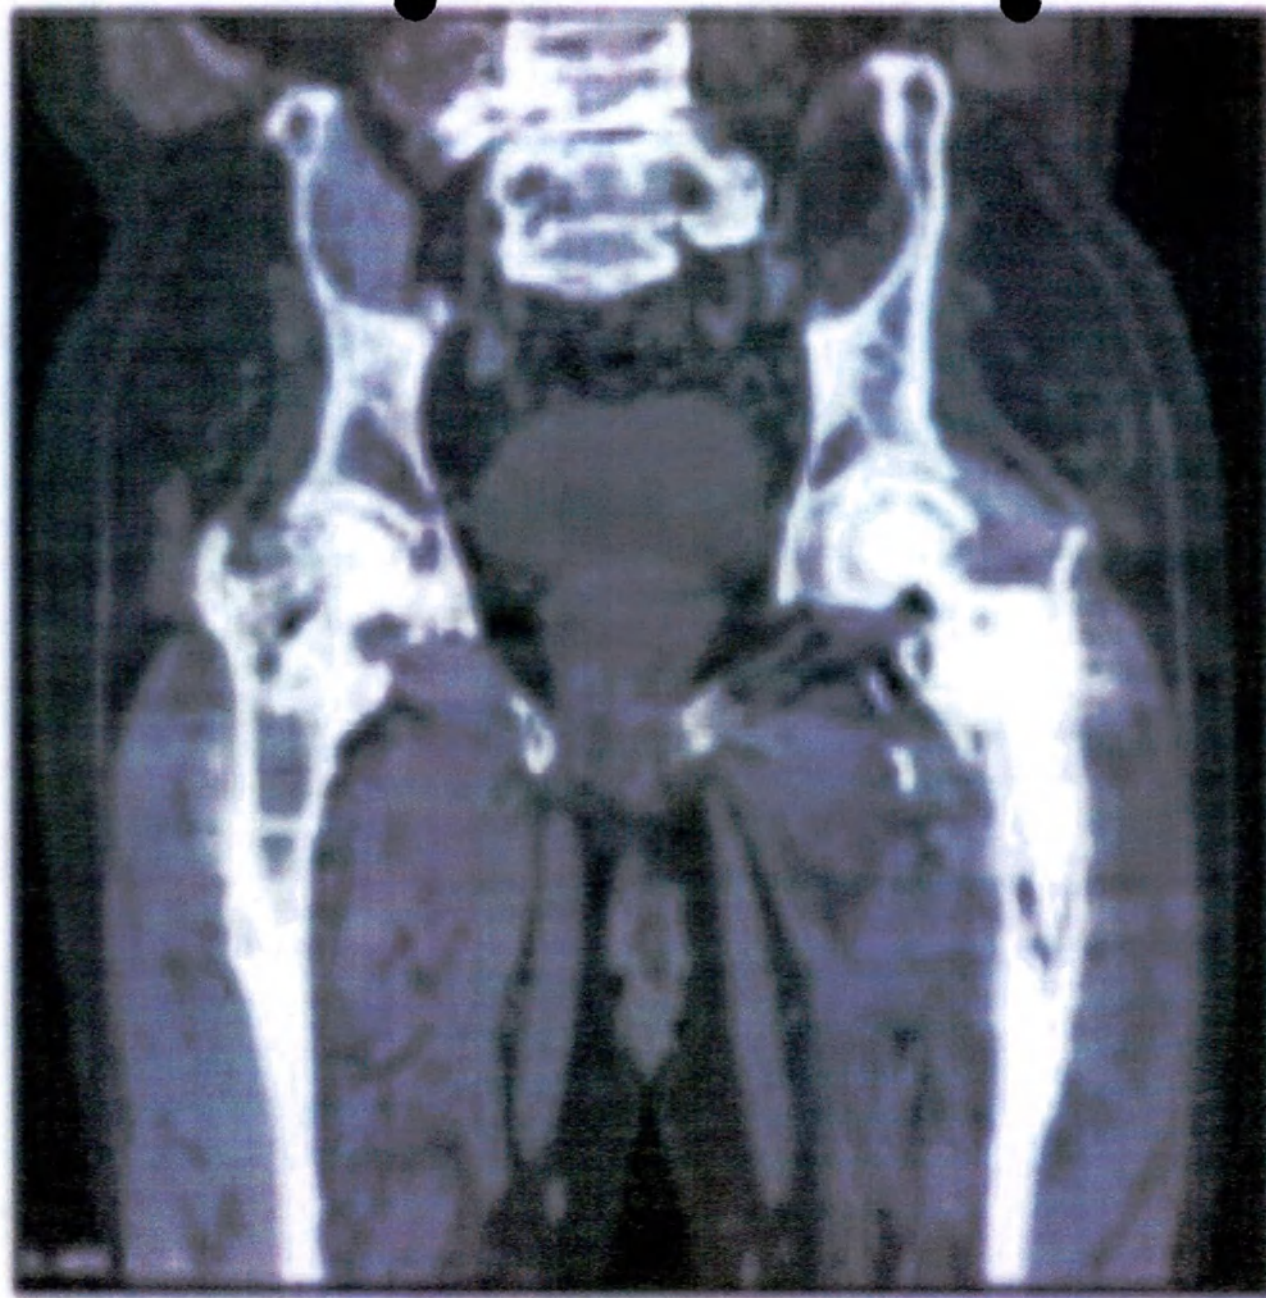


Рис. 171. Программный пакет Volume Helical Shuttle (не более 10 шт.).

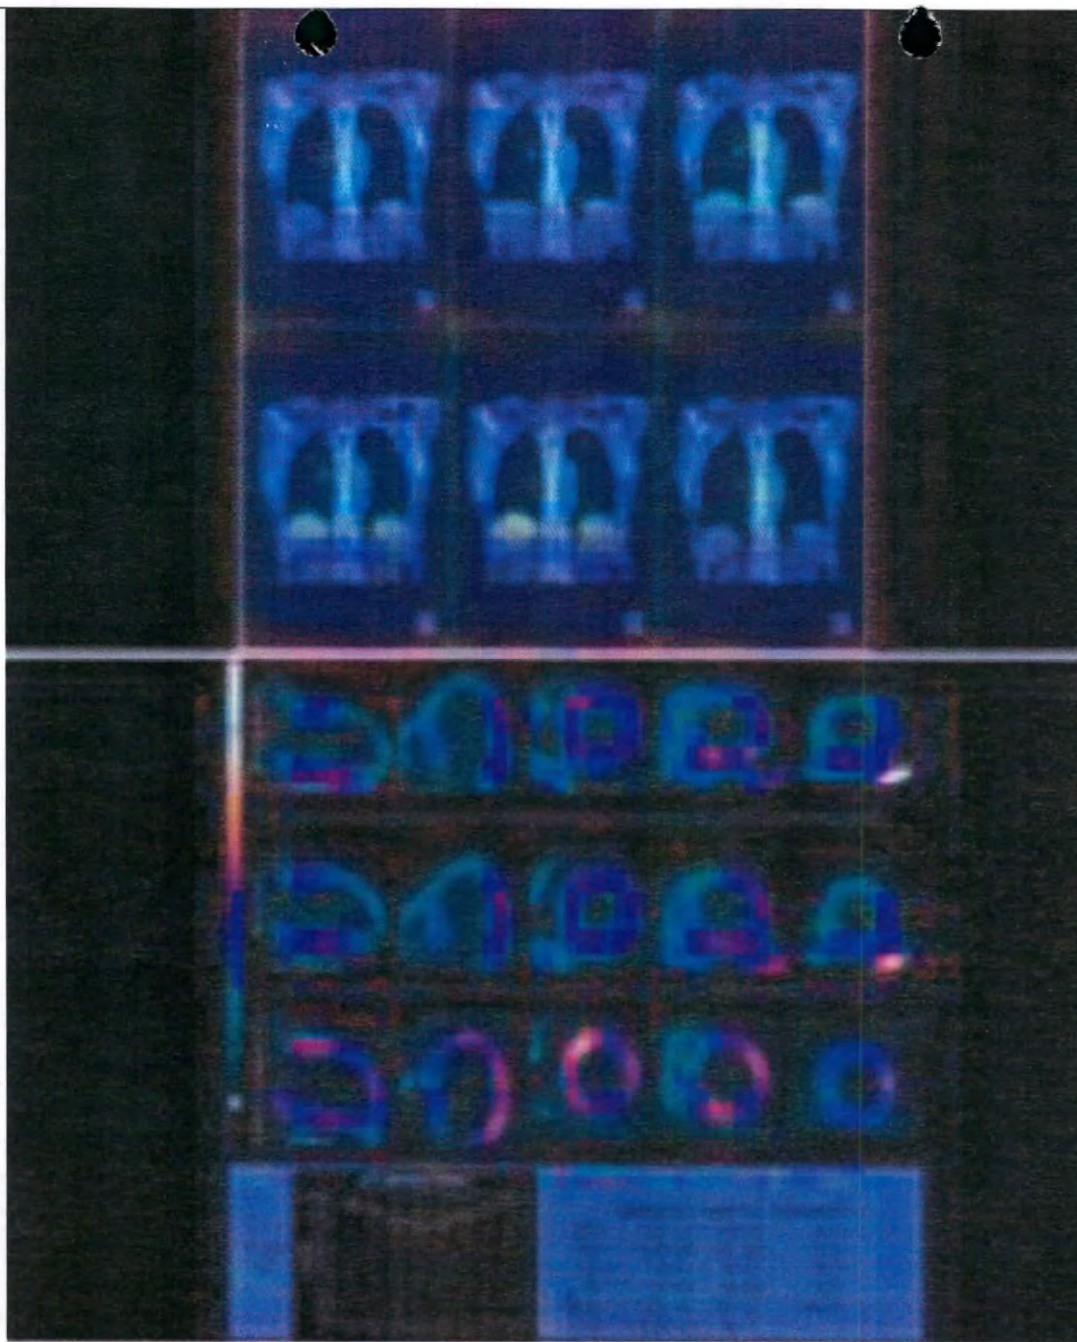


Рис. 172. Программный пакет РЕТ FBP (не более 10 шт.).

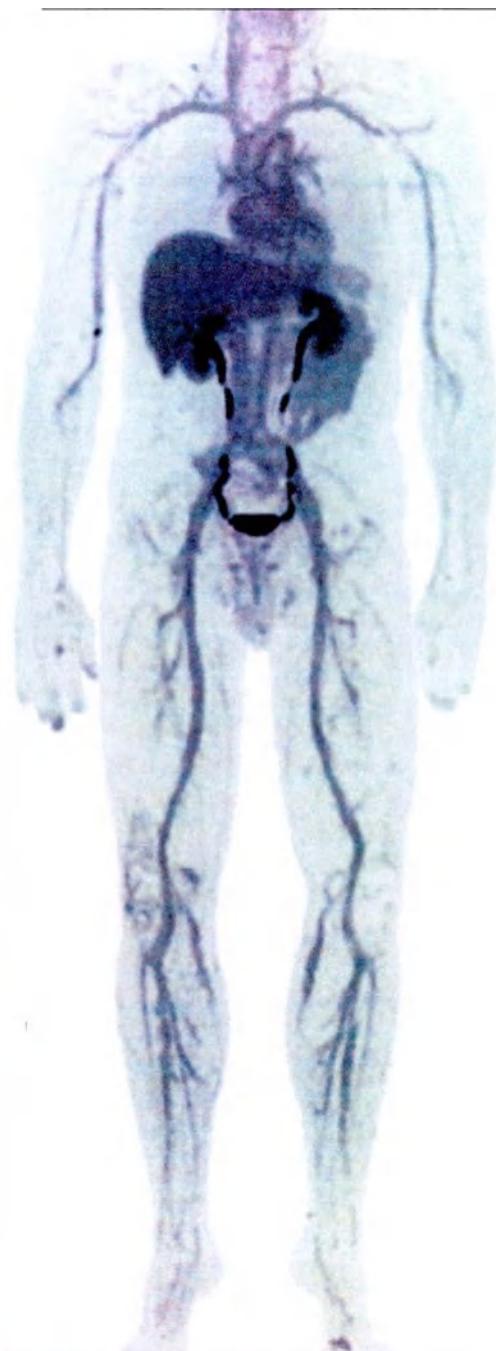


Рис. 173. Программный пакет PET Dynamic IQ (не более 10 шт.).

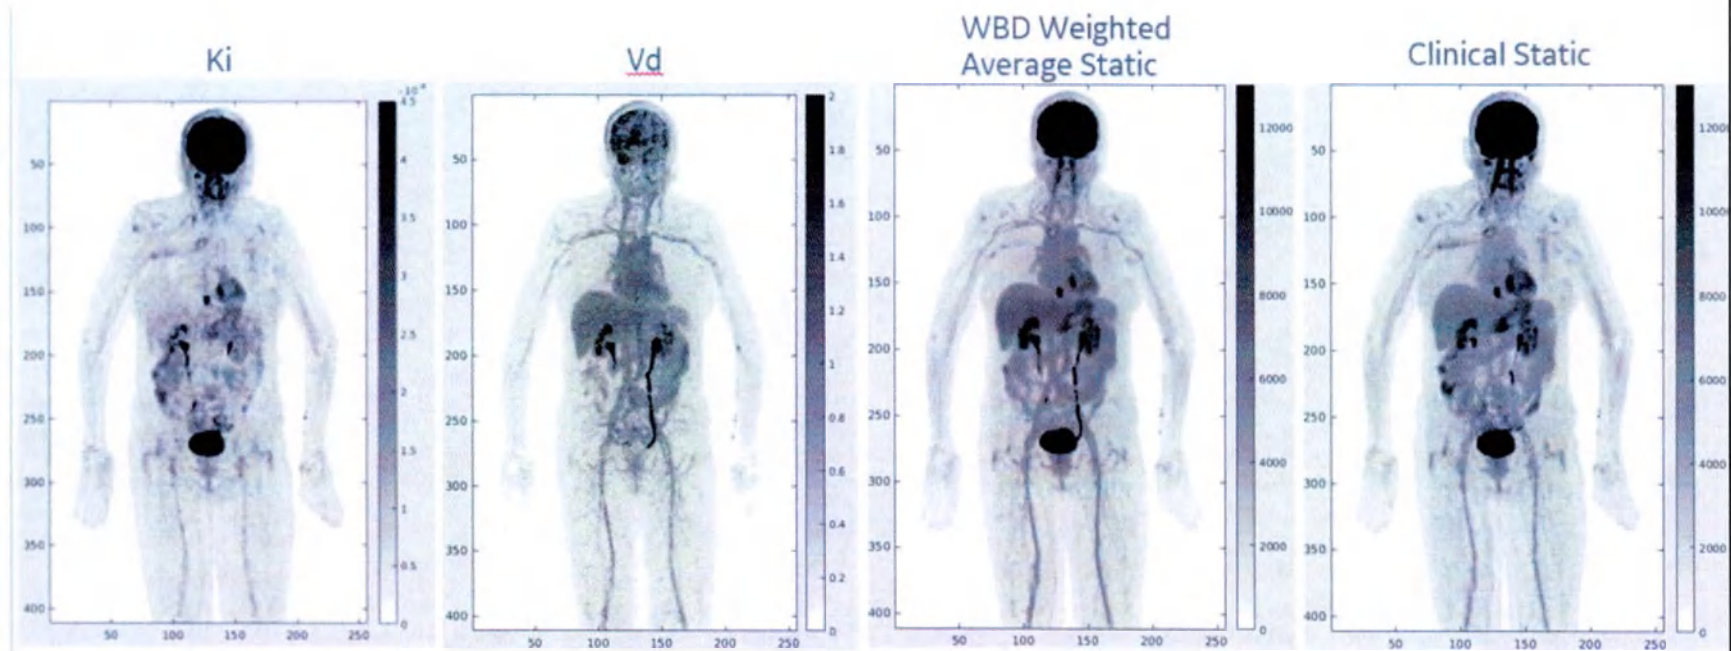


Рис. 174. Программный пакет WB Dynamic Acquisition (не более 10 шт.).

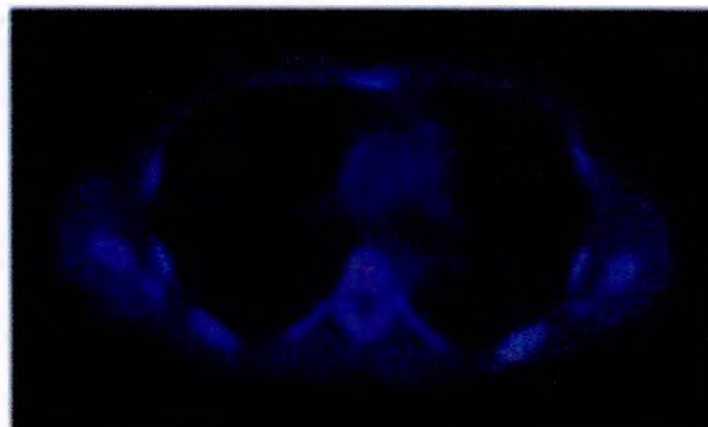
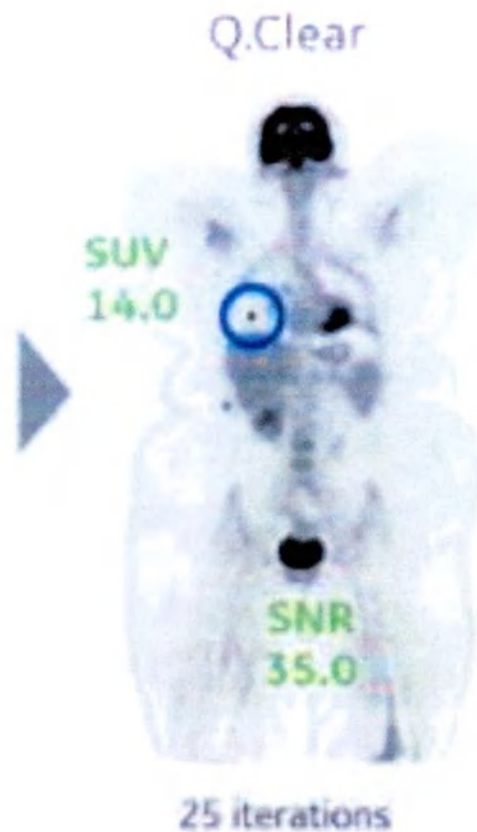


Рис. 175. Программный пакет Q.Prep (не более 10 шт.).

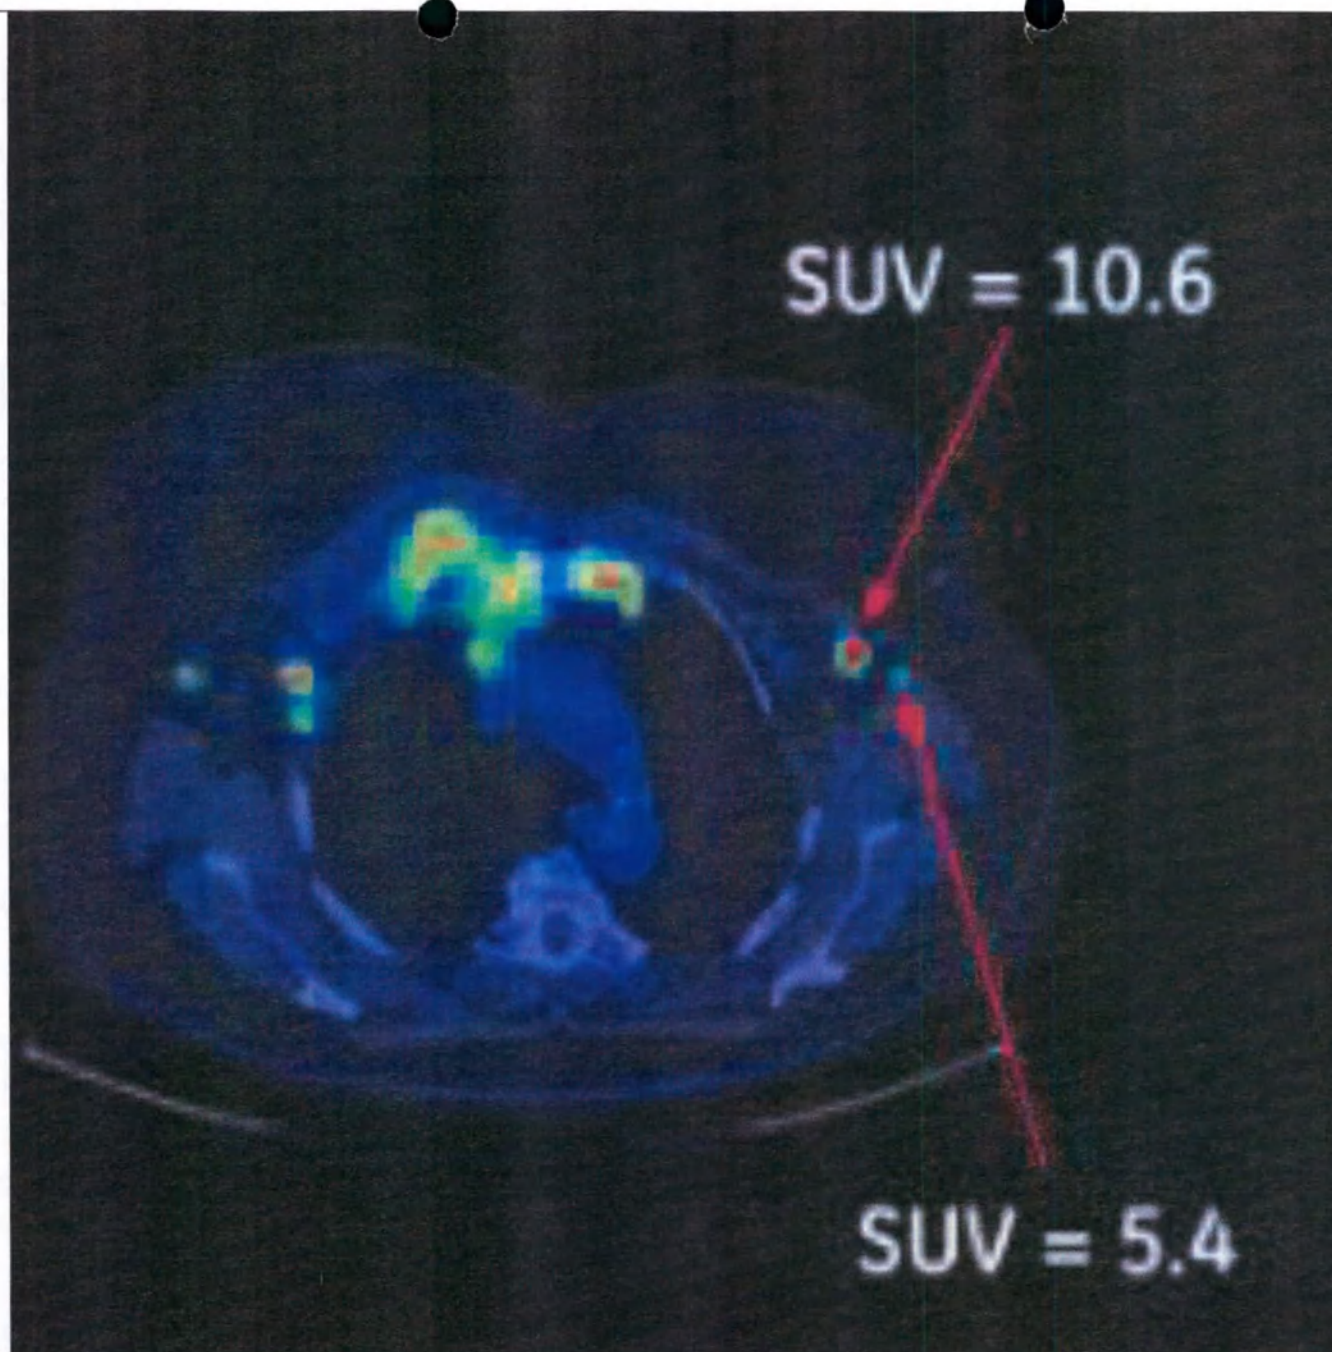


Рис. 176. Программный пакет Q.Suite Pkg (не более 10 шт.).

Select the desired image thickness

Detector Coverage (mm)

40.0

Initial Thickness (mm)

0.25 1.25 2.5

Rotation Time (s)

0.35	0.37	0.4	0.42	0.45	0.47	0.5
0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	2.0	

OK Cancel

Рис. 177. Программный пакет для увеличения скорости сканирования (не более 10 шт.).



Рис. 178. Программный пакет для автоматического позиционирования стола пациента (не более 10 шт.).

16x8 8x4 4x2 2x1

Procedure Split Exam

Preset ▼ Reset

Series (1/2): - + Host Selection

Comments:
Exam Split

Delete All Delete Add ->





Procedure	Images
CT THORAX WITH CONTRAST	0
CT PELVIS WITH CONTRAST	0
CT ABDOMEN W/ CONTRAST	0

Send Program

Send Browser

Рис. 179. Программный пакет Prospective Exam Split для просмотра, обработки и анализа ПЭТ изображений (не более 10 шт.).

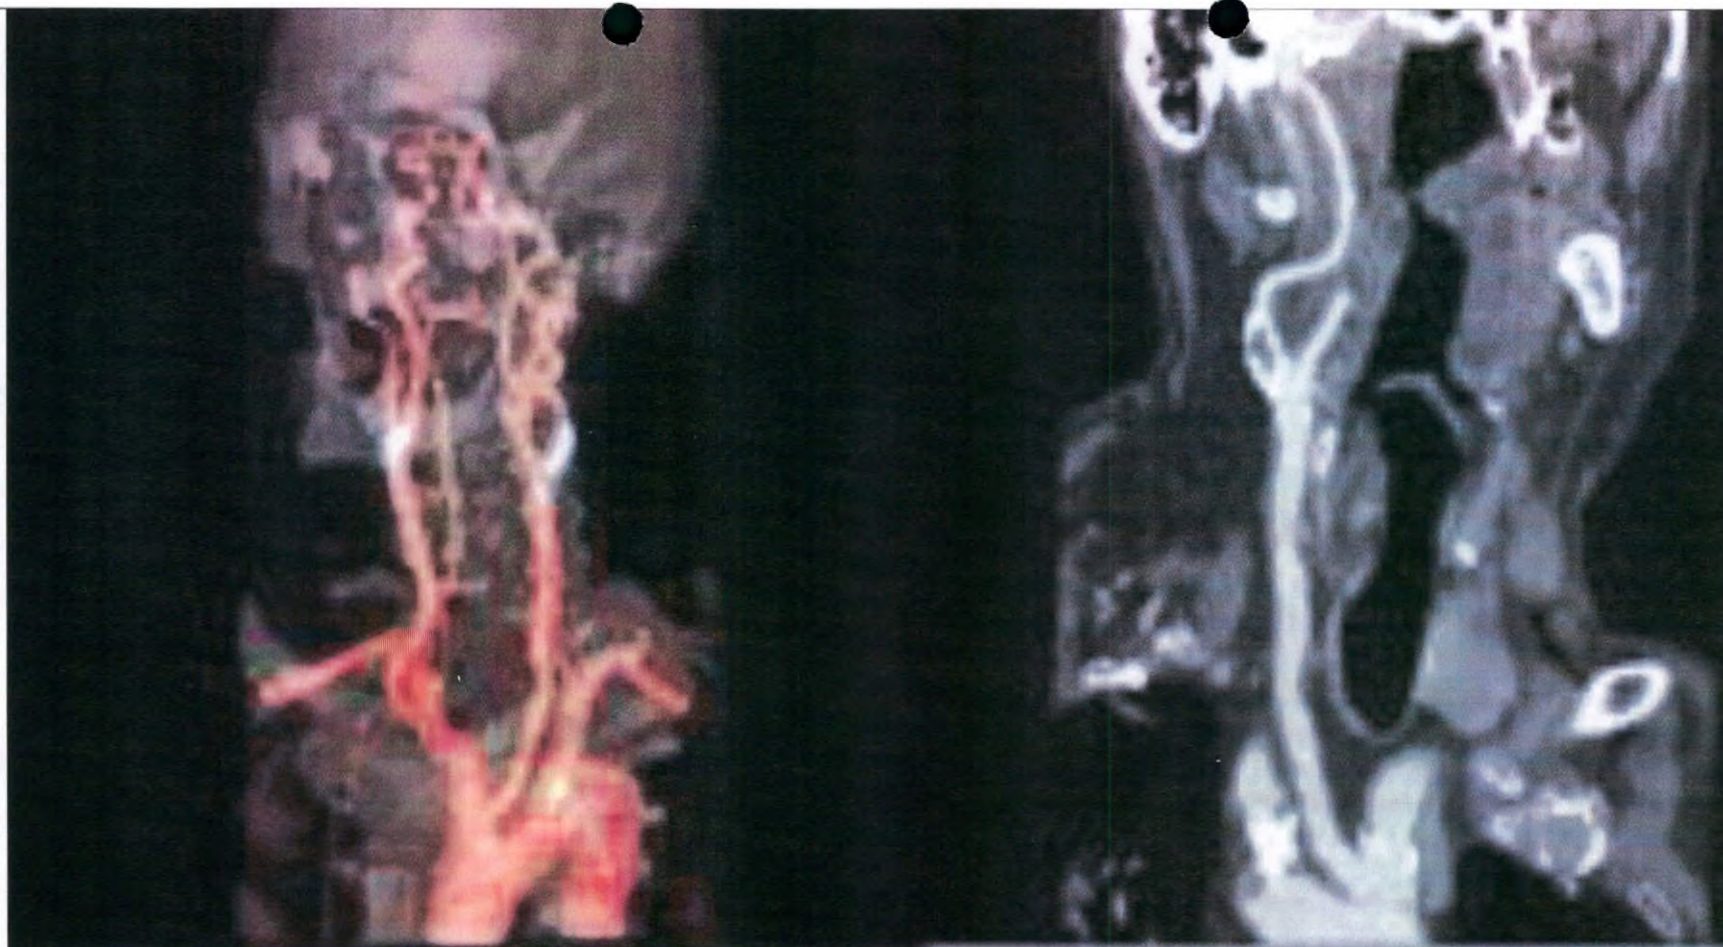


Рис. 180. Программный пакет VesselIQ Xpress (не более 10 шт.).



Рис. 181. Программный пакет AutoBone (не более 10 шт.).

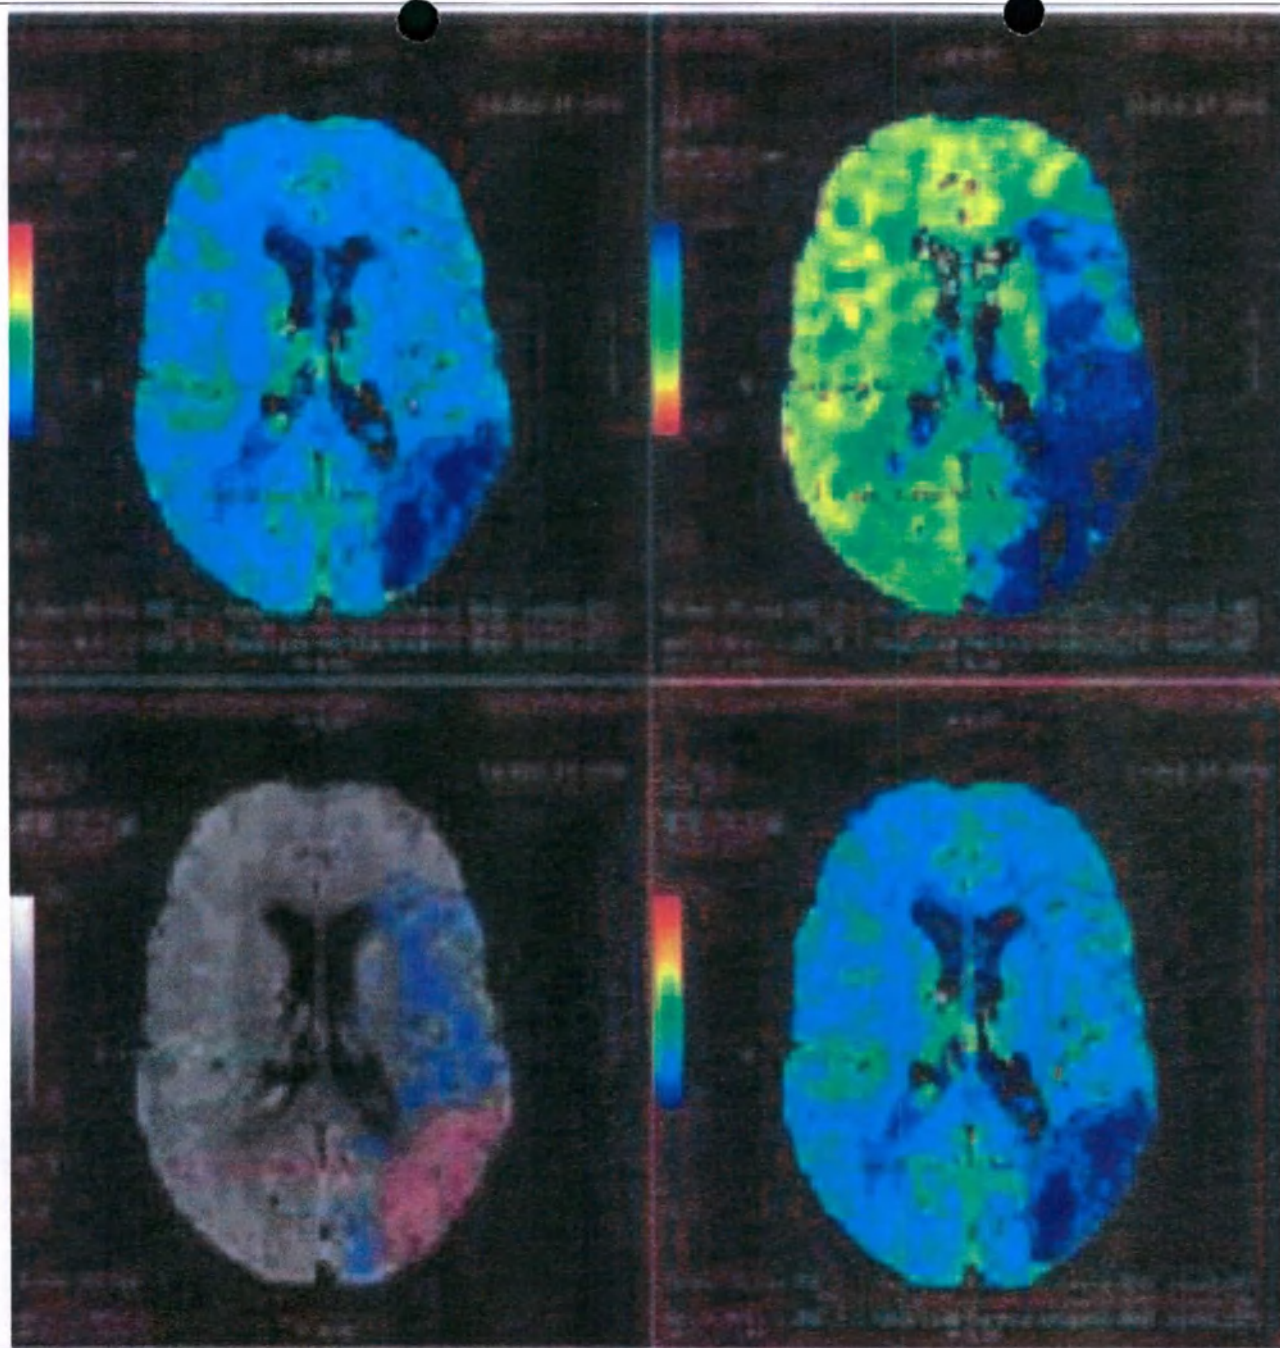


Рис. 182. Программный пакет CT Perfusion 4D Neuro (не более 10 шт.).

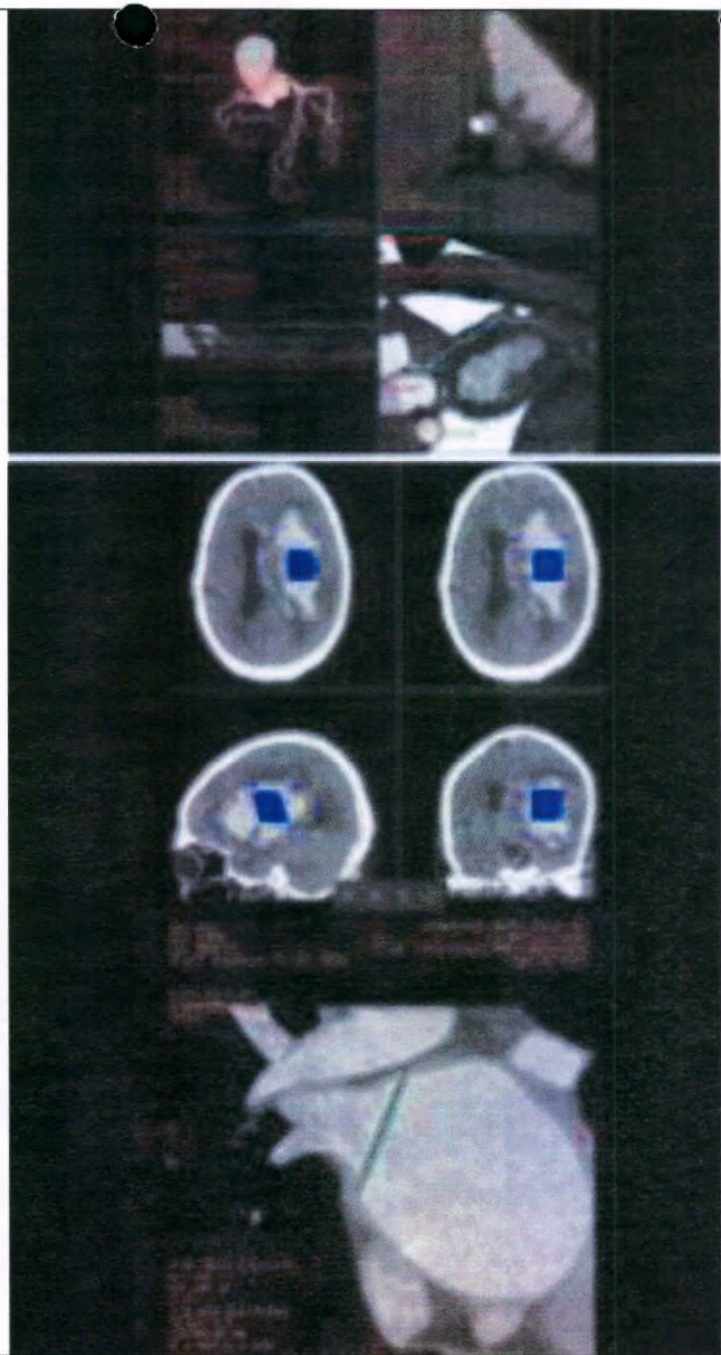


Рис. 183. Программный пакет CardIQ Xpress 2.0 (не более 10 шт.).

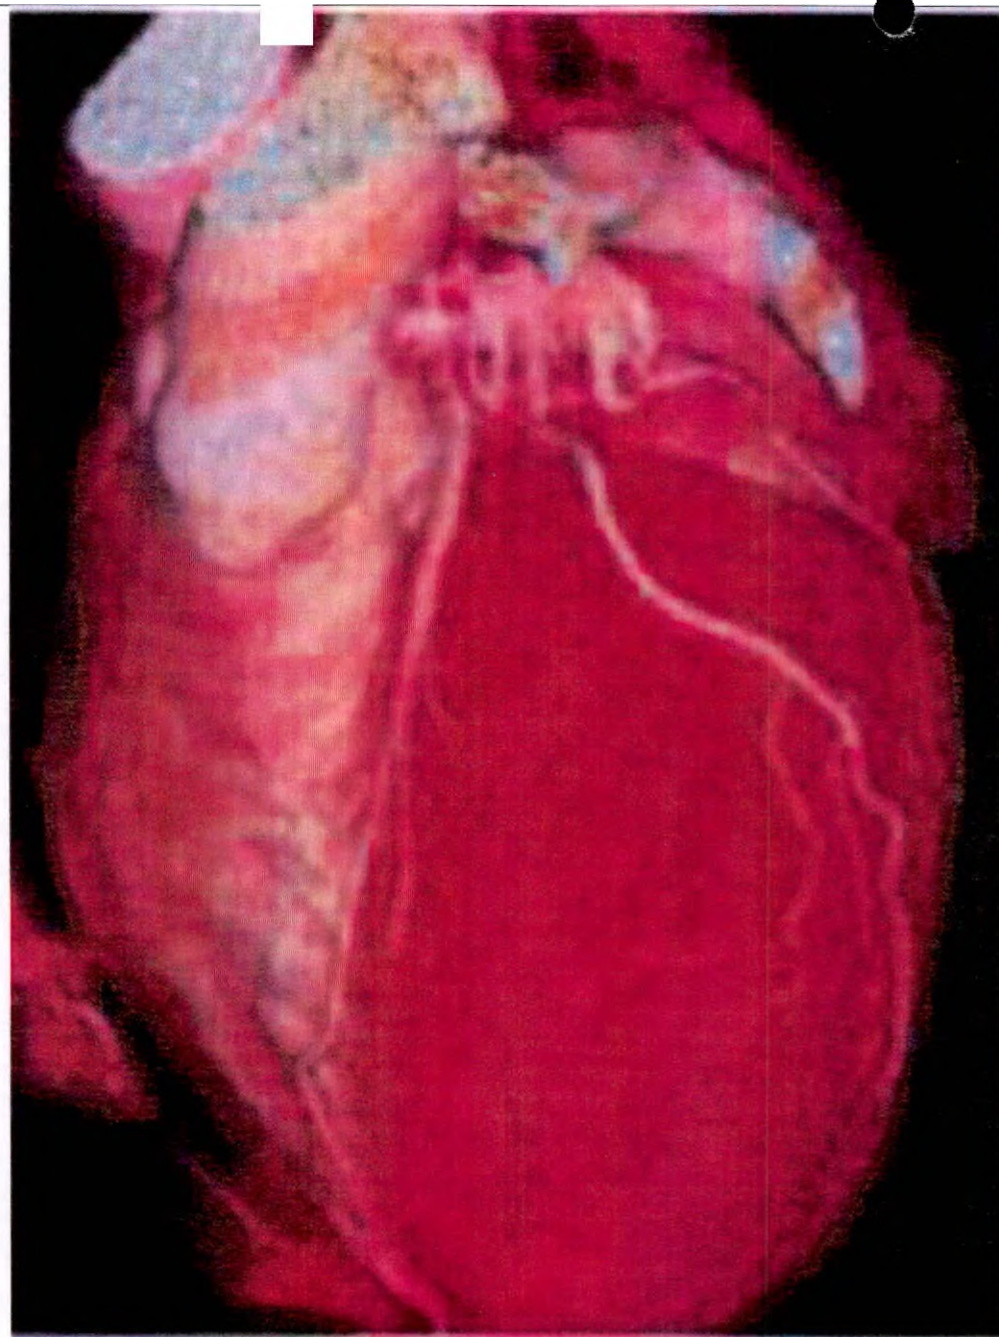


Рис. 184. Пакет программ для кардиологических исследований (не более 10 шт.).

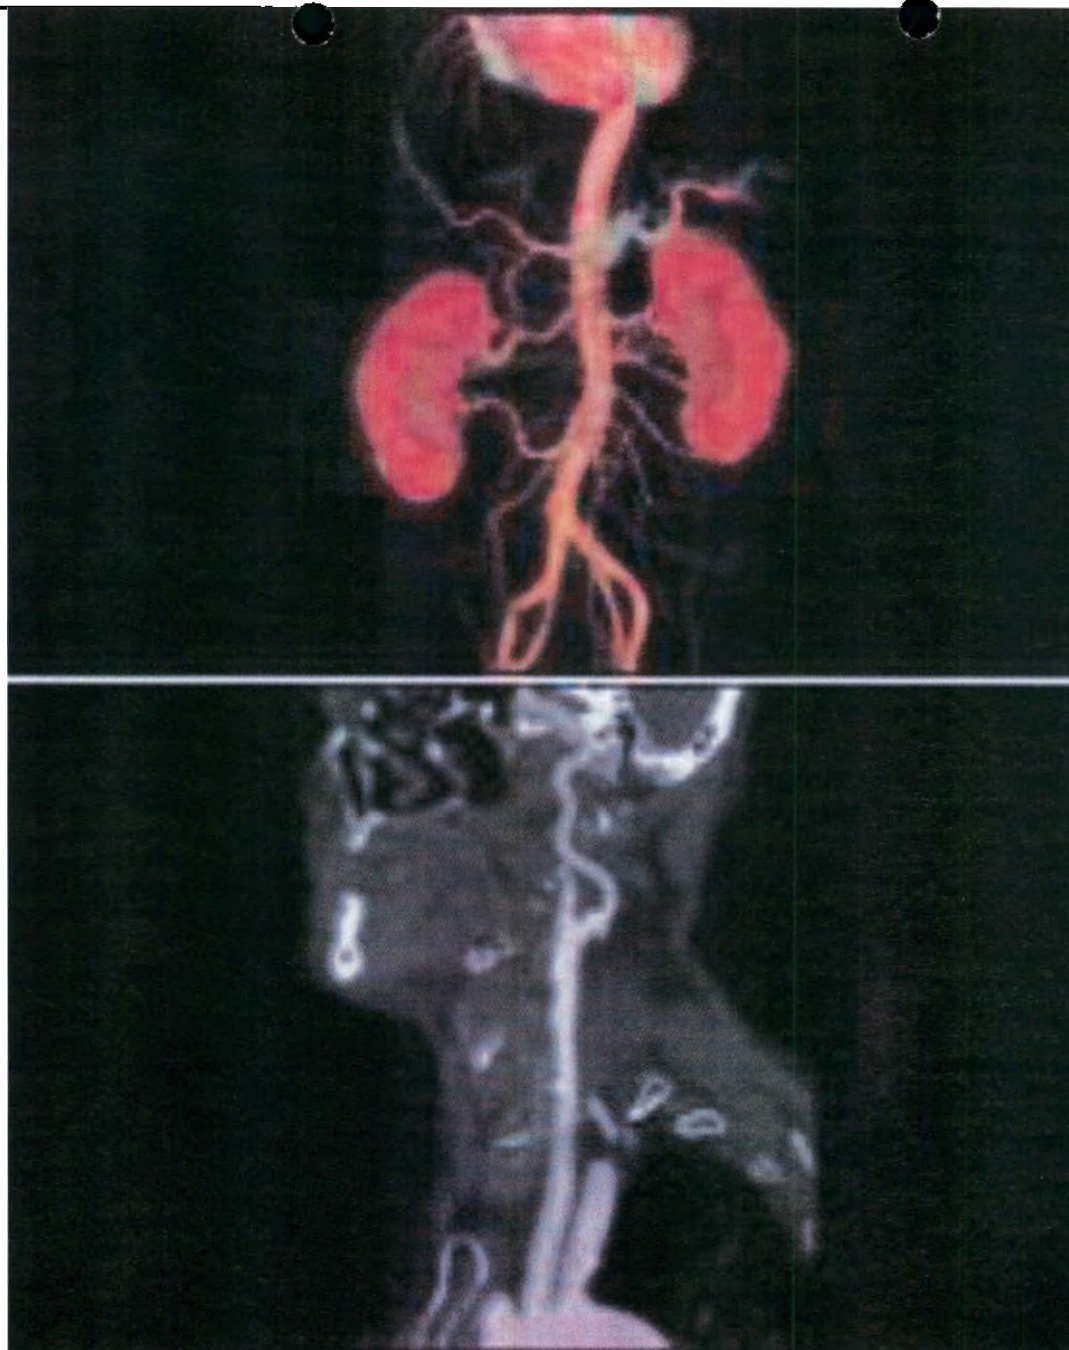


Рис. 185. Программный пакет SmartScore Pro ОС (не более 10 шт.).

SmartScore Pro

On

R to R Interval	Center R-Peak Delay(%)	Time Between Images(ms)	Images per R to R Interval
54	70	50	3
1111ms	777ms		

Accept Cancel

Рис. 186. Программный пакет SmartScore Pro ОС (не более 10 шт.).

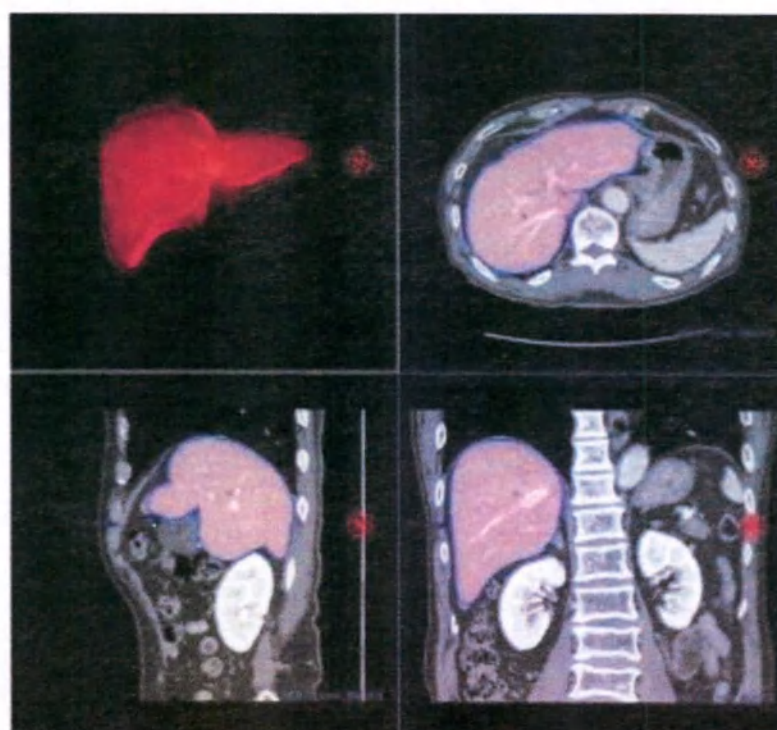
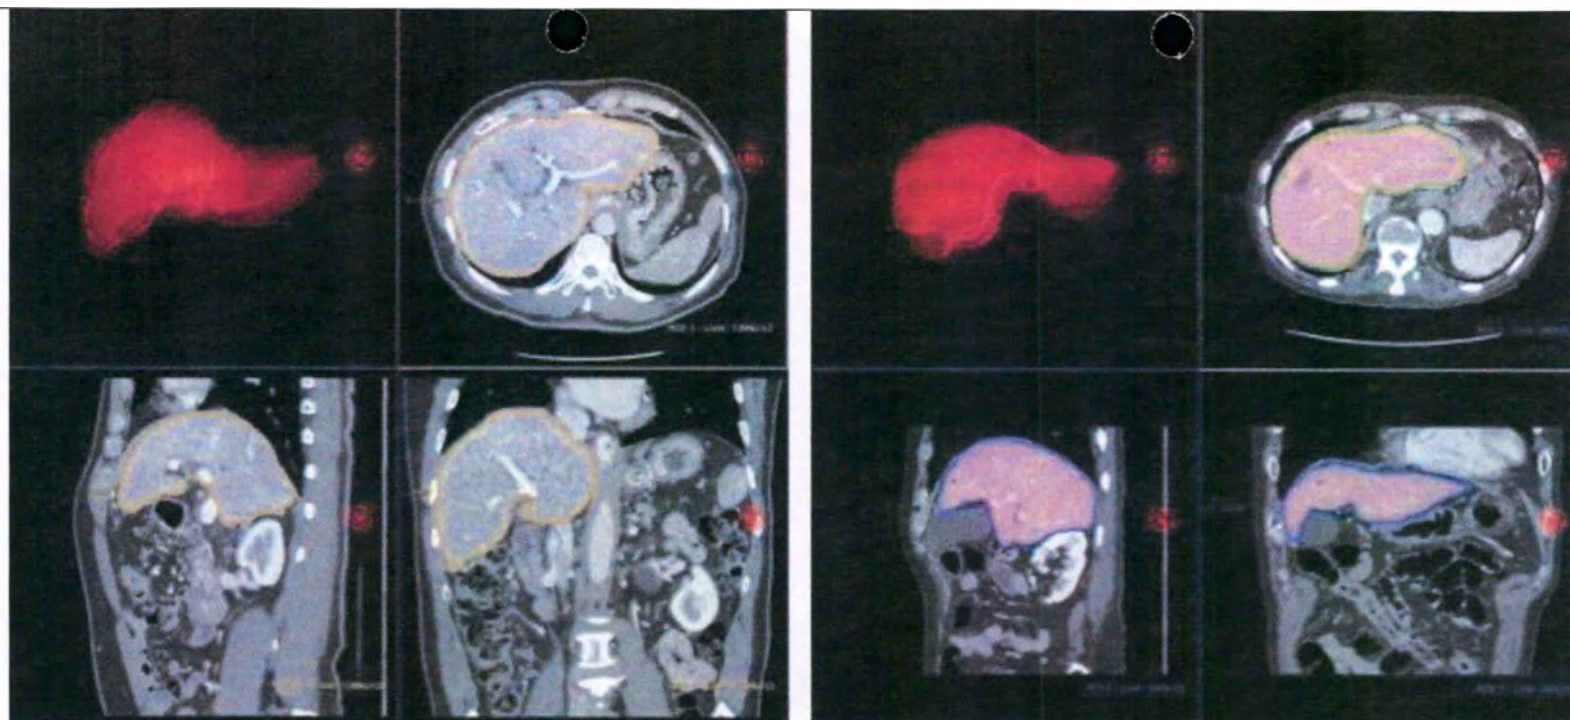


Рис. 187. Программный пакет Card IQ Snapshot (не более 10 шт.).

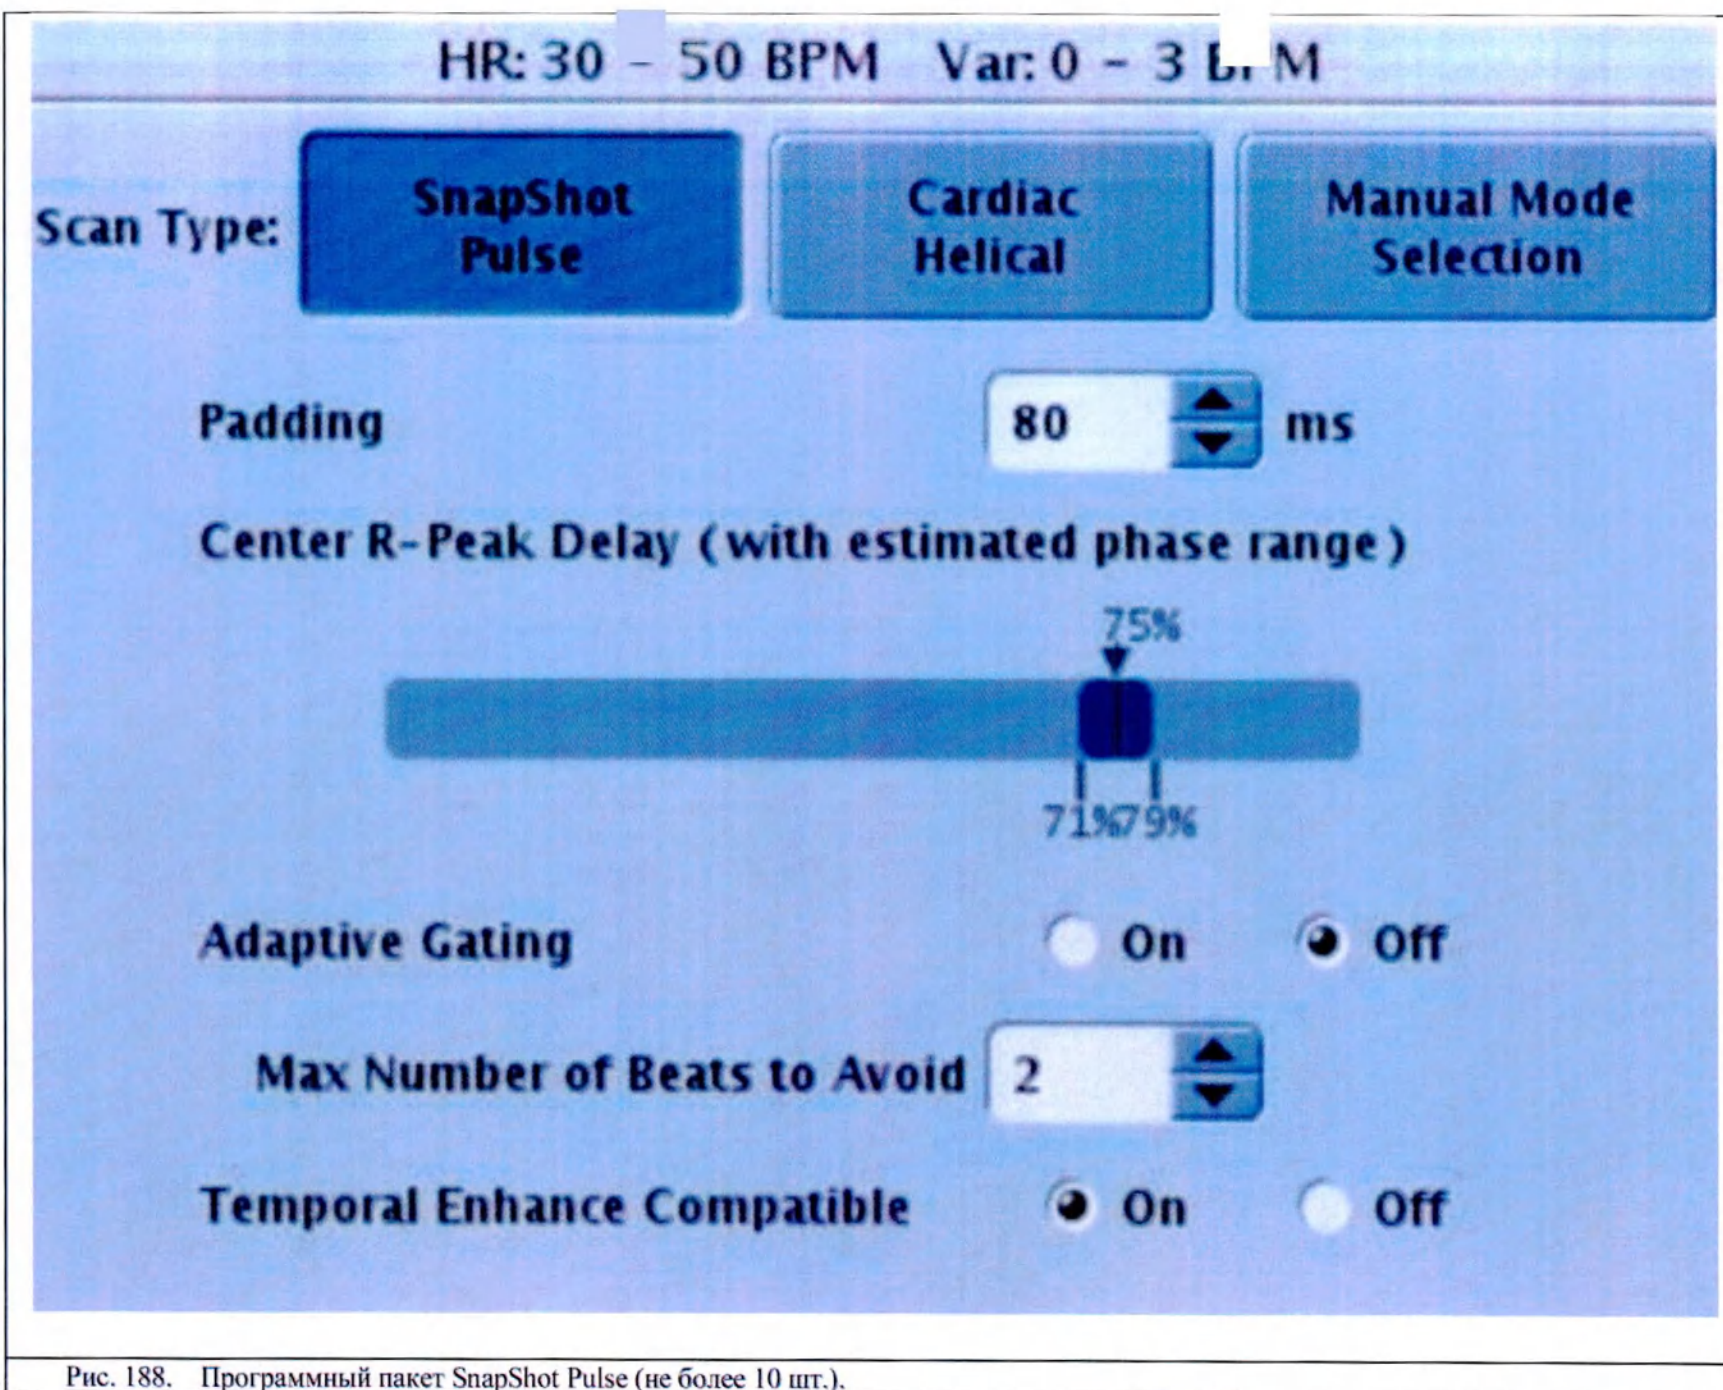


Рис. 188. Программный пакет SnapShot Pulse (не более 10 шт.).

Select the desired Scan Type.

Scan Type	Axial	Helical	Cine	Cardiac			
Cardiac Mode	SnapShot Segment (Helical)	SnapShot Burst (Helical)	SnapShot Burst Plus (Helical)	SnapShot Pulse (Cine)			
Rotation Time	0.35	0.37	0.4	0.42	0.45	0.47	0.5
	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	2.0	
Rotation Length	Segment	Full					
Shuttle Mode	Off	On					
Consistent Start Angle	Off	On					

OK Cancel

Рис. 189. Программный пакет SnapShot Assist (не более 10 шт.).

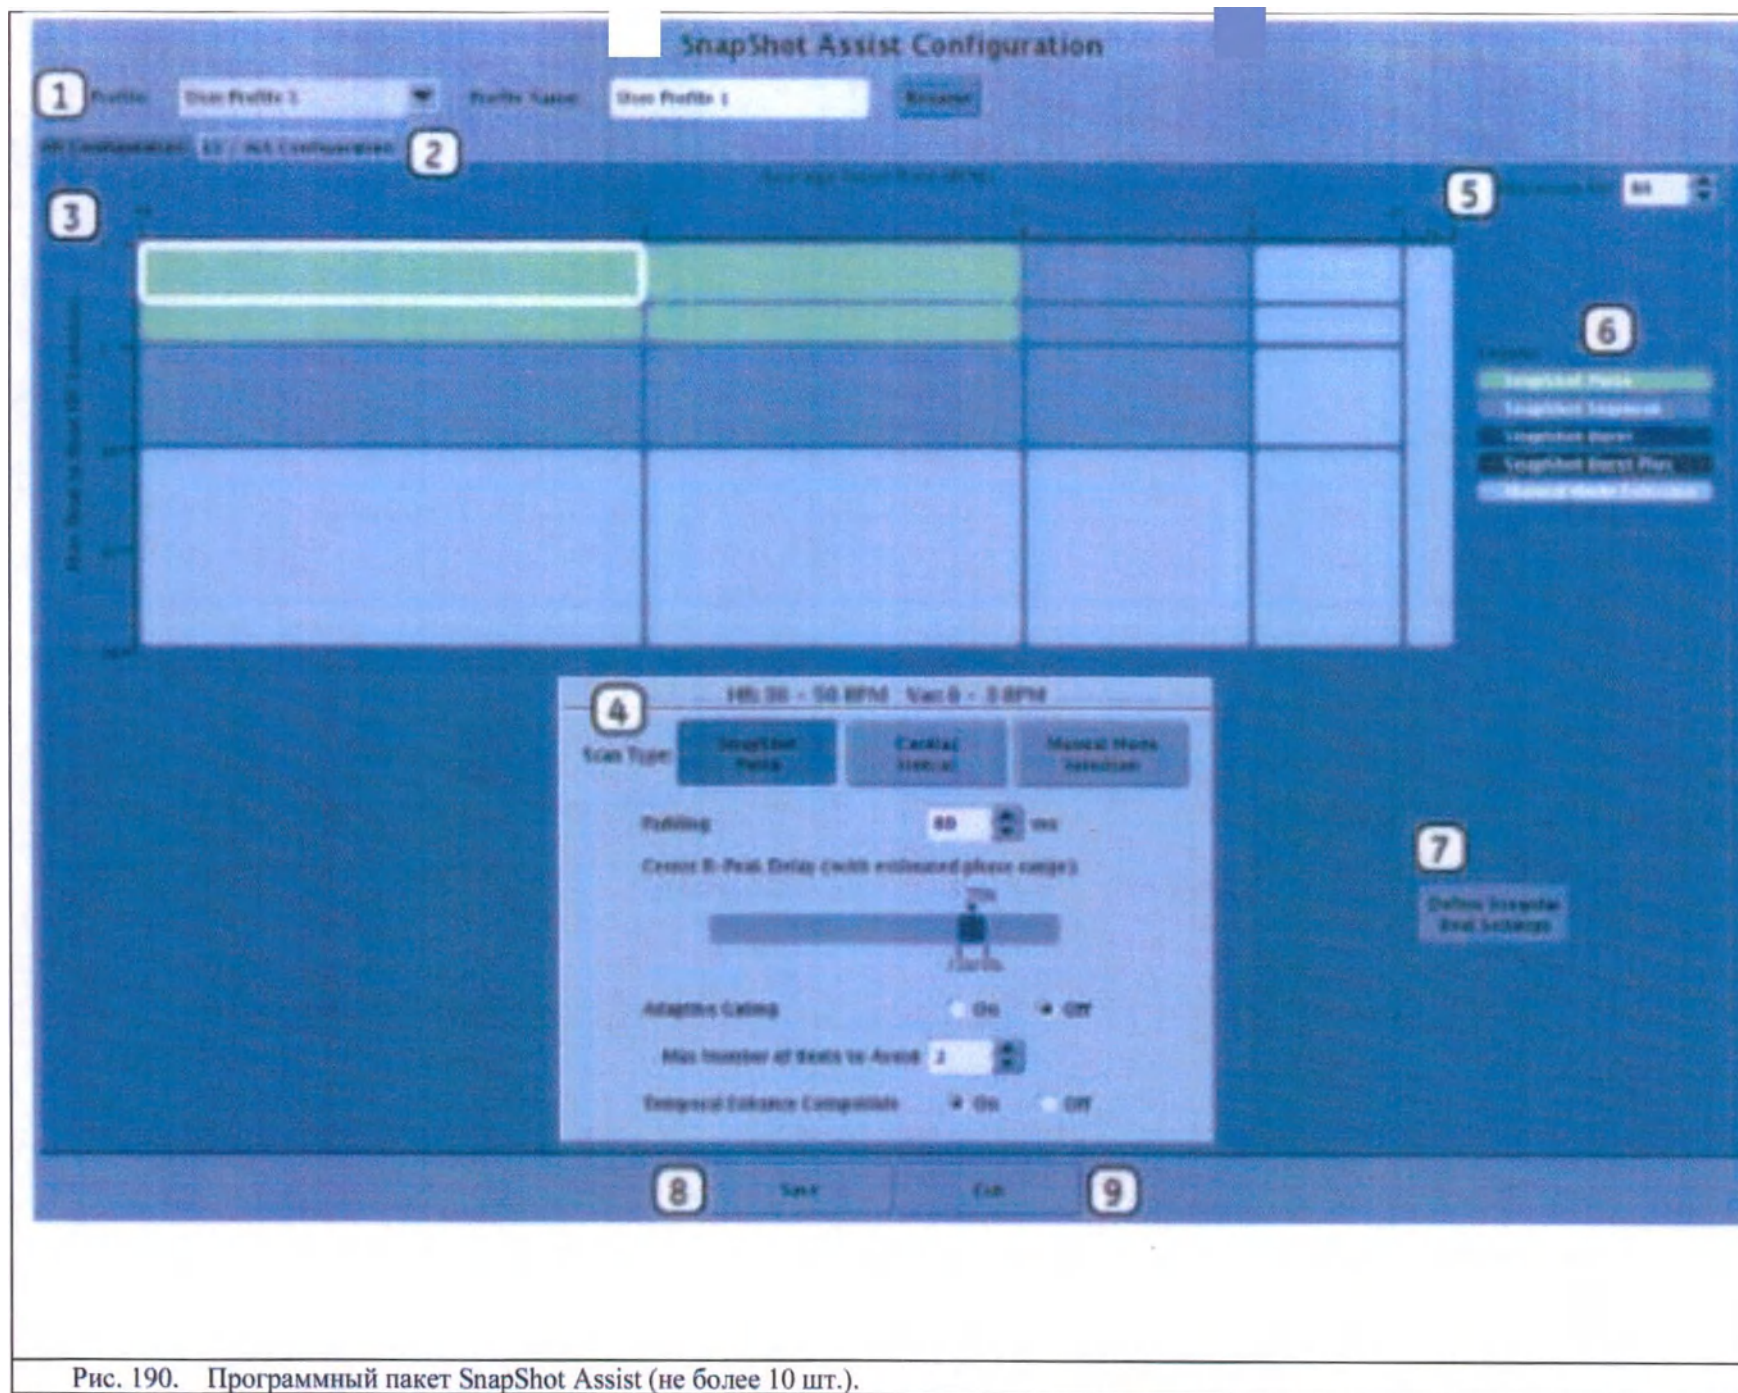


Рис. 190. Программный пакет SnapShot Assist (не более 10 шт.).

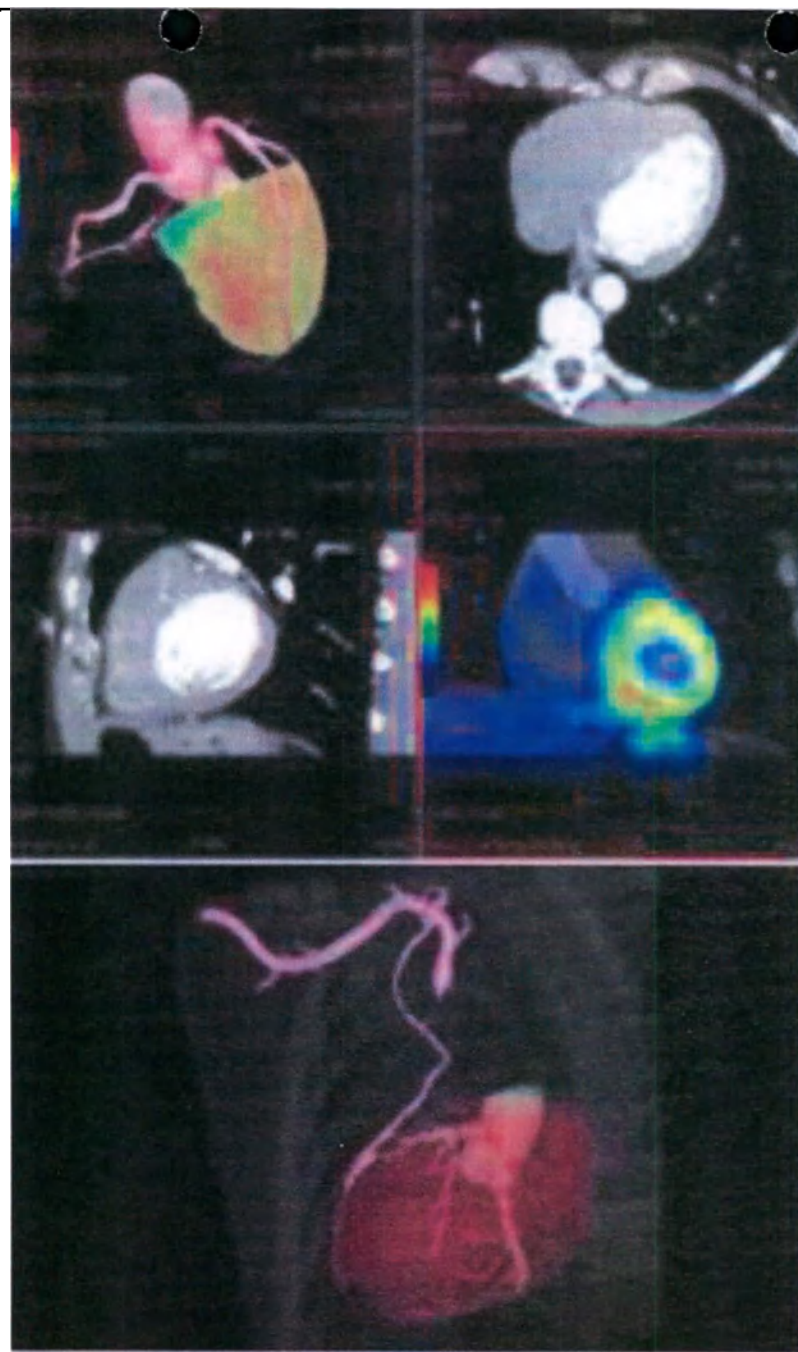


Рис. 191. Программный пакет Temporal Enhance (не более 10 шт.).

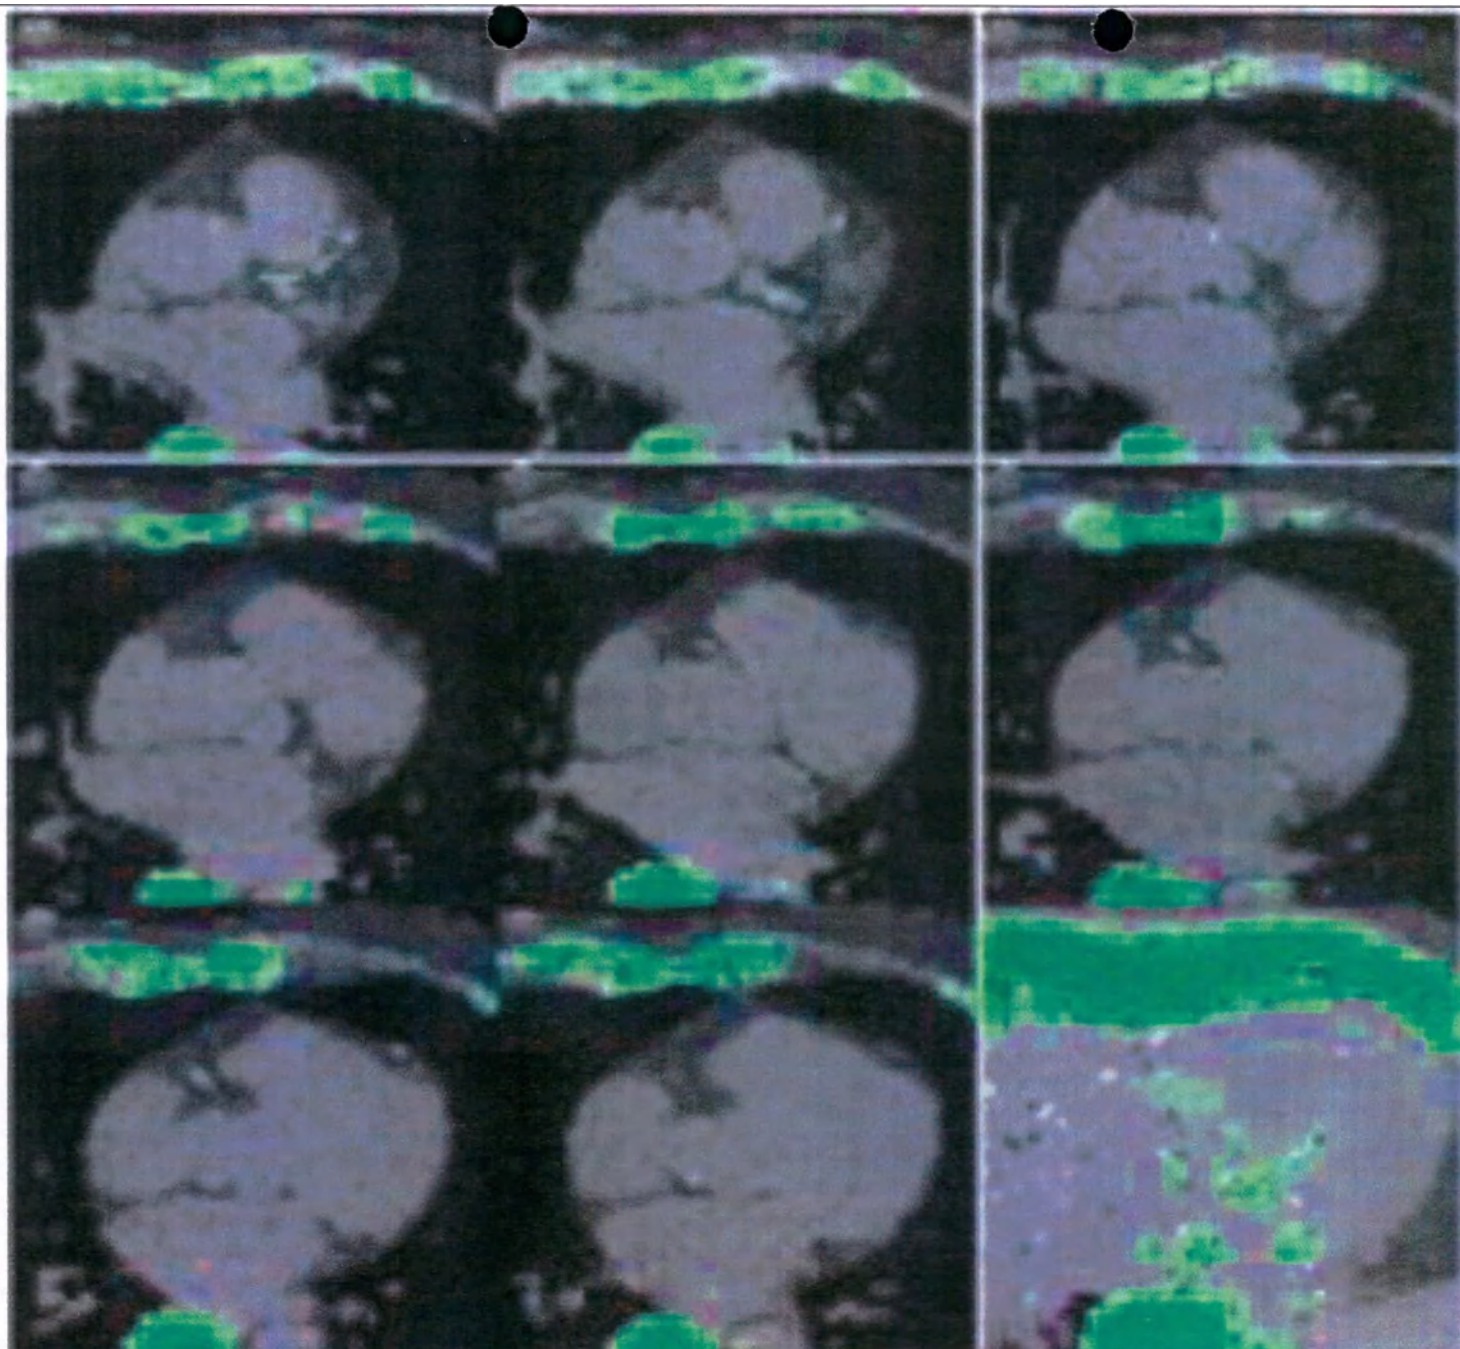


Рис. 192. Программный пакет SmartScore 4.0 (не более 10 шт.).

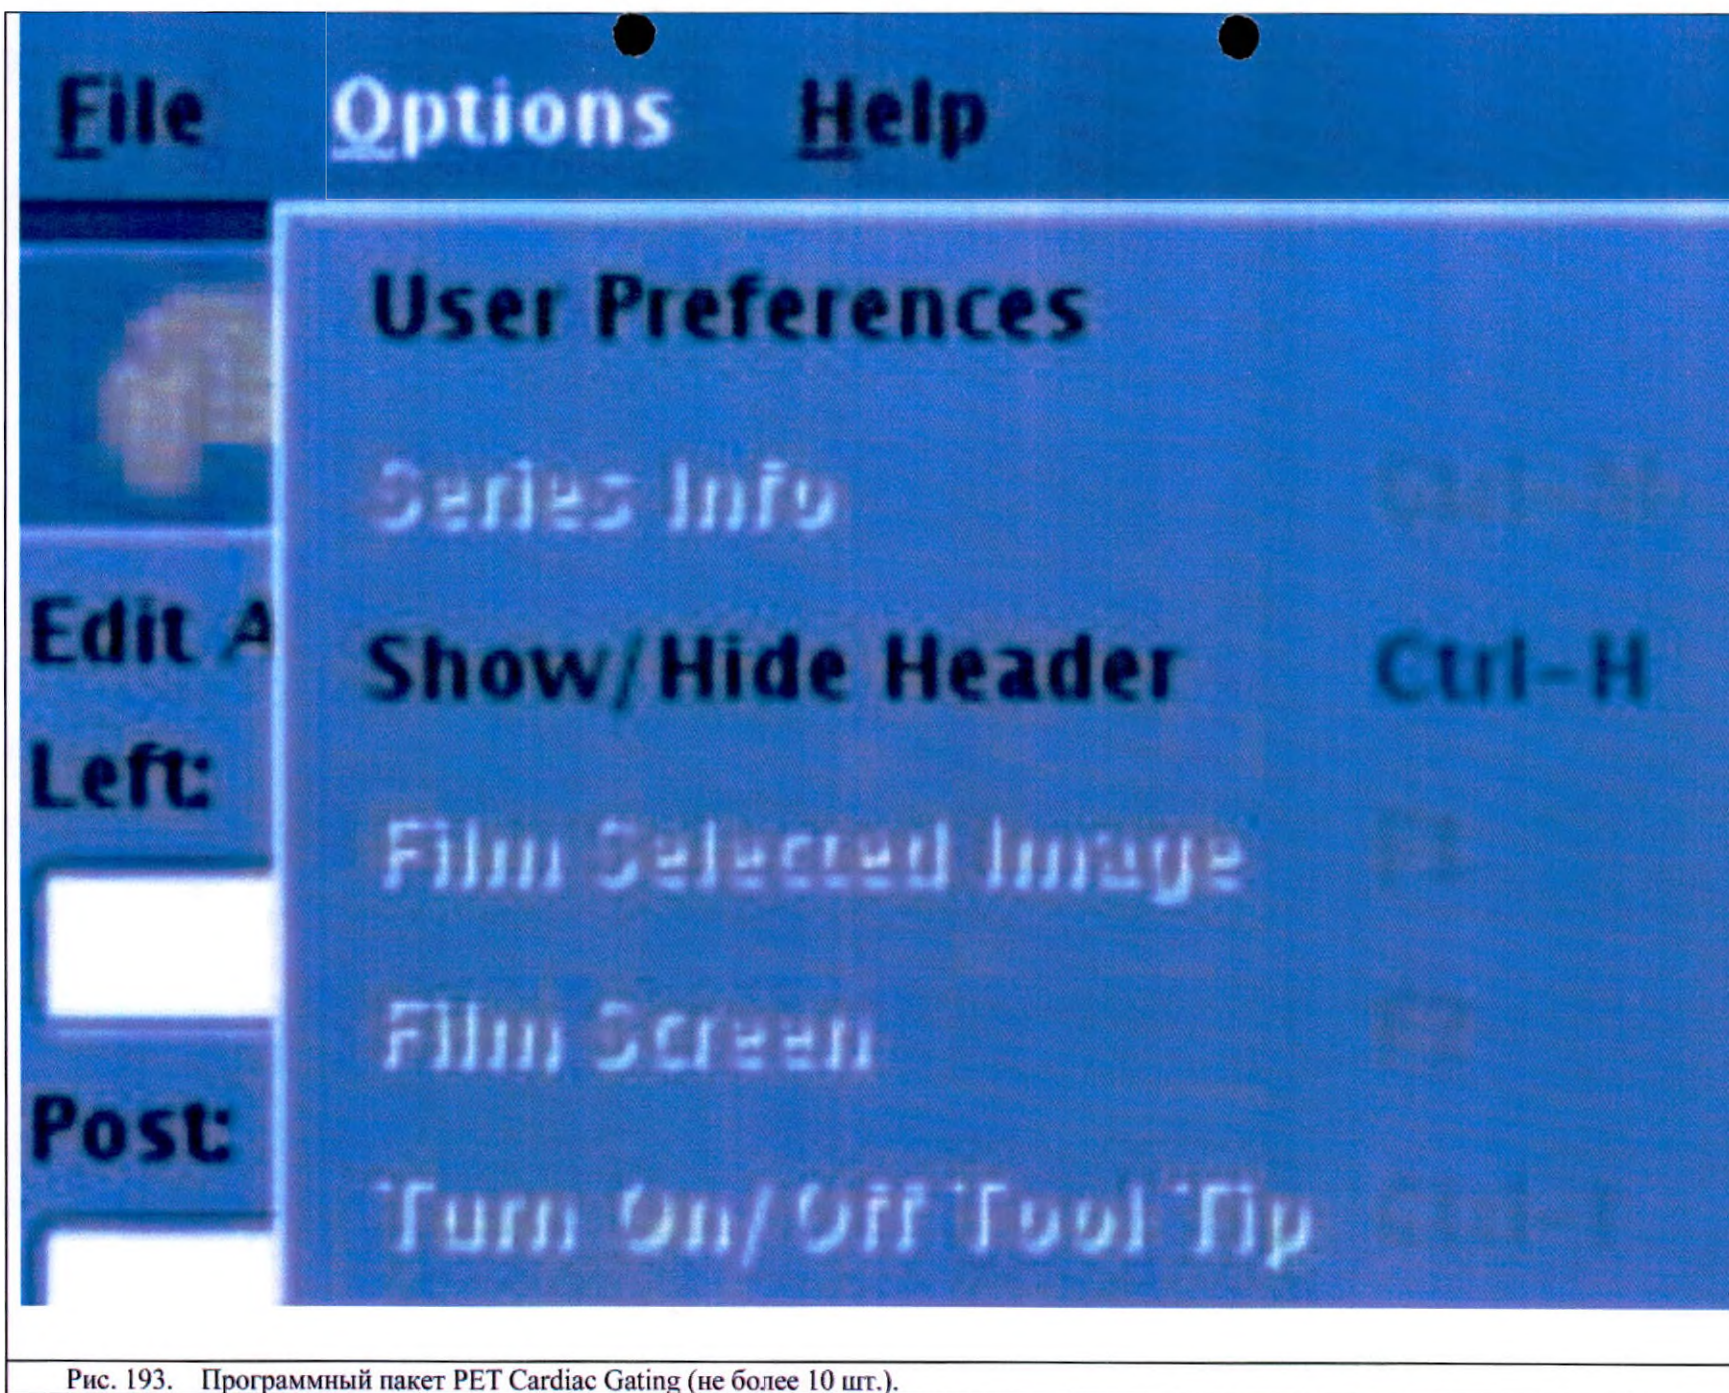


Рис. 193. Программный пакет PET Cardiac Gating (не более 10 шт.).

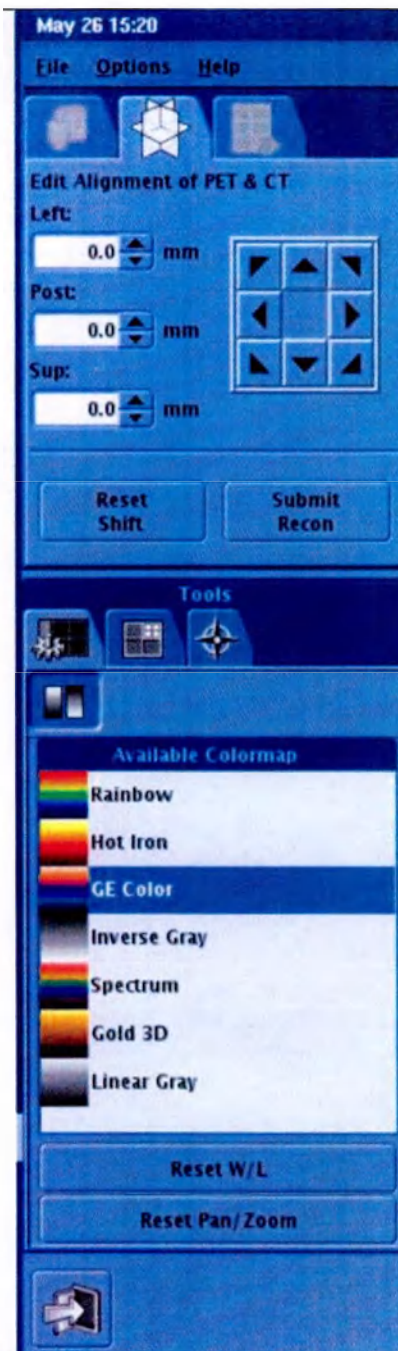


Рис. 194. Программный пакет Cardiac PET ACQC (не более 10 шт.).

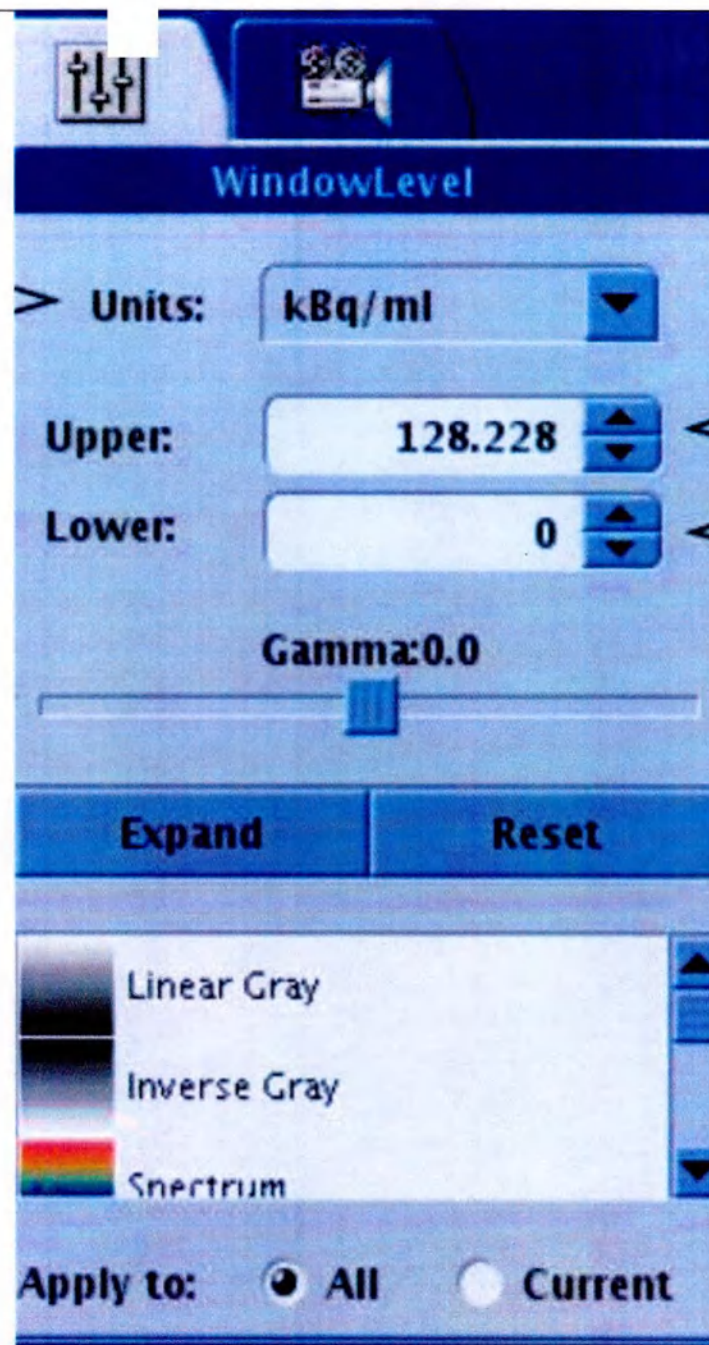


Рис. 195. Программный пакет Cadias VUE (не более 10 шт.).

Attenuation:
Type:

Open ACQC:

CTAC Type:
CTAC Series:

Prior
▲
▼
Next

Contrast Compensation:

CTAC Shift: L (mm): P (mm): S (mm):

Correction:
Well Counter:

WCC File:

Prior
▲
▼
Next

Normalization:

Prior
▲
▼
Next

Randoms: Deadtime:

Scatter:

Рис. 196. Программный пакет PET Auto ACQC (не более 10 шт.).

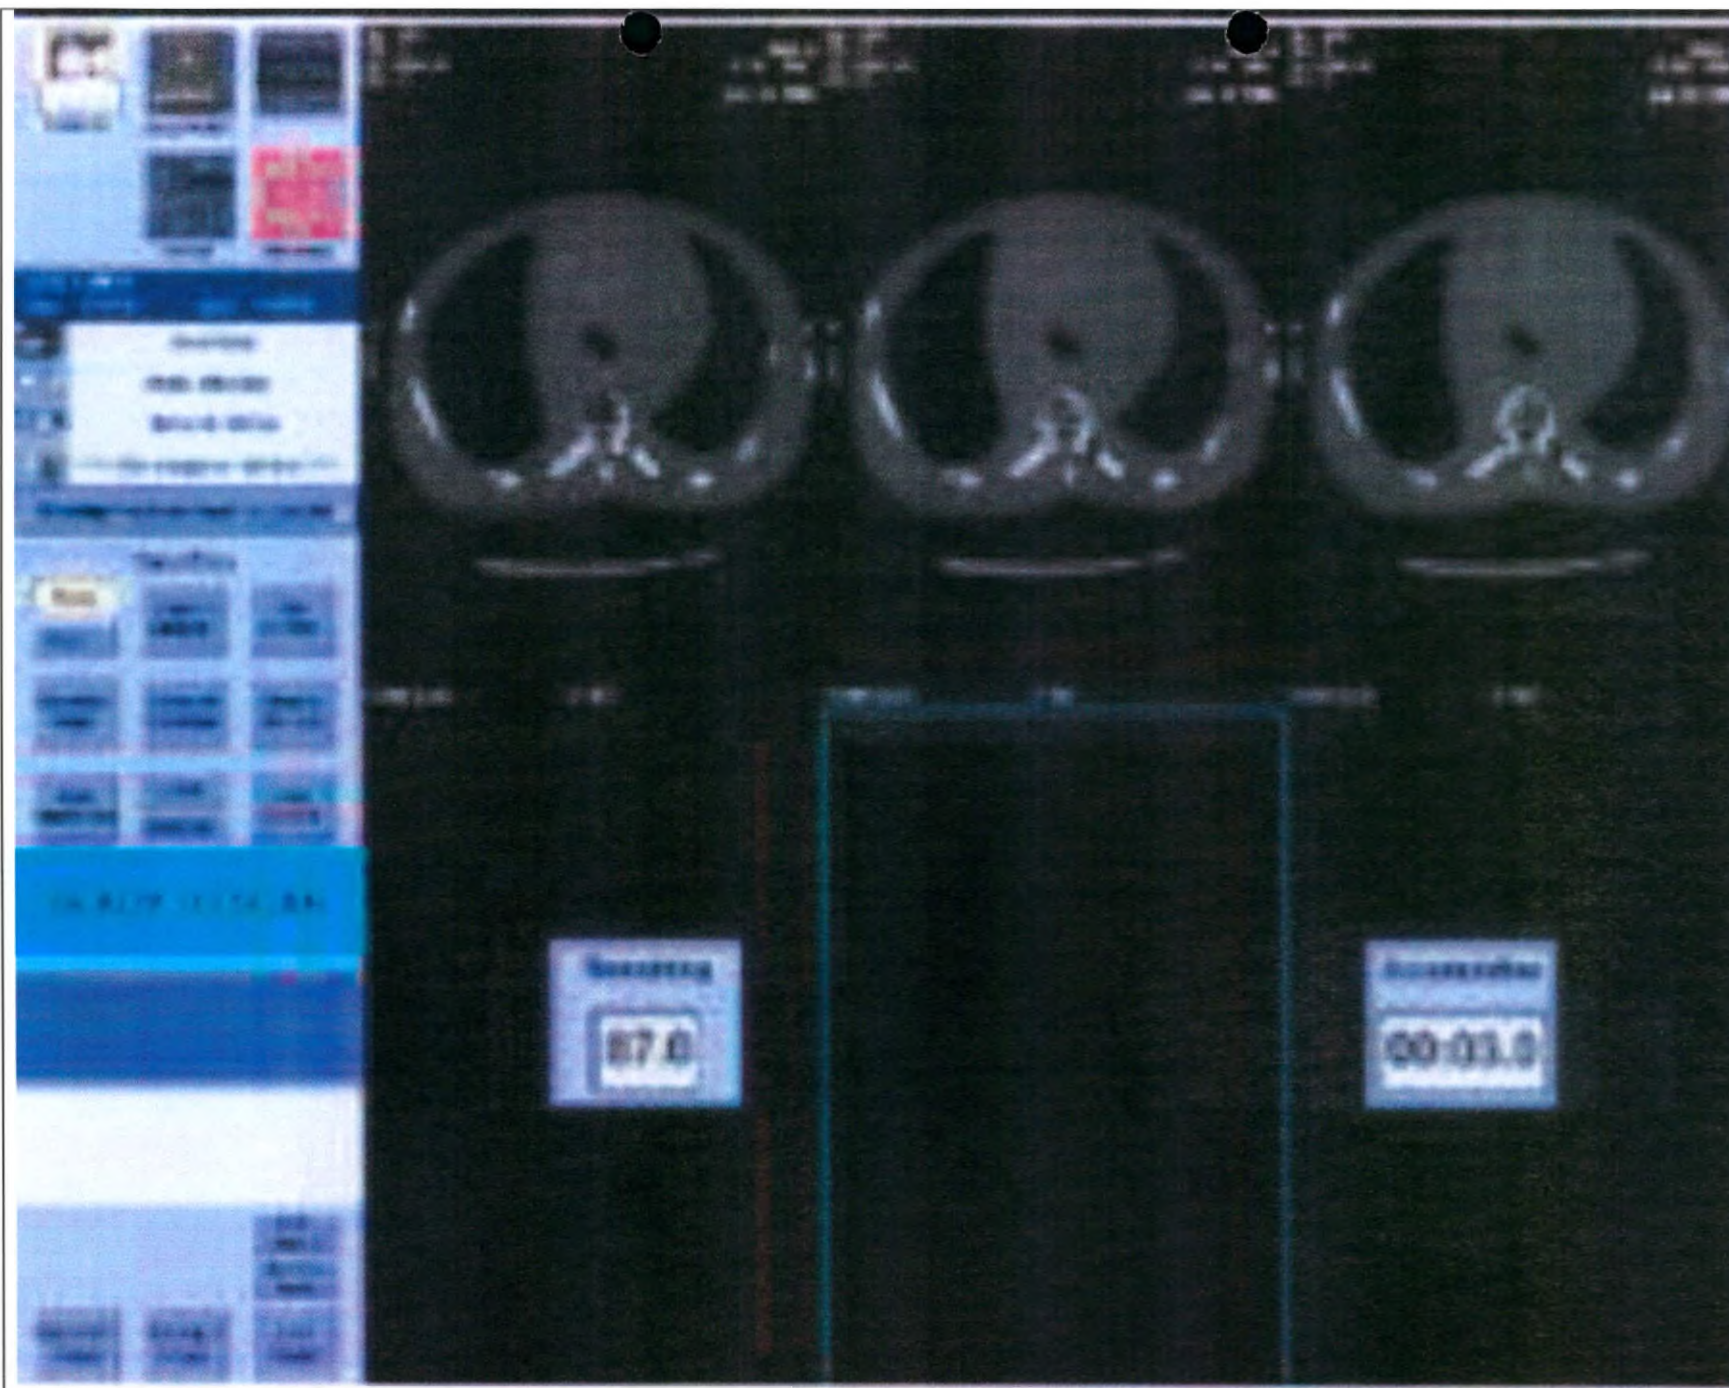


Рис. 197. Программный пакет Smart Step (не более 10 шт.).

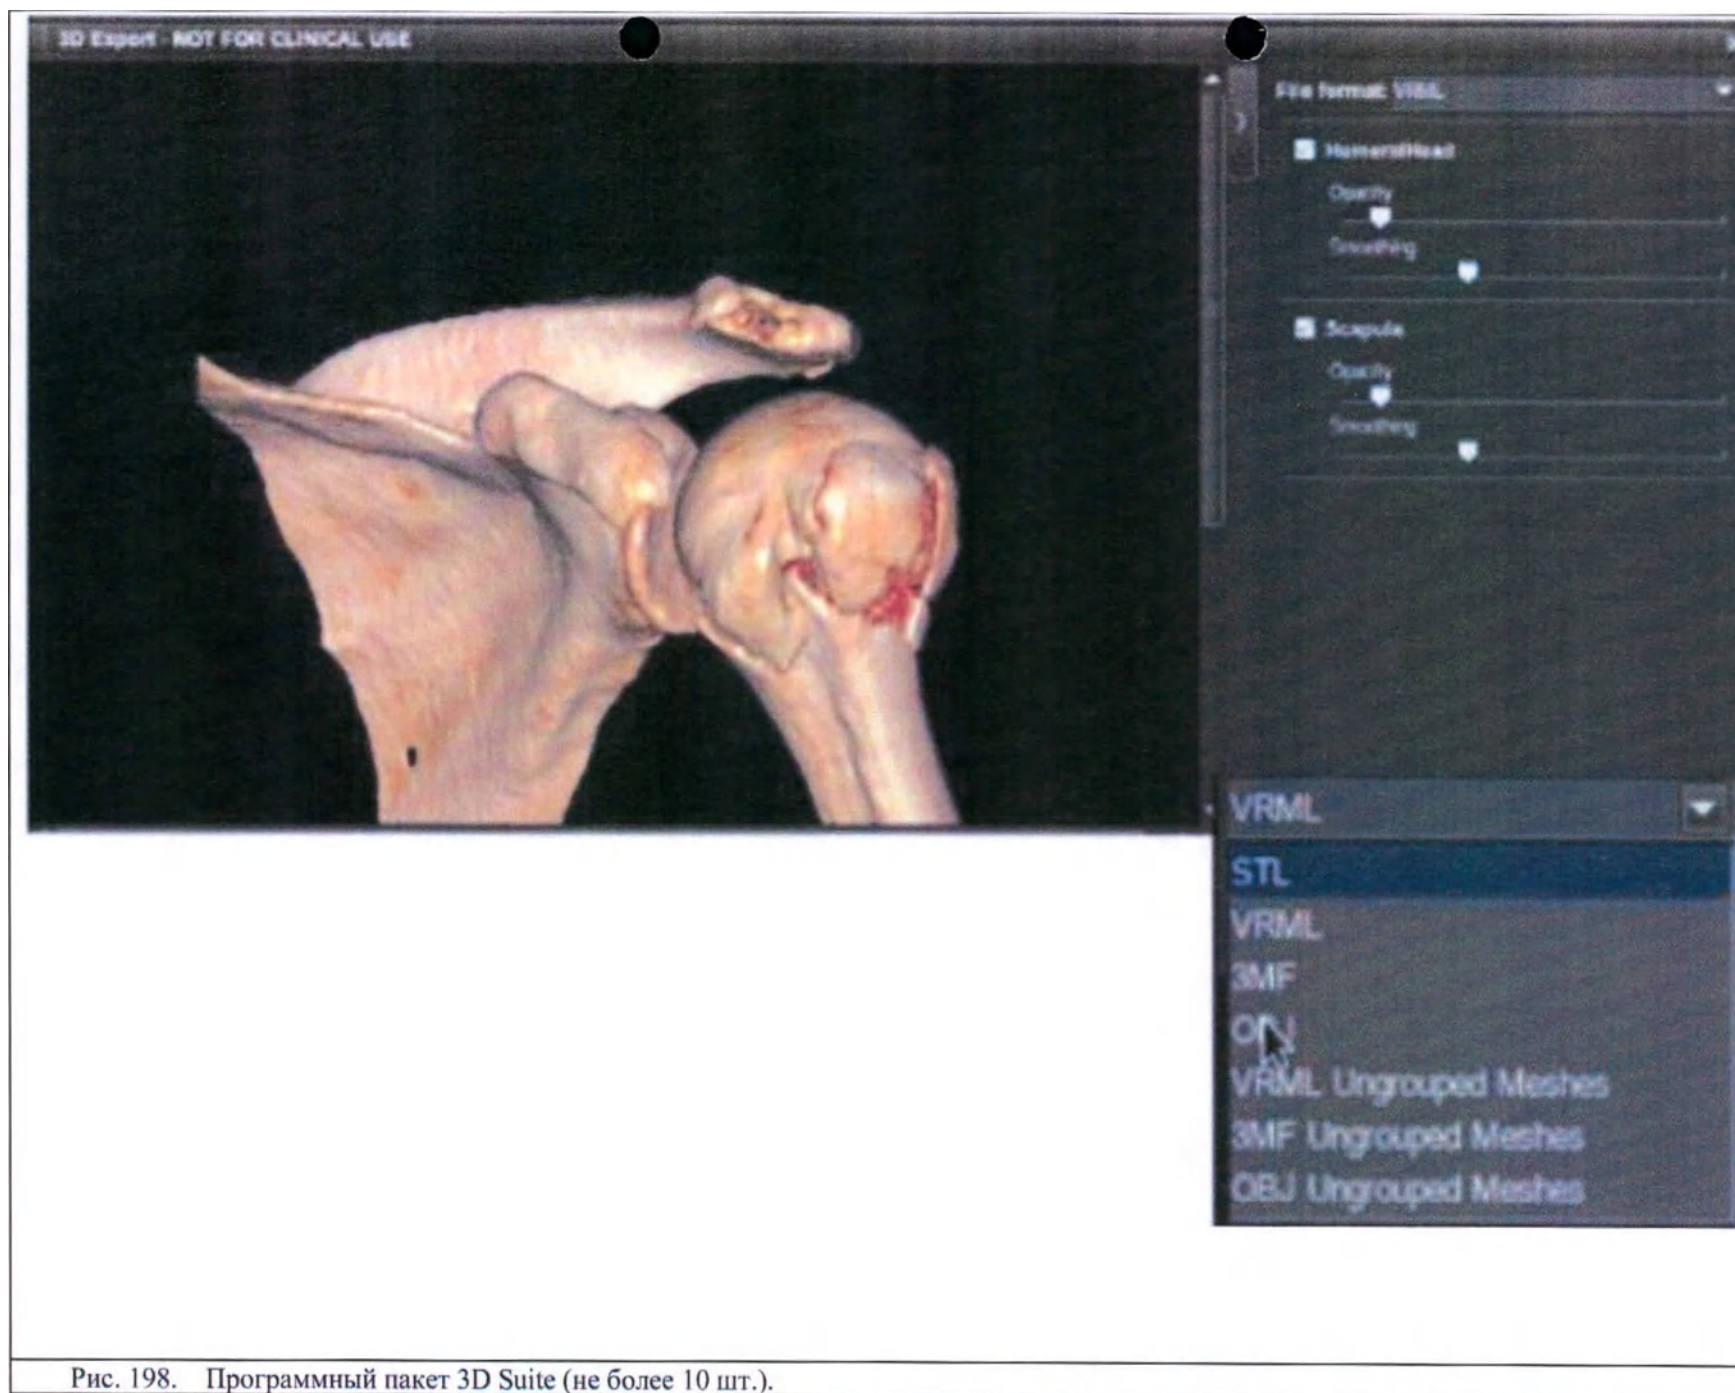


Рис. 198. Программный пакет 3D Suite (не более 10 шт.).

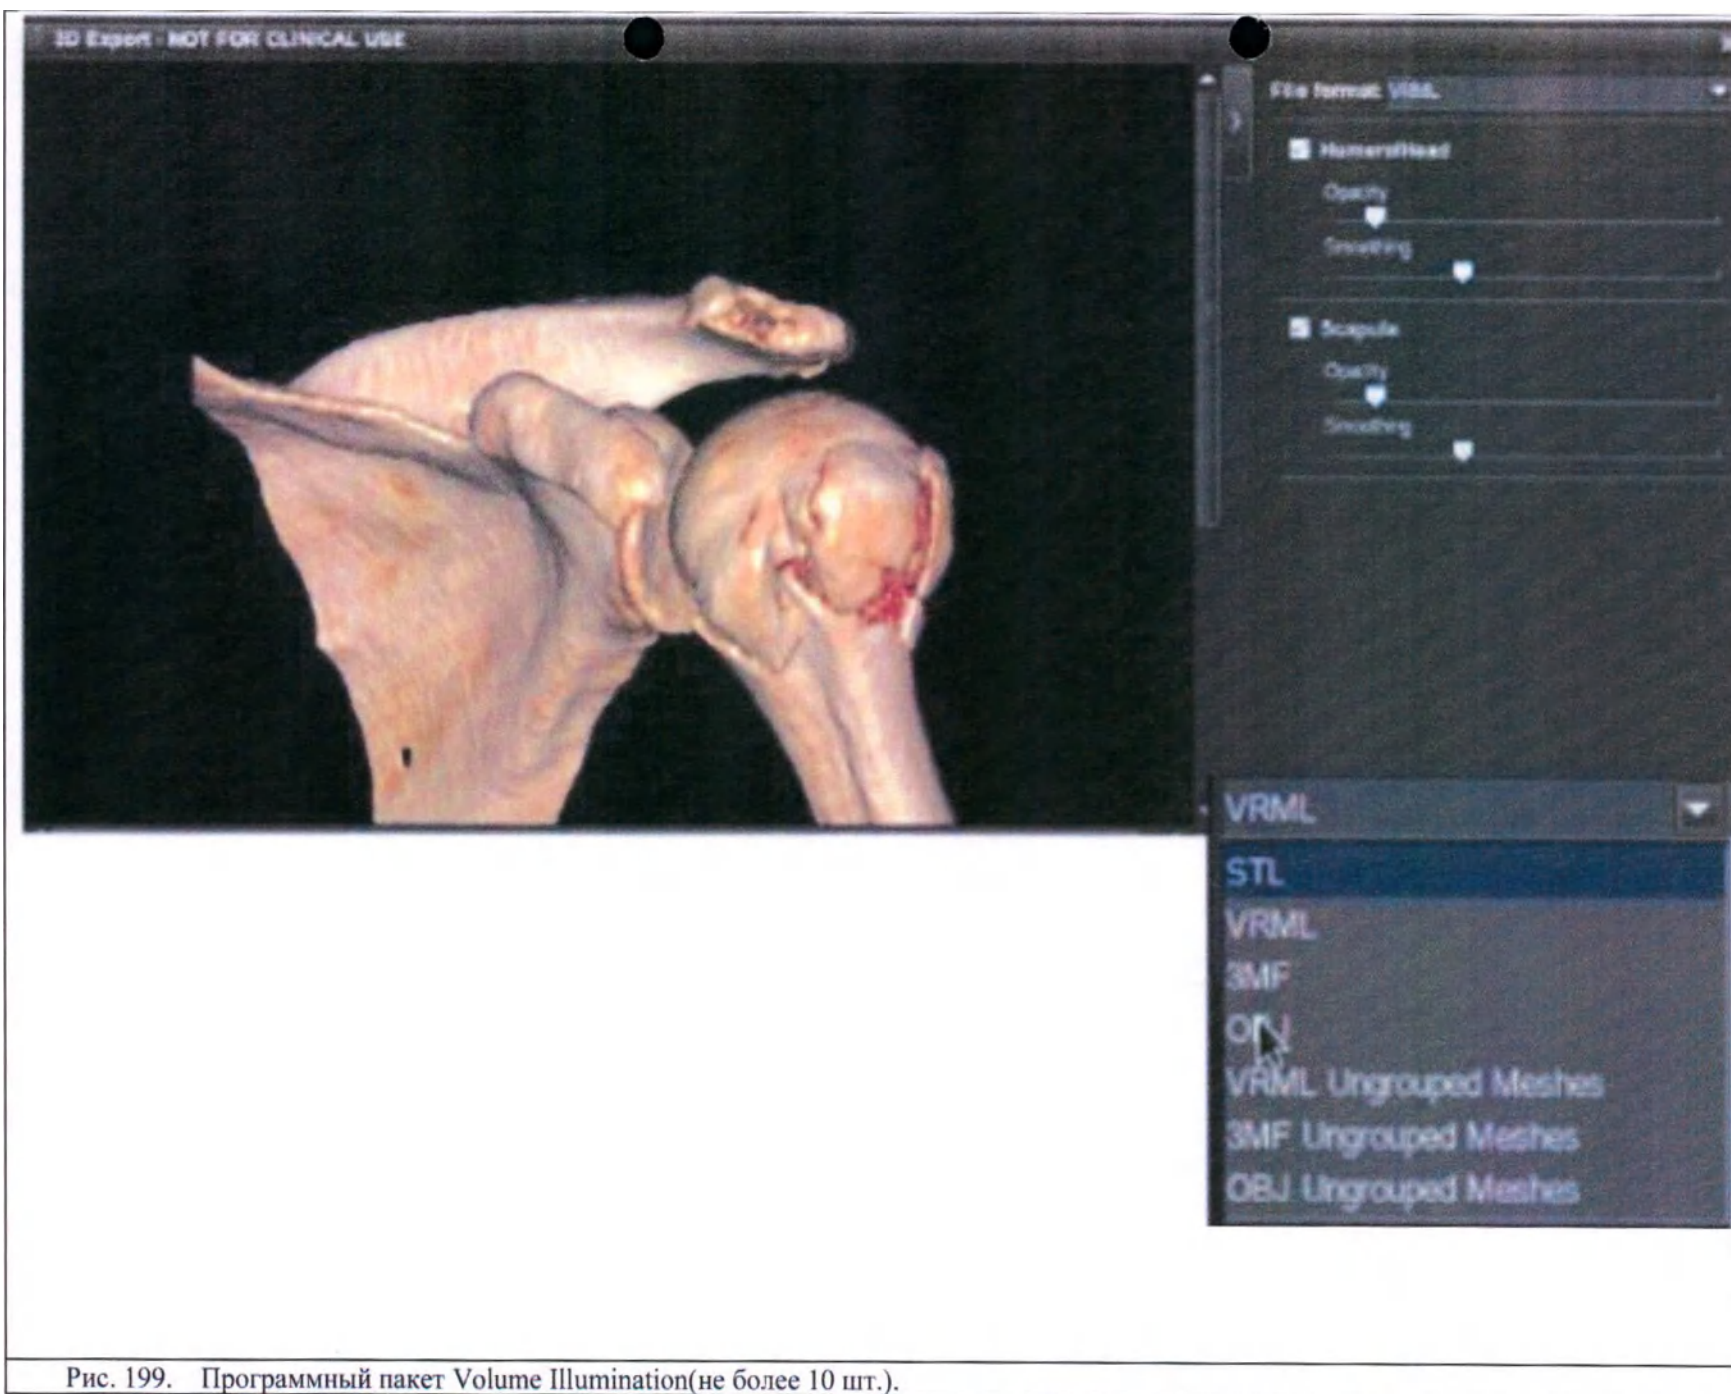


Рис. 199. Программный пакет Volume Illumination(не более 10 шт.).

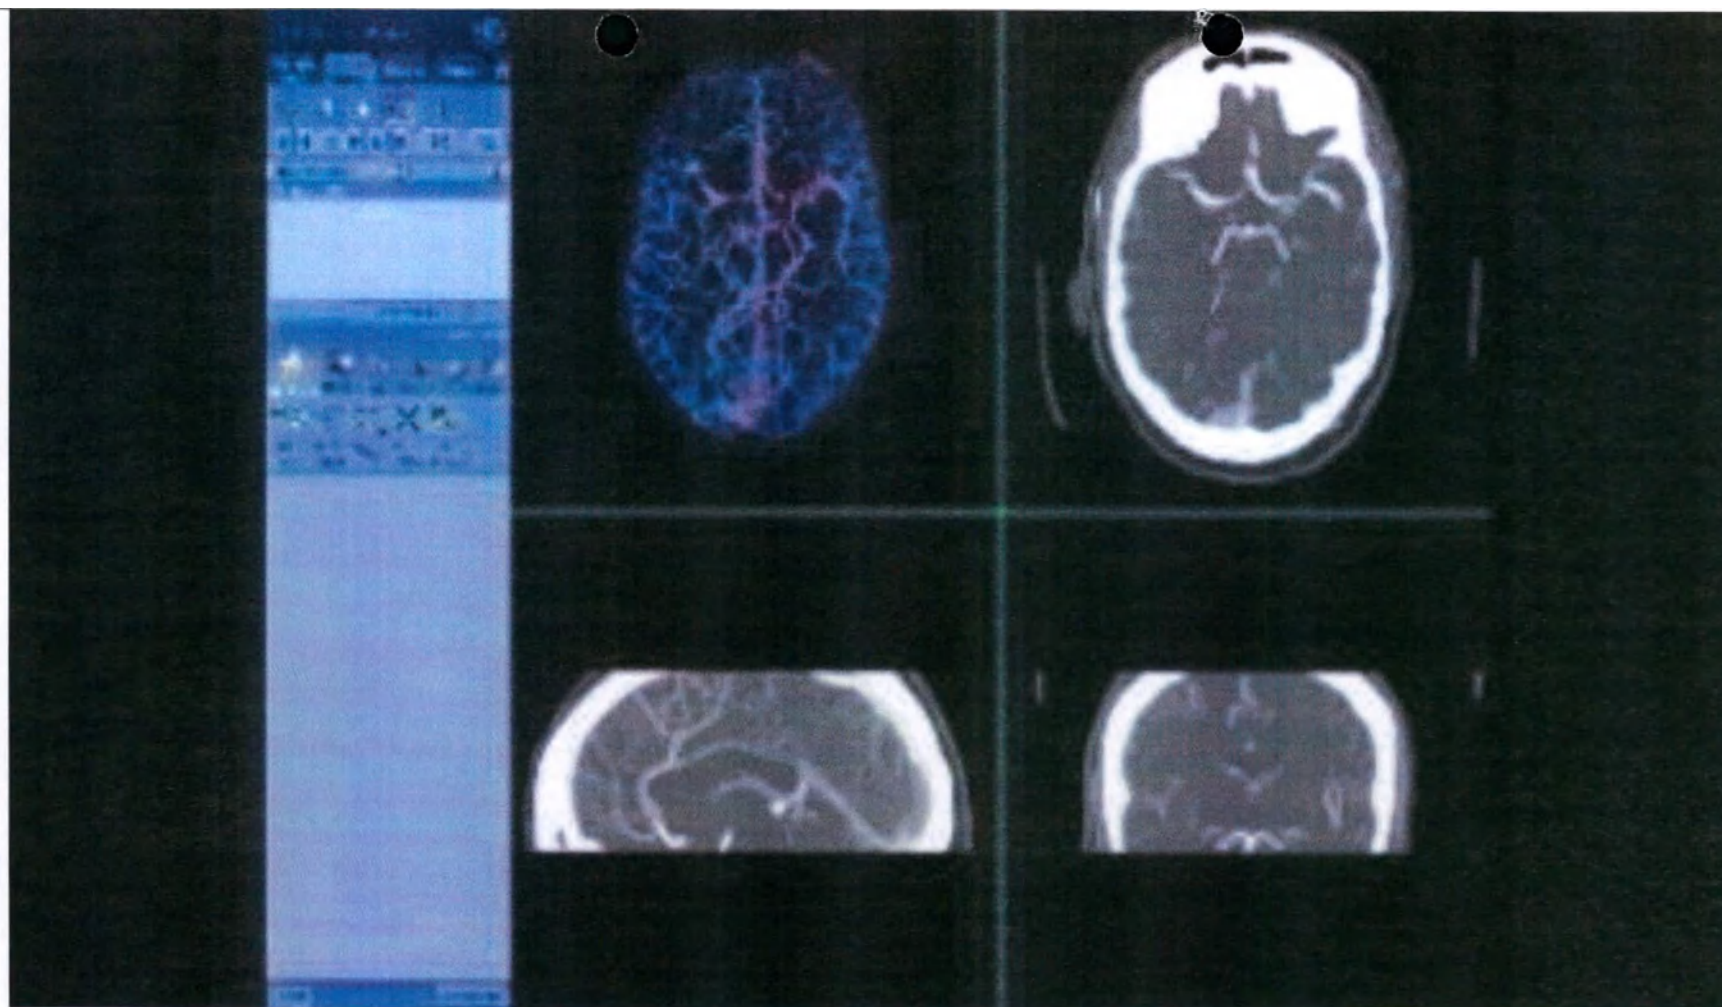


Рис. 200. Программный пакет Dynamic Shuttle (не более 10 шт.).



Рис. 201. Программный пакет Integrated Registration – Full Fusion Package (не более 10 шт.).

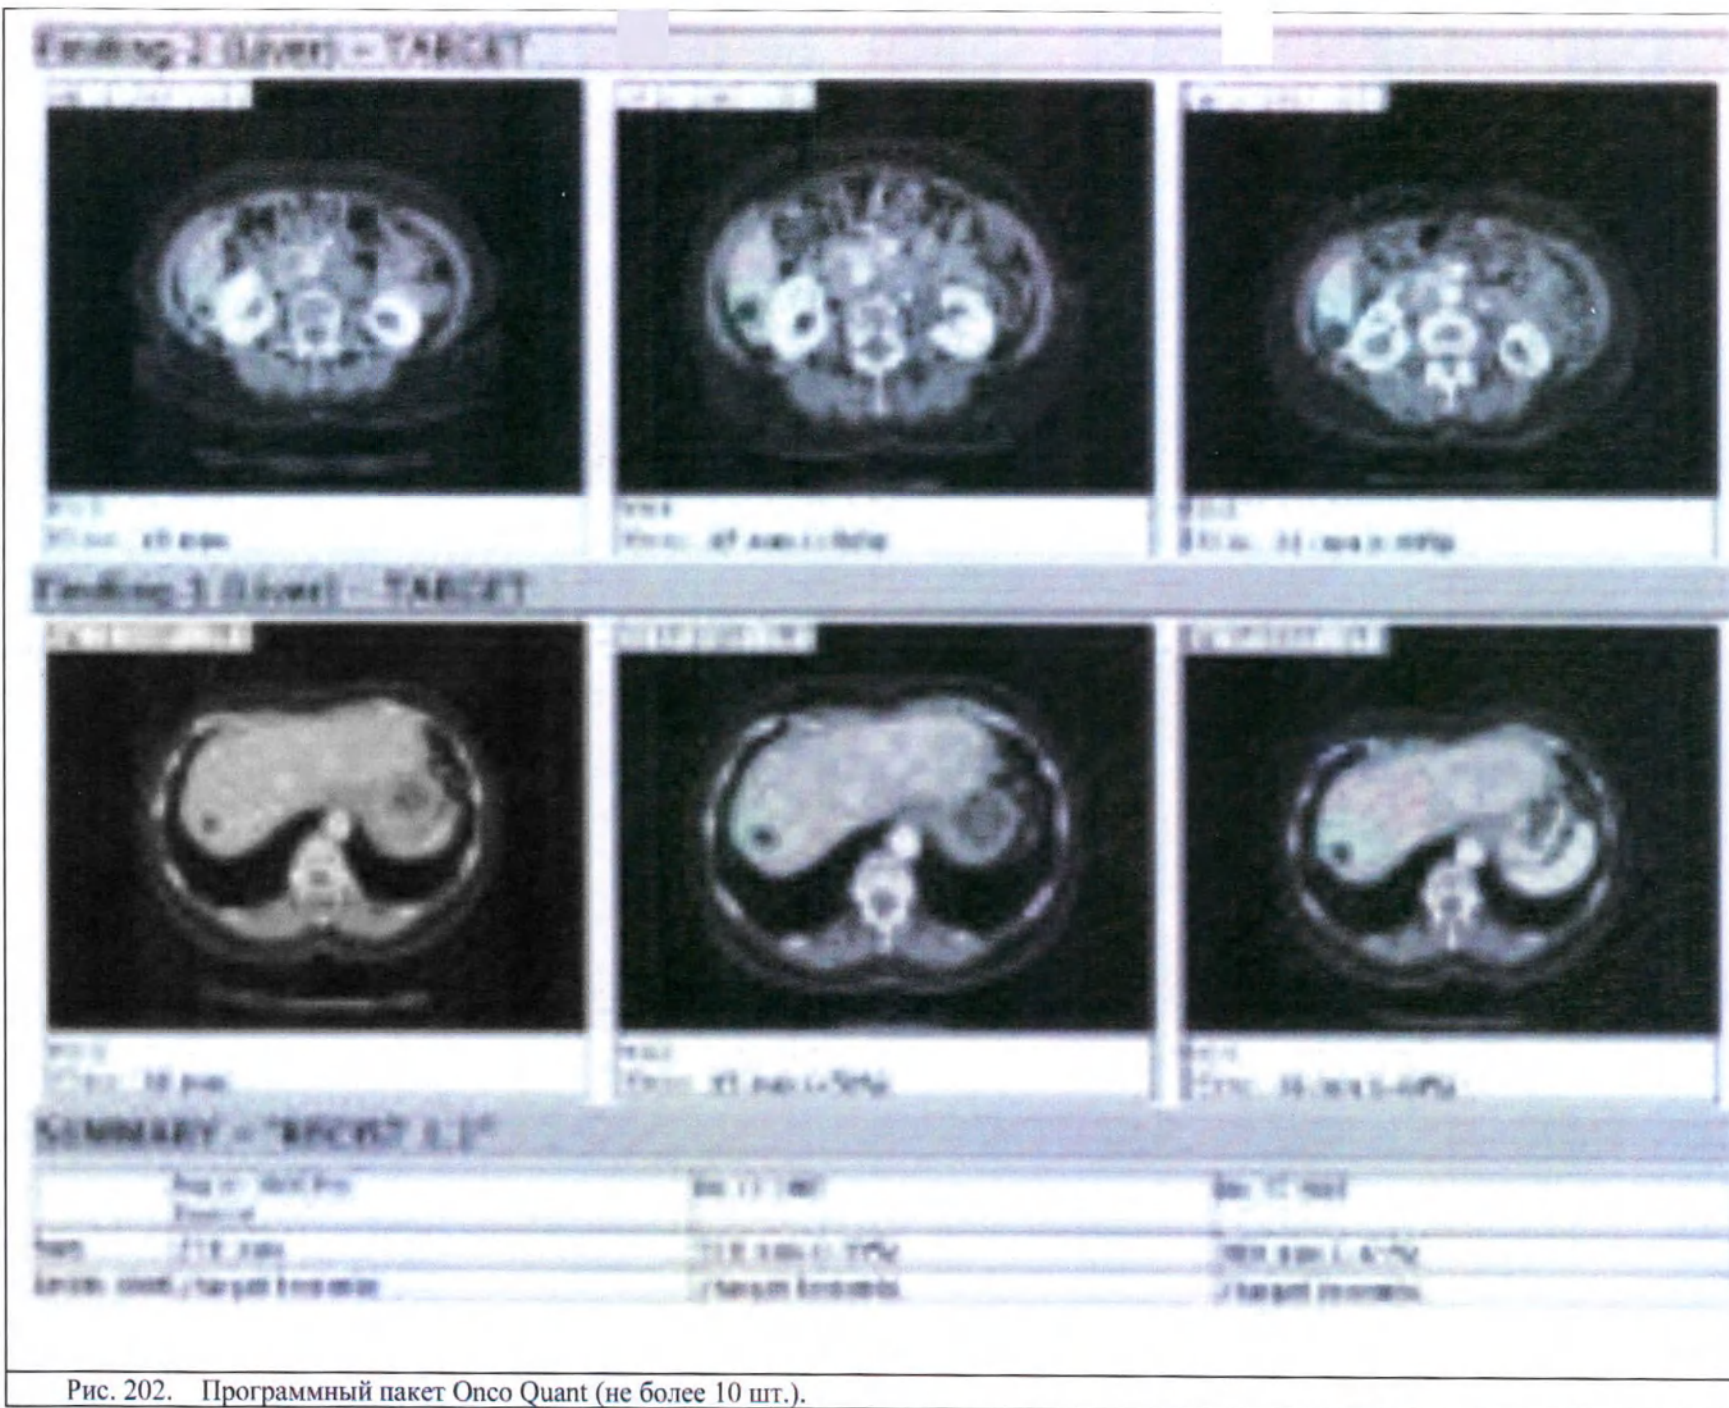


Рис. 202. Программный пакет Onco Quant (не более 10 шт.).

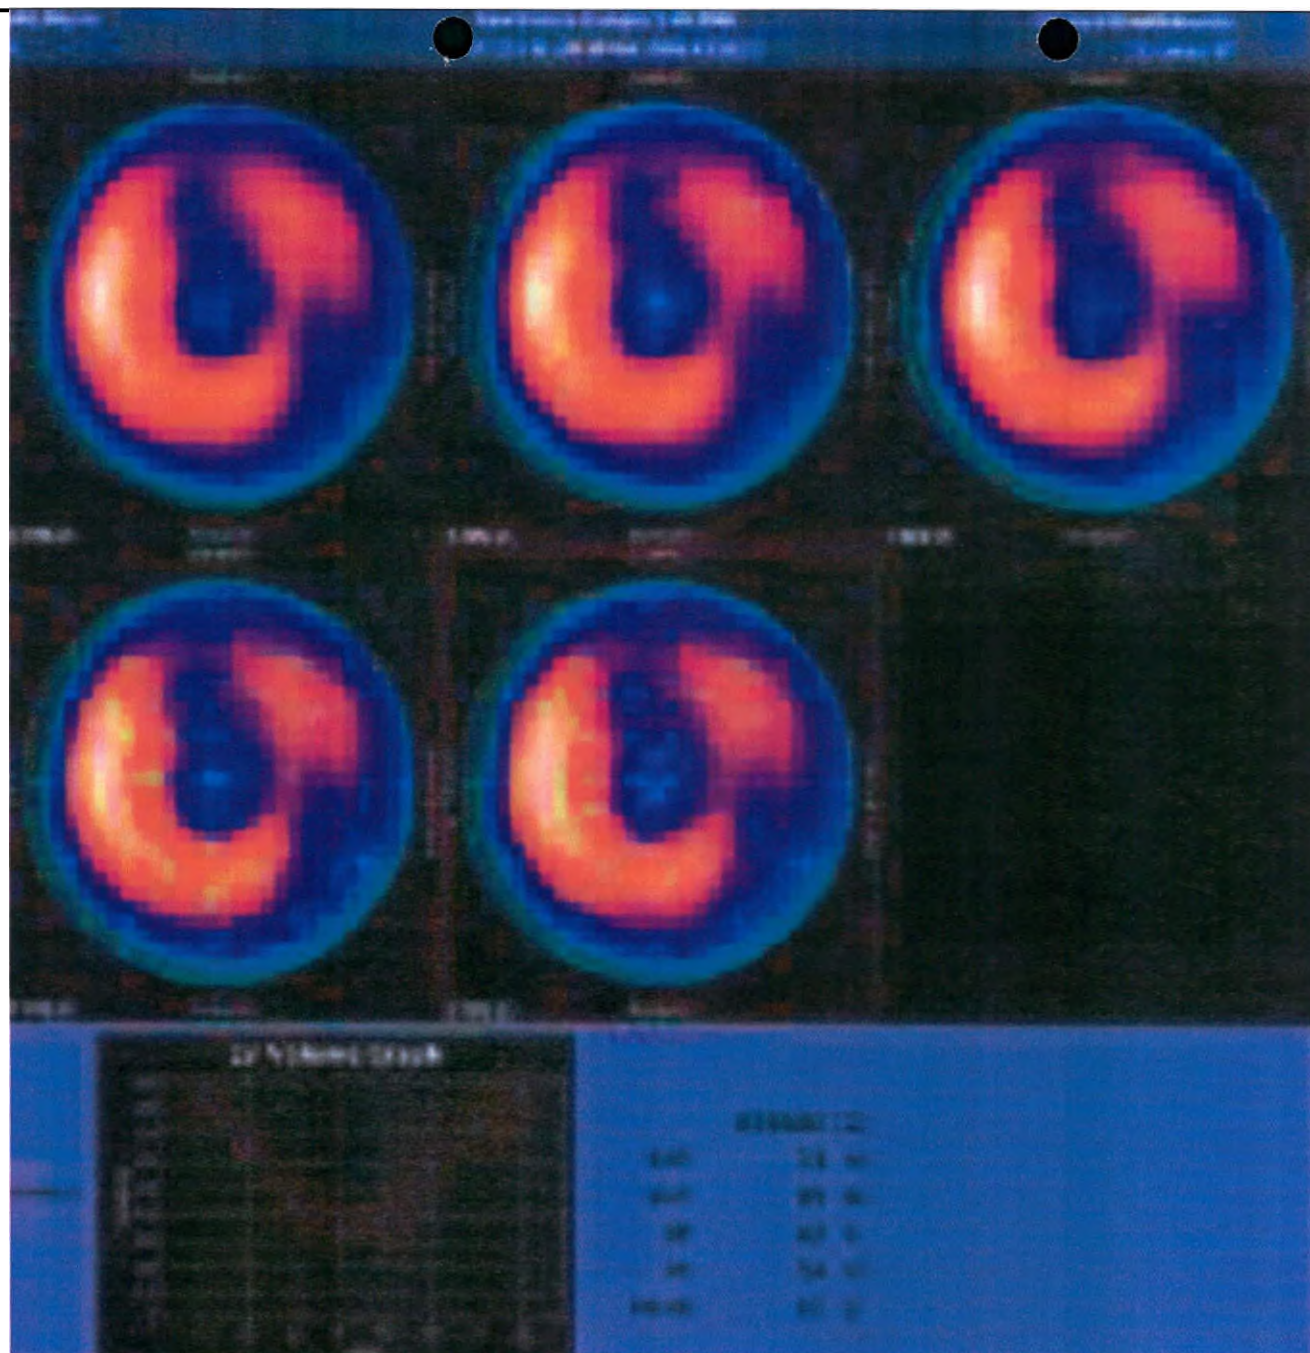


Рис. 203. Программный пакет CardIQ Xpress (не более 10 шт.).

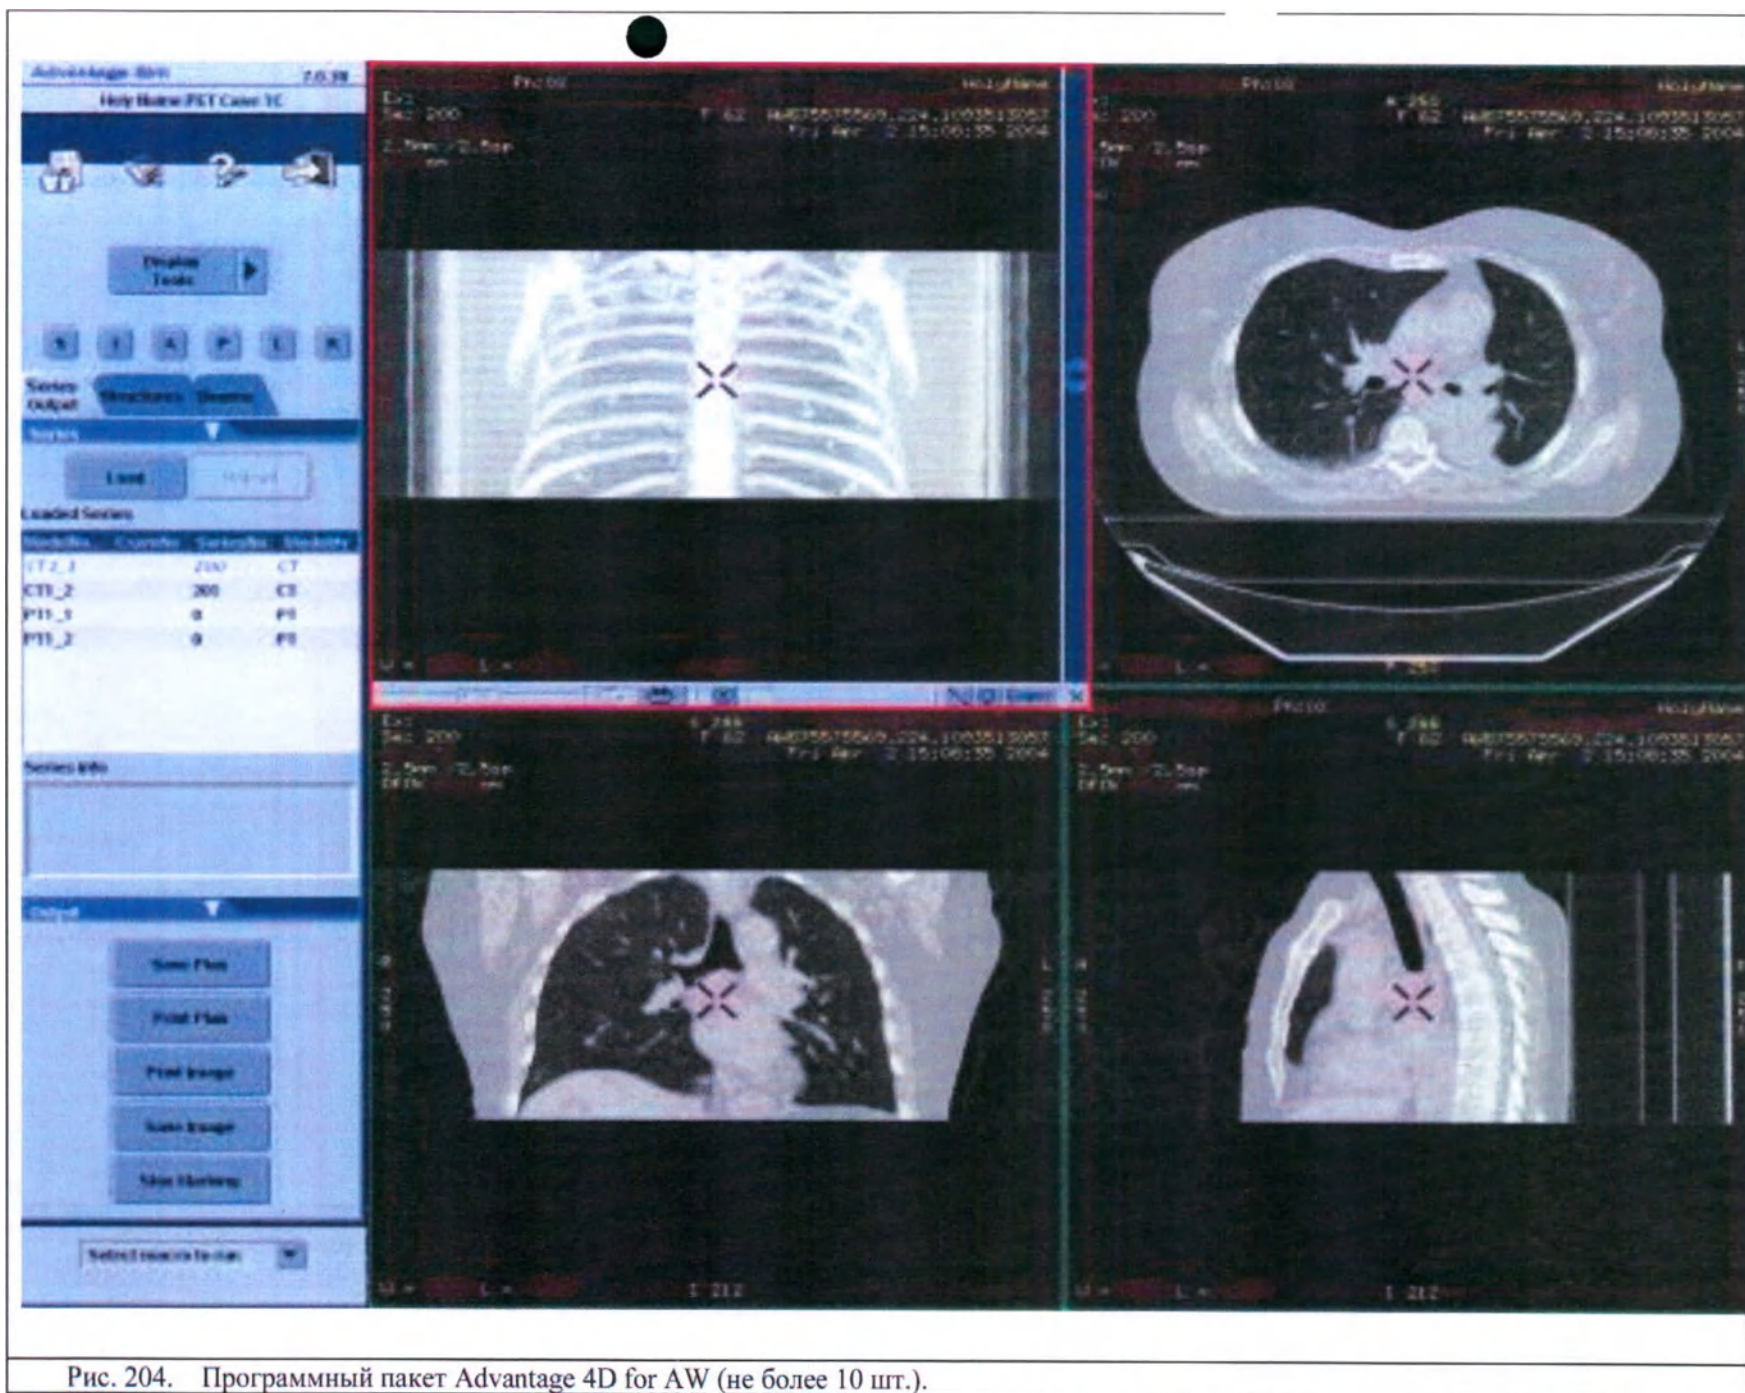


Рис. 204. Программный пакет Advantage 4D for AW (не более 10 шт.).

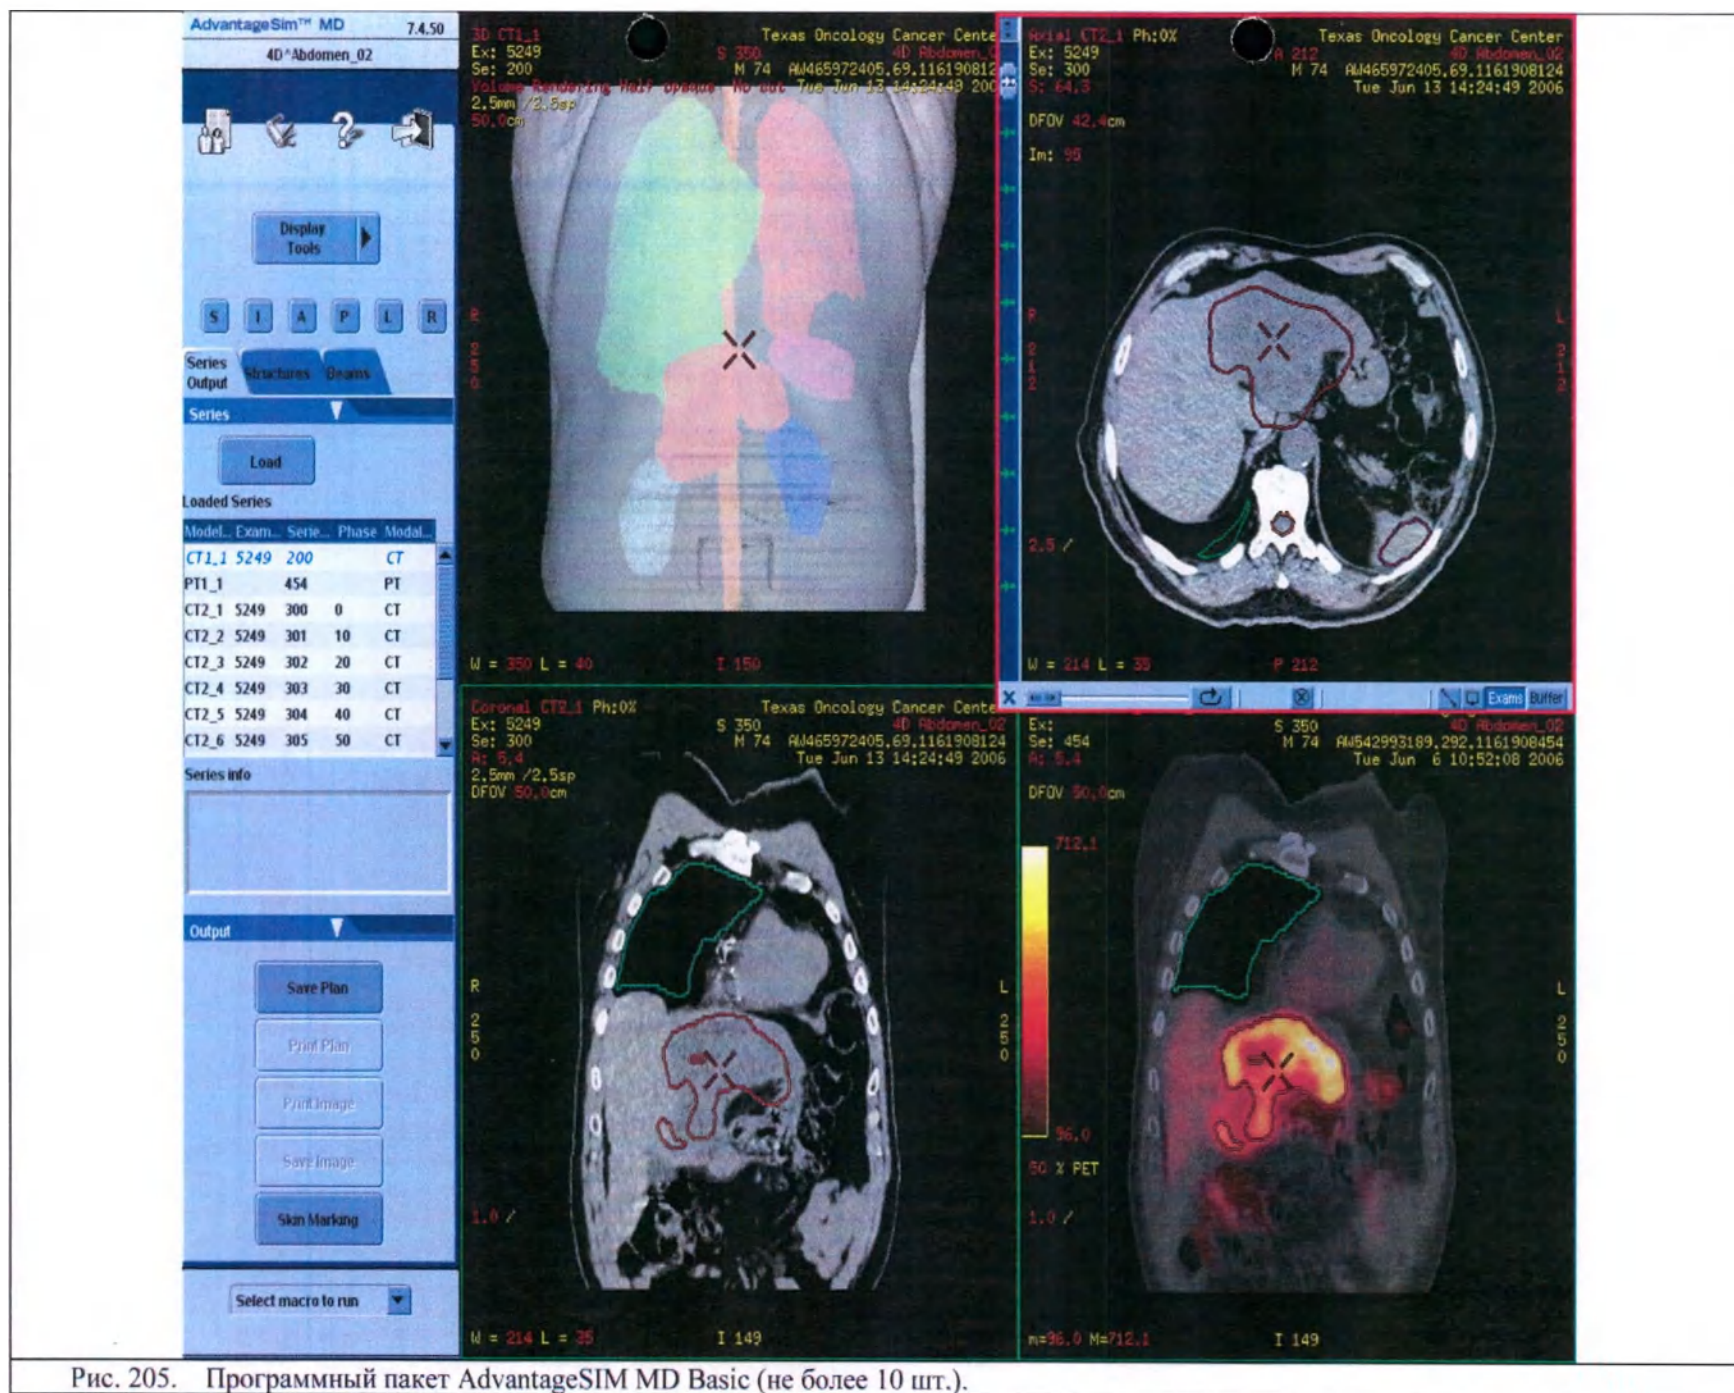


Рис. 205. Программный пакет AdvantageSIM MD Basic (не более 10 шт.).

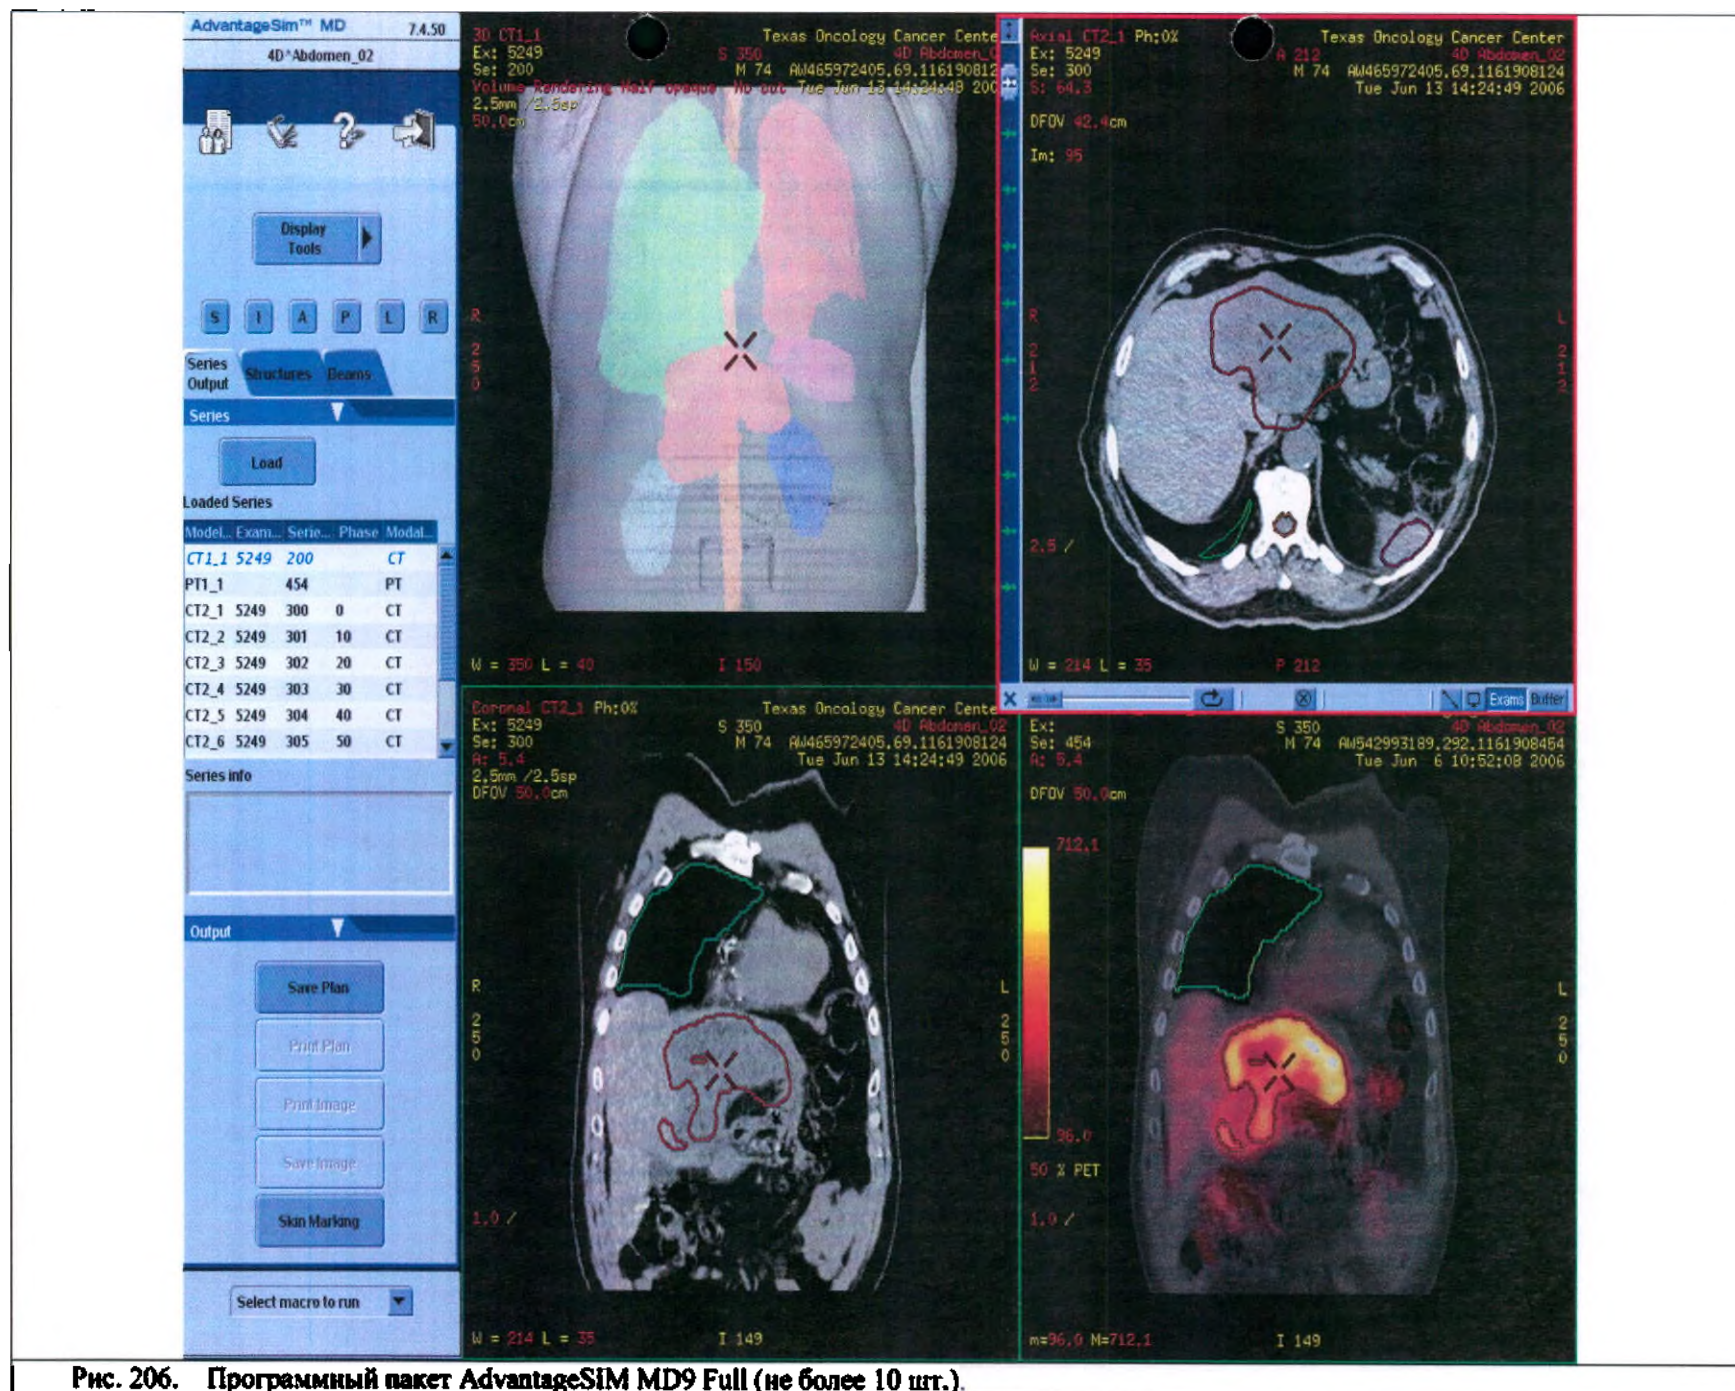



Рис. 206. Программный пакет AdvantageSIM MD9 Full (не более 10 стр.).



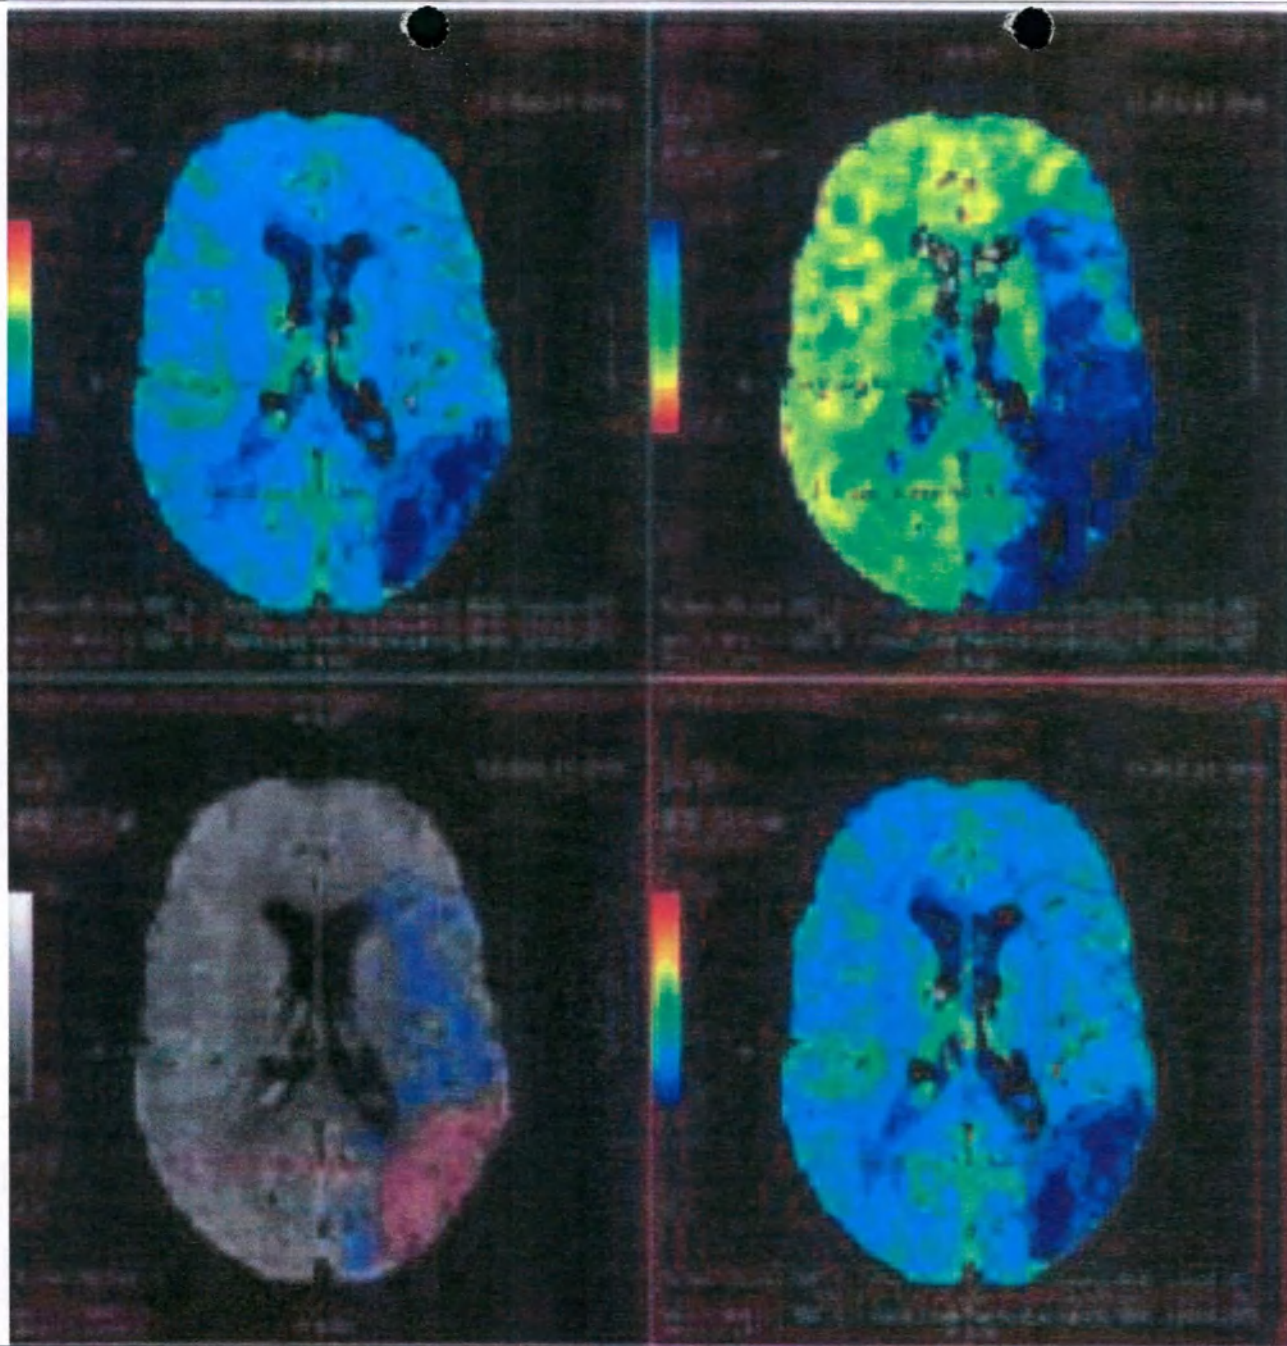


Рис. 208. Программный пакет для нейро исследований (не более 10 шт.).

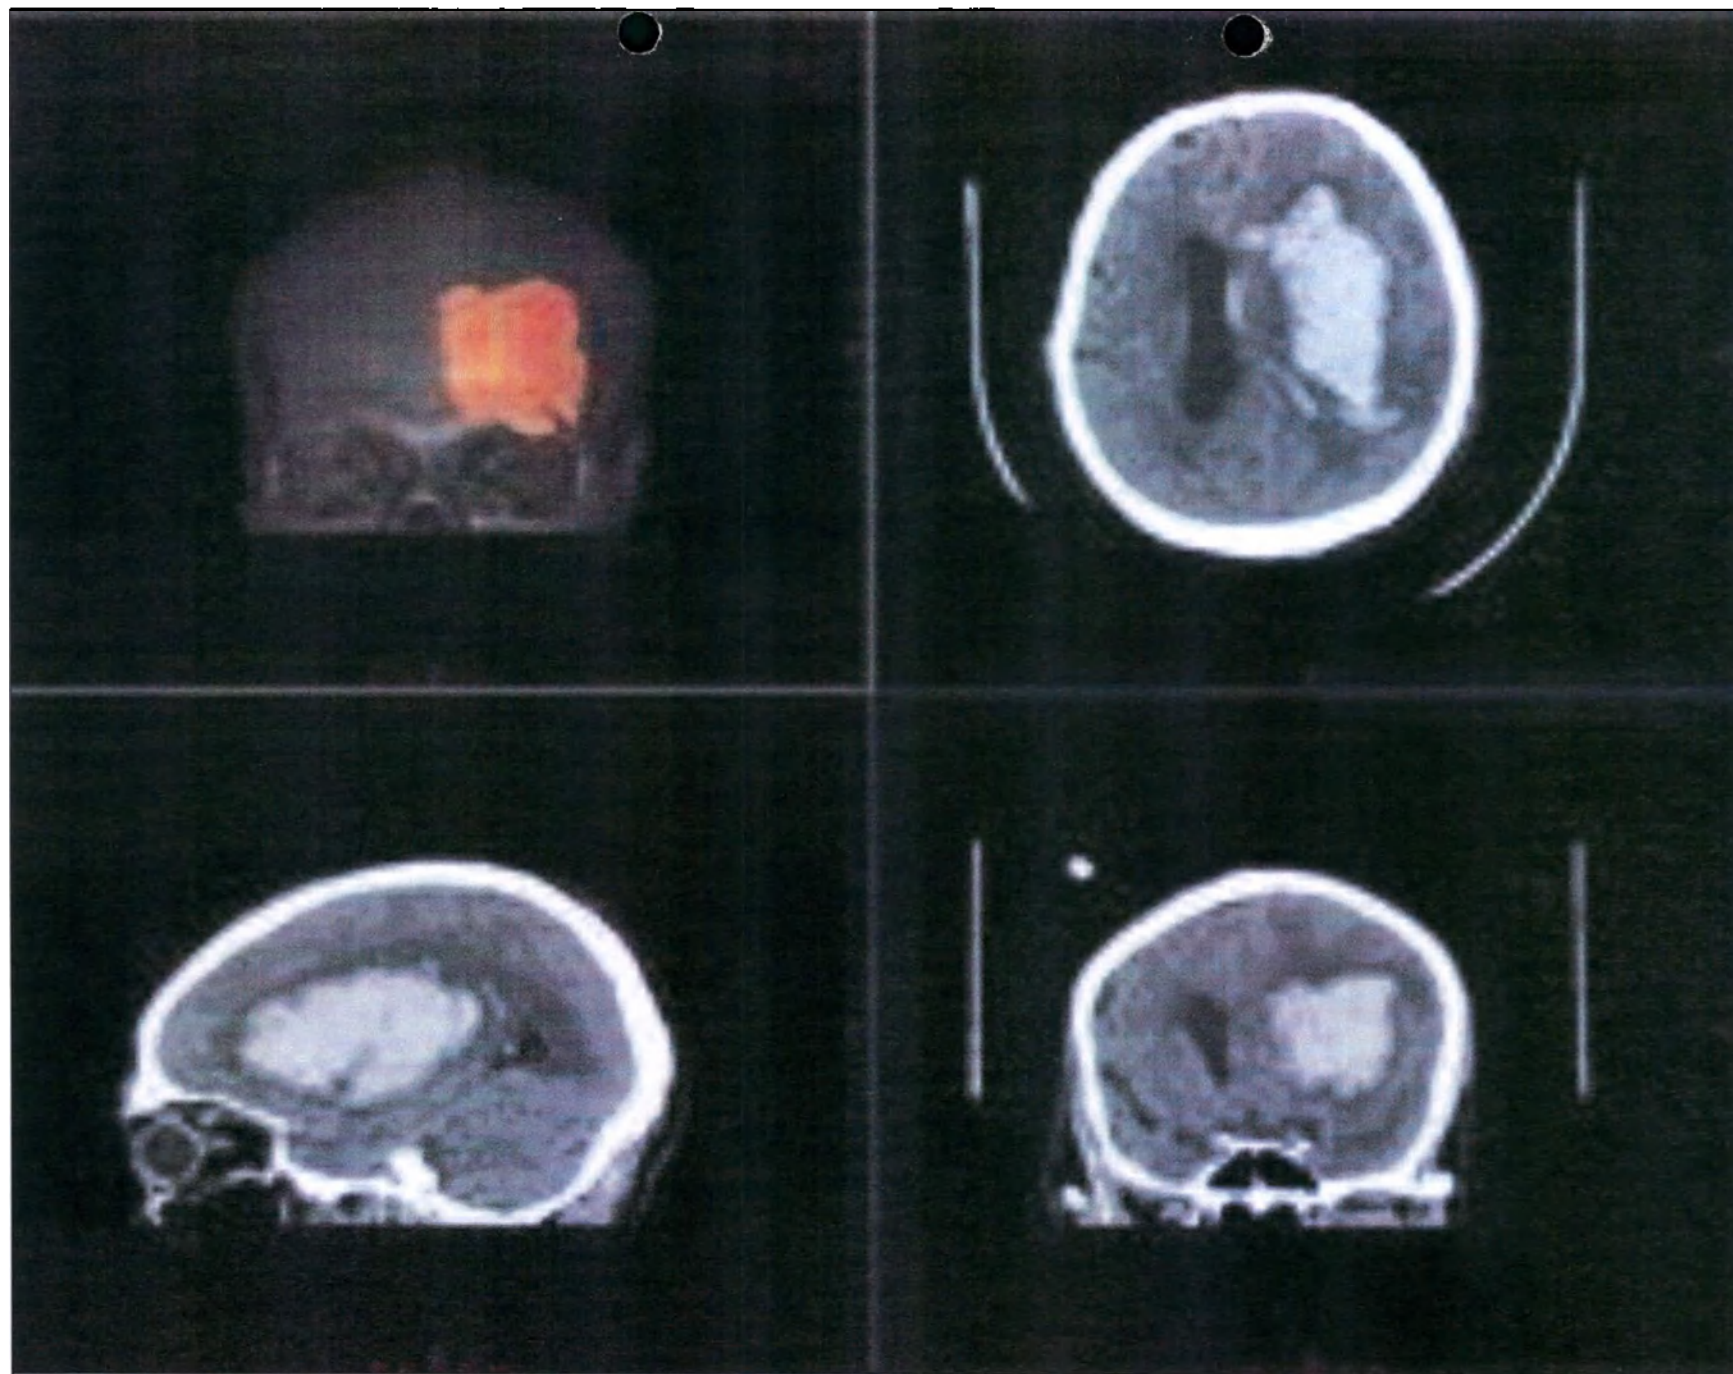


Рис. 209. Программный пакет для нейро исследований (не более 10 шт.).

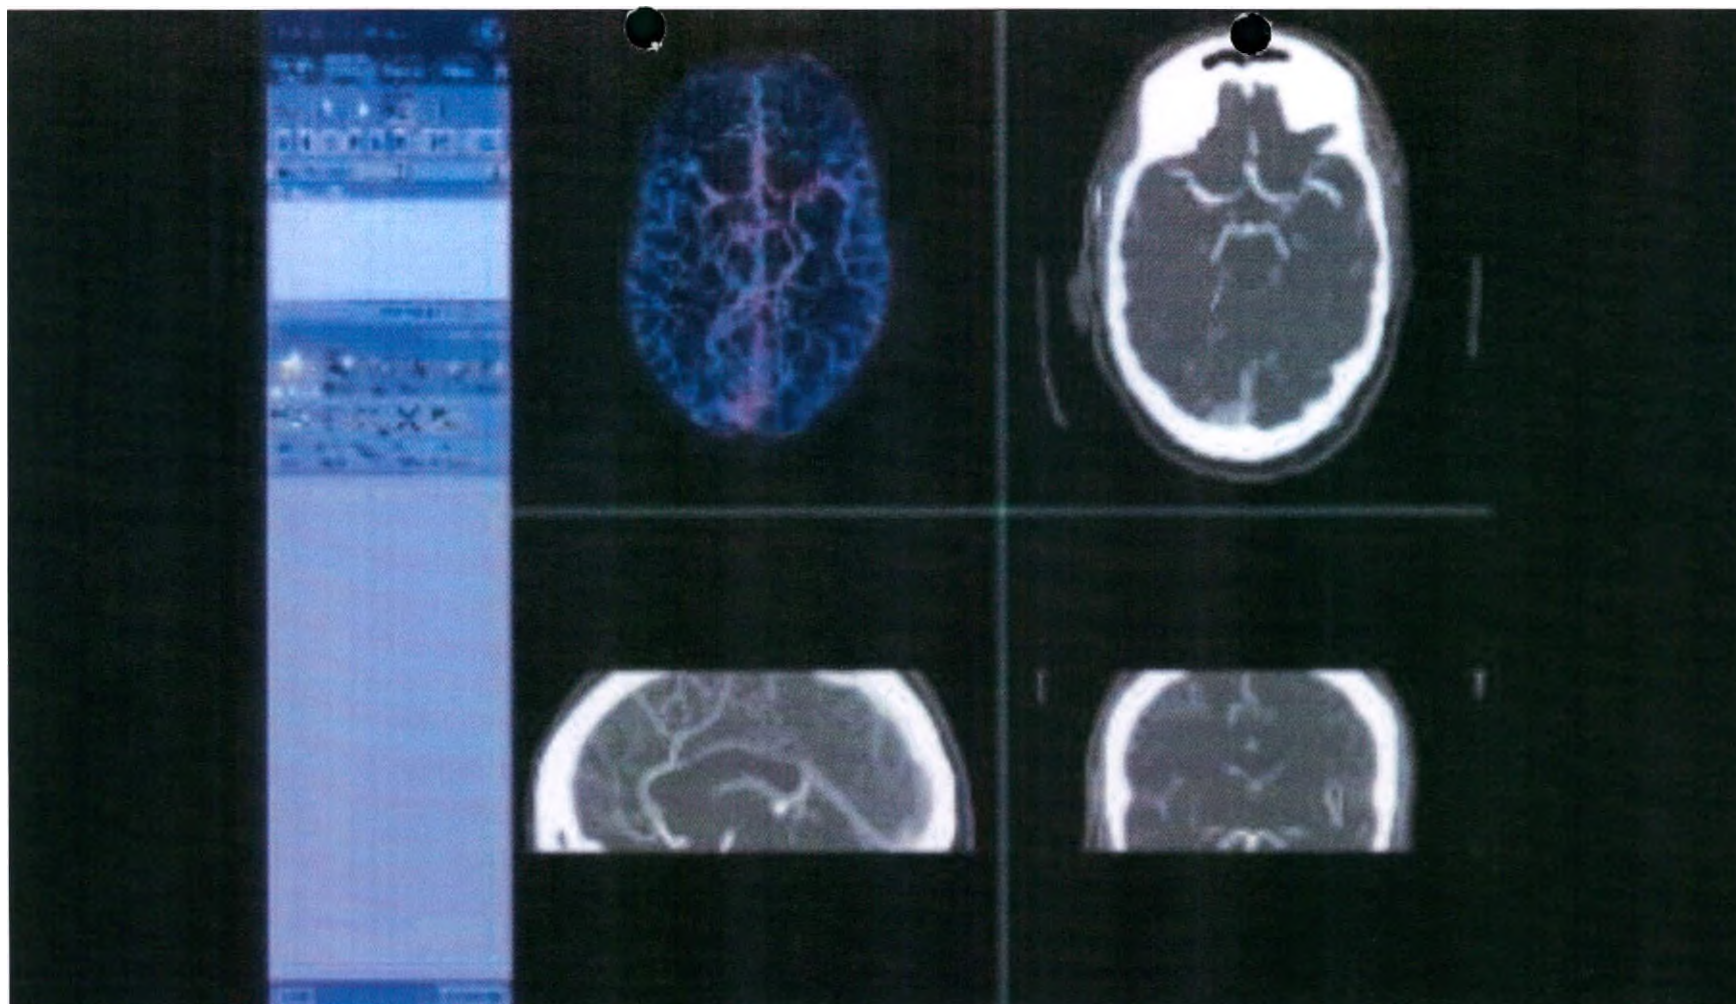


Рис. 210. Программный пакет для нейро исследований (не более 10 шт.).

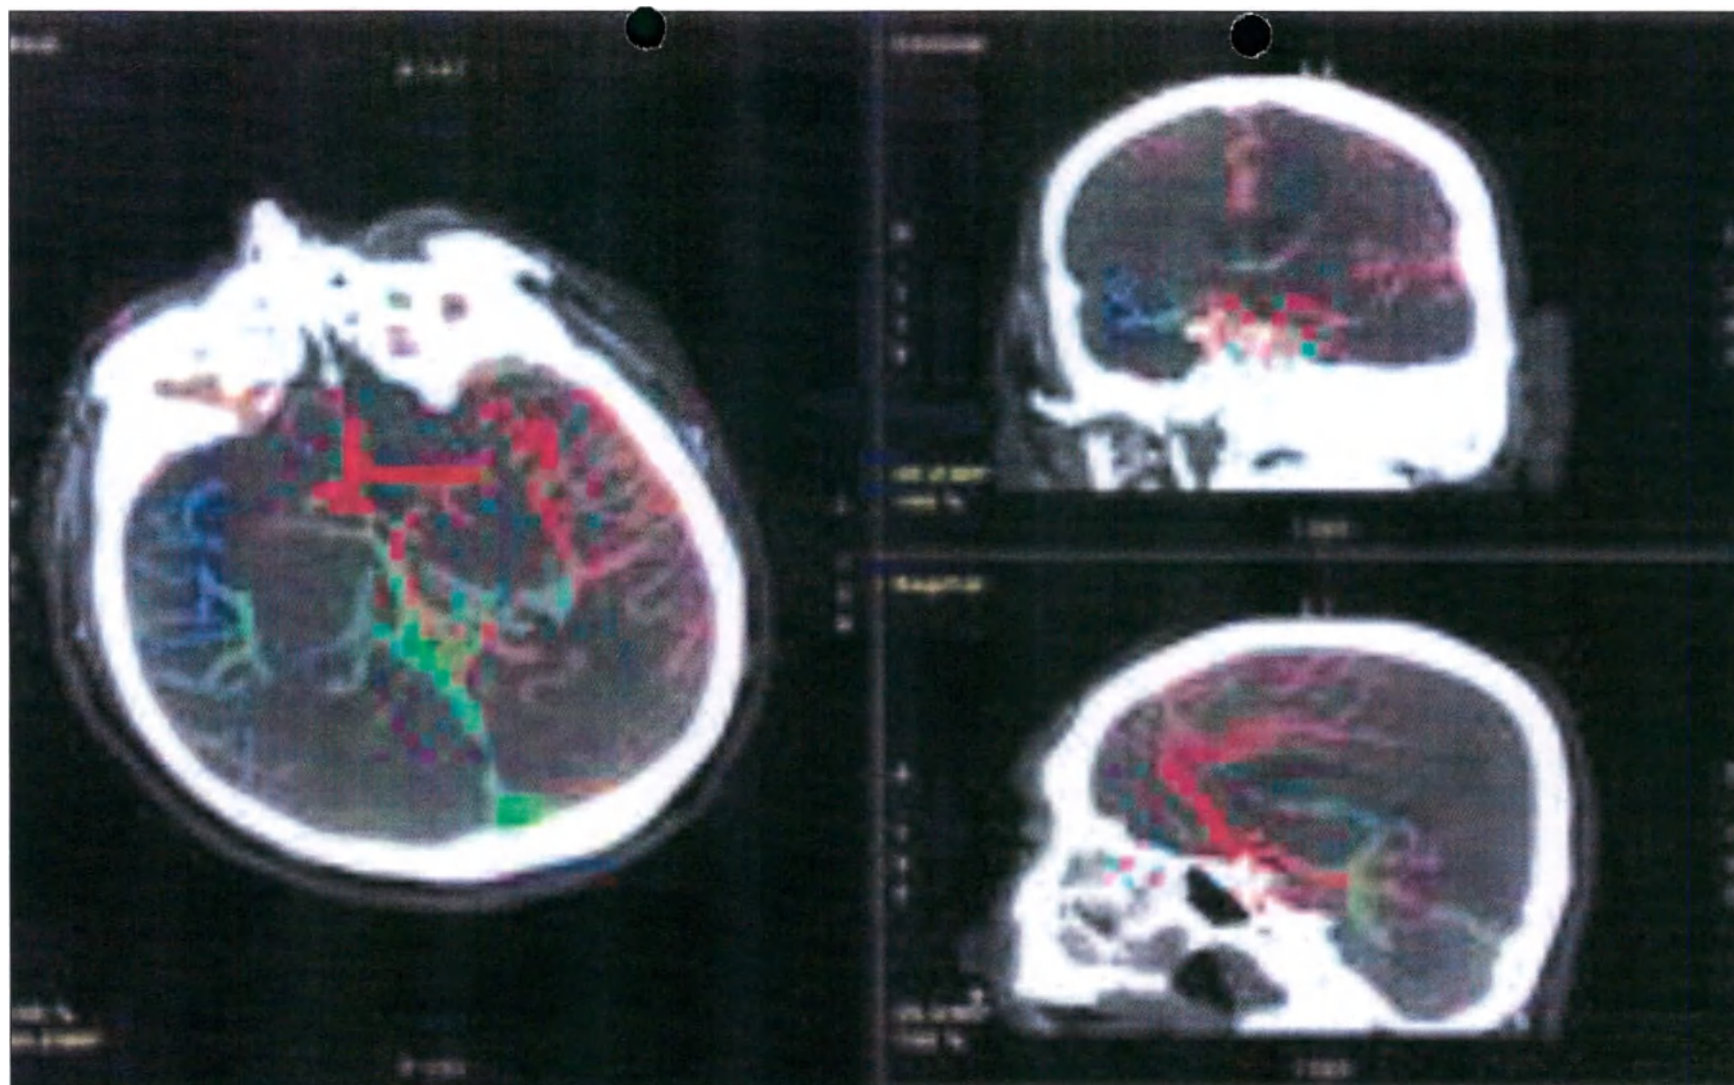


Рис. 211. Программный пакет для нейро исследований (не более 10 шт.).

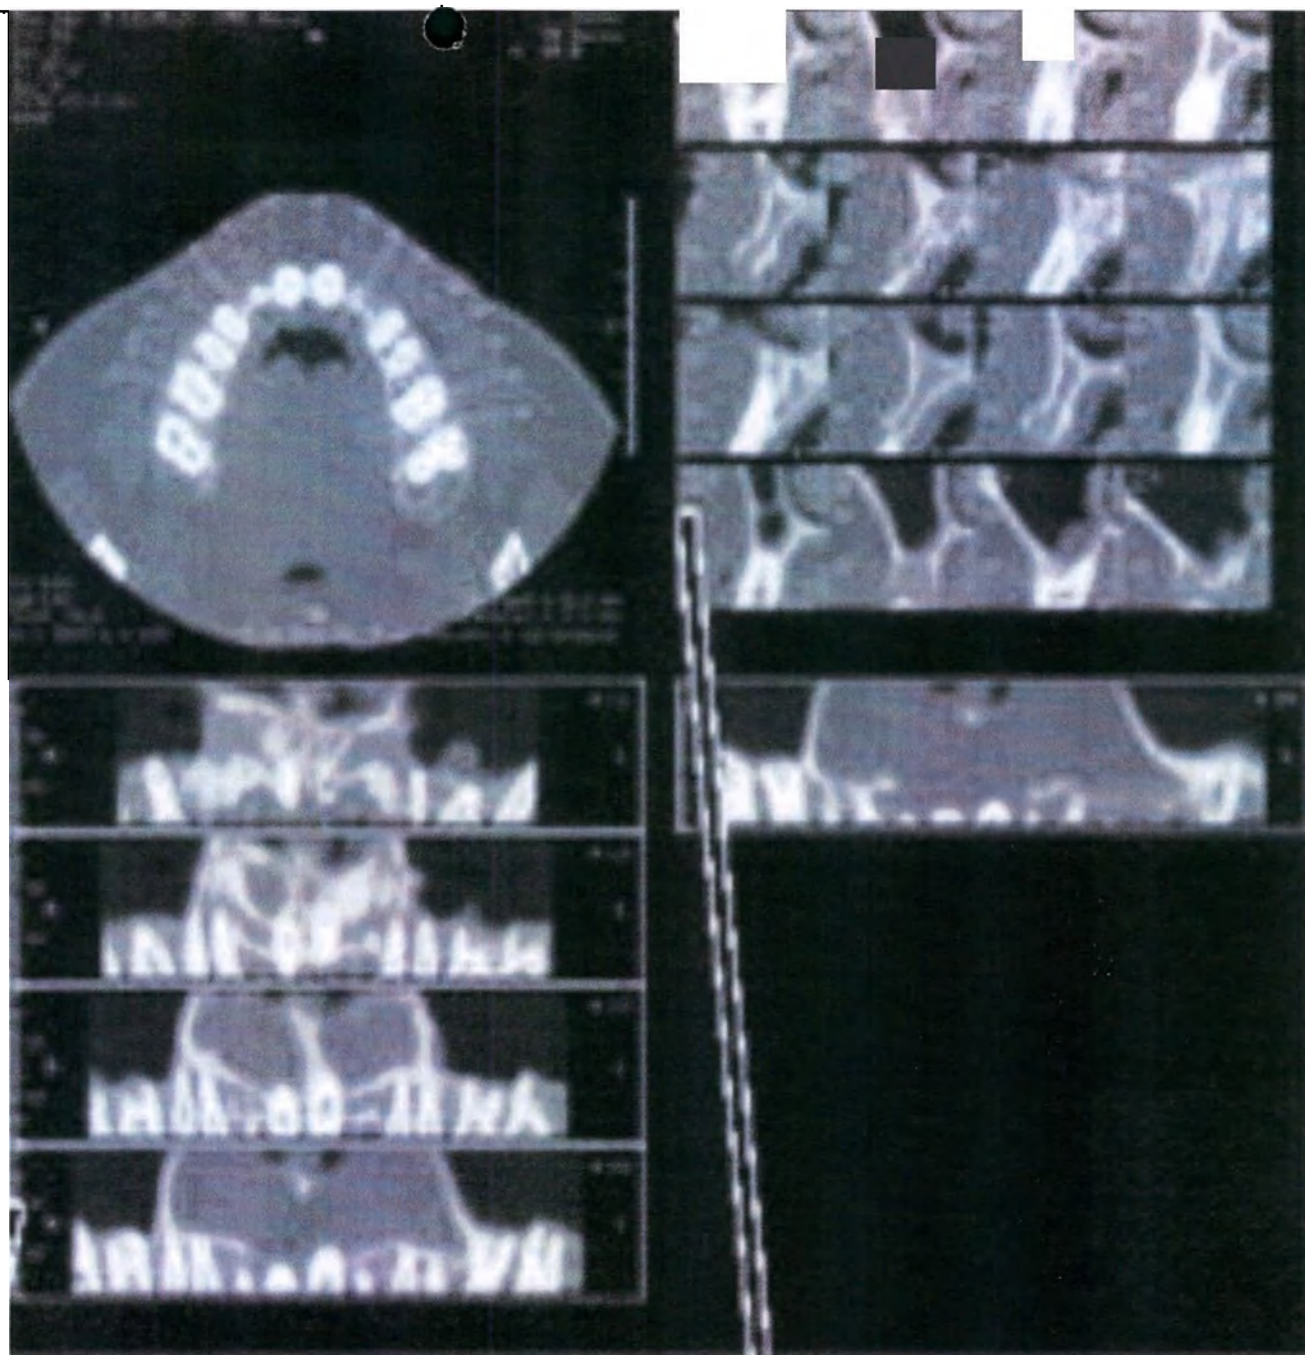


Рис. 212. Программный пакет DentaScan Software (не более 10 шт.).

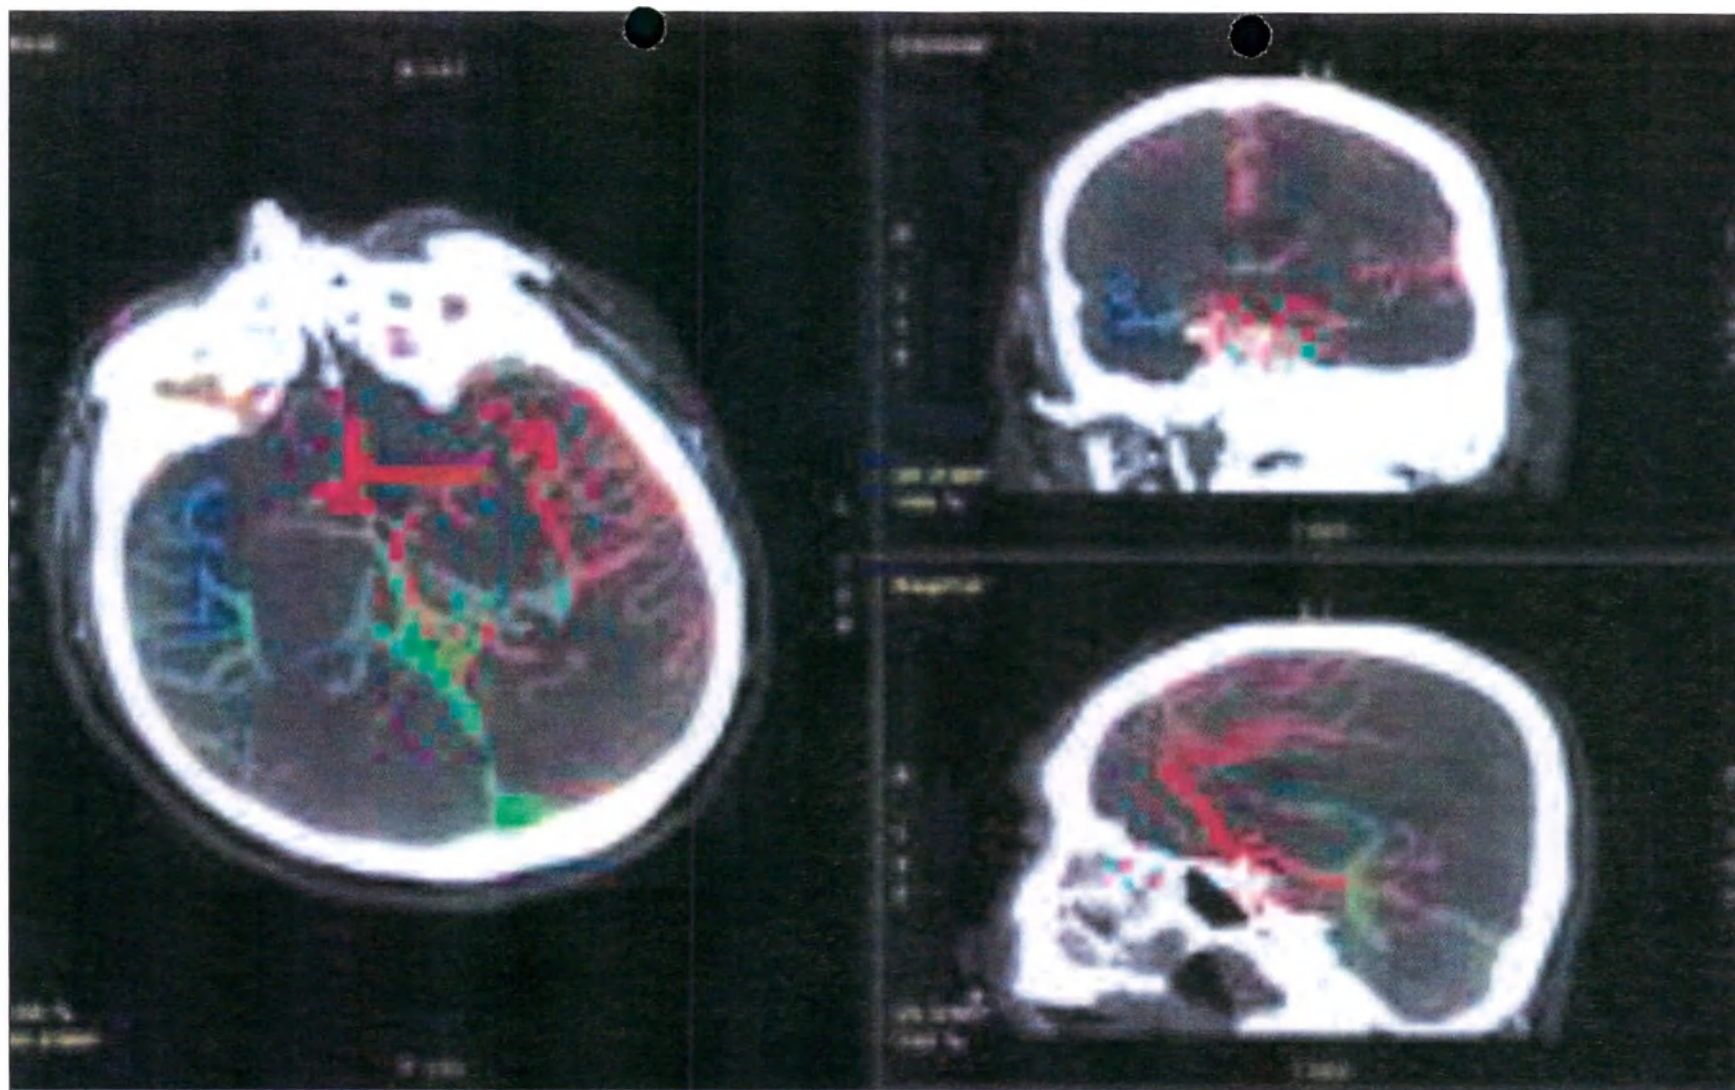


Рис. 213. Программный пакет FastStroke (не более 10 шт.).

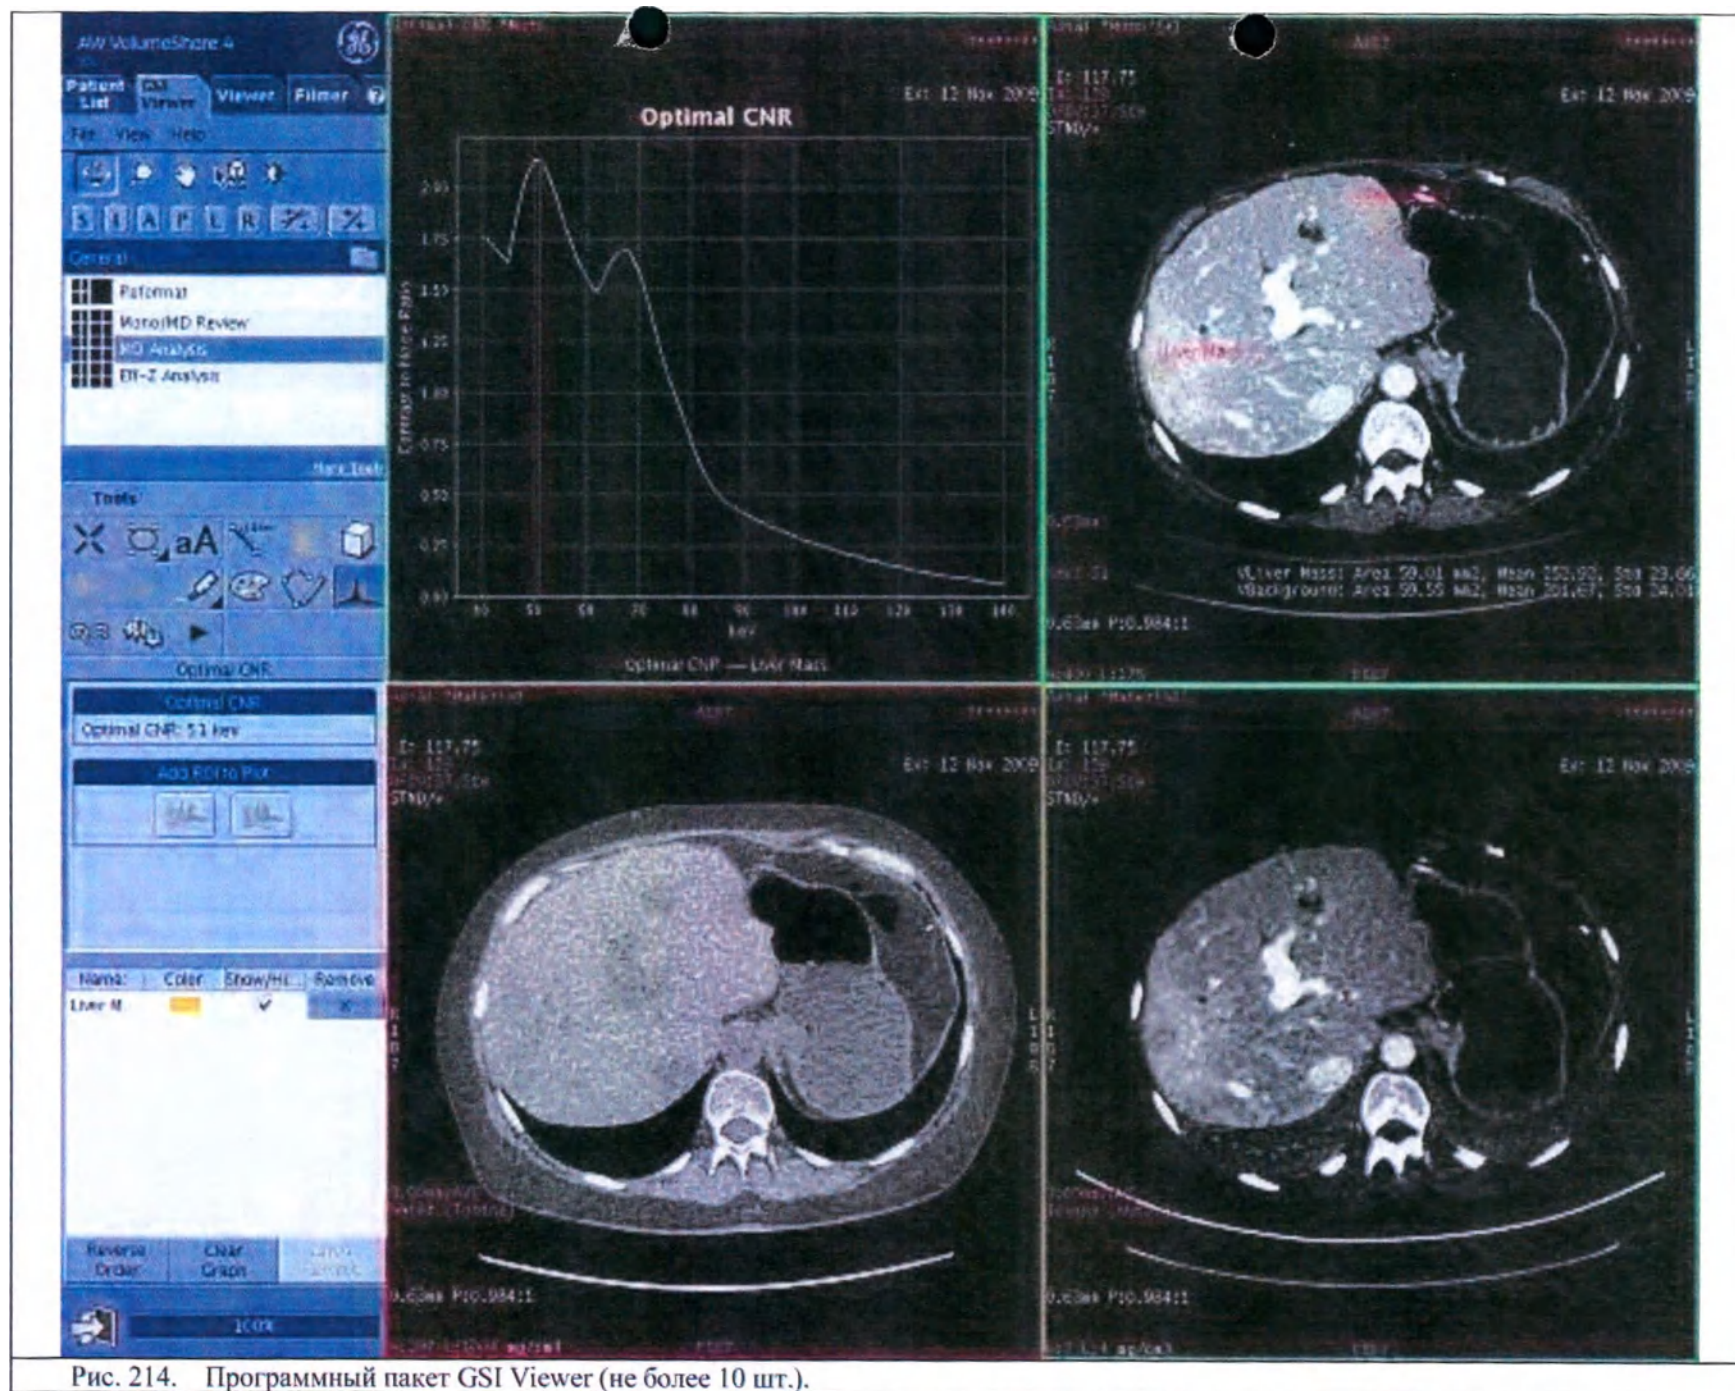


Рис. 214. Программный пакет GSI Viewer (не более 10 шт.).

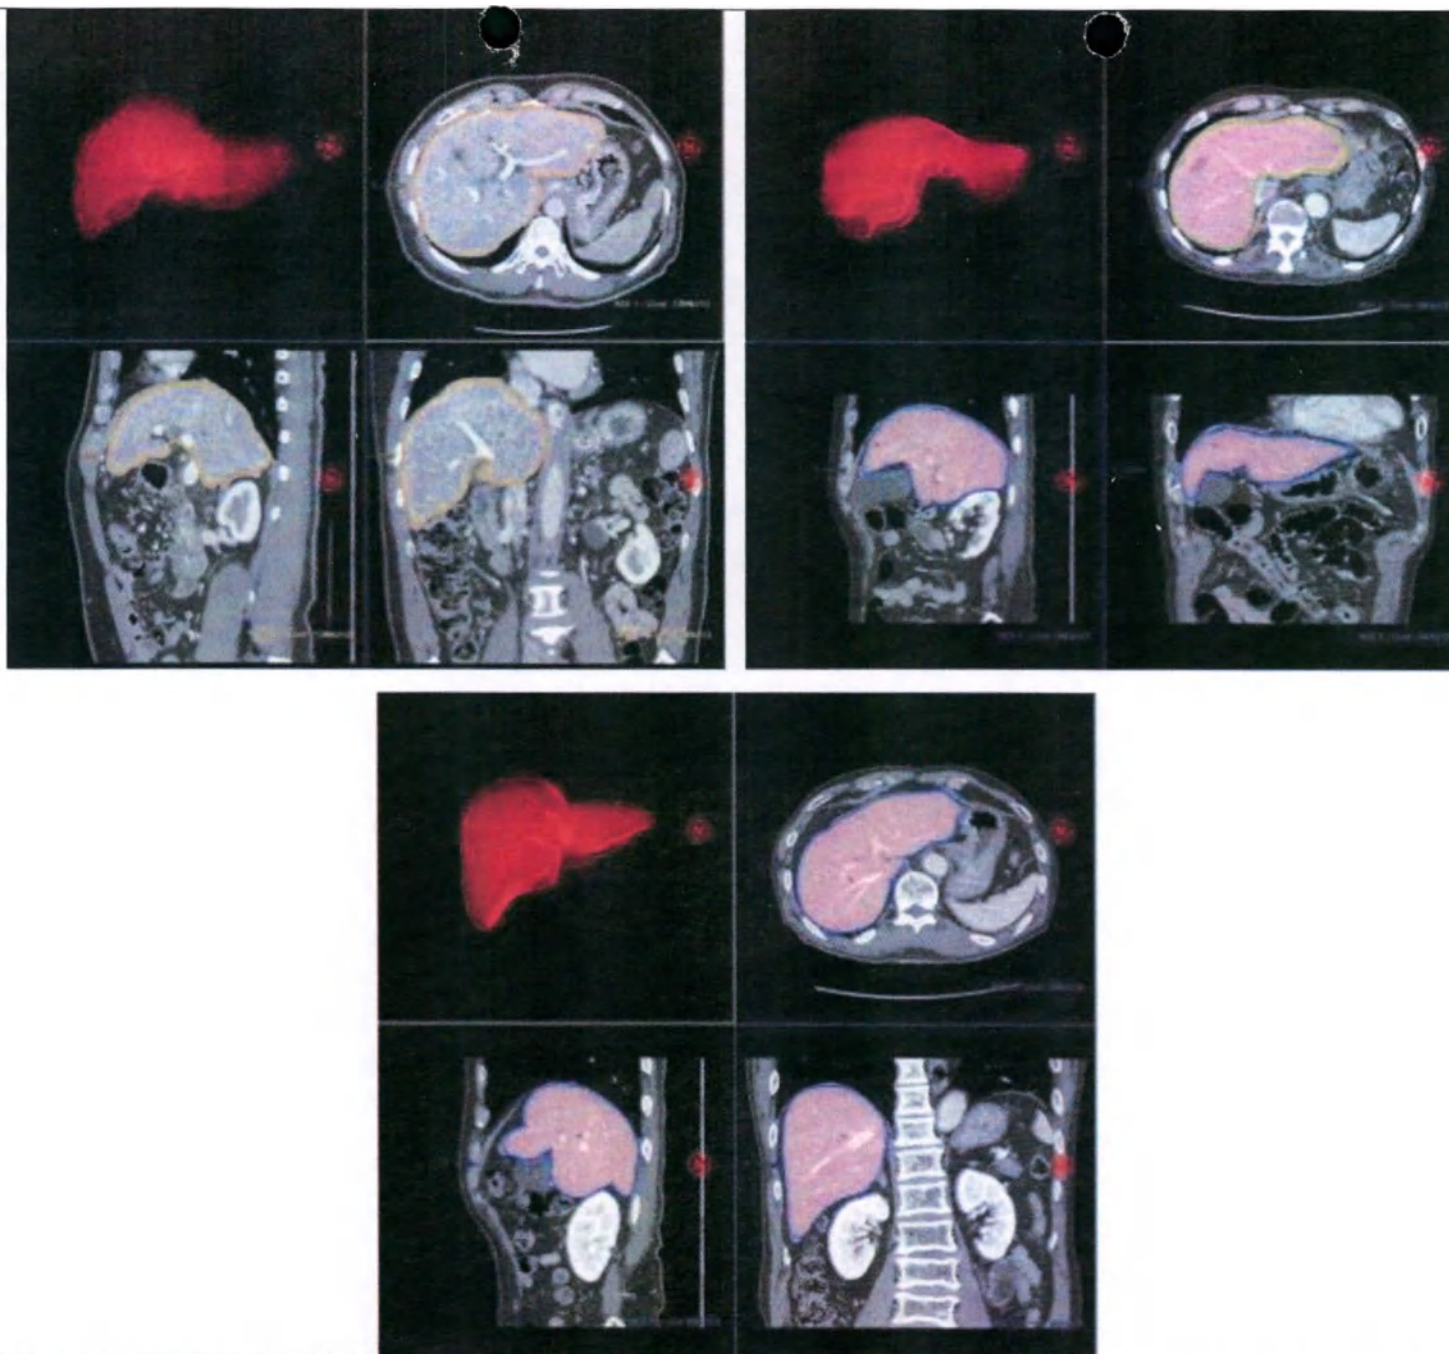


Рис. 215. Программный пакет Hepatic VCAR (не более 10 шт.).

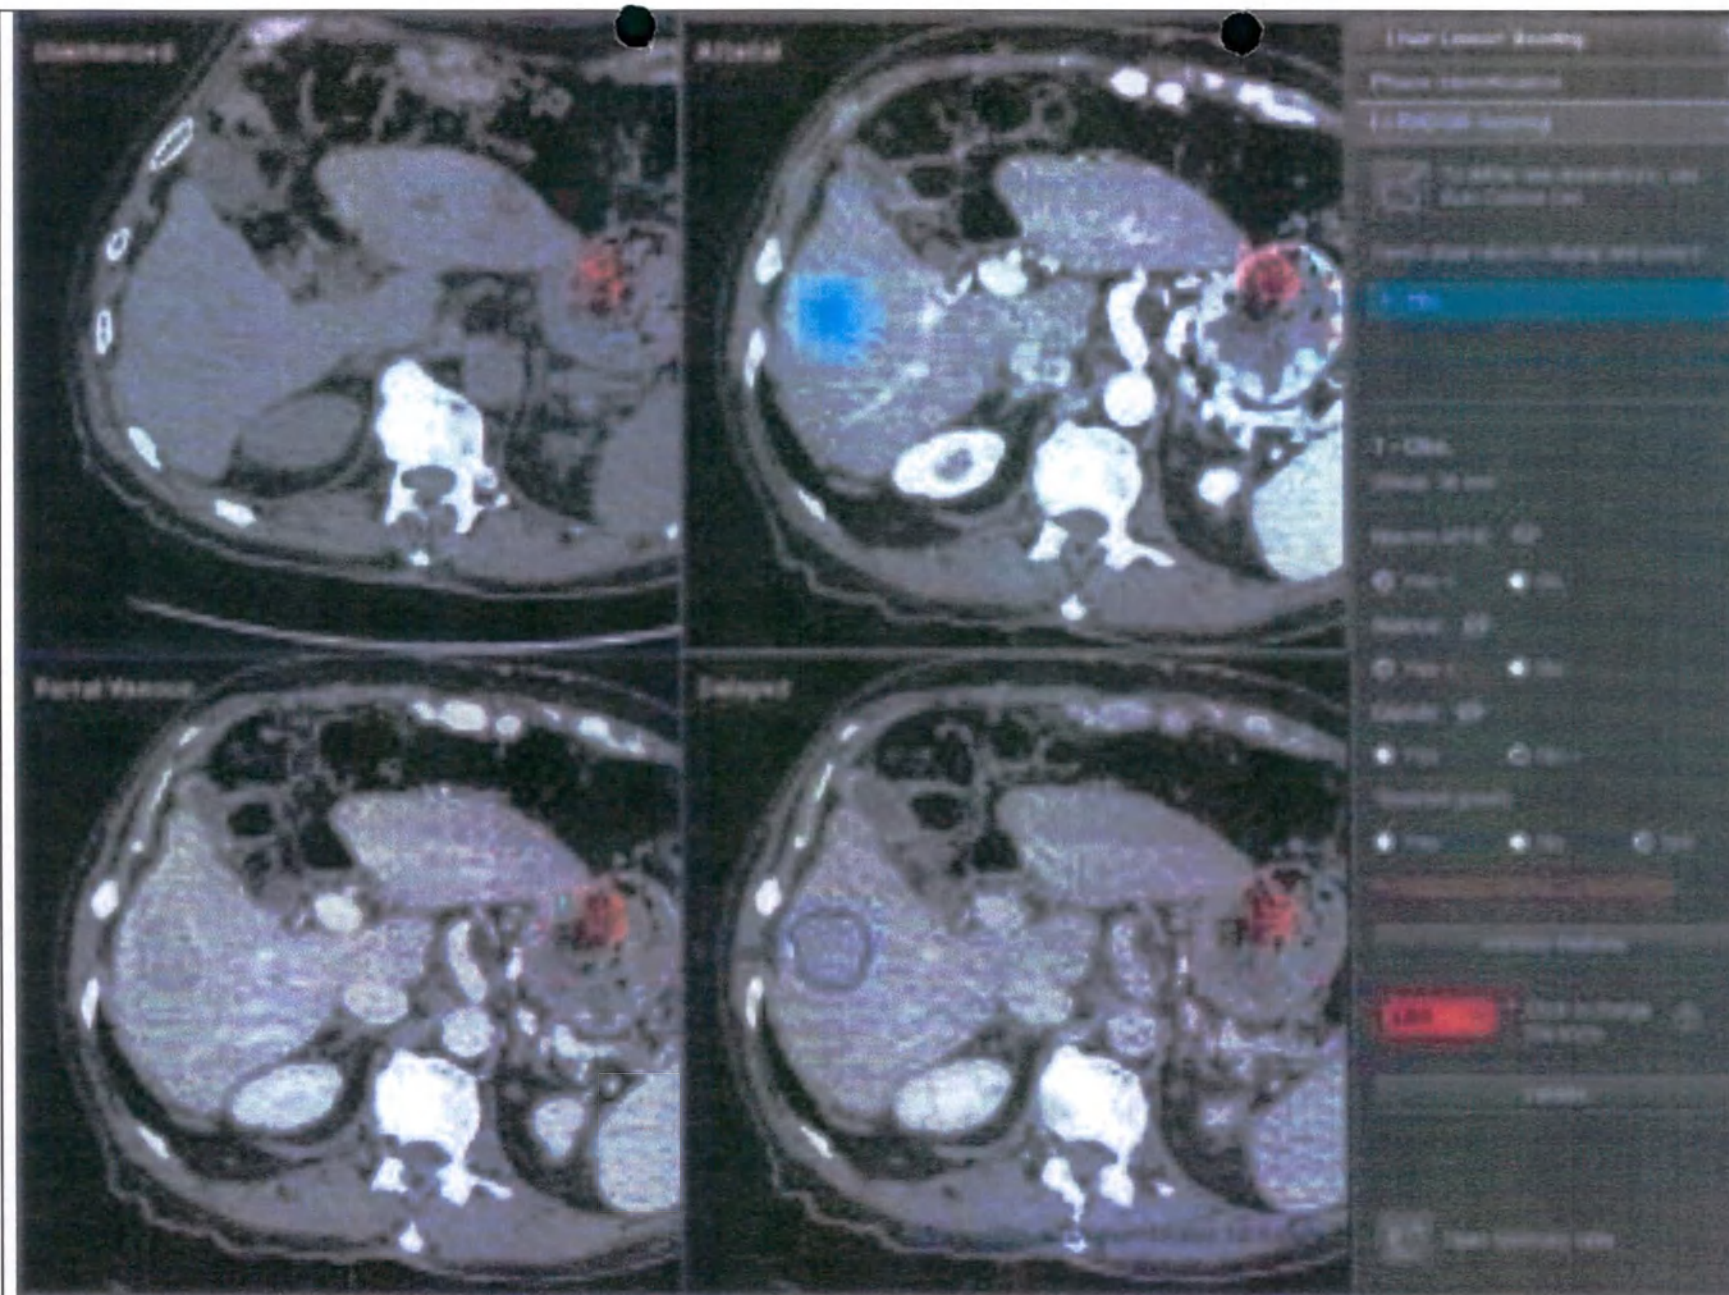


Рис. 216. Программный пакет Liver Suite (не более 10 шт.).

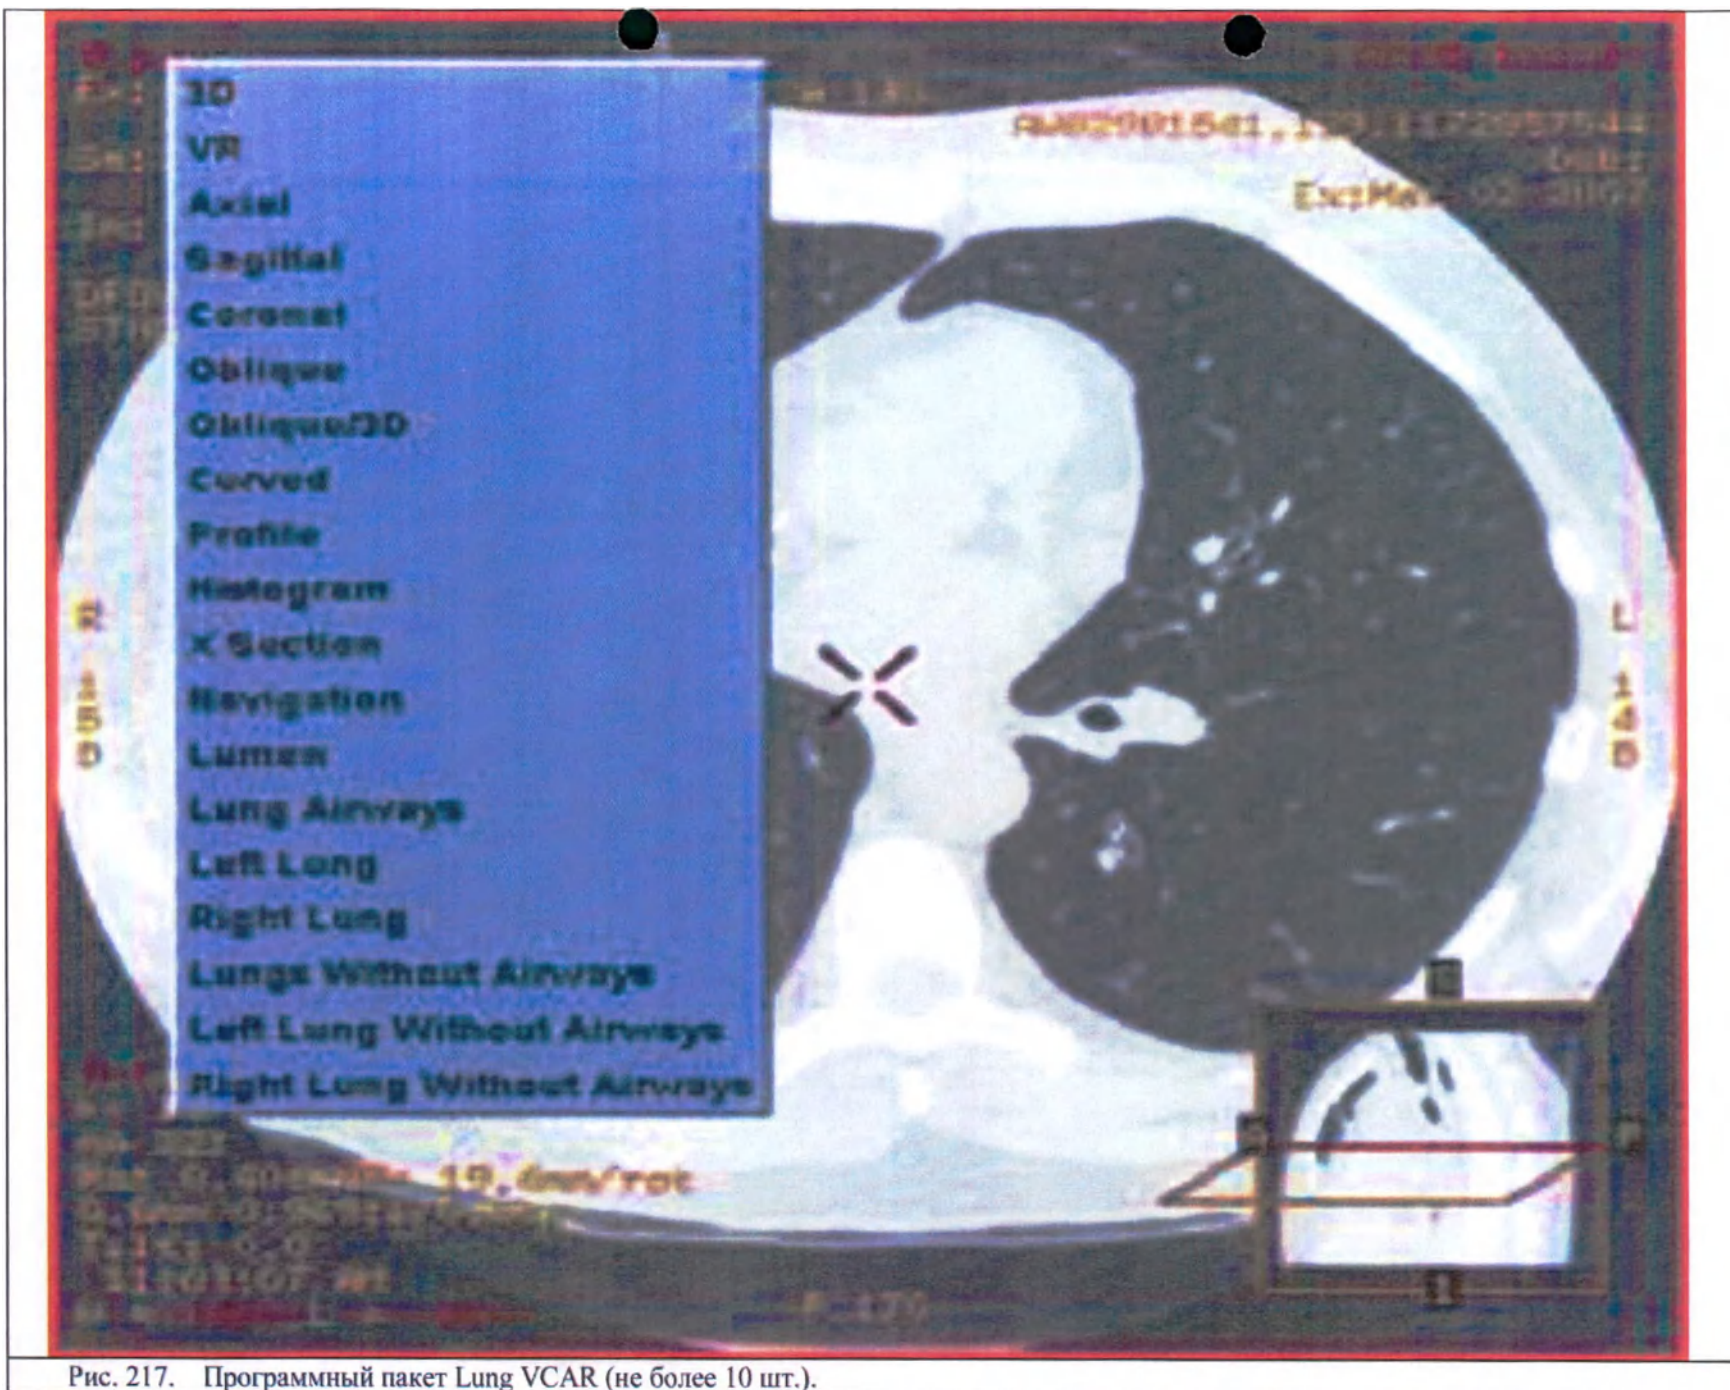


Рис. 217. Программный пакет Lung VCAR (не более 10 шт.).

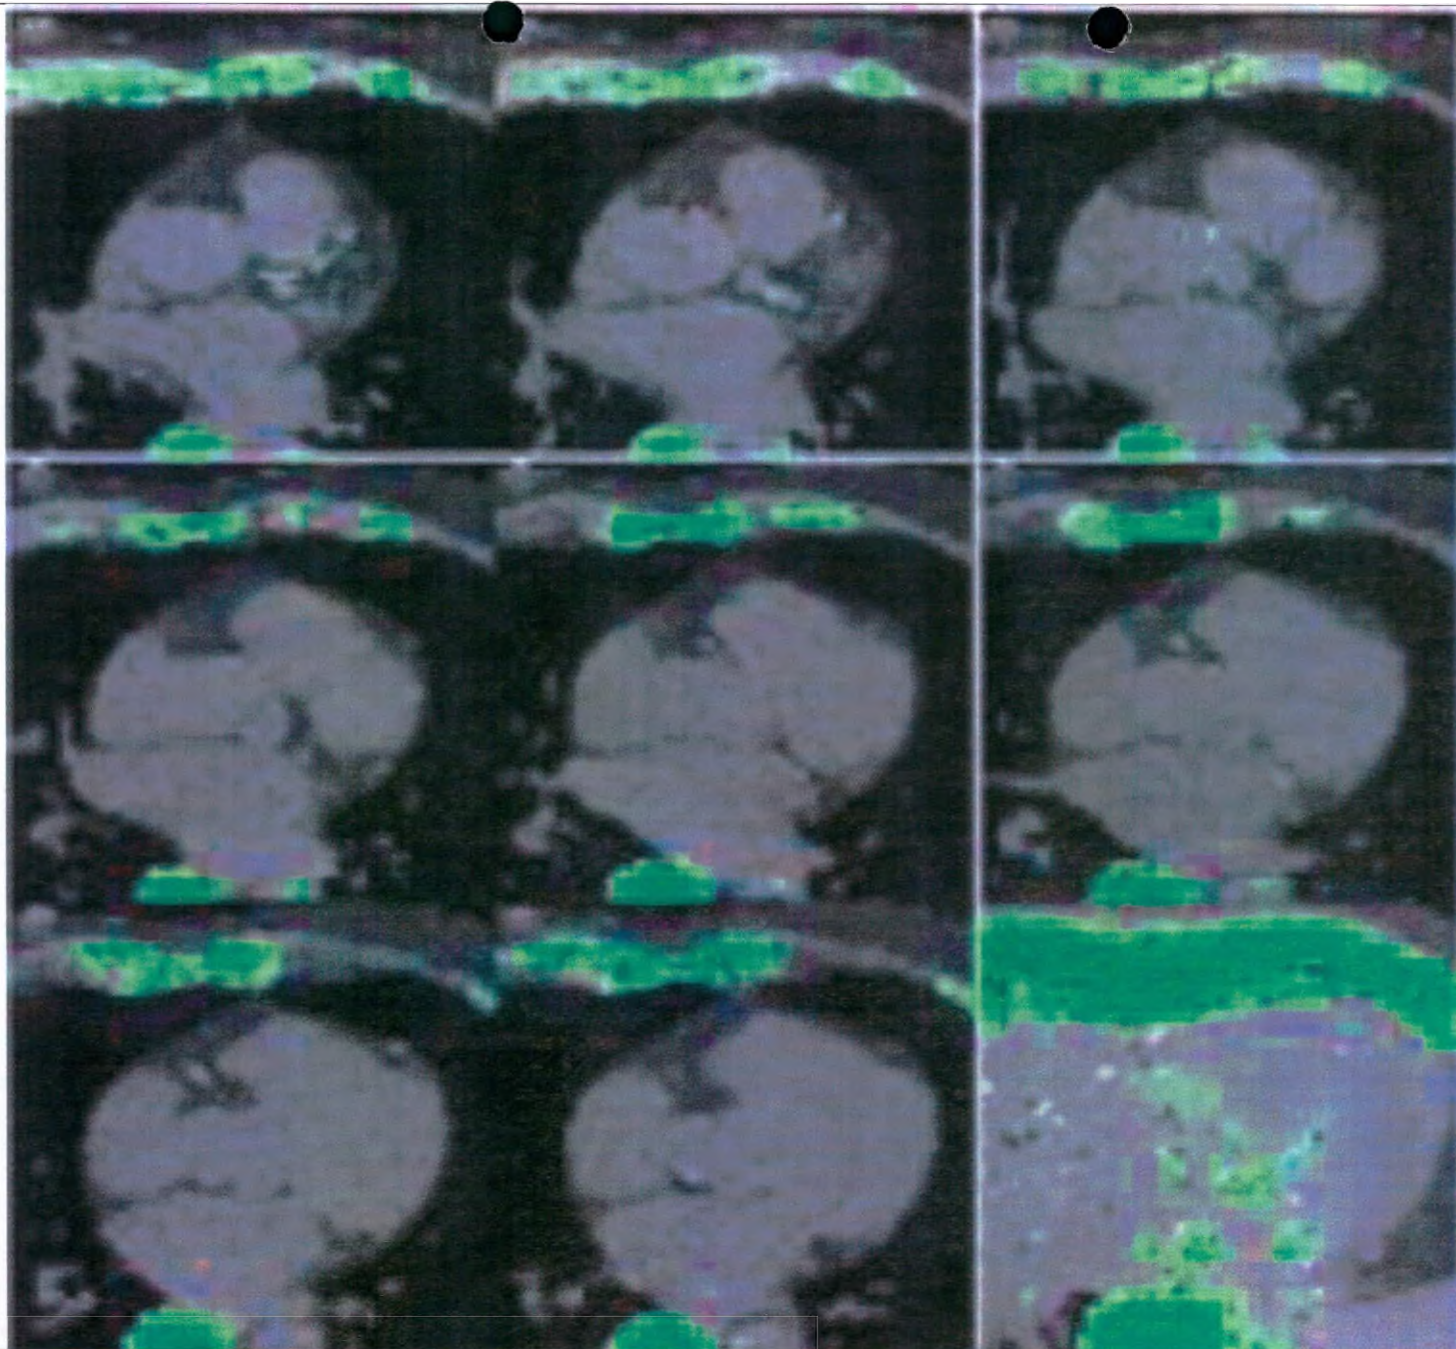


Рис. 218. Программный пакет SmartScore 4.0 Software (не более 10 шт.).

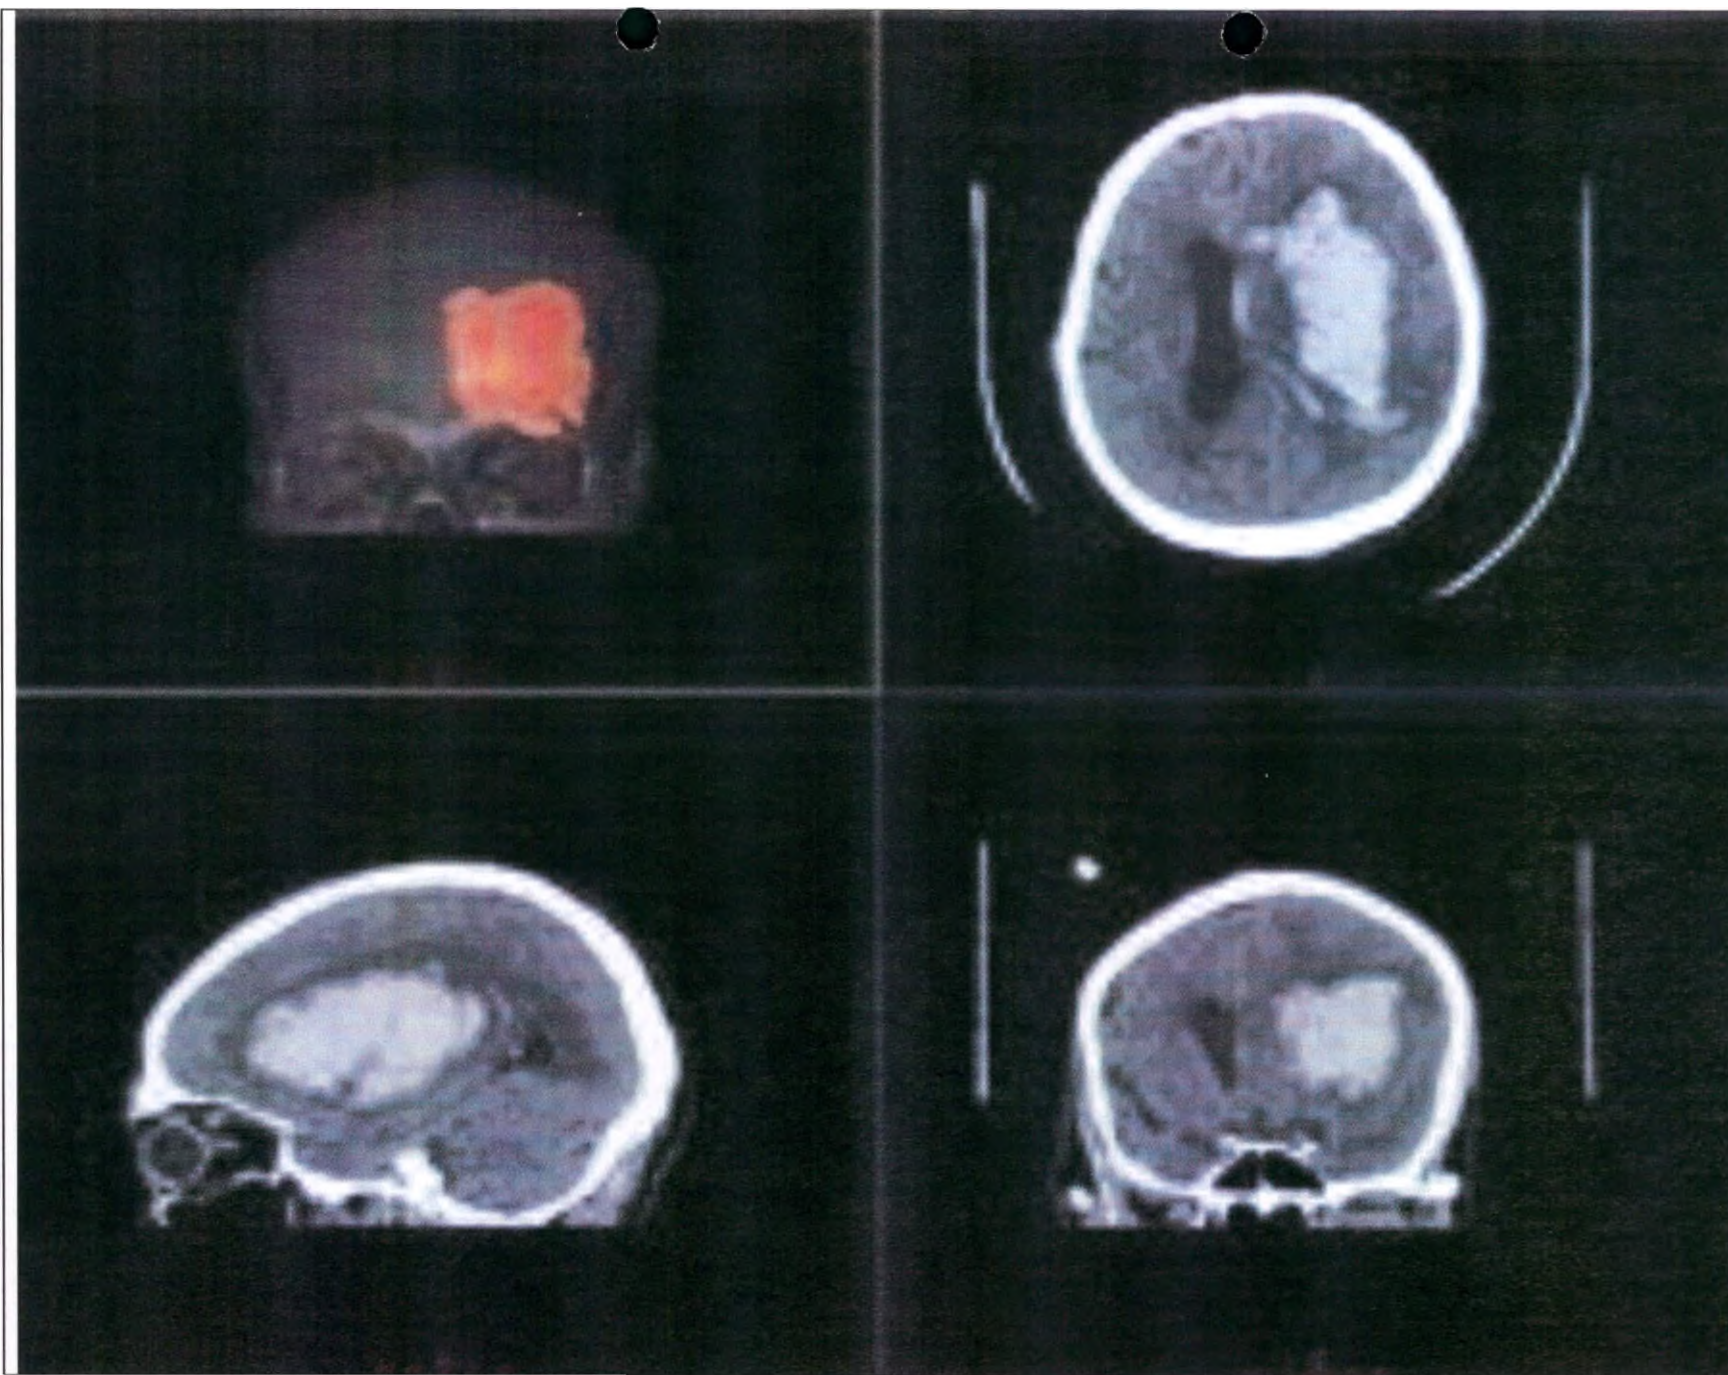


Рис. 219. Программный пакет Stroke VCAR (не более 10 шт.).

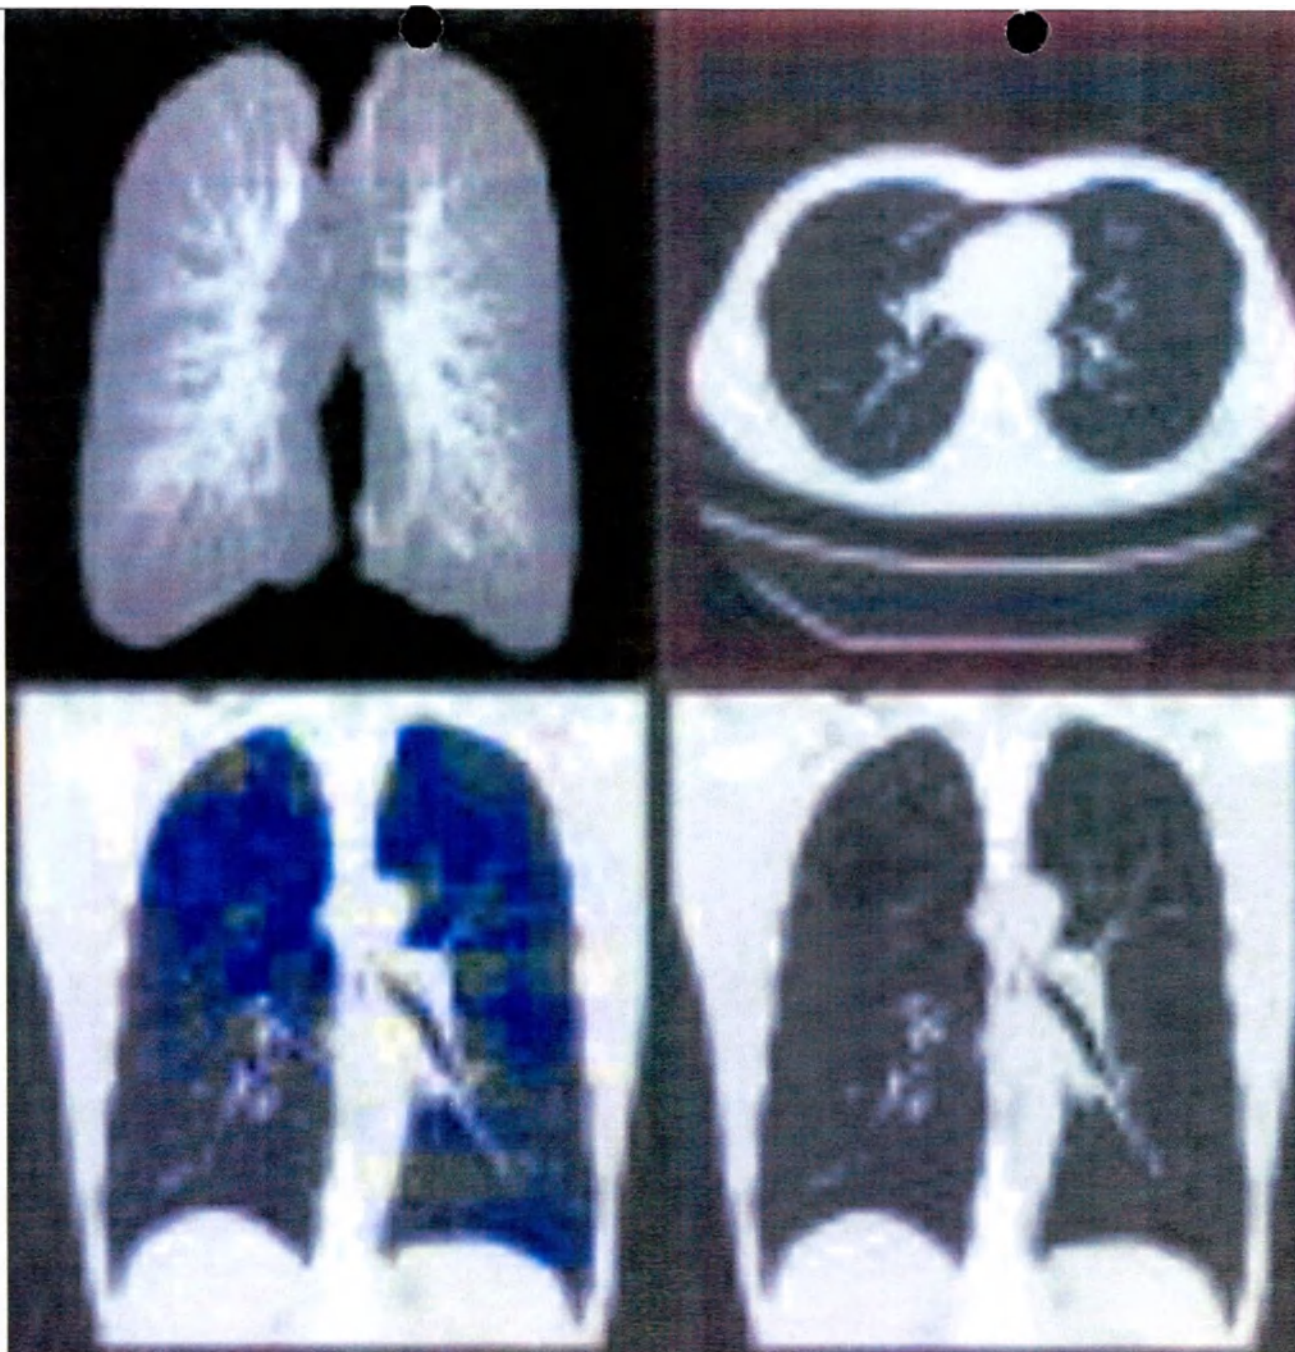


Рис. 220. Программный пакет Thoratic VCAR (не более 10 шт.).

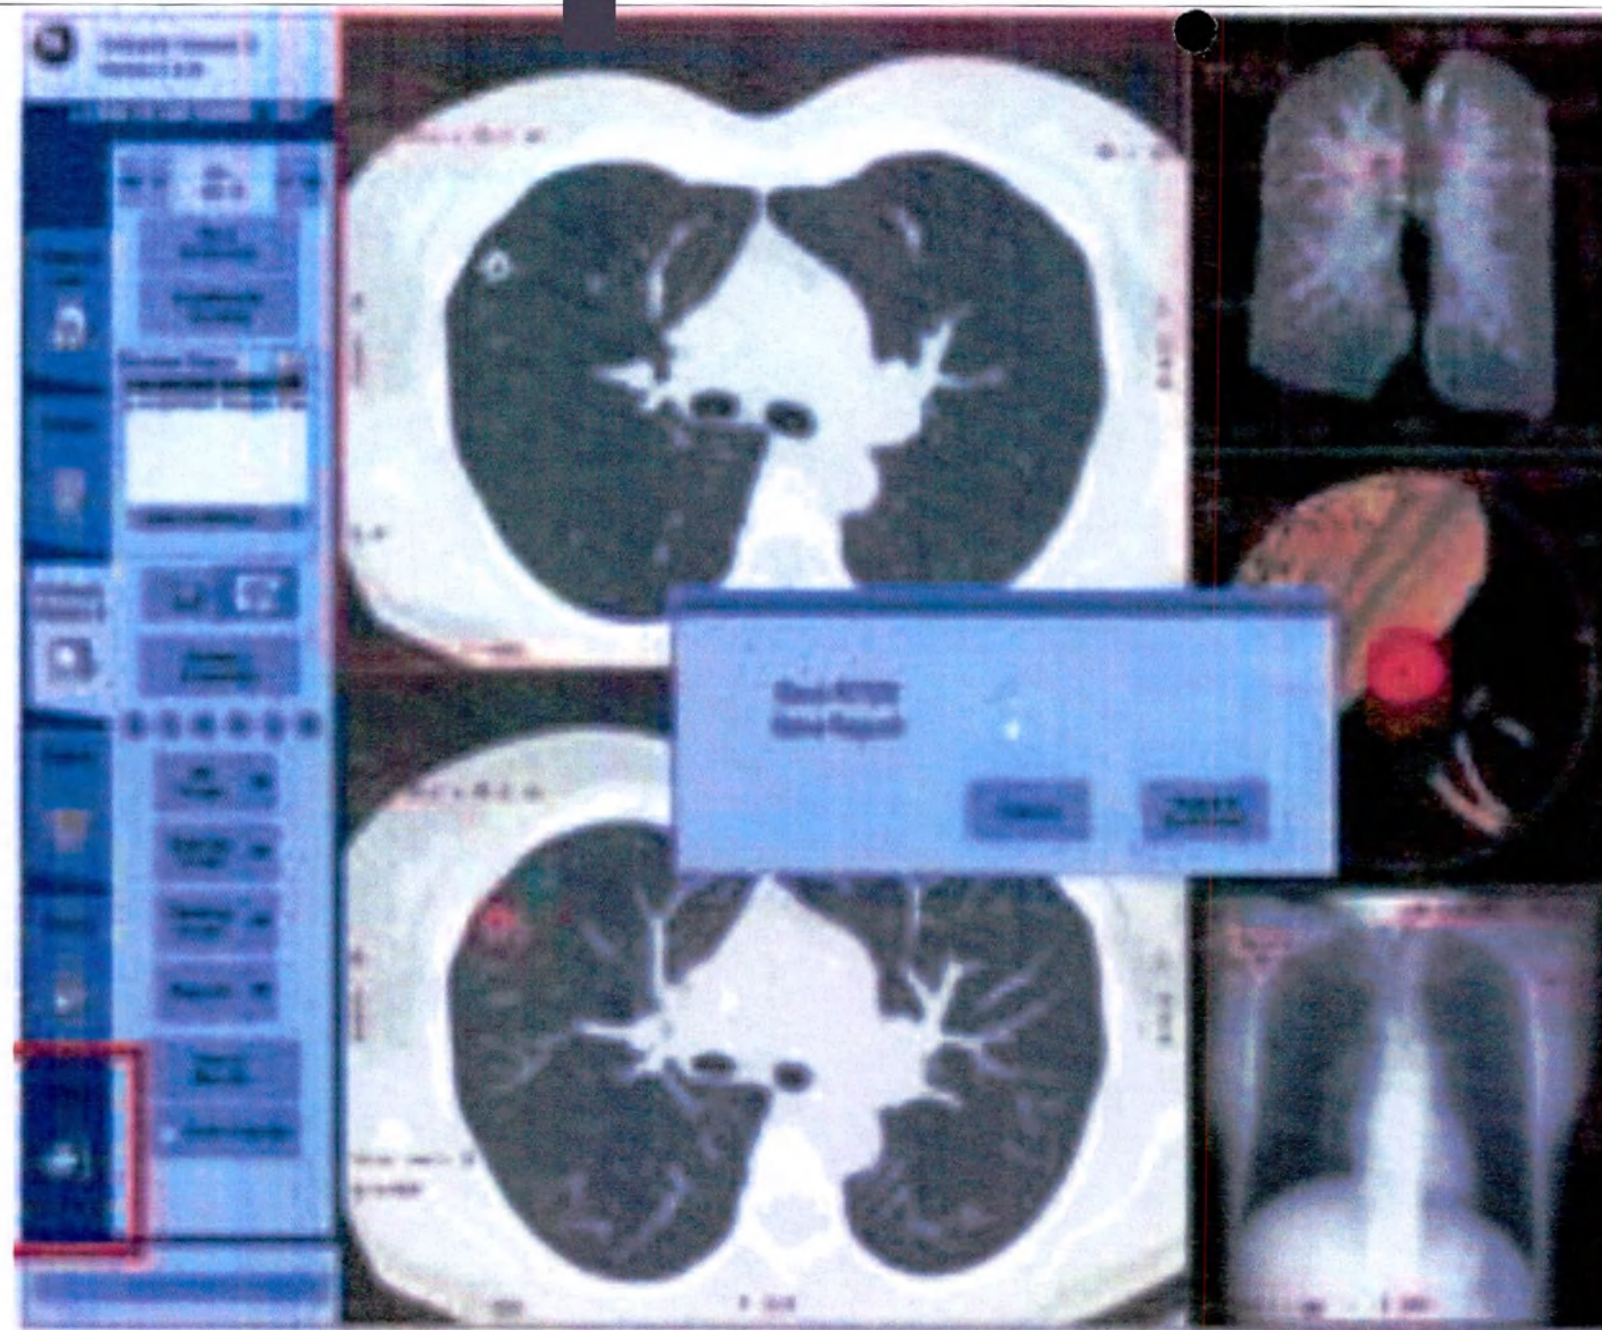


Рис. 221. Программный пакет Thoracic VCAR and Lung VCAR Package (не более 10 шт.).



Рис. 222. Программный пакет TAVI Analysis Enhanced (не более 10 шт.).

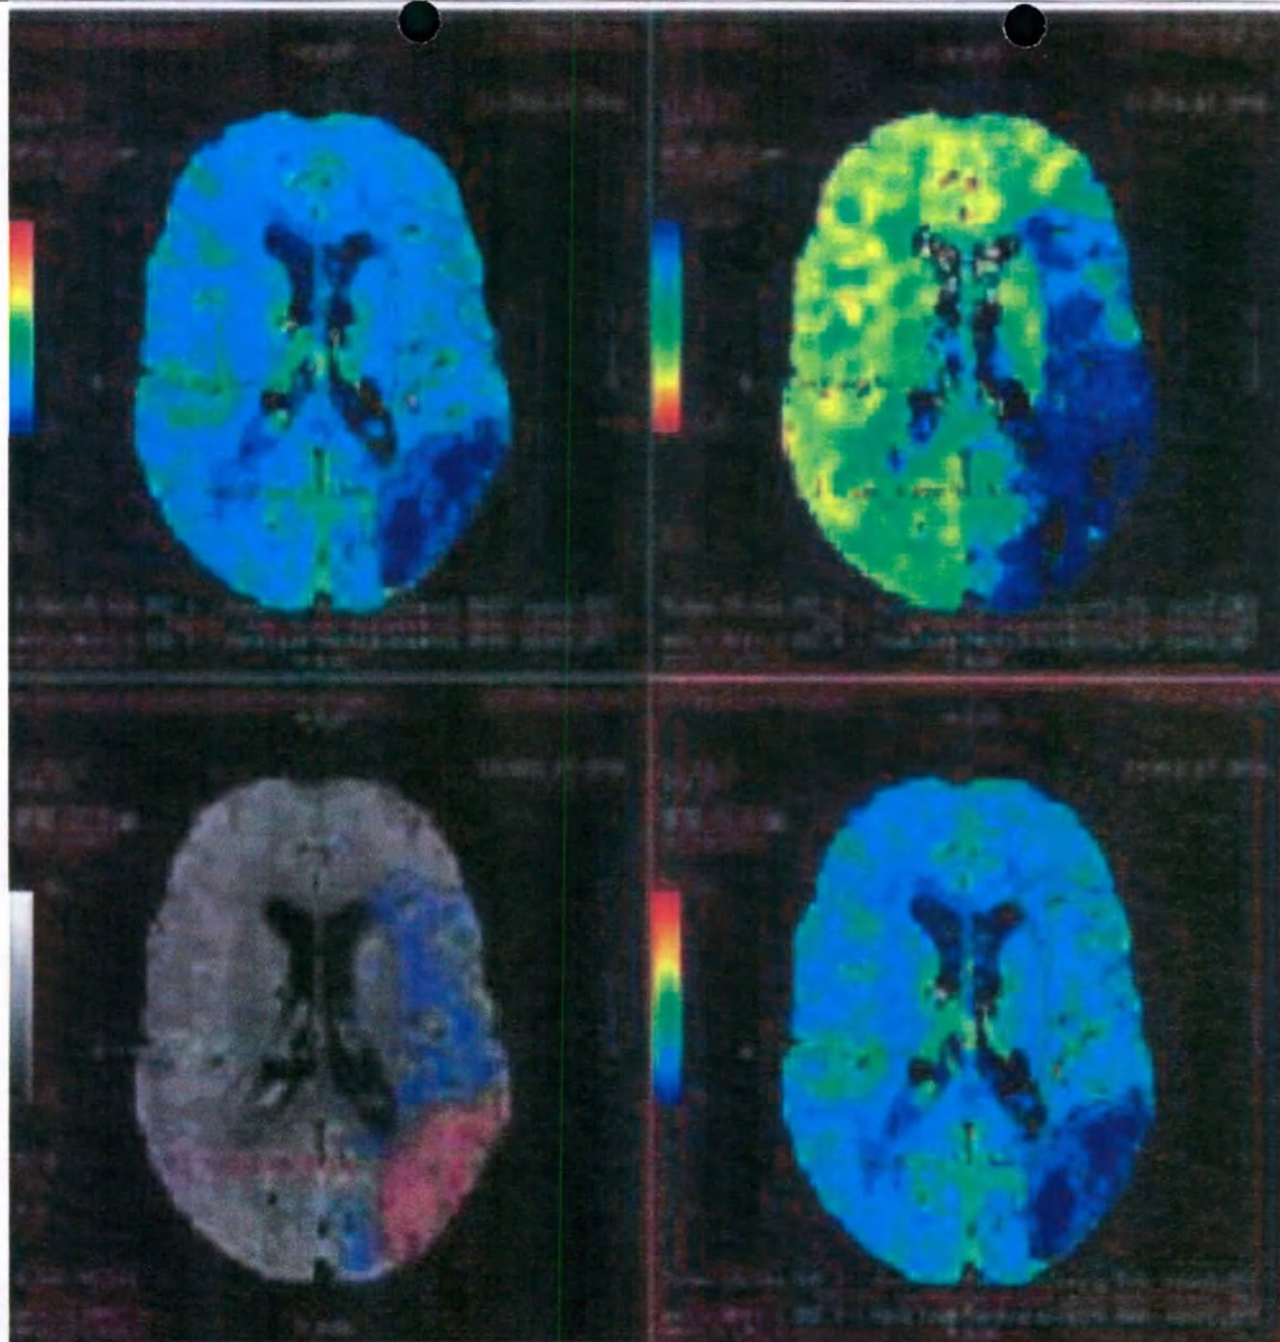
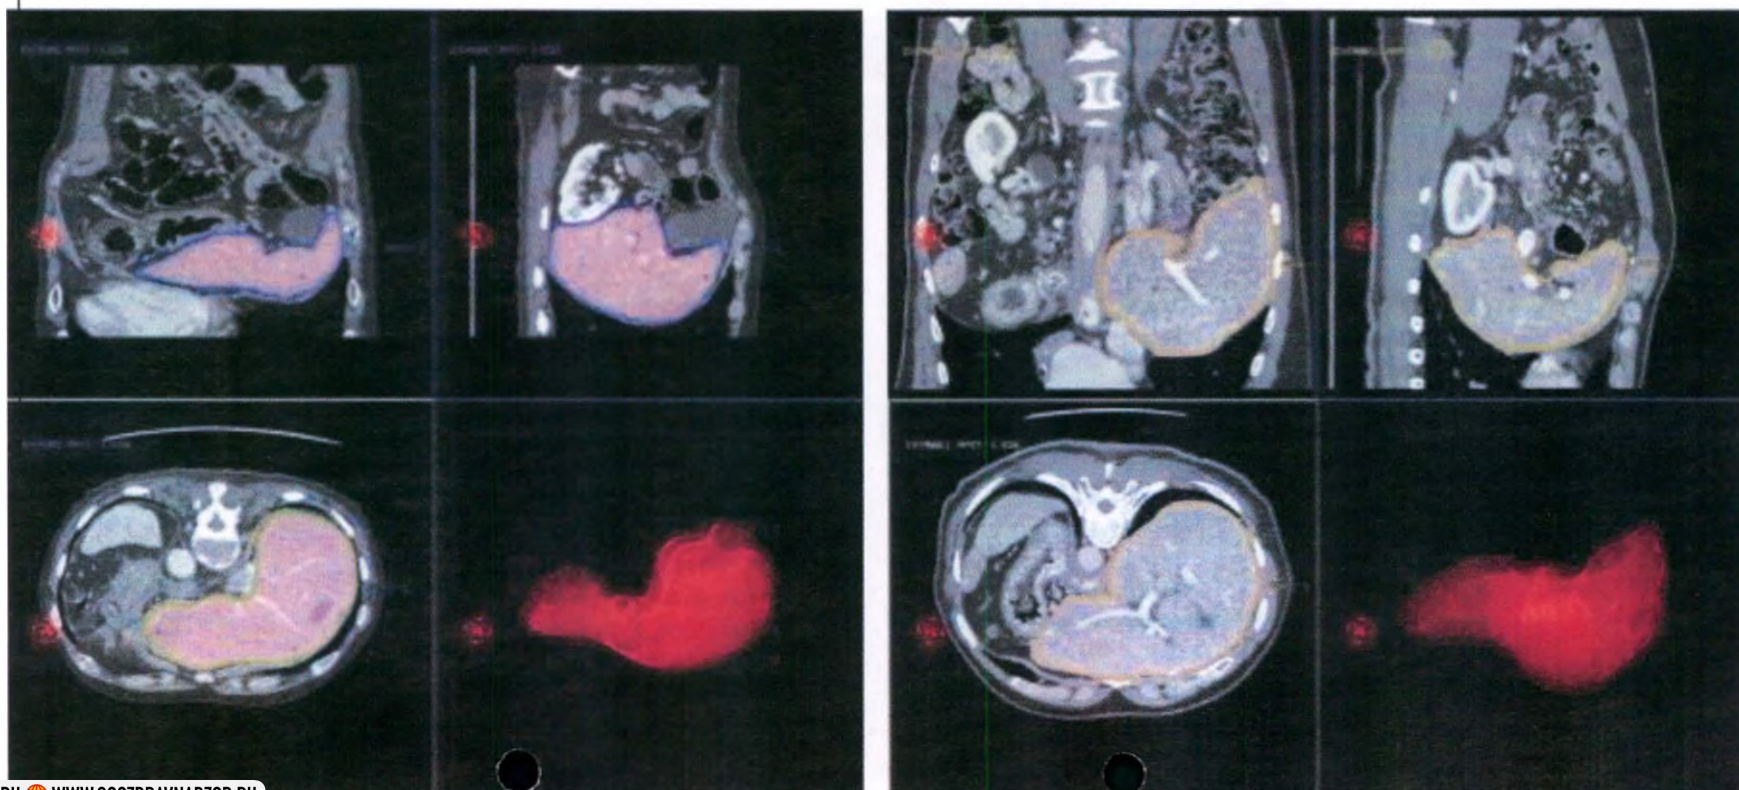
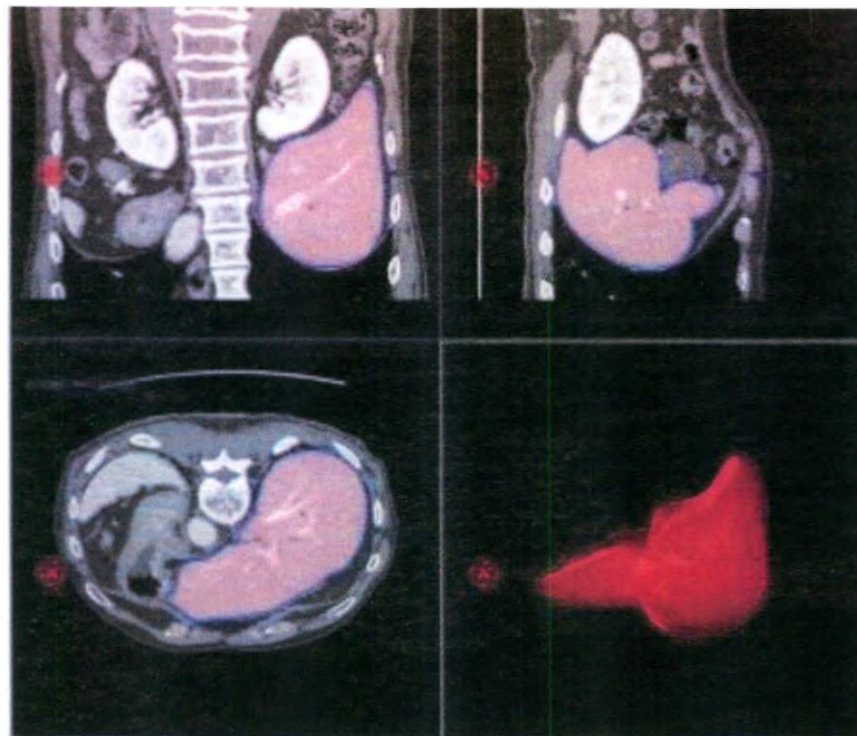


Рис. 223. Программный пакет CT PERF 4D COMPLETE (не более 10 шт.).



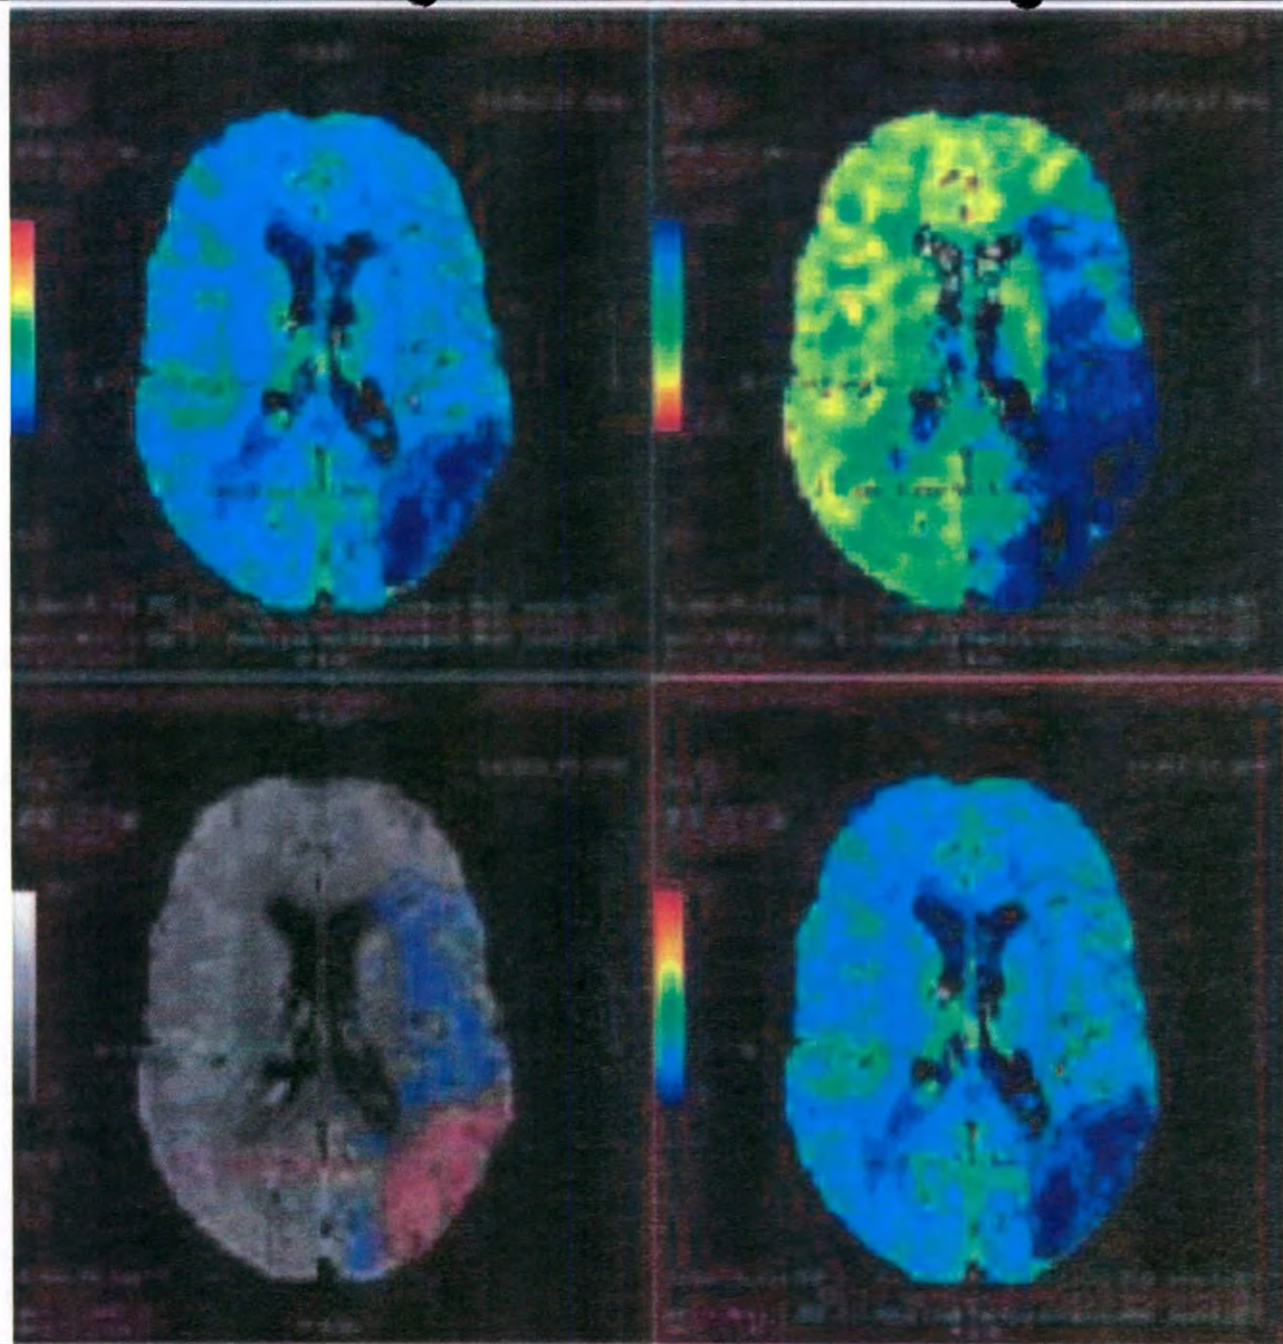


Рис. 225. Программный пакет CT Perfusion 4D Neuro Enhanced Upgrade (не более 10 шт.).

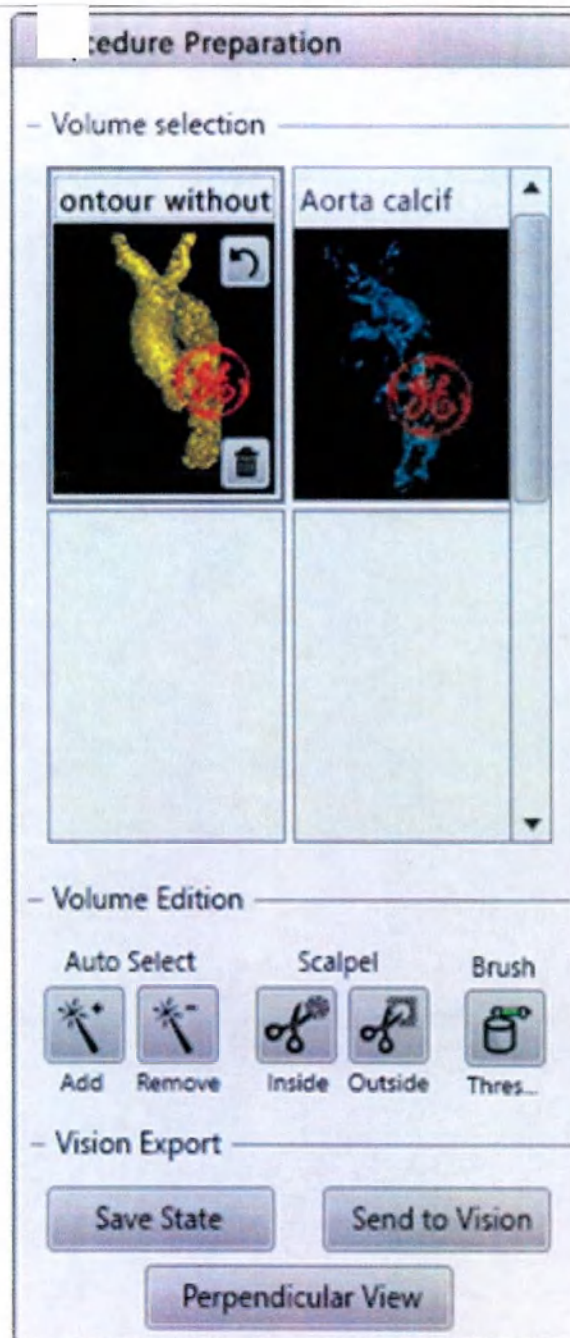


Рис. 226. Программный пакет TAVI Analysis upgrade from previous version (не более 10 шт.).

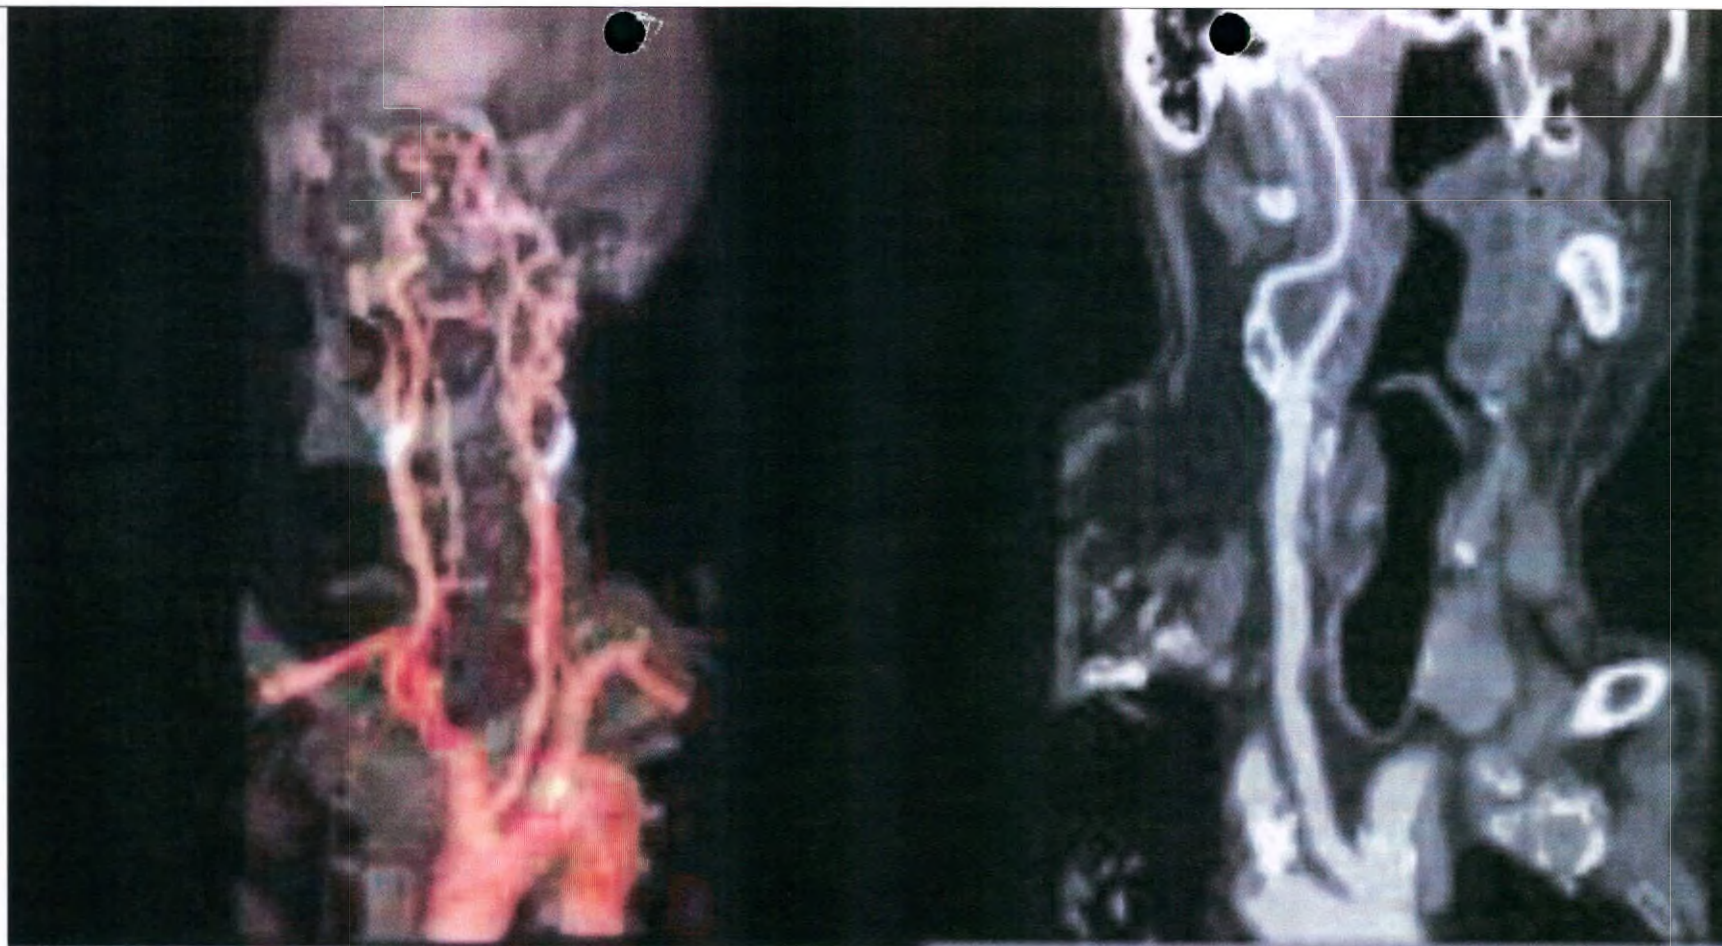


Рис. 227. Программный пакет VesselIQ Xpress & AutoBone Xpress (не более 10 шт.).



Рис. 228. Программный пакет VesseliQ Xpress & AutoBone Xpress (не более 10 шт.).

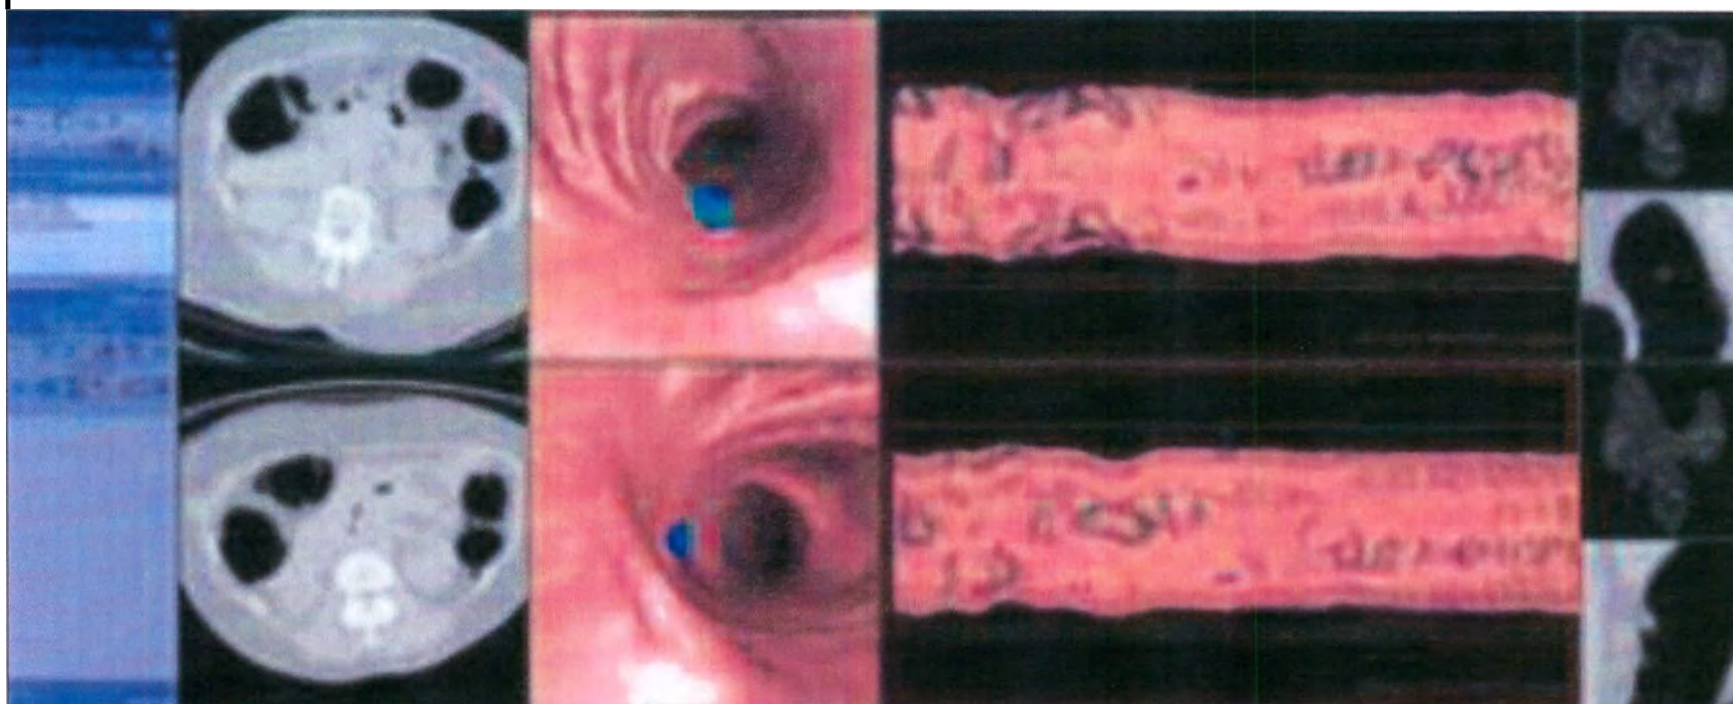


Рис. 229. Программный пакет Colon VCAR EC (не более 10 шт.).

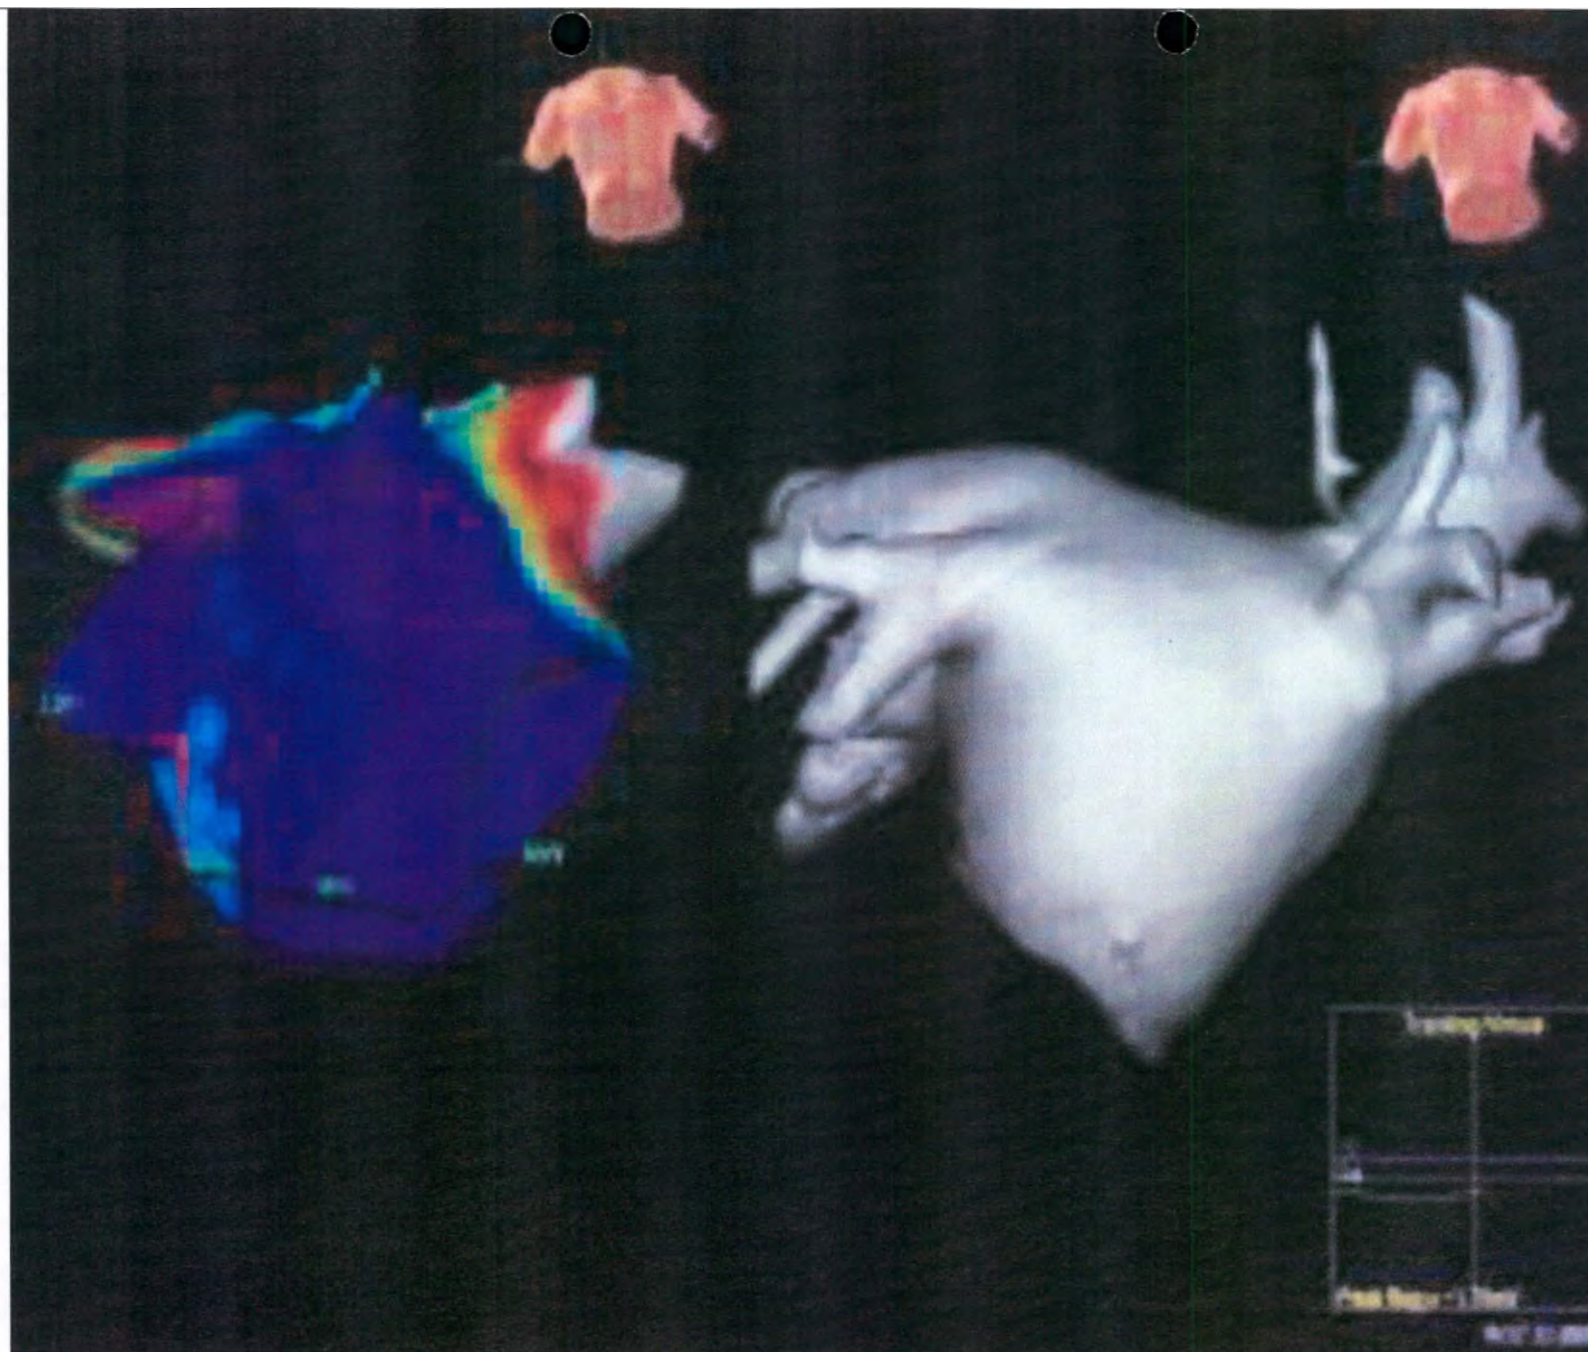


Рис. 230. Программный пакет CardEP (не более 10 шт.).

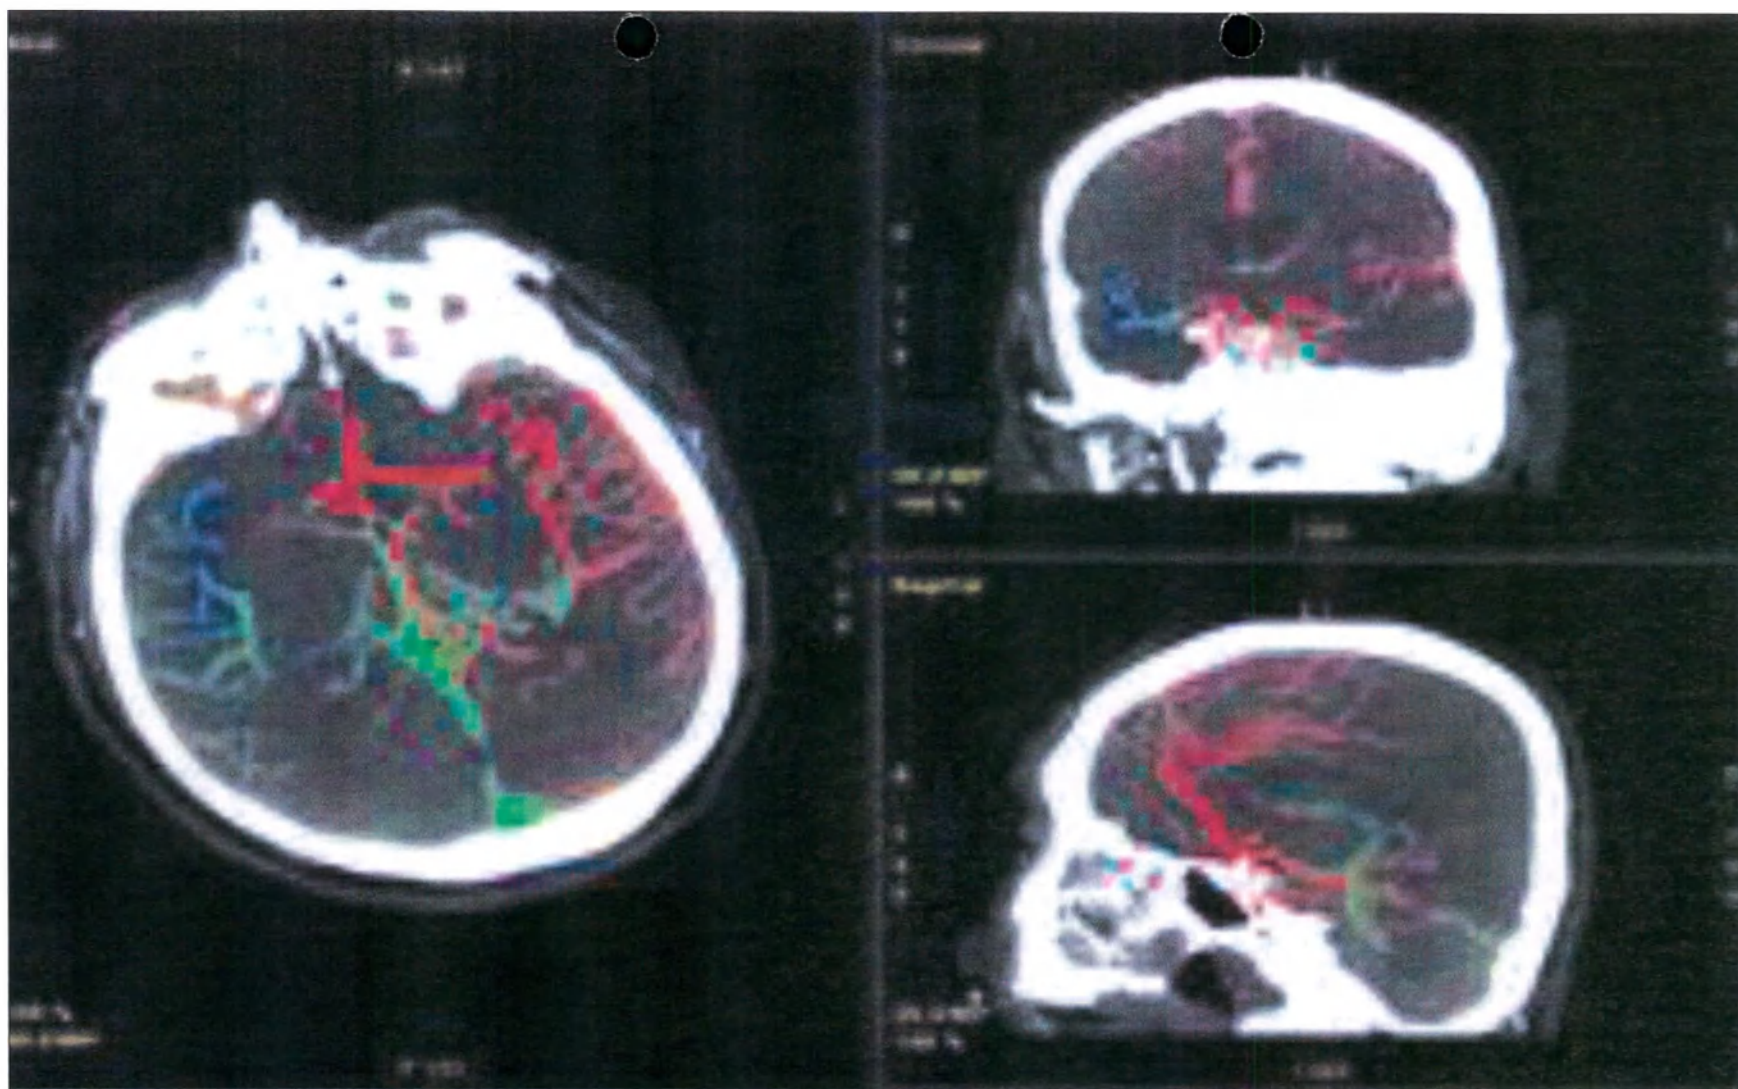


Рис. 231. Программный пакет FastStroke and CT Perfusion 4D Neuro Enhanced (не более 10 шт.).

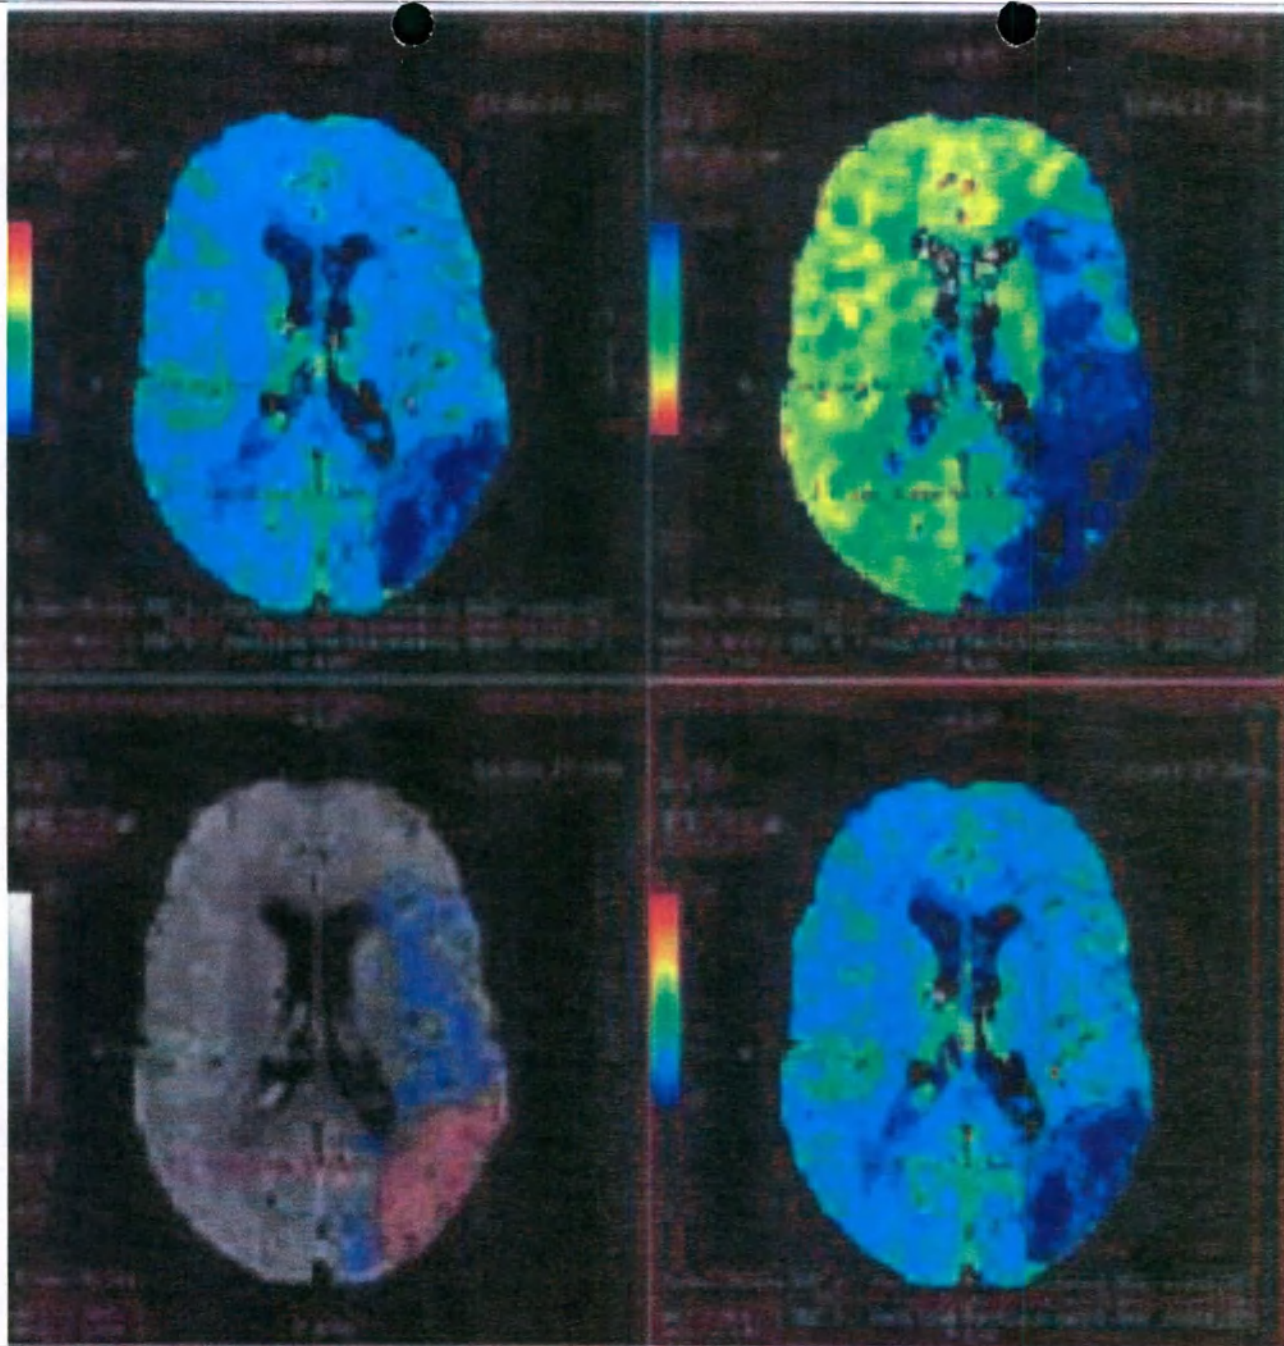


Рис. 232. Программный пакет FastStroke and CT Perfusion 4D Neuro Enhanced (не более 10 шт.).

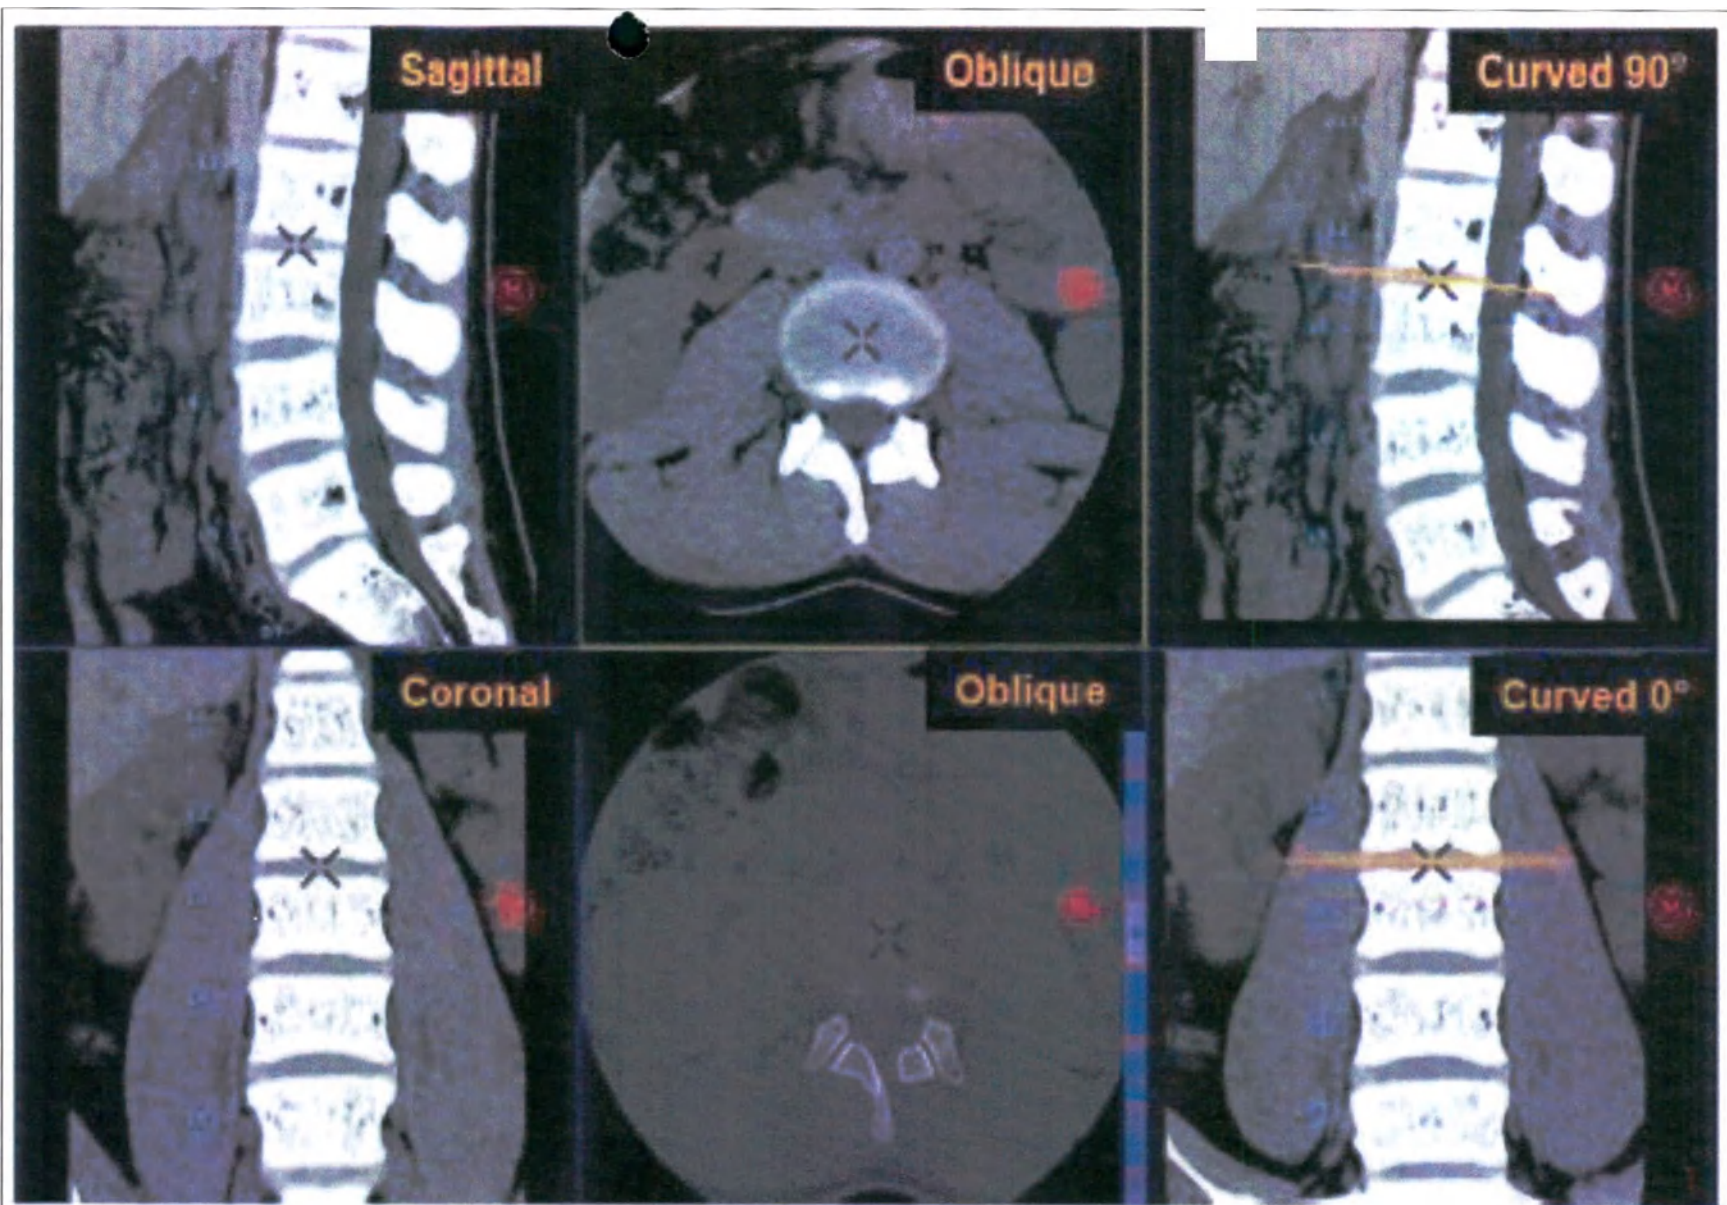


Рис. 233. Программный пакет Bone VCAR (не более 10 шт.).

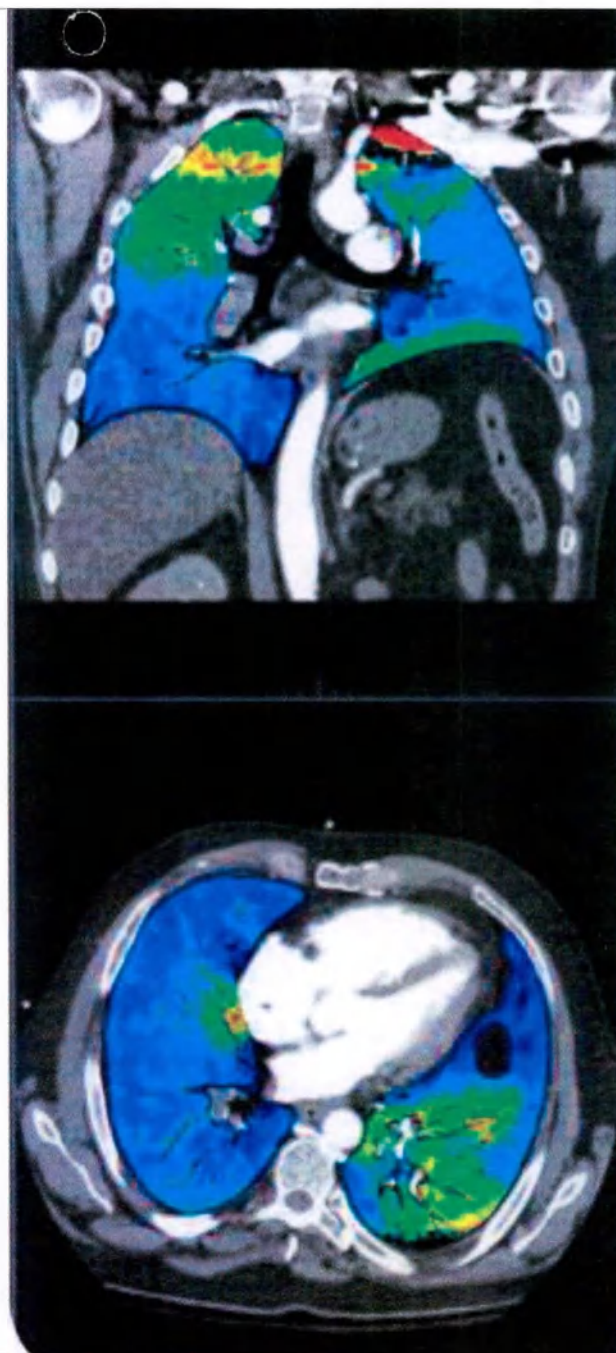


Рис. 234. Программный пакет GSI Pulmonary Perfusion for TVCAR (не более 10 шт.).

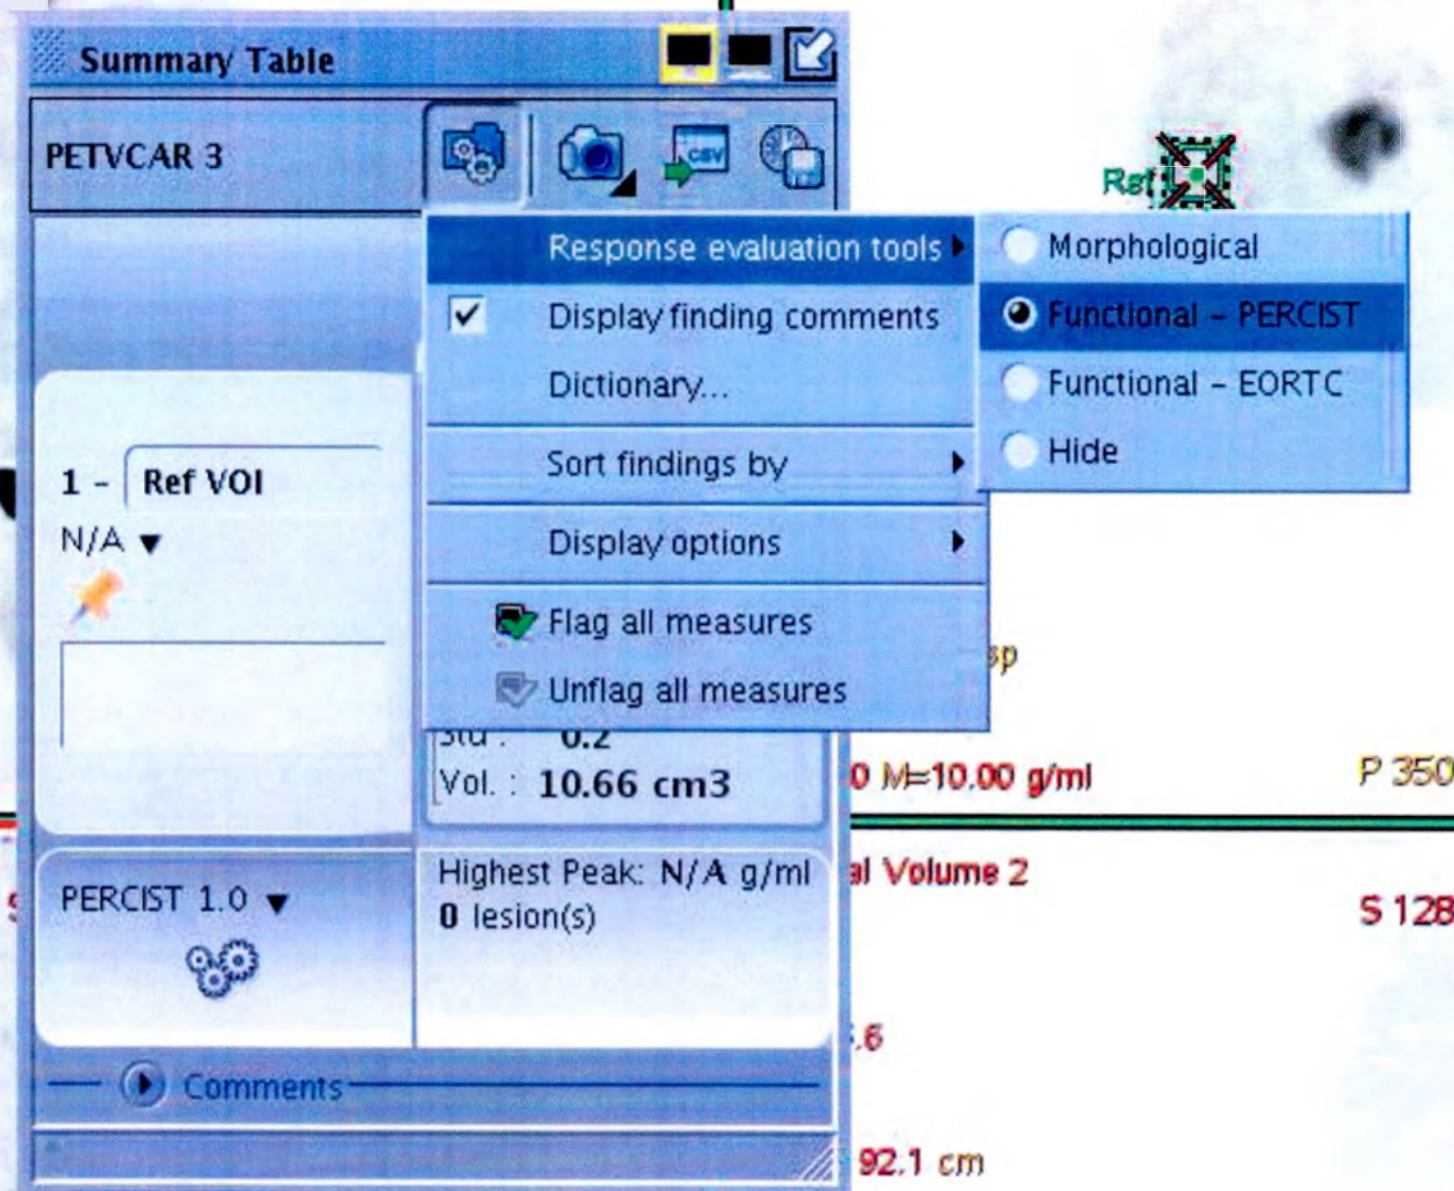


Рис. 235. Программный пакет PET VCAR (не более 10 шт.).



Рис. 236. Программный пакет PET VCAR (не более 10 шт.).

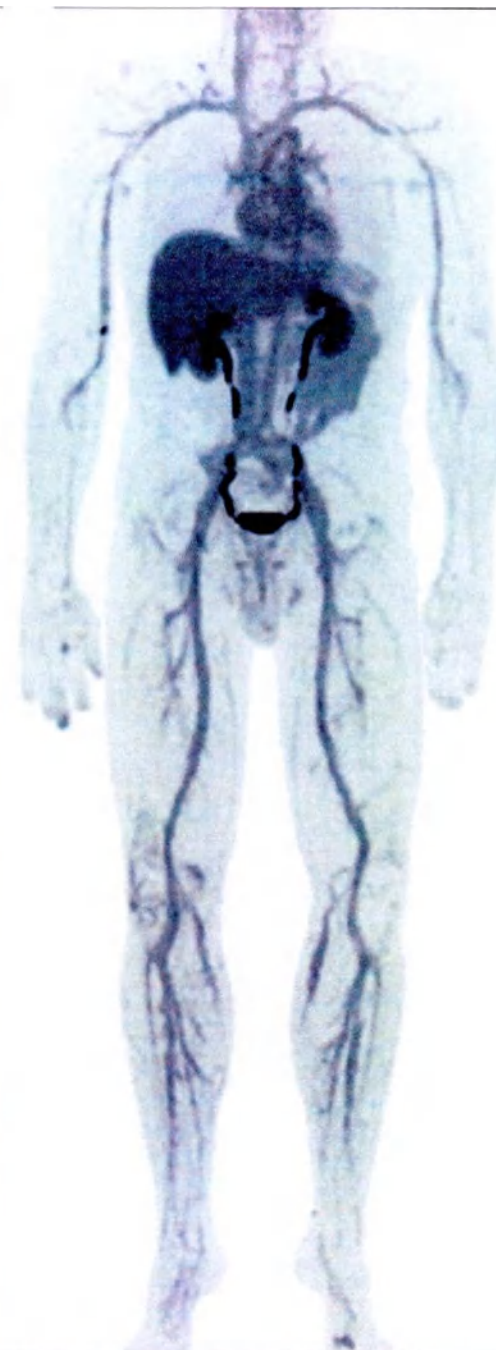


Рис. 237. Программный пакет DynaMiciQ (не более 10 шт.).

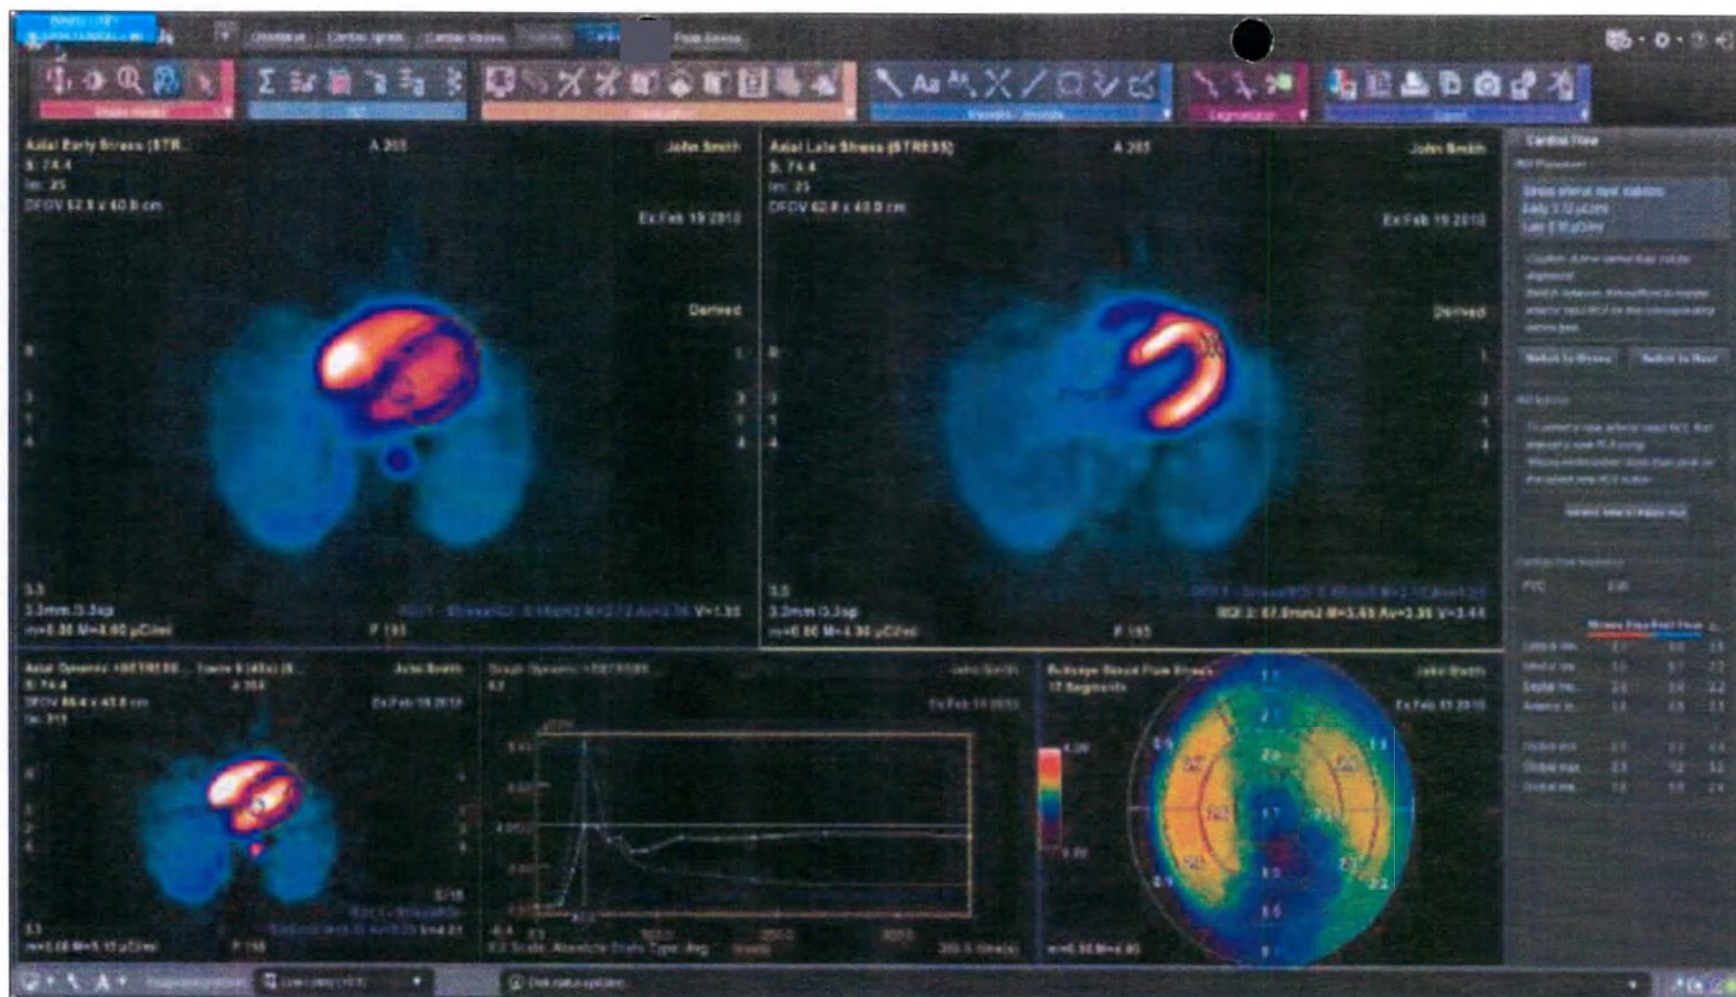


Рис. 238. Программный пакет CardIQ Flow (не более 10 шт.).

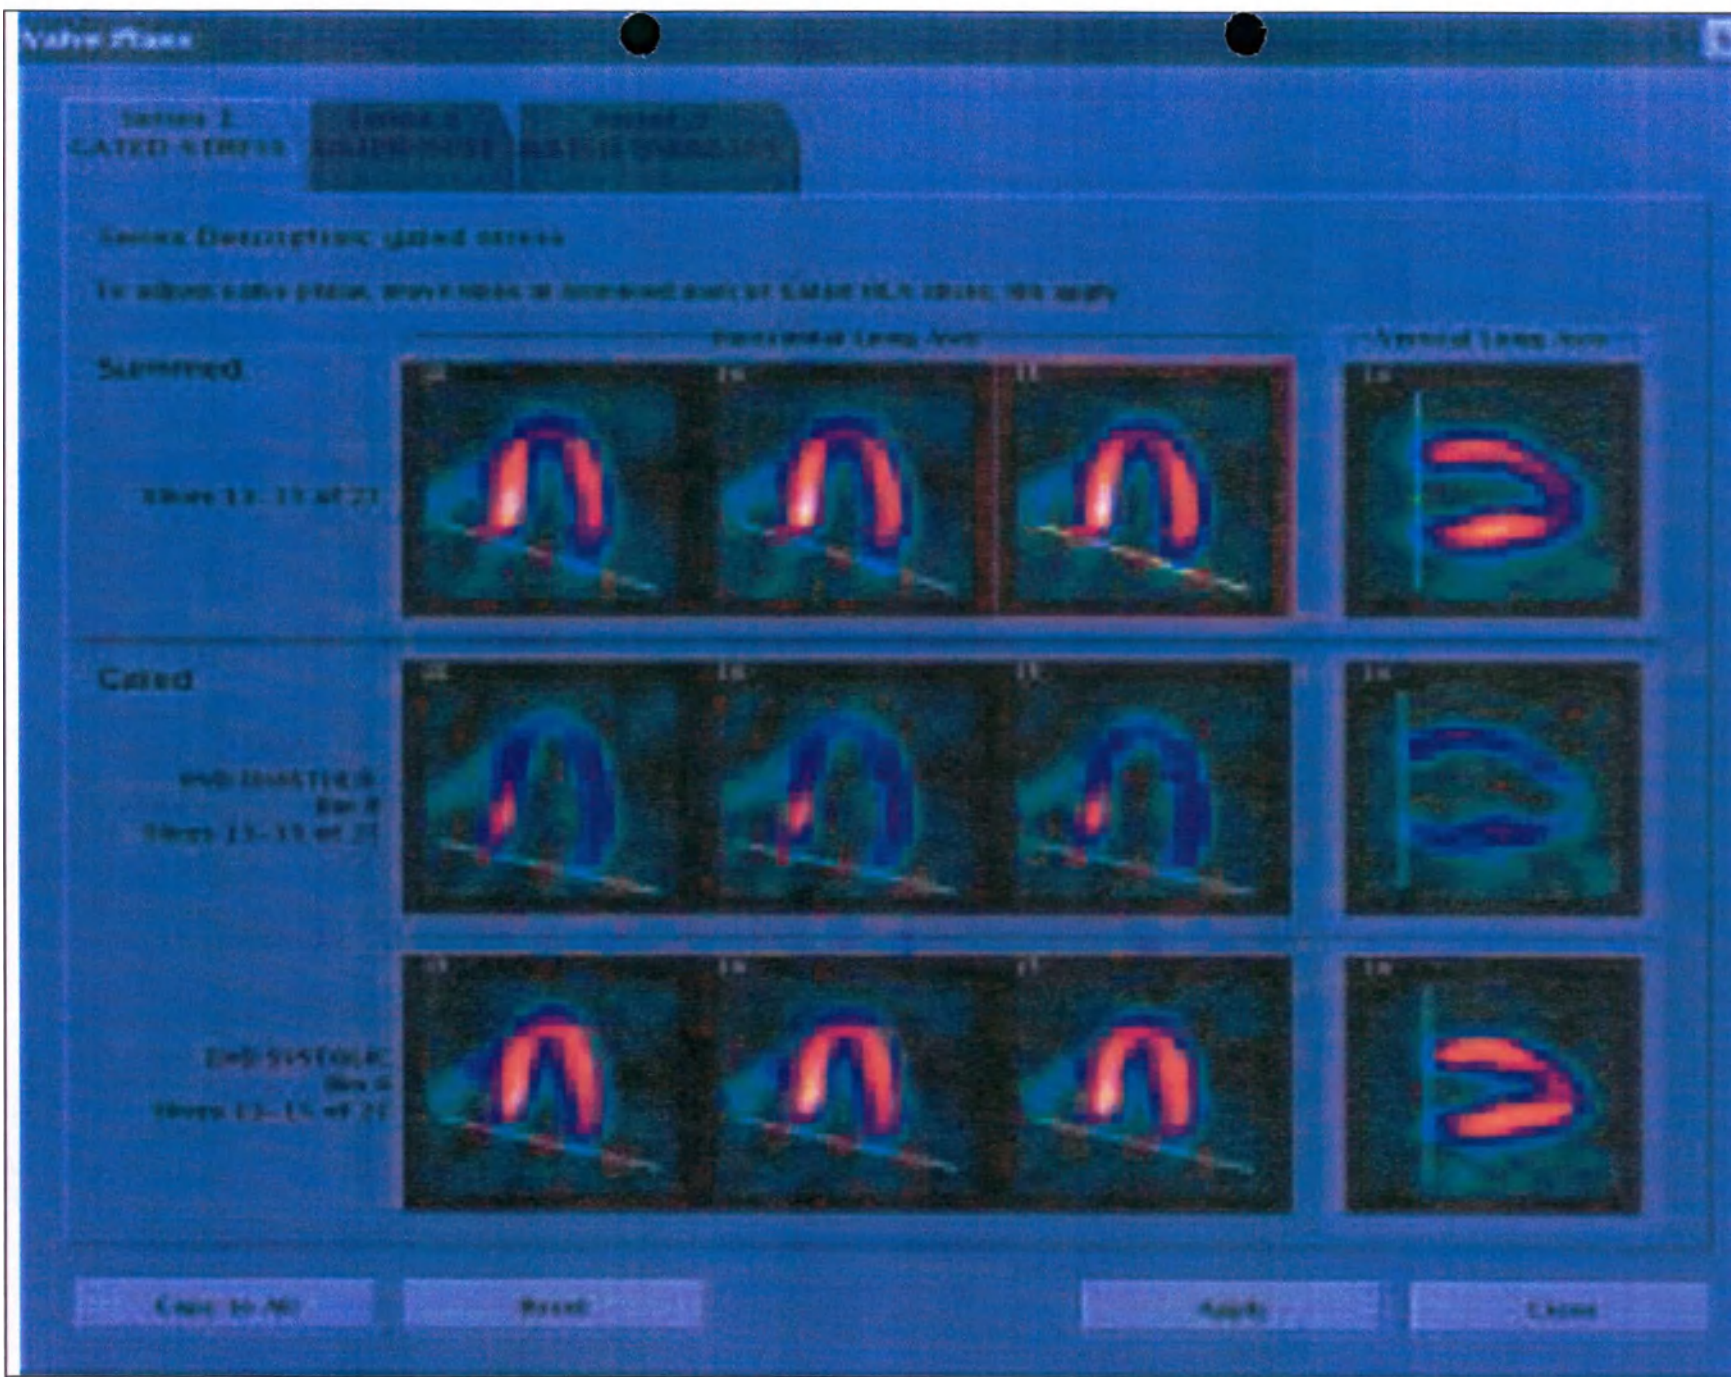


Рис. 239. Программный пакет CardIQ Fusion (не более 10 шт.).

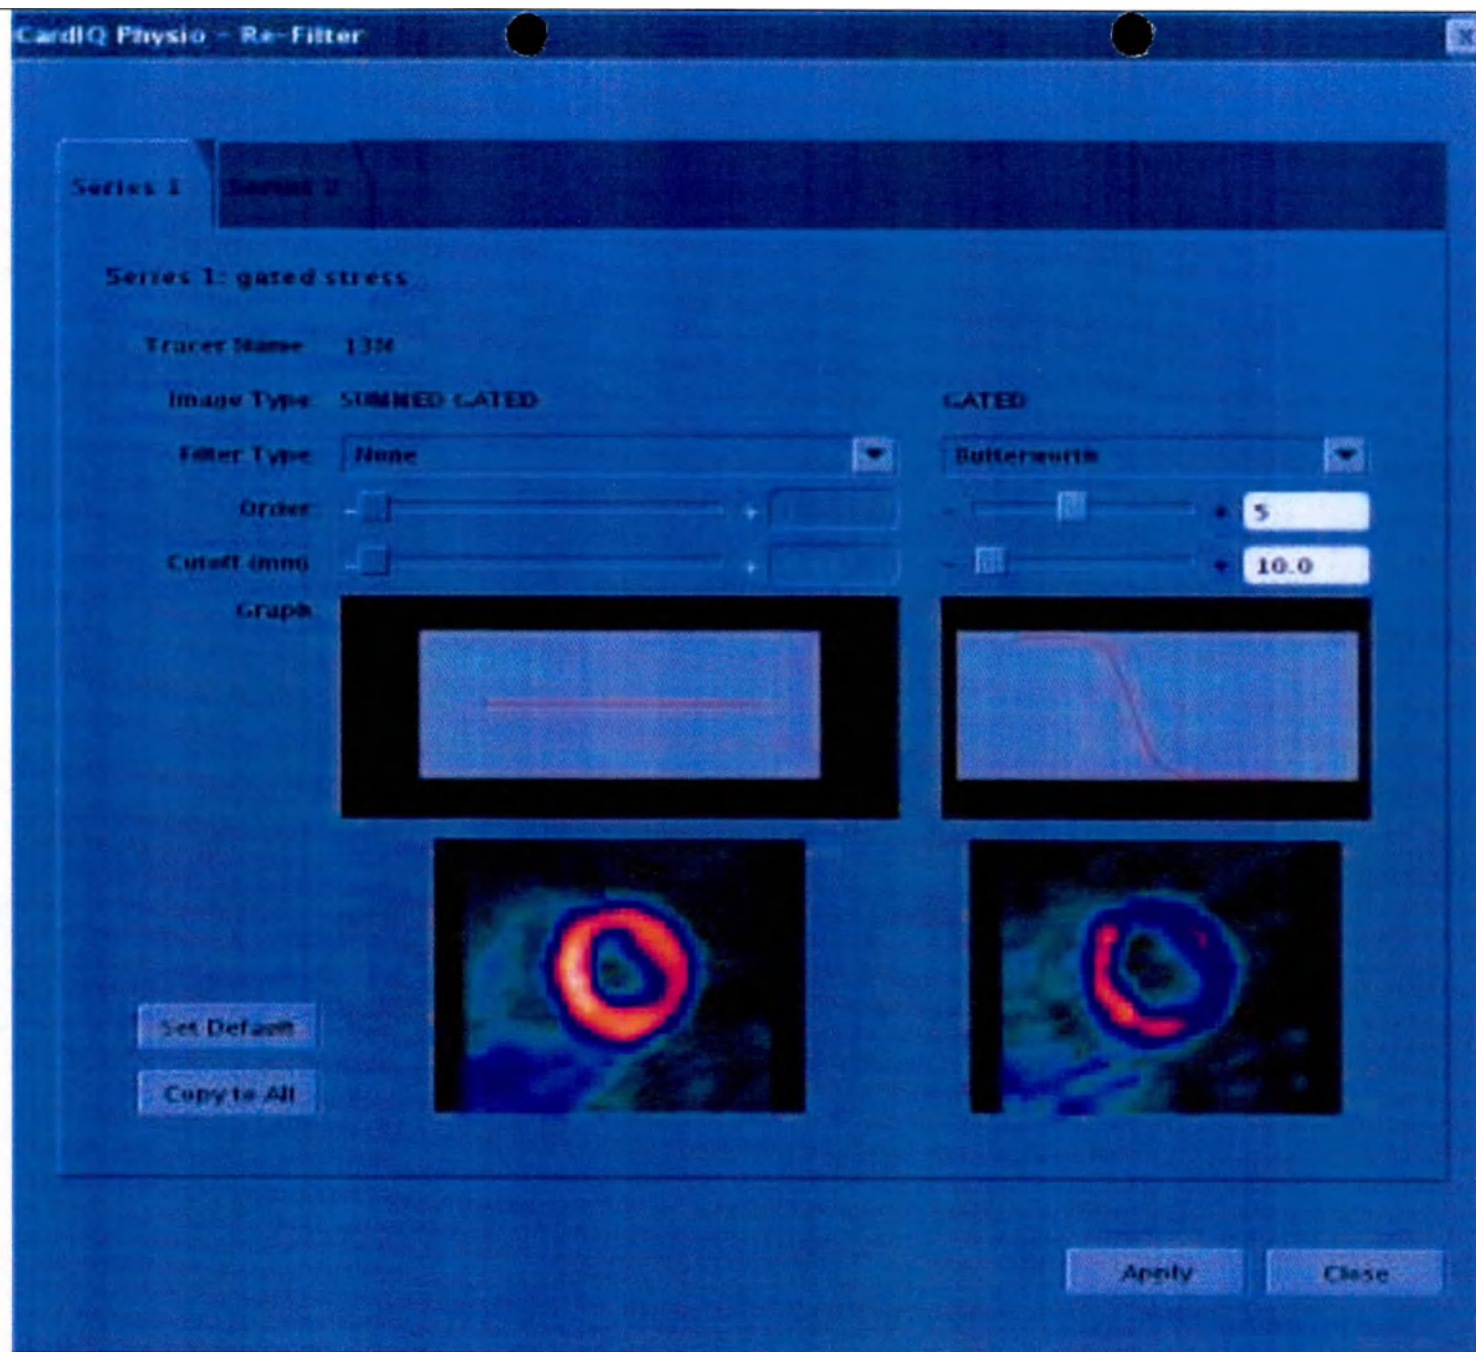


Рис. 240. Программный пакет CardIQ Physio (не более 10 шт.).

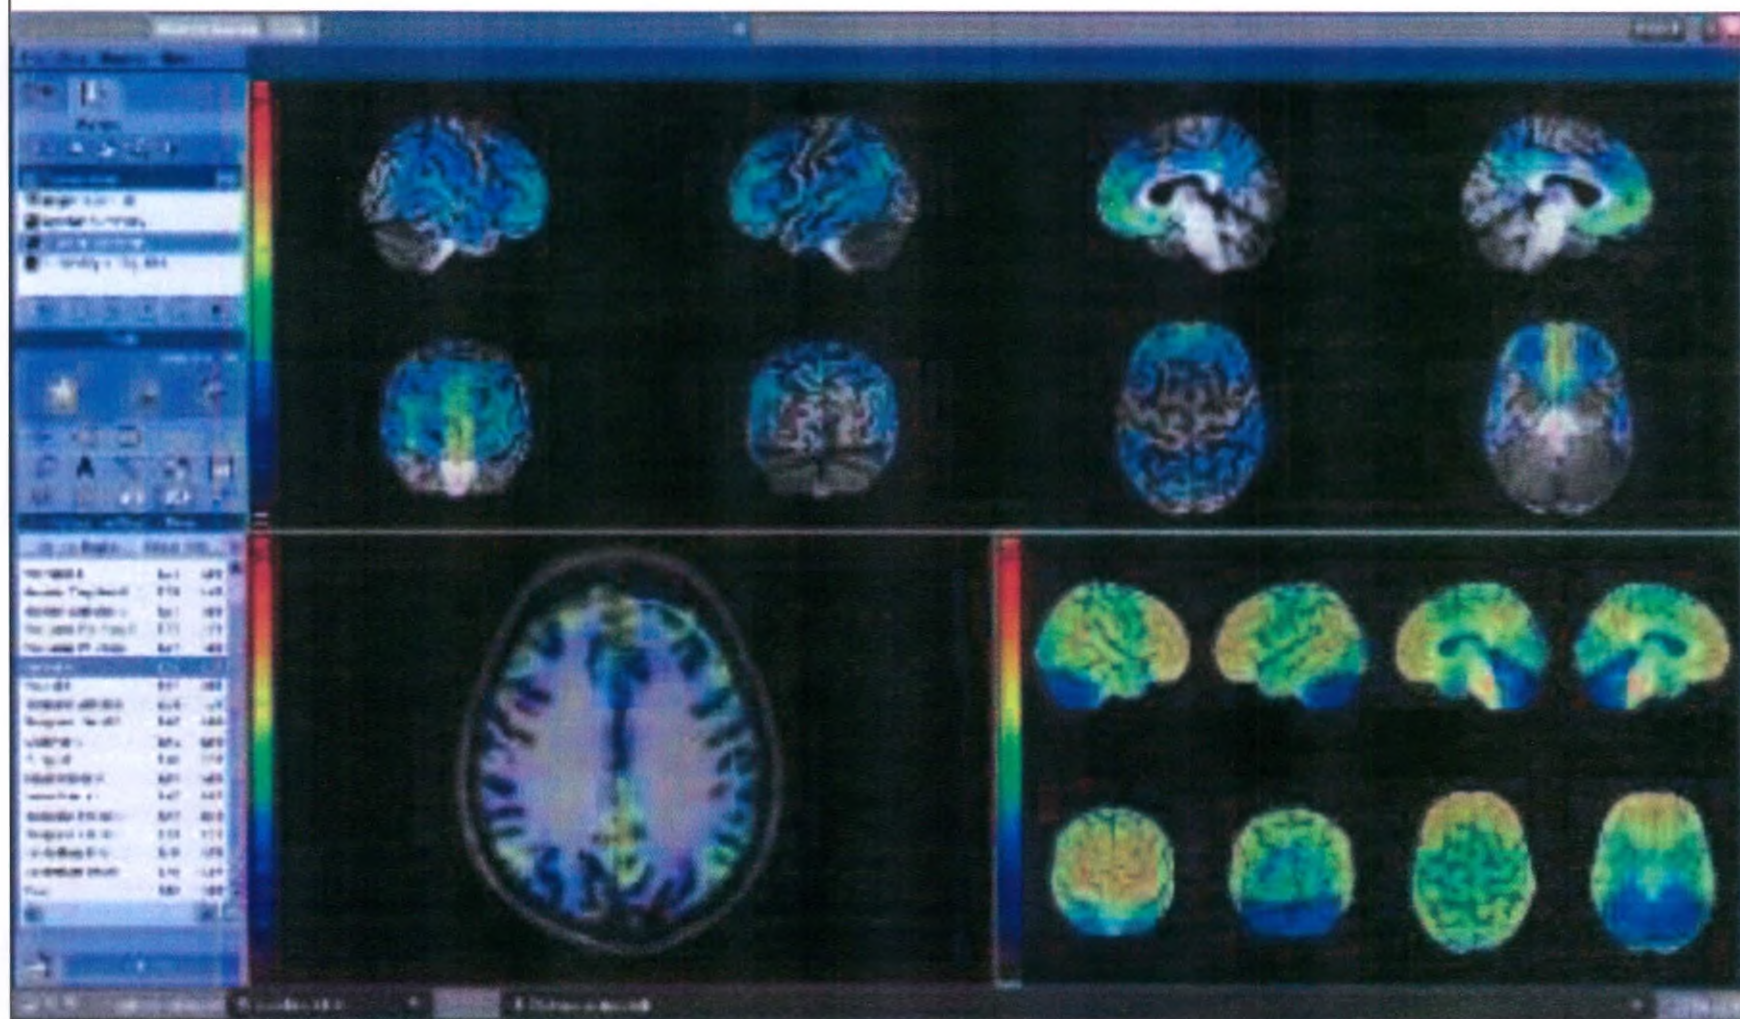


Рис. 241. Программный пакет CortexID Suite (не более 10 шт.).

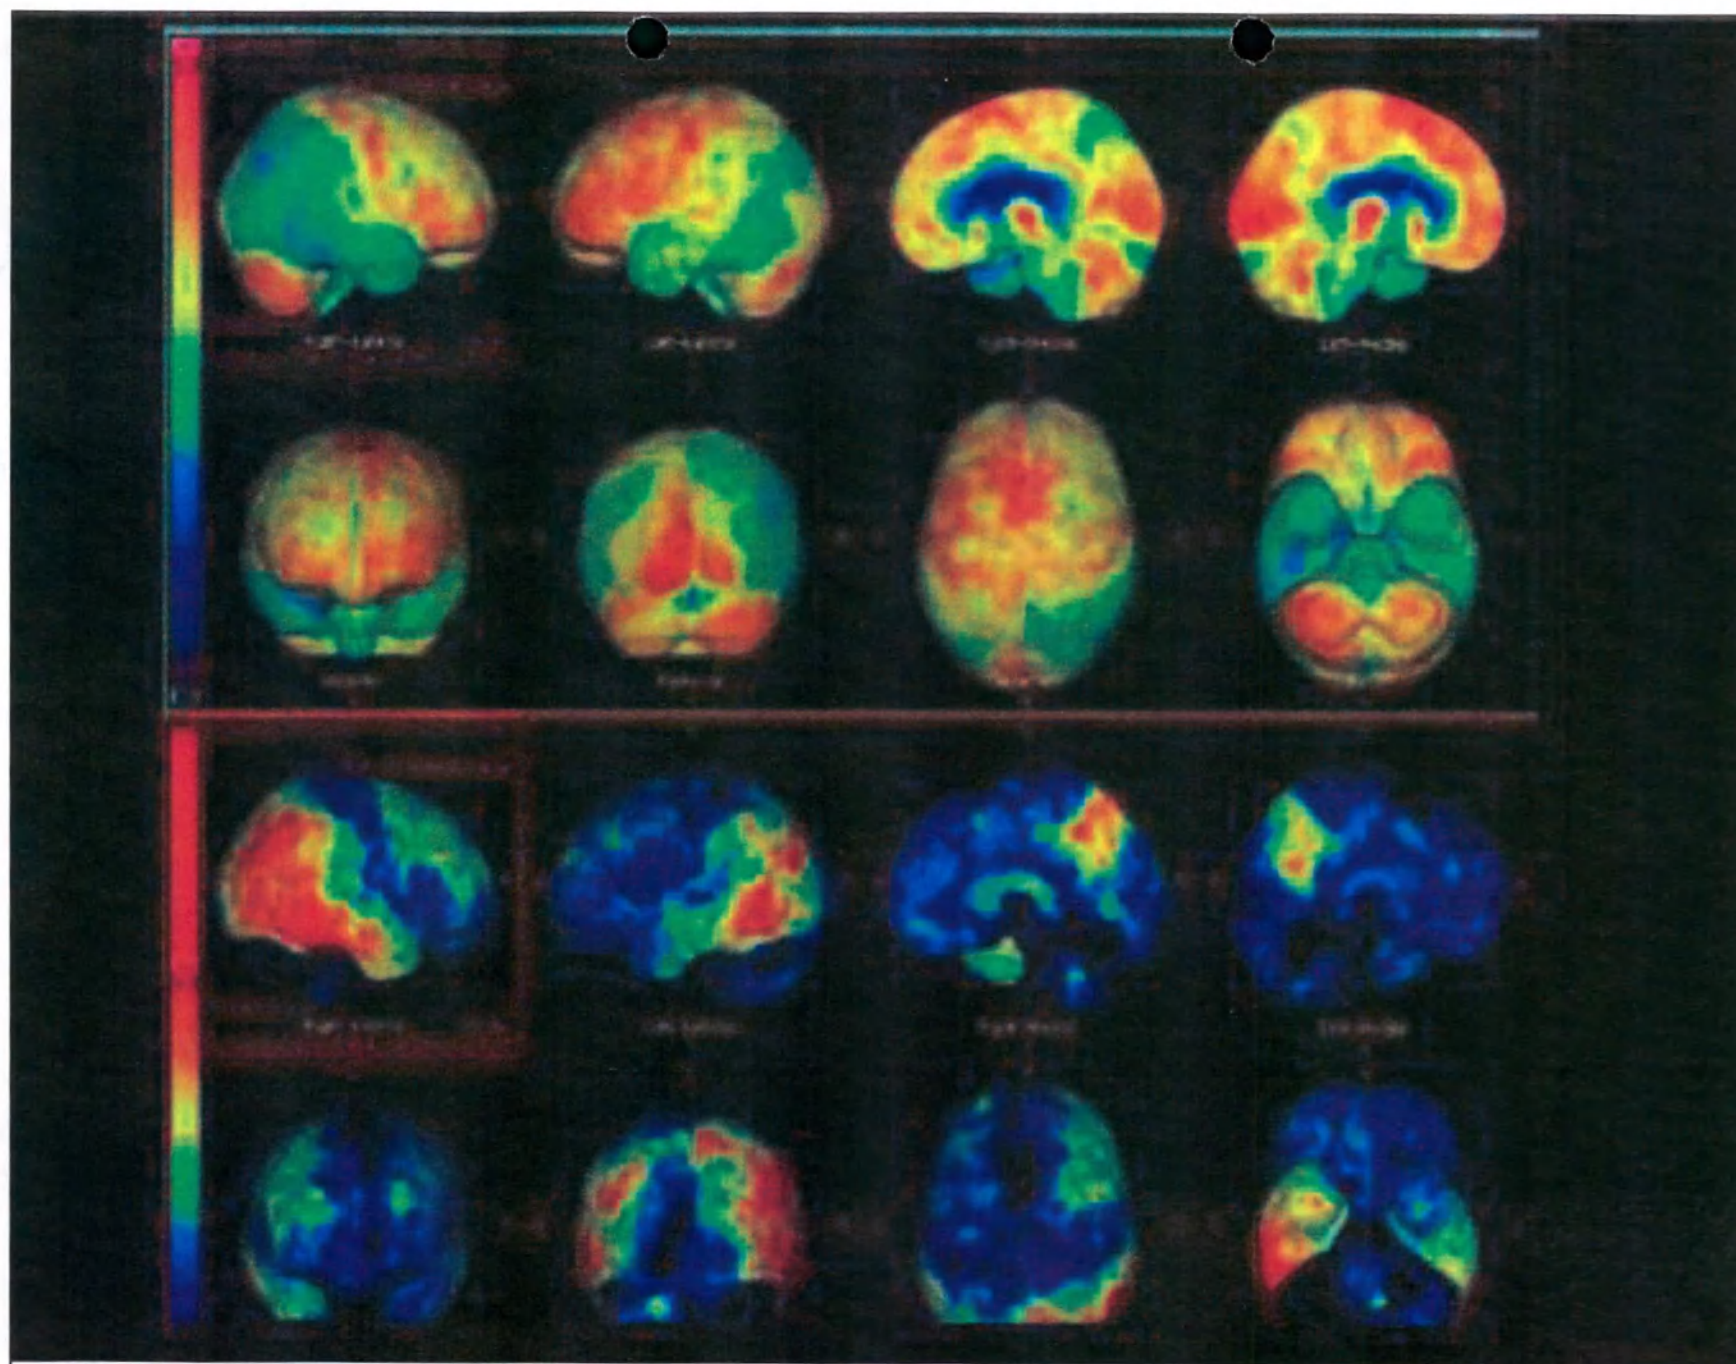


Рис. 242. Программный пакет CortexID Suite PIB (не более 10 шт.).

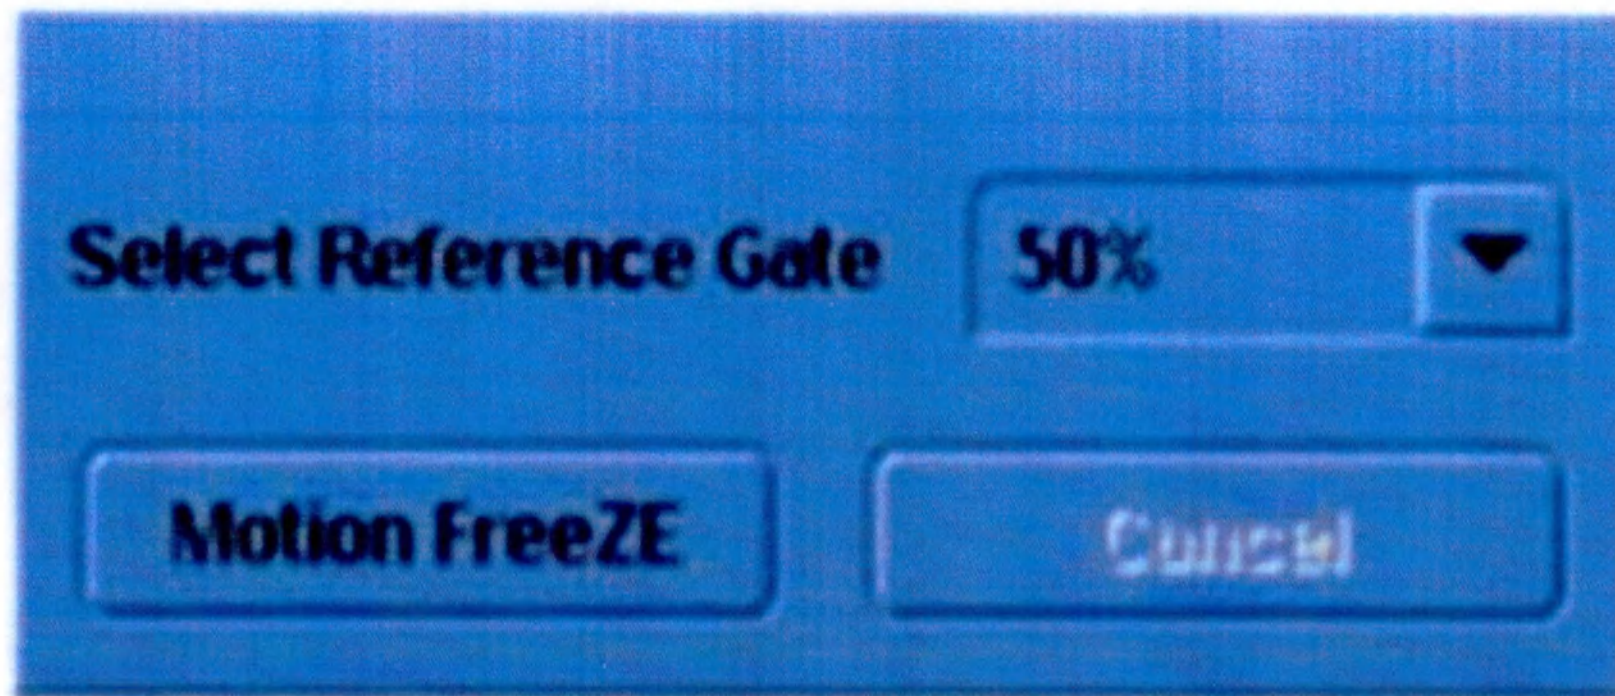


Рис. 244. Программный пакет Q.Freeze 2 (не более 10 шт.).

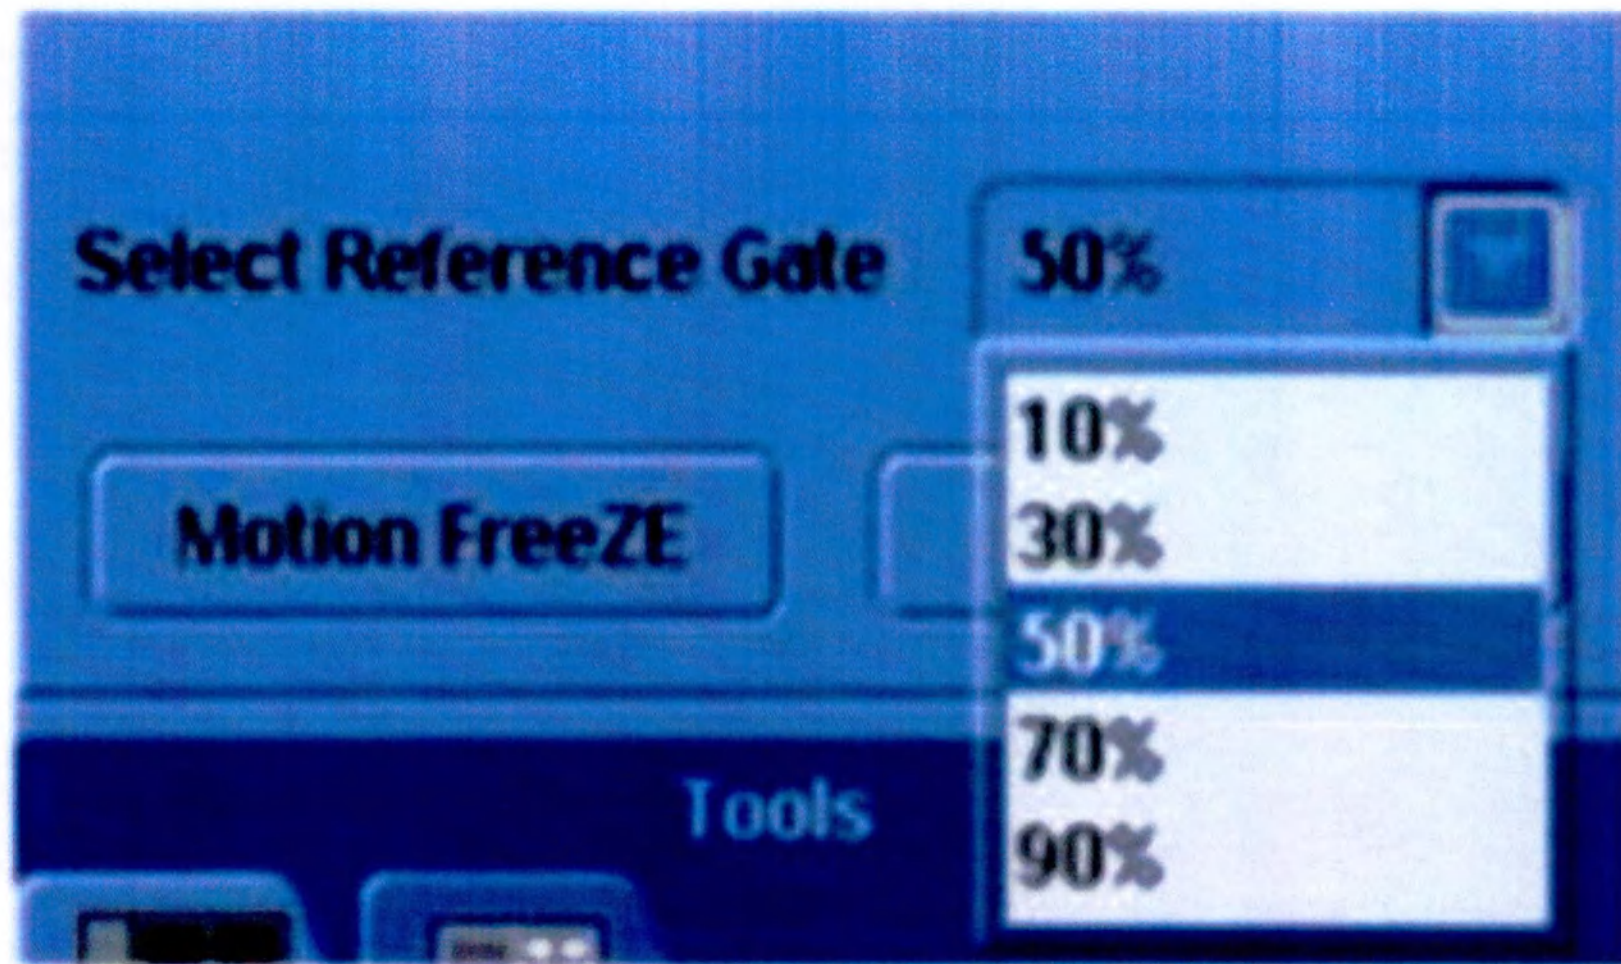


Рис. 245. Программный пакет Q.Freeze 2 (не более 10 шт.).

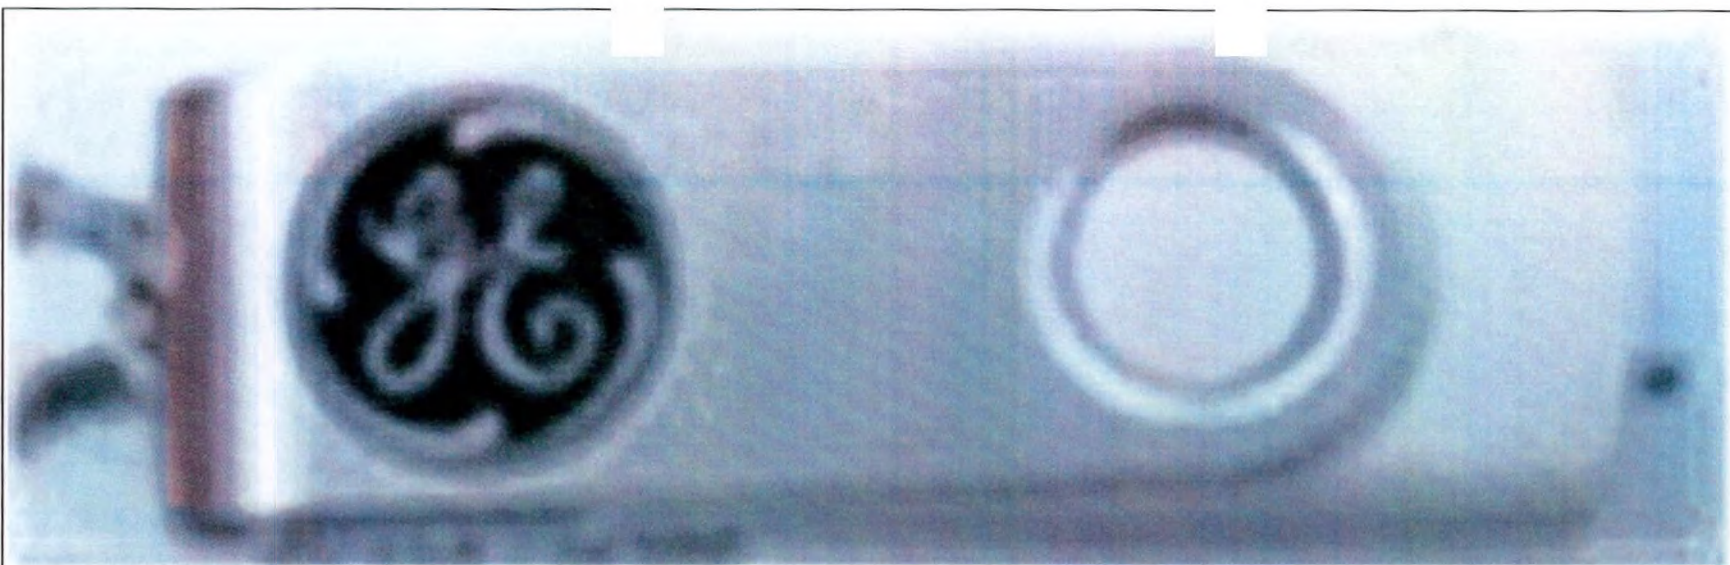


Рис. 246. Программный пакет Certificate for Virtual Items (не более 10 шт.).



Рис. 247. Программный пакет Connect Pro (не более 10 шт.).

Schedule

Status	Accession No.	Patient ID	Patient Name	Date	Time	Exam Description
N	2289-1226	215-295-421	GUERRA-ROGERS, SAAD	6/15/1998	09:00	ROUTINE HEAD
N	2693-0450	374-987-003	JAY, LINDA	6/15/1998	09:00	RENAL DONOR PROTOCOL
N	9109-9698	966-91-579	GOLDBERG, ALIS	6/15/1998	09:30	SELLA IX1
N	1520-8120	392-854-162	SAUNAVAGAN, DAN	6/15/1998	09:30	L-SPINE 3 LEVELS
N	0042-6419	493-602-683	ABRAHAM, SASHA	6/15/1998	10:00	KNEE-HELICAL
N	3776-7279	687-764-393	DOHANGE, MITCHELL	6/15/1998	10:00	SELLA SUPINE
N	2761-8961	643-426-119	STEPHENS, TERRY	6/15/1998	10:00	PRE/POST KIDNEY
N	8893-1170	126-643-635	JAMISON, KATHRYN	6/15/1998	10:30	CT BRAIN W/NO
N	2292-3431	171-00-101	GARRIGUES, STEVEN	6/15/1998	10:30	CHEST/ABDOMEN/PELVIS
N	7279-9542	820-17-173	SATYANAND, EUNICE	6/15/1998	10:30	ABD PELVIS PANCREAS
N	1473-9057	867-306-719	SAITA, MELANIE	6/15/1998	11:00	FACIAL / ORBITS
N	3147-6869	609-364-901	PARK, HANNA	6/15/1998	11:00	TEMP BONES
N	4396-9255	947-160-445	MORGAN, FREDERIC	6/15/1998	11:00	SELLA IX1
N	9174-2540	162-556-716	ANDREWS, JACQUES	6/15/1998	11:30	PEDICLE
N	3864-1823	663-852-105	NELSON, ARVIND	6/15/1998	11:30	FACIAL / ORBITS
N	0525-1993	167-638-227	SHINDOKA, ABIGALE	6/15/1998	11:30	SELLA IX1
N	7923-2222	432-77-233	ESPARANZA, ANGELA	6/15/1998	12:00	KNEE-HELICAL

Quit

Select
Patient

View
More Info

Add
Patient

Edit
Patient

Delete
Selected

Delete All

Preferences

Update

Last Update:
6/17/2004 11:14



Next



Prior

Рис. 248. Программный пакет Connect Pro (не более 10 шт.).



Рис. 249. Программный пакет Dynamic VUE (не более 10 шт.).

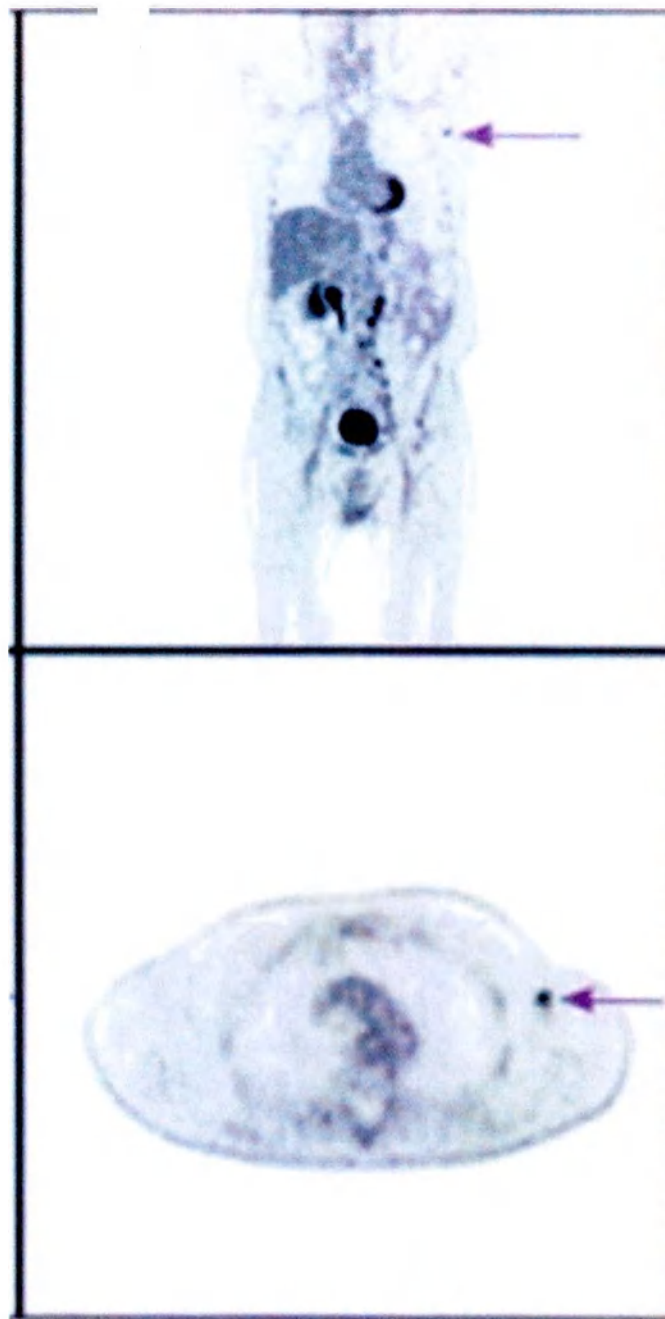


Рис. 250. Программный пакет SharpIR (не более 10 шт.).

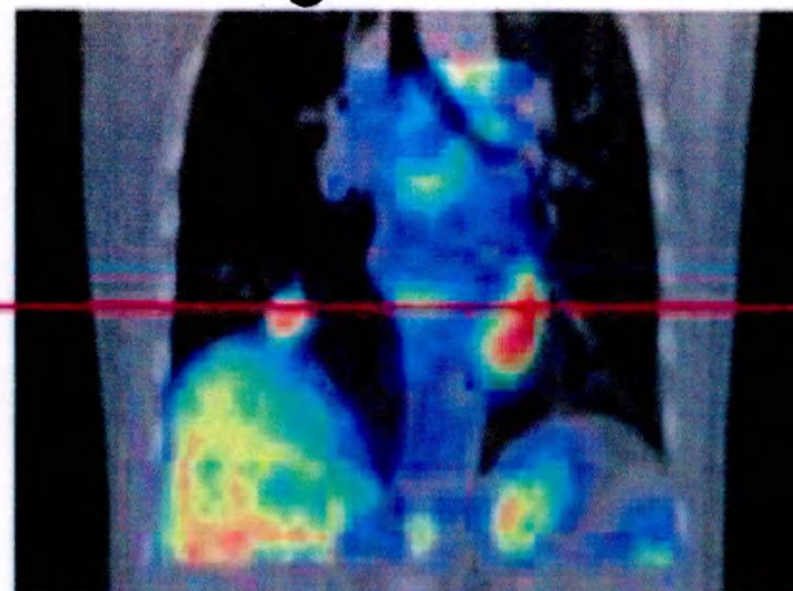
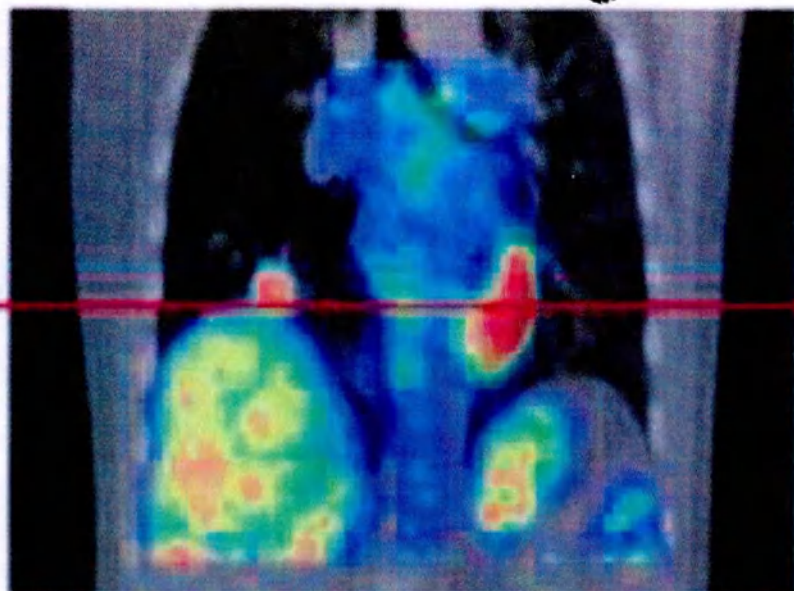


Рис. 251. Программный пакет Motion Match Option (не более 10 шт.).

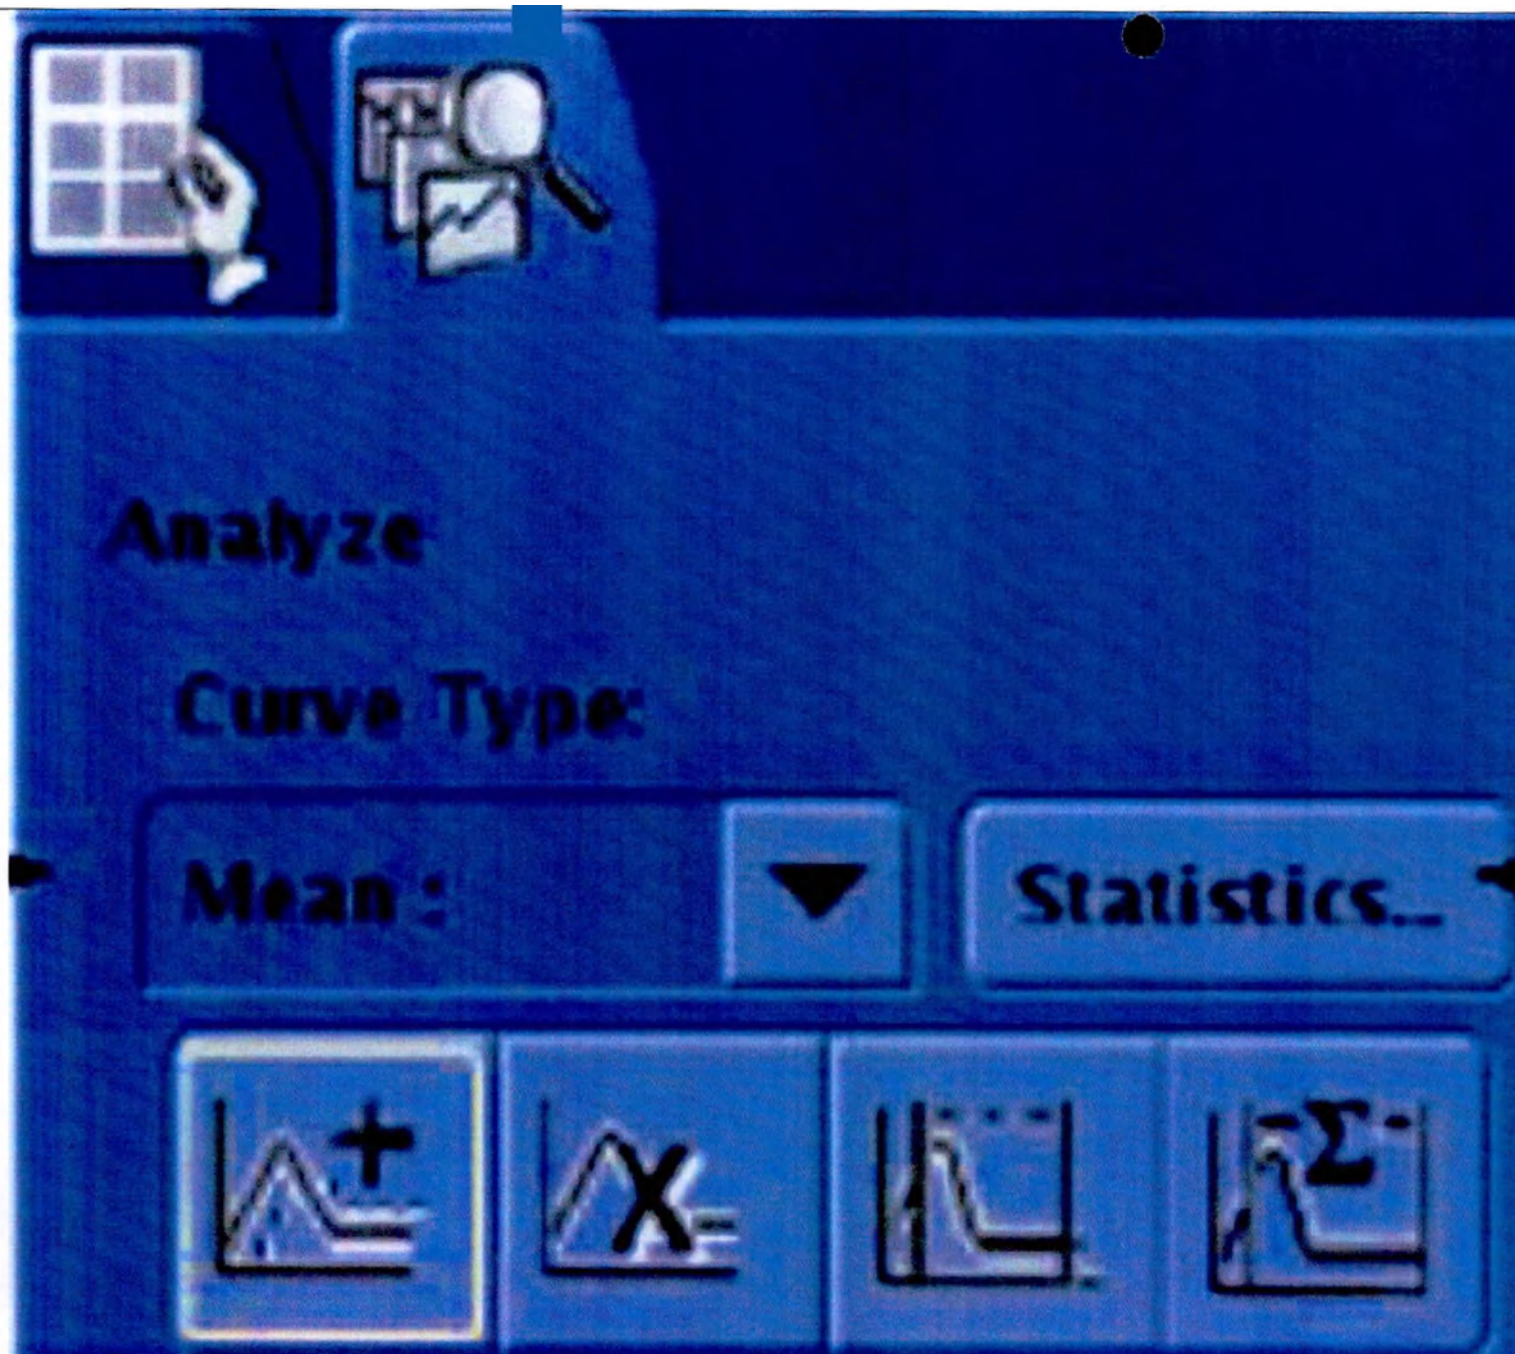


Рис. 252. Программные пакеты для консоли (не более 10 шт.).

Enhanced Stream Injector

Index	No. Bytes (B)	Type	Play Time (min)	Volume (dB)	Duration (s)	Path (URL)	Header Volume
1	1	Endless	1.0	5	5.0	-	-
2	0	Endless Track	1.0	10	5.0	10	1.0/5.0
3	0	Track	1.0	0	5.0	10	1.0/5.0

Previous Count
(P10)

00

Remaining
Count/Volume
(R)

00

Remaining
Time
(M)

00

1/1

Full
Track

Full
Track

Apply

Cancel

Рис. 253. Программные пакеты для консоли (не более 10 шт.).



Рис. 254. Программные пакеты для консоли (не более 10 шт.).

SmartScore Pro

On

R to R
Interval

54

1111ms

Center
R-Peak
Delay(%)

70

777ms

Time Between
Images(ms)

50

Images per
R to R
Interval

3

Accept

Cancel

Рис. 256. Программные пакеты для консоли (не более 10 шт.).

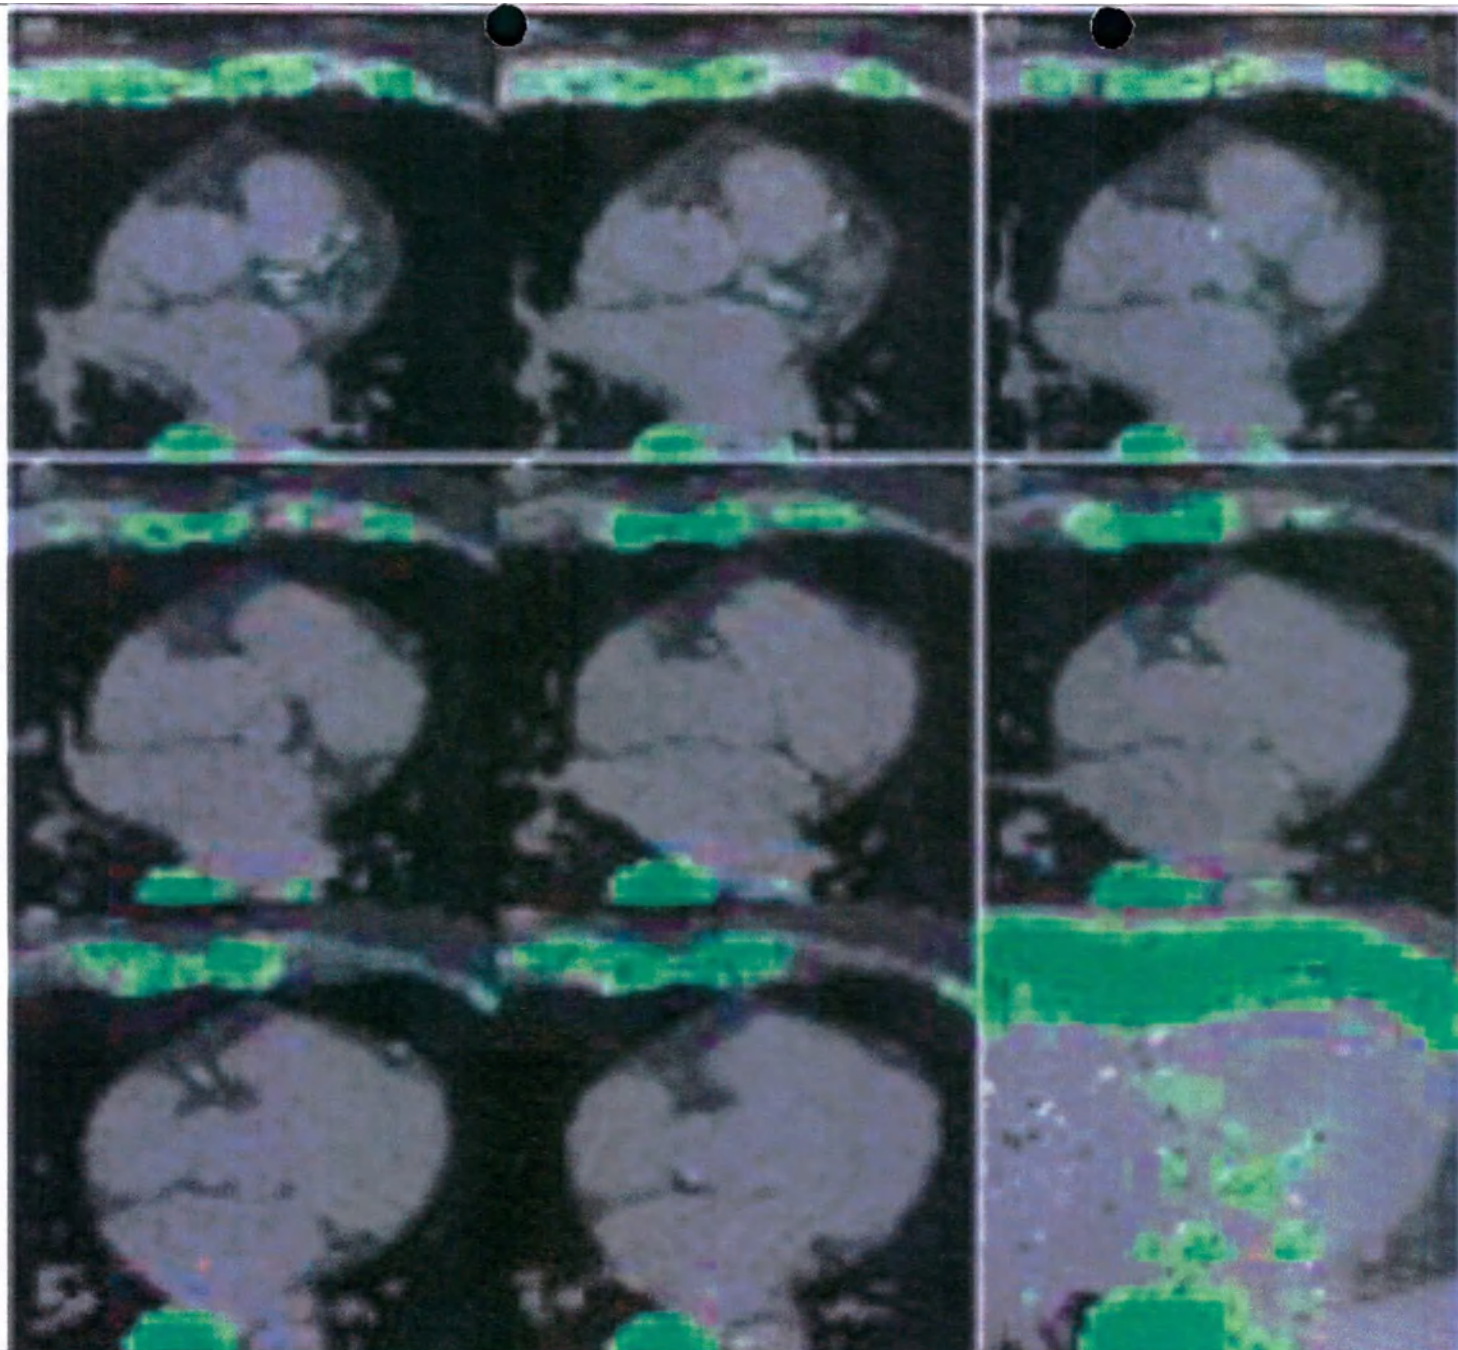


Рис. 257. Программные пакеты для консоли (не более 10 шт.).

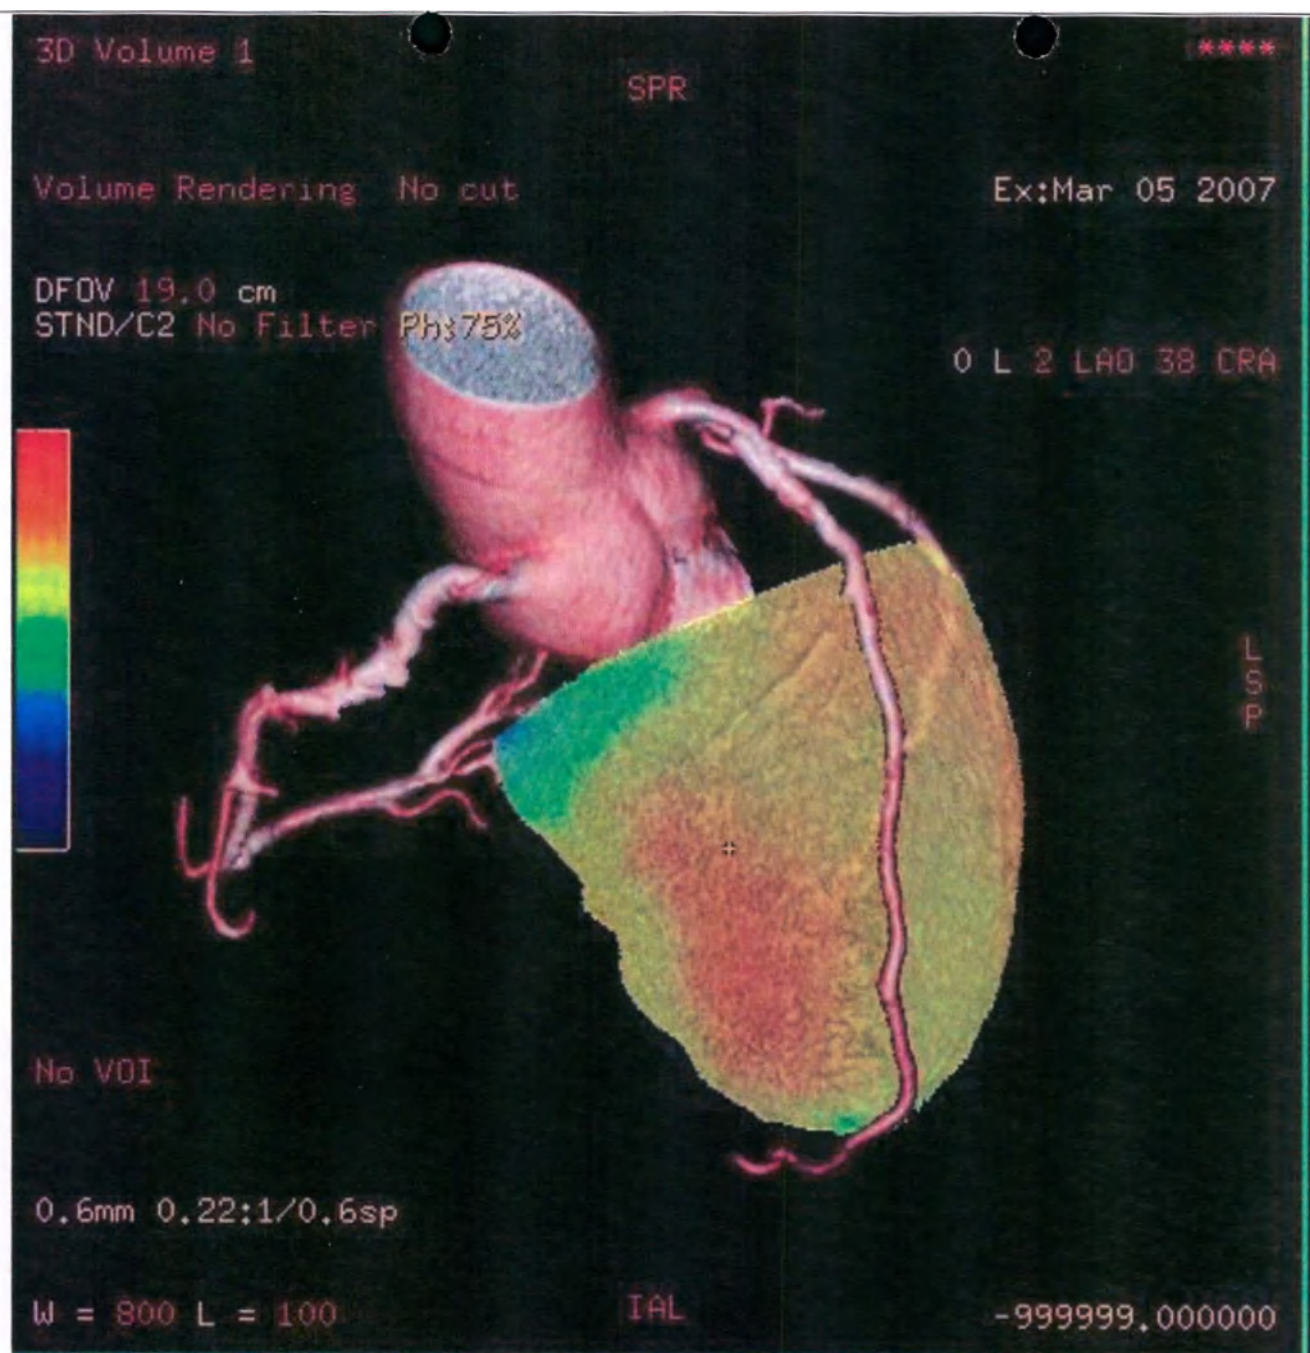


Рис. 258. Программные пакеты для просмотра, обработки и анализа ПЭТ изображений (не более 10 шт.).



Рис. 259. Программные пакеты для просмотра, обработки и анализа онкологических изображений (не более 10 шт.).

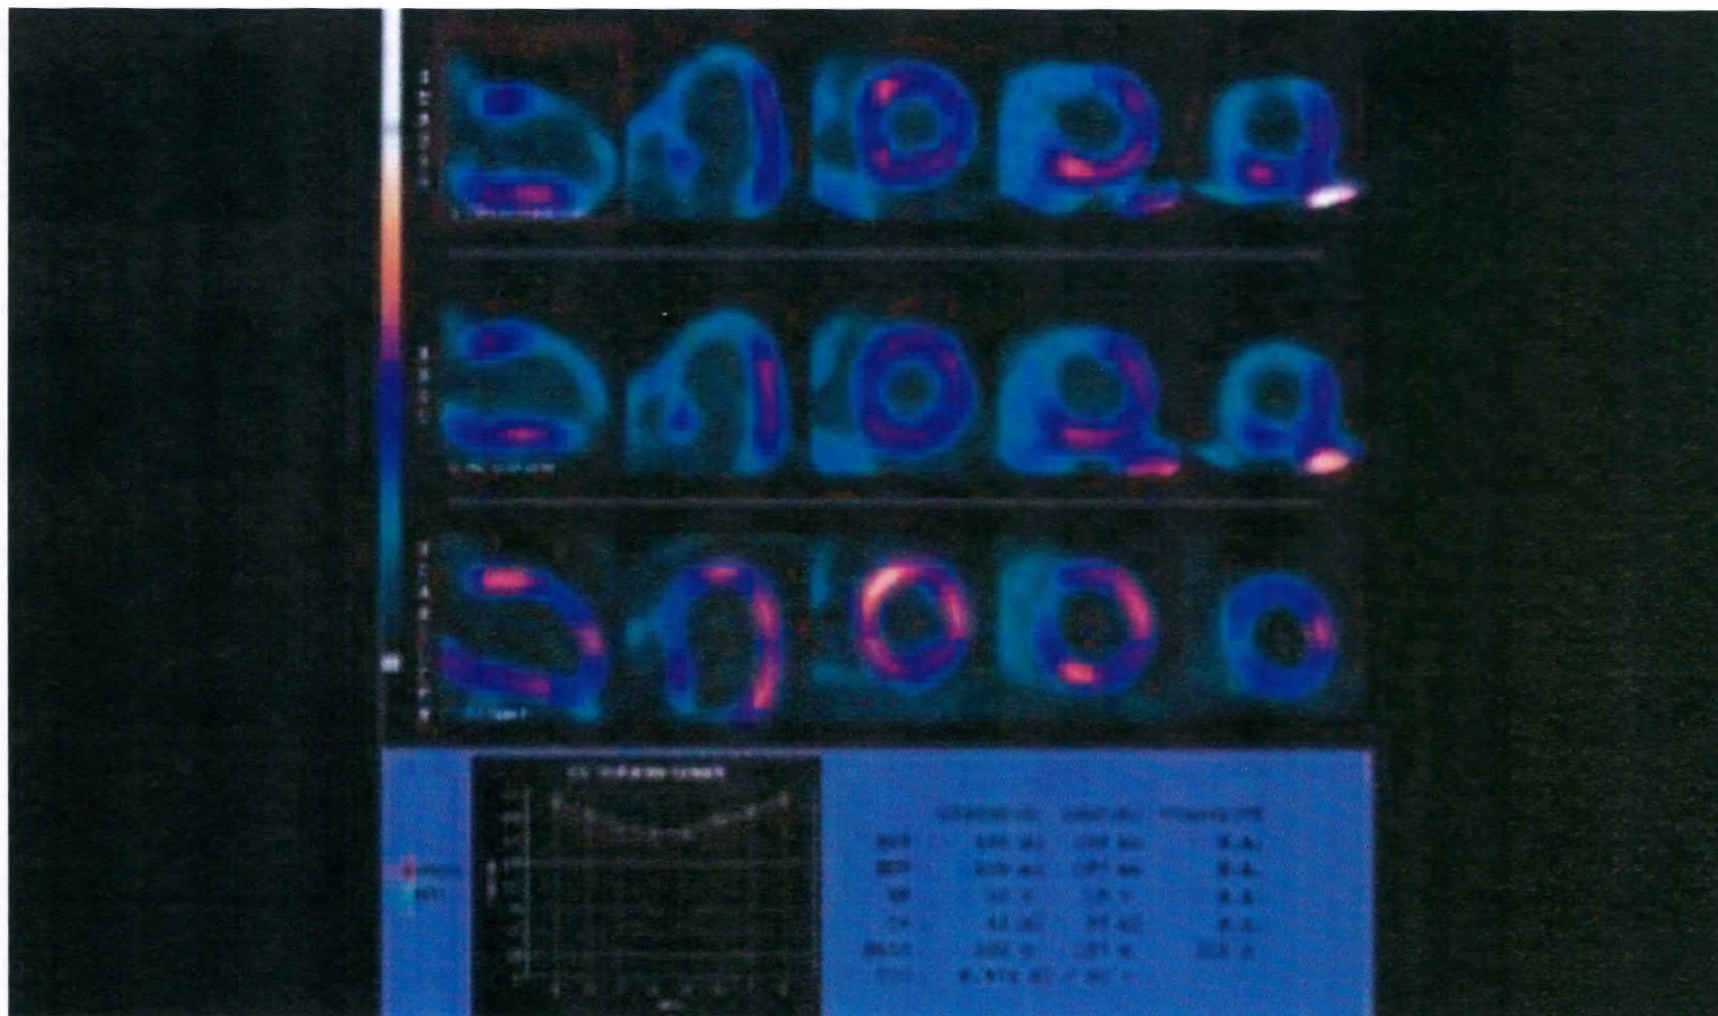


Рис. 260. Программные пакеты для просмотра, обработки и анализа кардиологических функциональных изображений (не более 10 шт.).

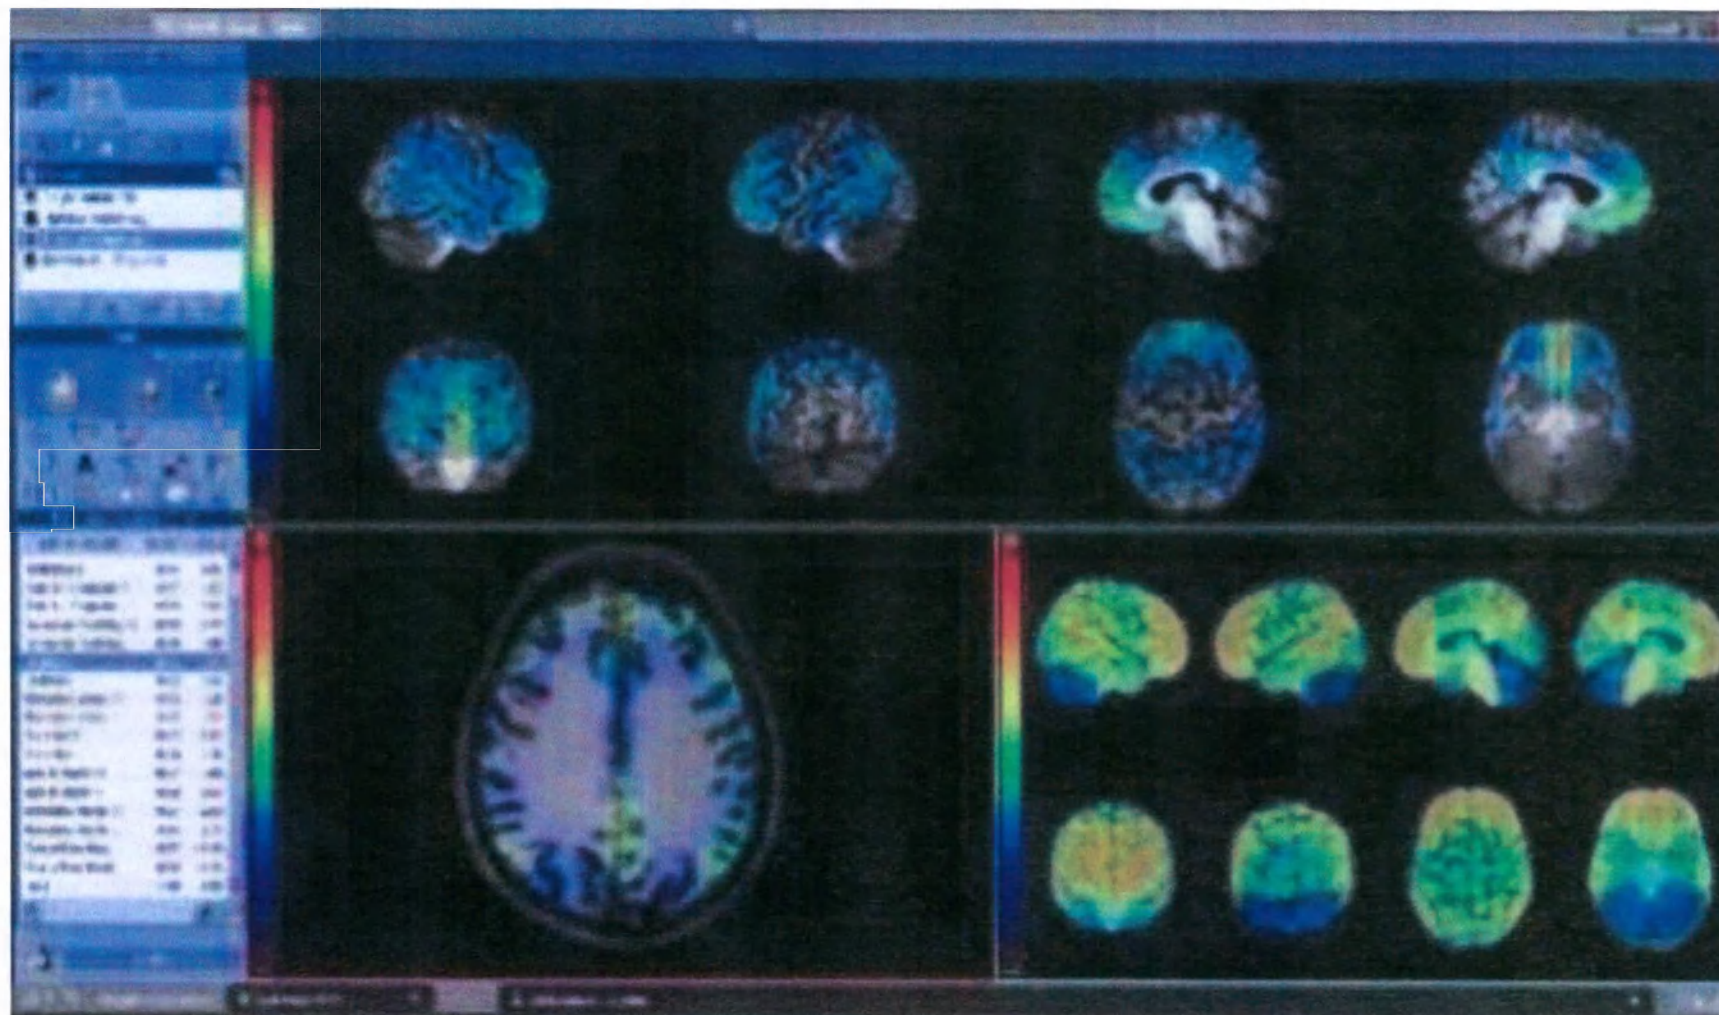
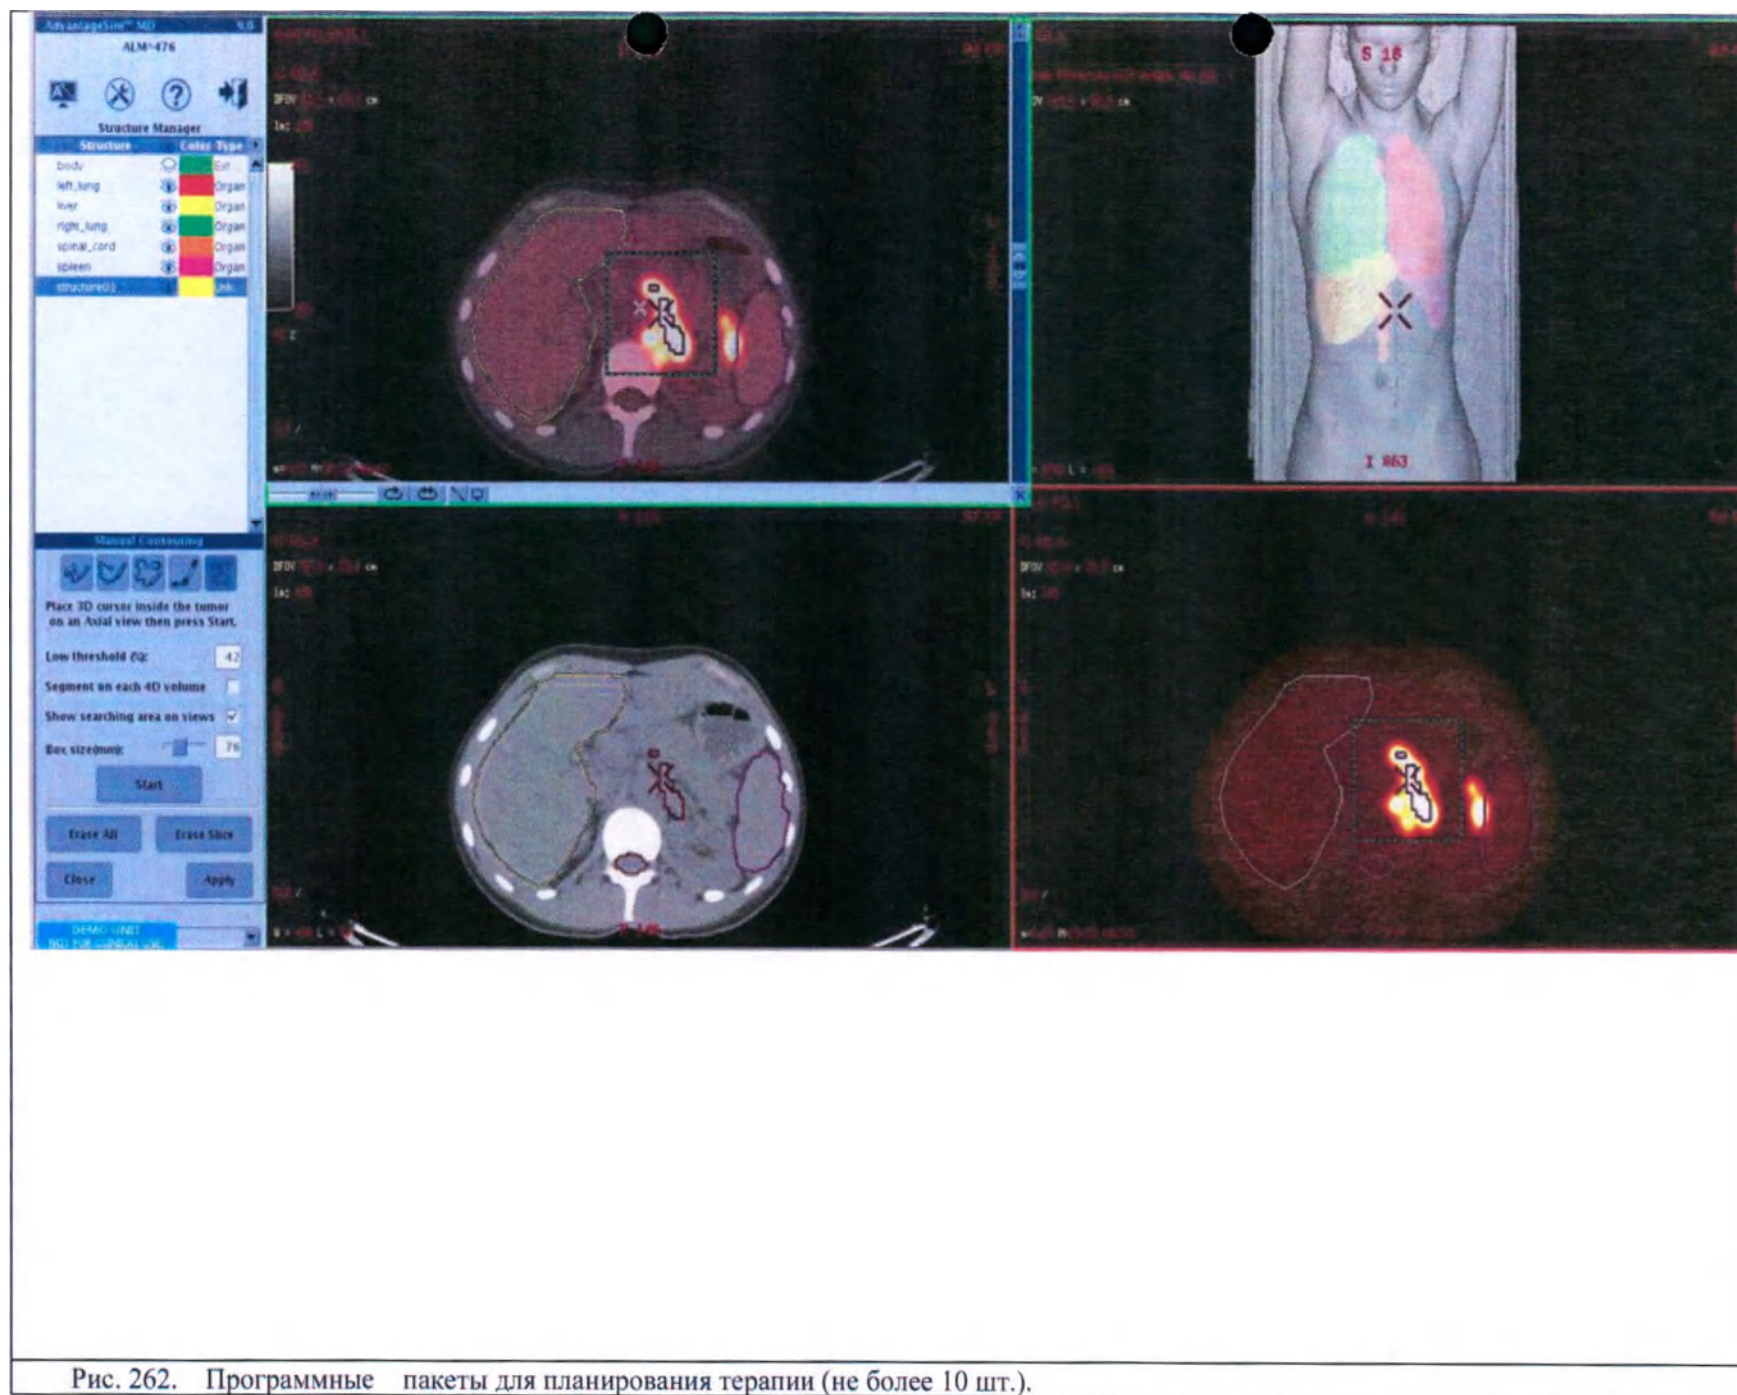


Рис. 261. Программные пакеты для просмотра, обработки и анализа неврологических функциональных изображений (не более 10 шт.).



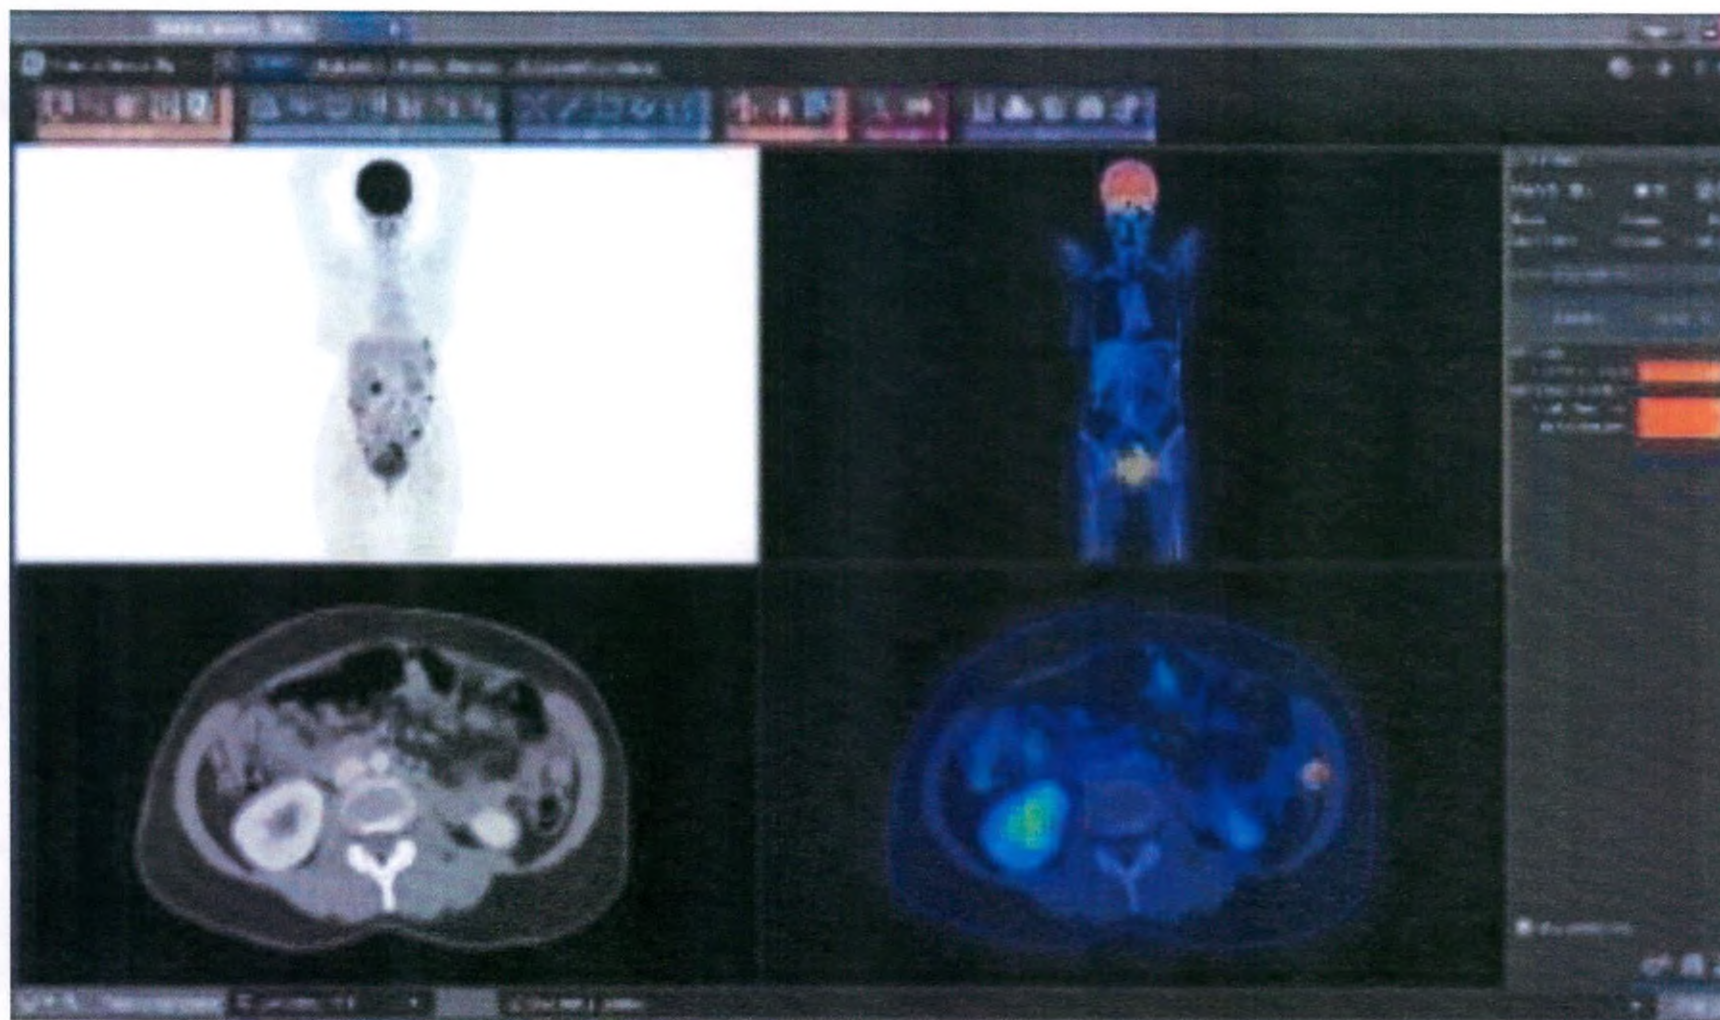


Рис. 263. Программные пакеты для оценки эффективности терапии (не более 10 шт.).

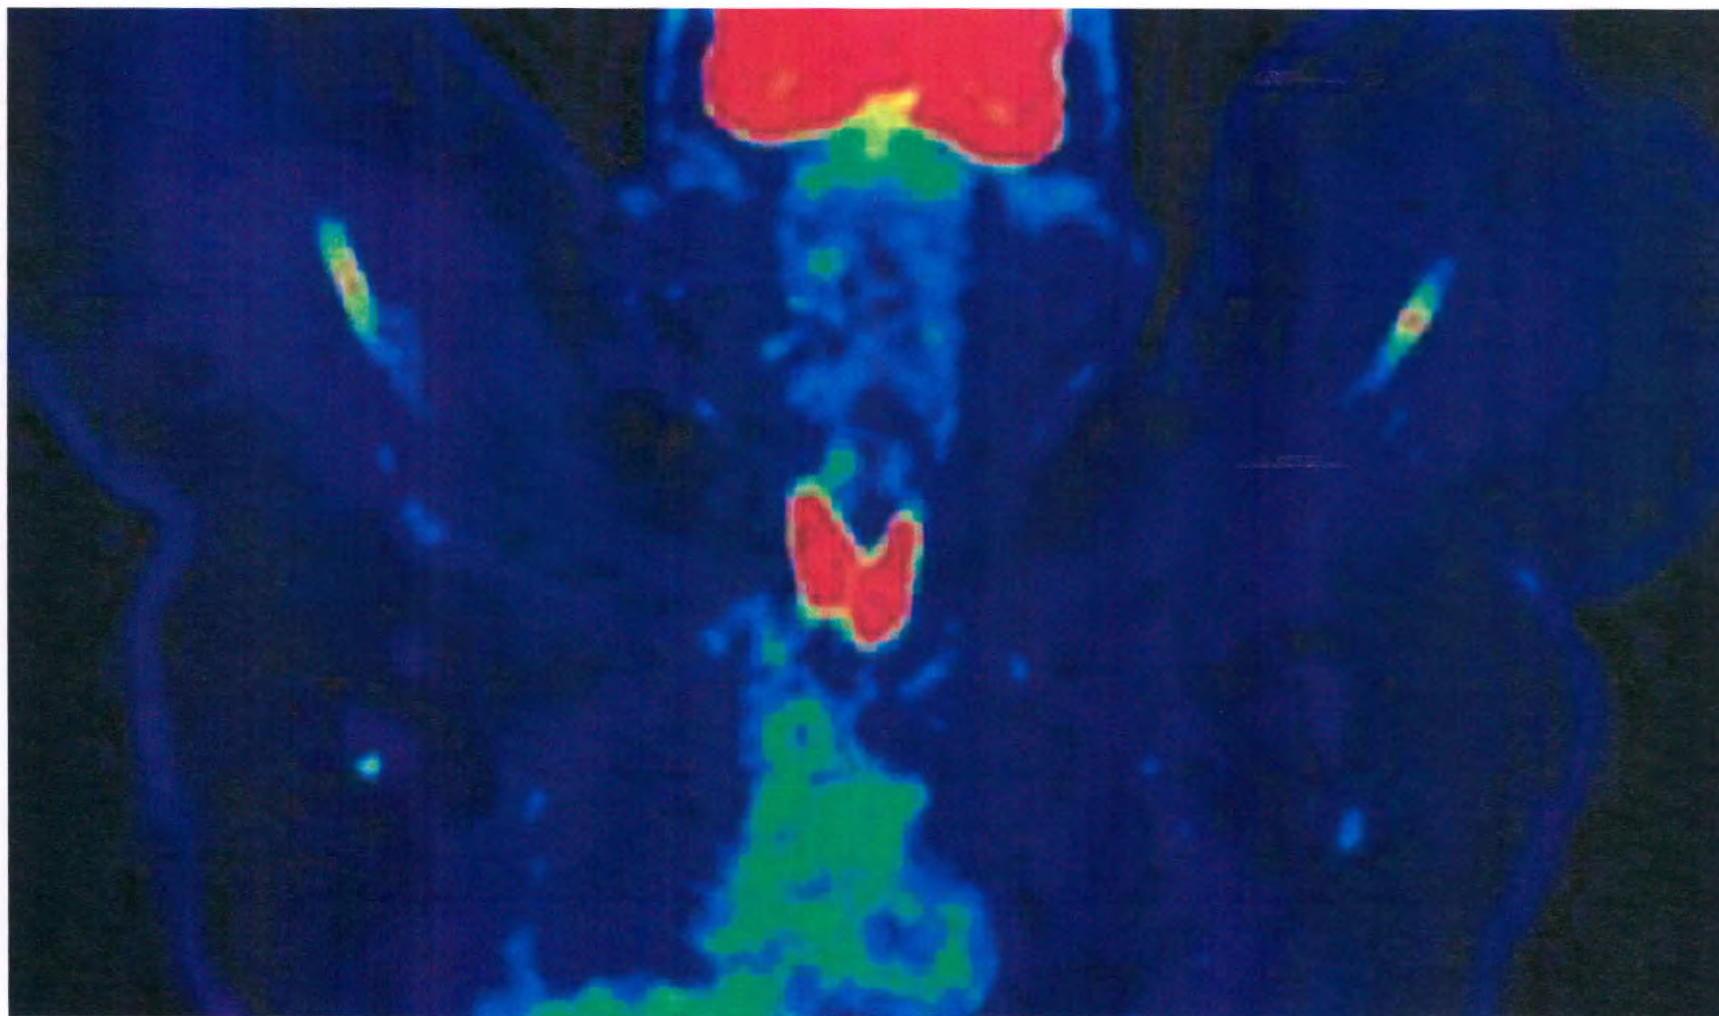


Рис. 264. Программные пакеты для оценки количественных данных ПЭТ (не более 10 шт.).

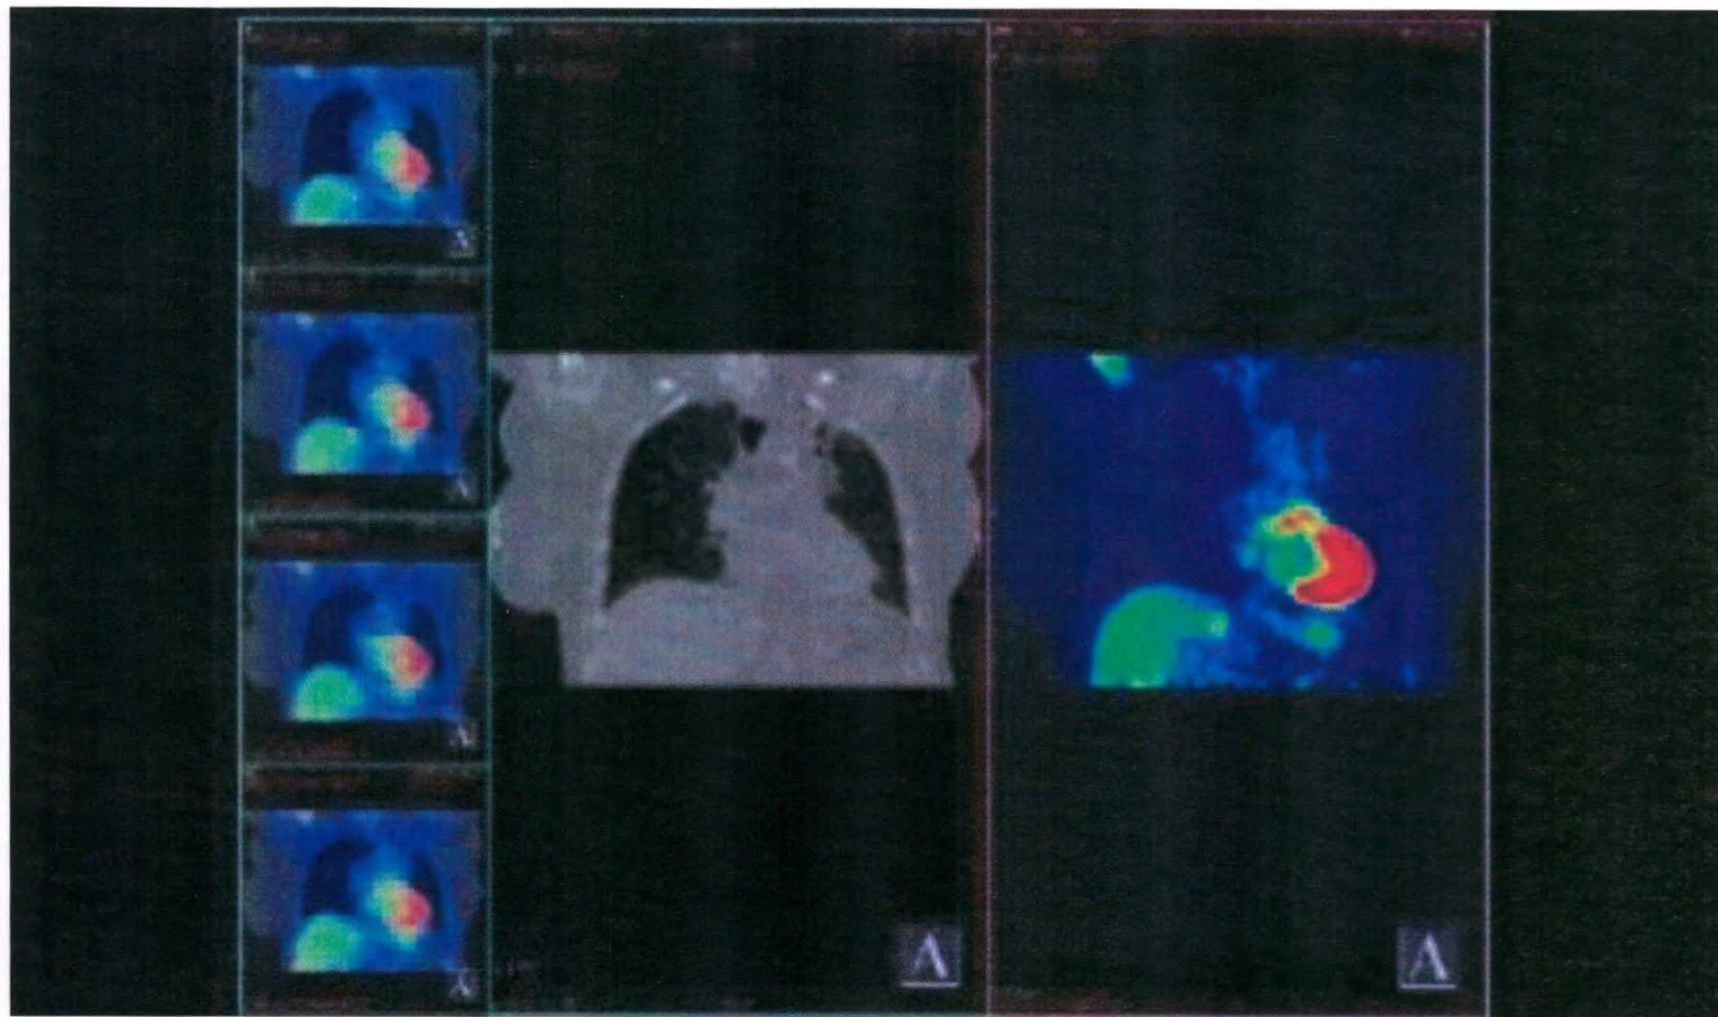


Рис. 265. Программные пакеты для просмотра, обработки и анализа синхронизированных изображений (не более 10 шт.).



Рис. 266. Стойки инфузионные (не более 4 шт.)



Рис. 267. Стойки инфузионные (не более 4 шт.)



Рис. 268. Стул оператора (не более 2 шт.).



Рис. 269. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.)



Рис. 270. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.)



Рис. 271. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.)

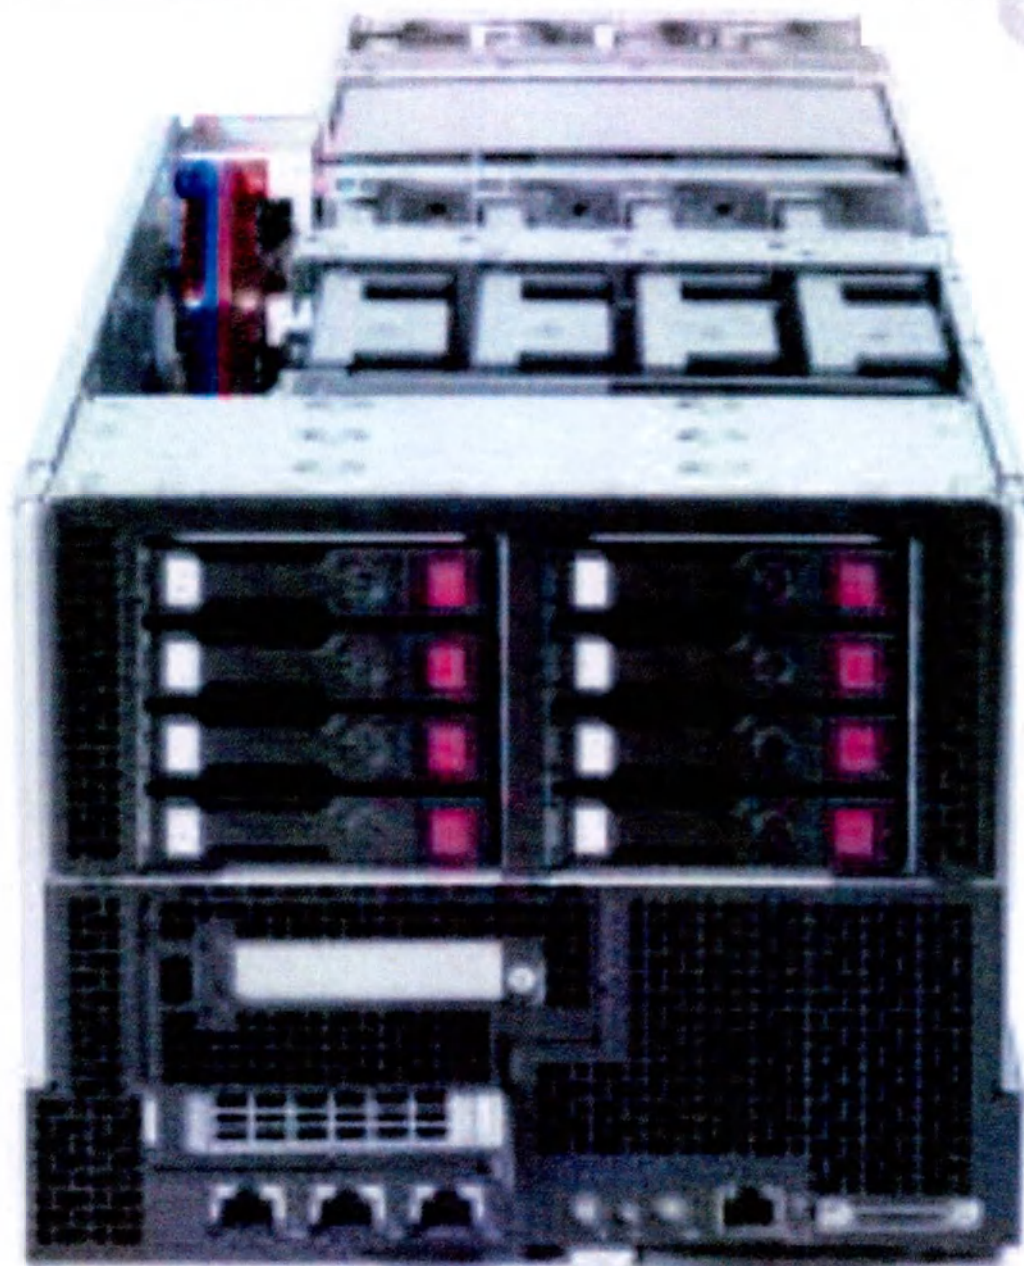


Рис. 272. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.)



Рис. 273. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.)



Рис. 274. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.)

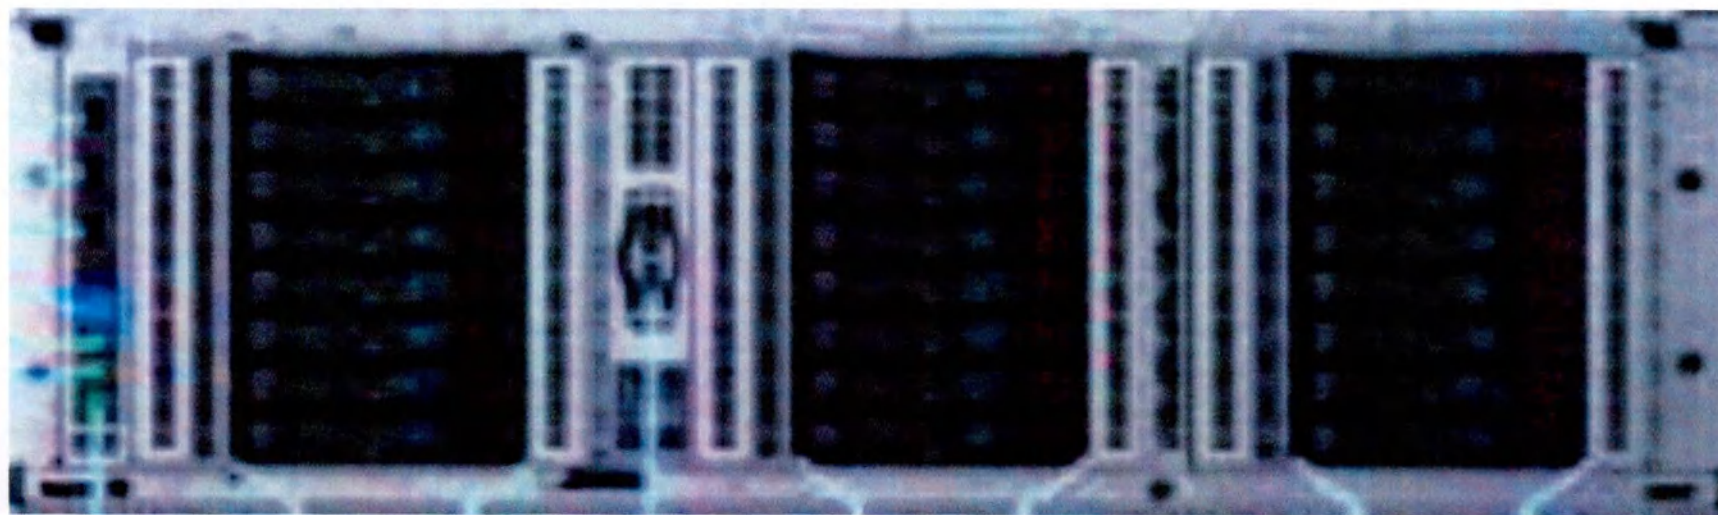


Рис. 275. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.)



Рис. 276. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.)



Рис. 277. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.)

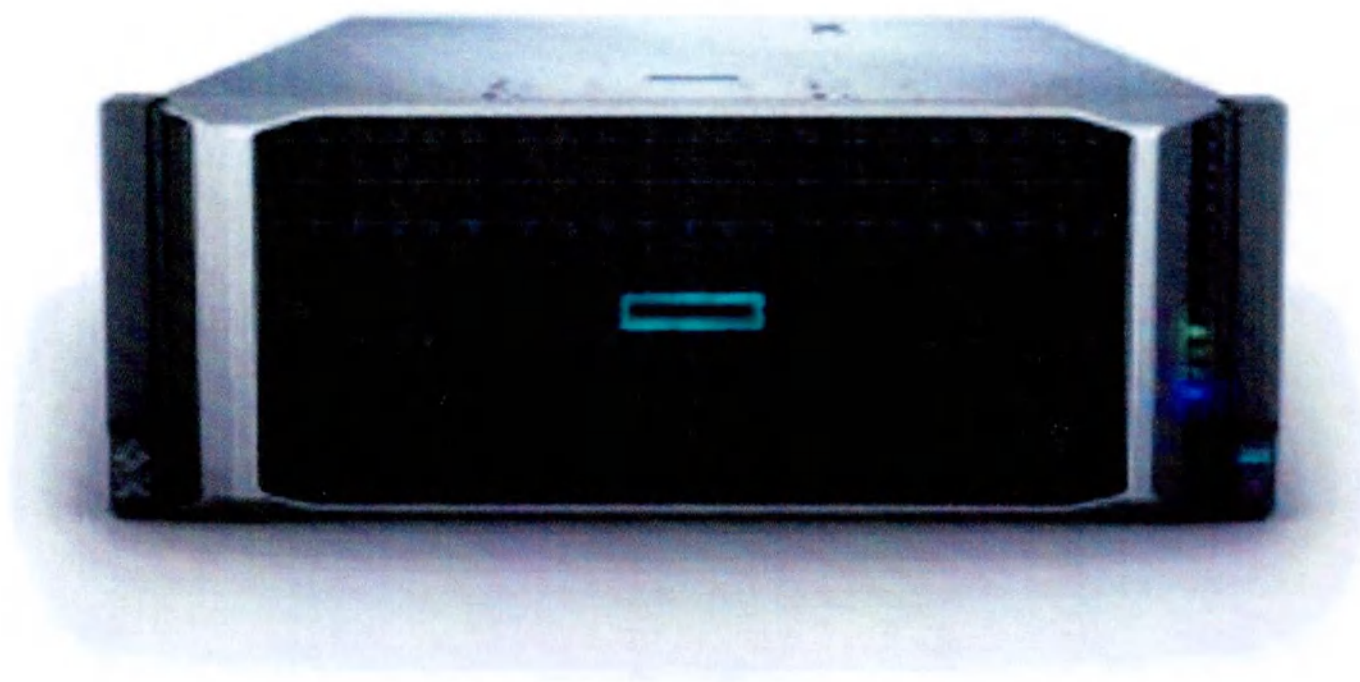


Рис. 278. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.)



Рис. 279. Блоки реконструкции дополнительные (не более 6 шт.)



Рис. 280. Мыши (не более 4 шт.)



Рис. 281. Клавиатуры специальные (не более 4 шт.)



Рис. 282. Клавиатуры специальные (не более 4 шт.)



Рис. 283. Трекболы (не более 4 шт.)



Рис. 284. Источник бесперебойного питания для рабочей станции (не более 10 шт.)

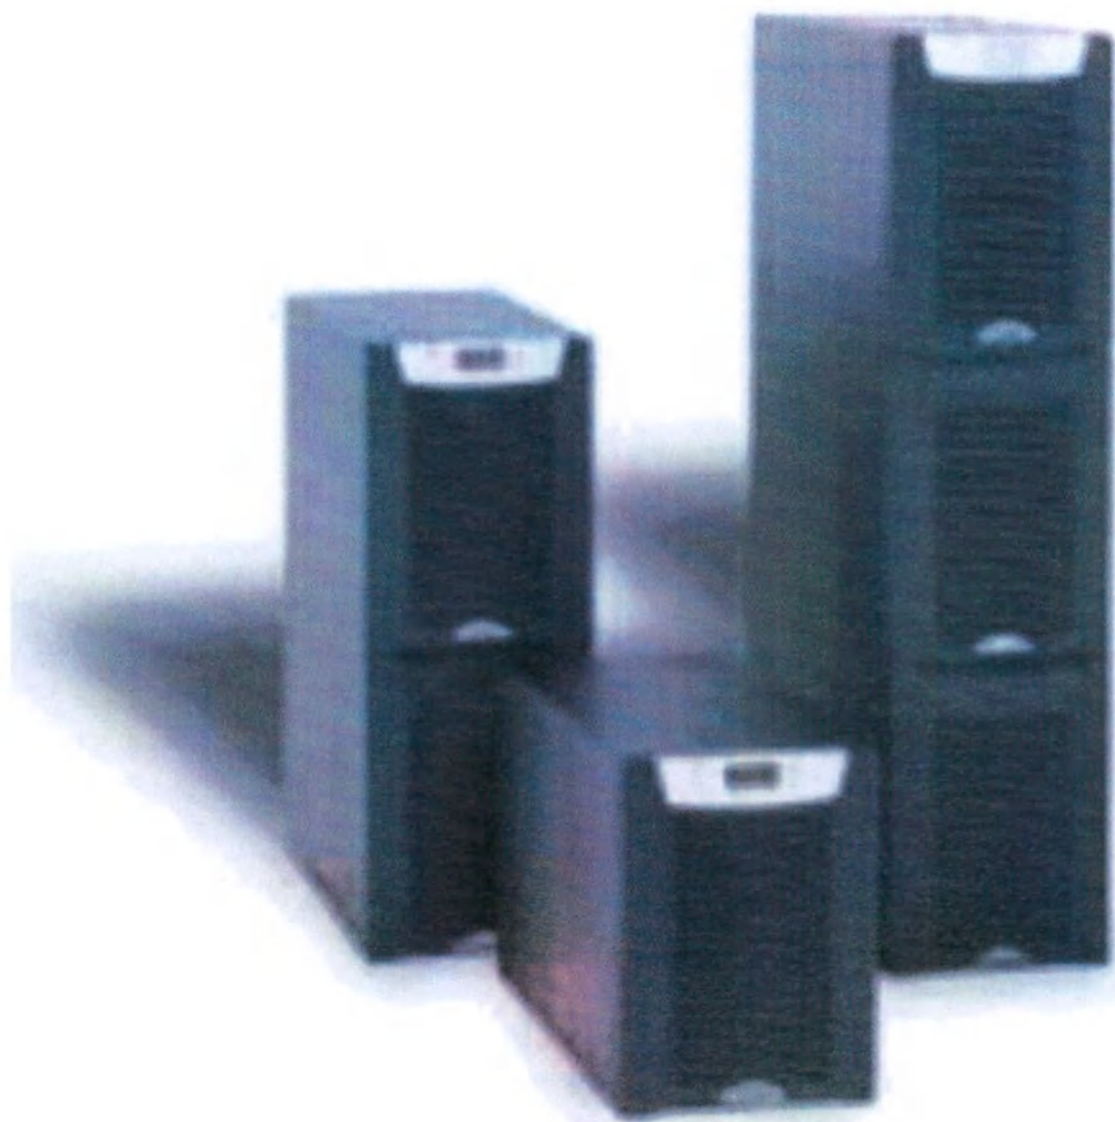


Рис. 285. Источник бесперебойного питания для рабочей станции (не более 10 шт.)



Рис. 286. Источник бесперебойного питания для рабочей станции (не более 10 шт.)

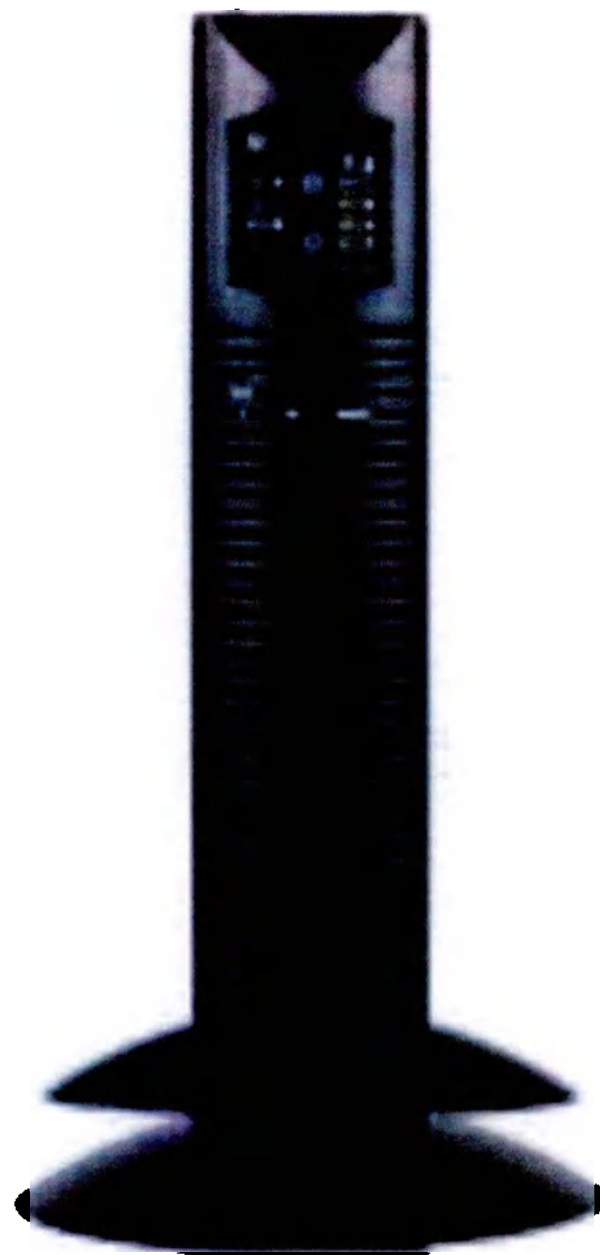


Рис. 287. Источник бесперебойного питания для рабочей станции (не более 10 шт.)



Рис. 288. Компоненты для транспортировки, монтажа и настройки комплекса (не более 10 шт.)



Рис. 289. Инструменты для сервисного обслуживания комплекса (не более 4 шт.)



Рис. 290. Инструменты для сервисного обслуживания комплекса (не более 4 шт.)



Рис. 291. Шкафы для хранения принадлежностей (не более 4 шт.)



Рис. 292. Сервера рабочей станции (не более 4 шт.)



Рис. 293. Сервера рабочей станции (не более 4 шт.)

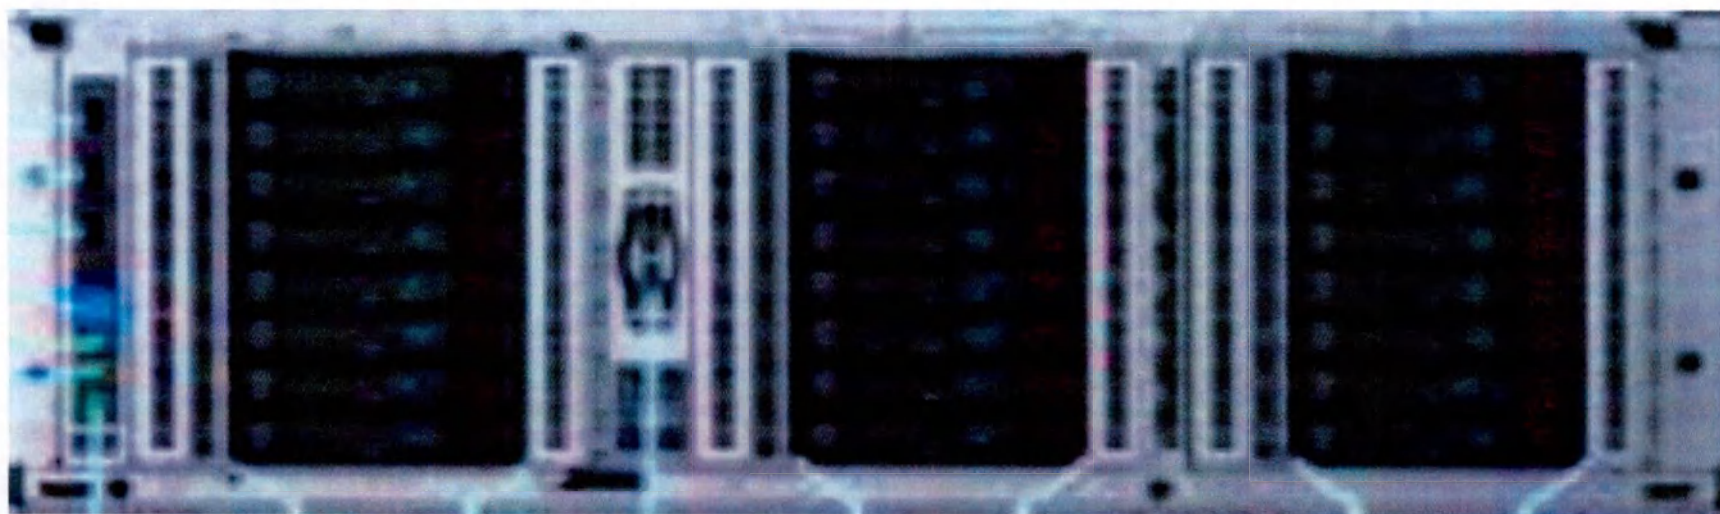


Рис. 294. Сервера рабочей станции (не более 4 шт.)



Рис. 295. Мониторы для рабочей станции (не более 10 шт.)



Рис. 296. Мониторы для рабочей станции (не более 10 шт.)



Рис. 297. Мониторы для рабочей станции (не более 10 шт.)



GE Medical Systems Israel, Functional Imaging

4 Hayozma Street

30200 Tirat Hacarmel

Israel

**Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений
методом ПЭТ/КТ Omni Legend с принадлежностями,
вариант исполнения: с шириной ПЭТ детектора 16 см**



XXXXXXXX



XXXXXXXX



XX-XX-XXXX



**Класс 1
IPX0**

Номинальное напряжение: 380/400/420/440/460/480 В, 3 ~

Частота: 50 / 60 Гц

Кратковременная / Длительная мощность: 100 кВА / 30 кВА

Рис. 298. Пример маркировки медицинского изделия Omni Legend: с шириной ПЭТ детектора: 16 см на русском языке (макет)



GE Medical Systems Israel, Functional Imaging

4 Hayozma Street

30200 Tirat Hacarmel

Israel

**Комплекс комбинированный для получения медицинских изображений
методом ПЭТ/КТ Omni Legend с принадлежностями,
вариант исполнения: с шириной ПЭТ детектора 32 см**



XXXXXXXX



XXXXXXXX



XX-XX-XXXX



**Класс 1
IPX0**

Номинальное напряжение: 380/400/420/440/460/480 В, 3 ~

Частота: 50 / 60 Гц


Кратковременная / Длительная мощность: 100 кВА / 30 кВА

Рис. 299. Пример маркировки медицинского изделия Omni Legend: с шириной ПЭТ детектора: 32 см на русском языке (макет)

Всего прошито, пронумеровано,
(301) листов

Директор департамента
Регистрации и сертификации,
Россия и СНГ

ООО «ДжиИ Хэлскеа»

 А.П. Харитоновна

