

Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.

М.П.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НСV» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу гепатита C (Анти-НСV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-268-65614693-2022

2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НСV» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу гепатита С (Анти-НСV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 268-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Анти-НСV

Набор реагентов на 100 тестов

YHLO



LOT	20230701	01.07.2024	REF	C88050
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 4,0 мл/уп.; реагент для разведения при анализе (R4), 6,5 мл/уп.) – 2 шт;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НСV» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу гепатита С (Анти-НСV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 268-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Анти-НСV

Набор реагентов на 200 тестов

YHLO



LOT	20230701	01.07.2024	REF	C88050
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 4,0 мл/уп.; реагент для разведения при анализе (R4), 6,5 мл/уп.) – 4 шт;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НСV» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу гепатита С (Анти-НСV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 268-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:



- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Анти-НСV

Набор реагентов на 500 тестов

YHLO



LOT	20230701	01.07.2024	REF	C88050
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 4,0 мл/уп.; реагент для разведения при анализе (R4), 6,5 мл/уп.) – 10 шт;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НСV» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу гепатита С (Анти-НСV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 – 268-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур Анти-НСV

Набор реагентов на 1000 тестов

YHLO



LOT	20230701	01.07.2024	REF	C88050
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия

1. Картридж (в составе: реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп.; реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп.; реагент для разведения образцов (R3), 4,0 мл/уп.; реагент для разведения при анализе (R4), 6,5 мл/уп.) – 20 шт;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
5. Инструкция по применению – 1 шт.;
6. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YNLO**

**Лидлаб Амур
Анти-НСV**

IVD   ProClin 300  

3,5мл	4,0мл	4,0мл	6,5мл
R 1	R 2	R 3	R 4

2°C  8°C  1×50


LOT	20230701		01.07.2024
-----	----------	---	------------

 9031 1017

лидкор

Лидлаб Амур Анти-НСV

Калибратор инактивирован


2°C  8°C    ProClin 300  

1,0 мл	LOT	20230701
CAL 1		01.07.2024
	REF	C88050

лидкор

Лидлаб Амур Анти-НСV

Калибратор инактивирован

2°C  8°C    ProClin 300  


1,0 мл	LOT	20230701
CAL 2		01.07.2024
	REF	C88050

лидкор

Лидлаб Амур Анти-НСV

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701



01.07.2024


REF C88050




Лидлаб Амур Анти-НСV



LOT 20230701 EXP 01.07.2024

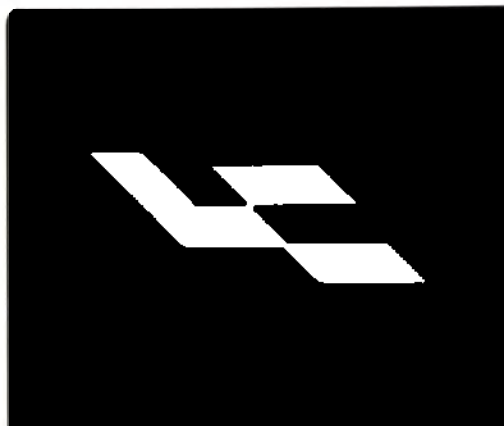


Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НСV» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу гепатита С (Анти-НСV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-268-65614693-2022

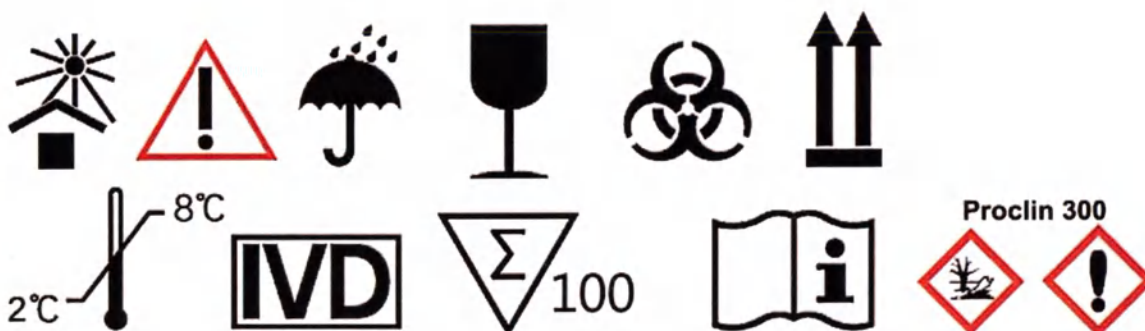

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C88050

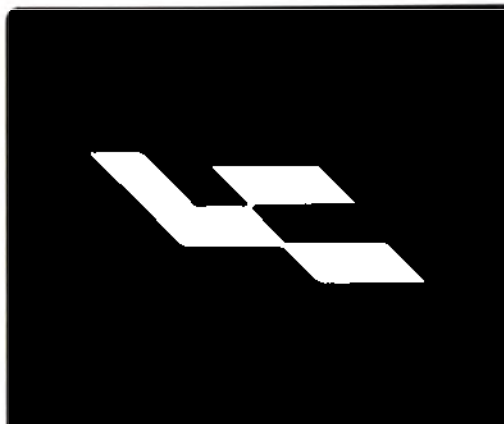


Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НСV» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу гепатита С (Анти-НСV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-268-65614693-2022




Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C88050

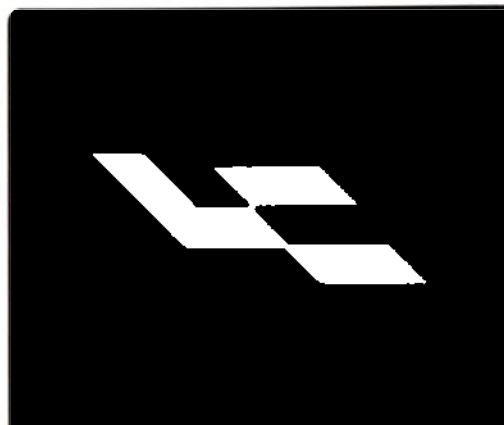


Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НСV» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу гепатита С (Анти-НСV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-268-65614693-2022

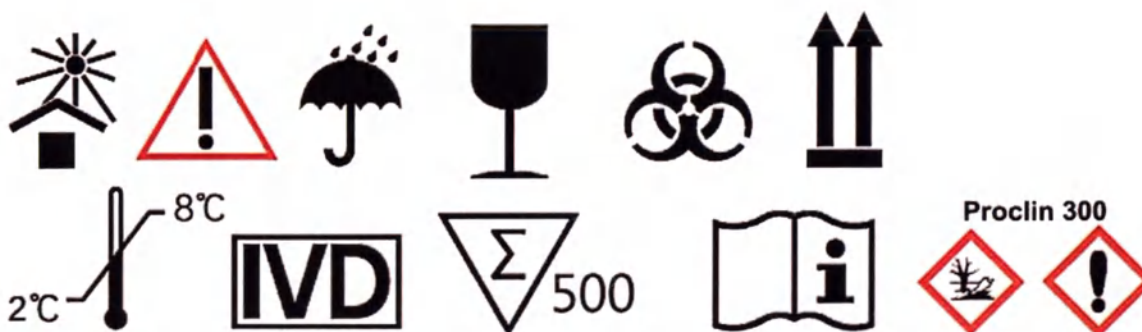


Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C88050

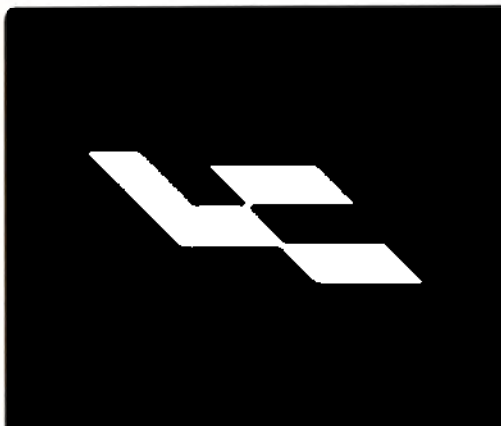


Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-HCV» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу гепатита С (Анти-HCV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-268-65614693-2022

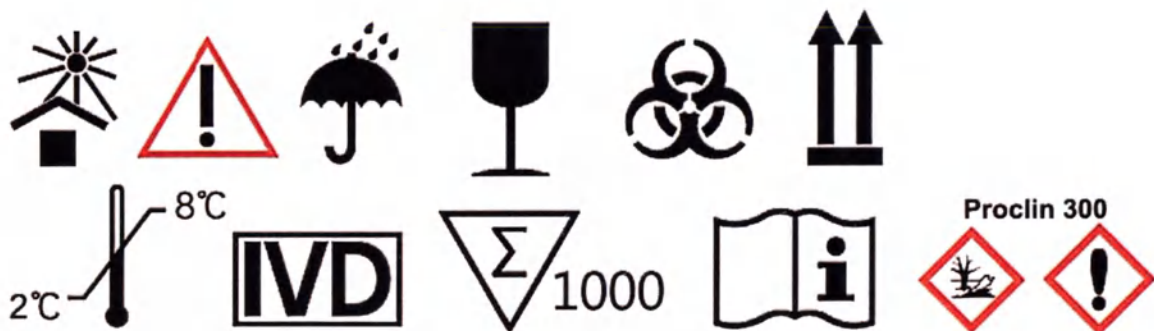

Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C88050

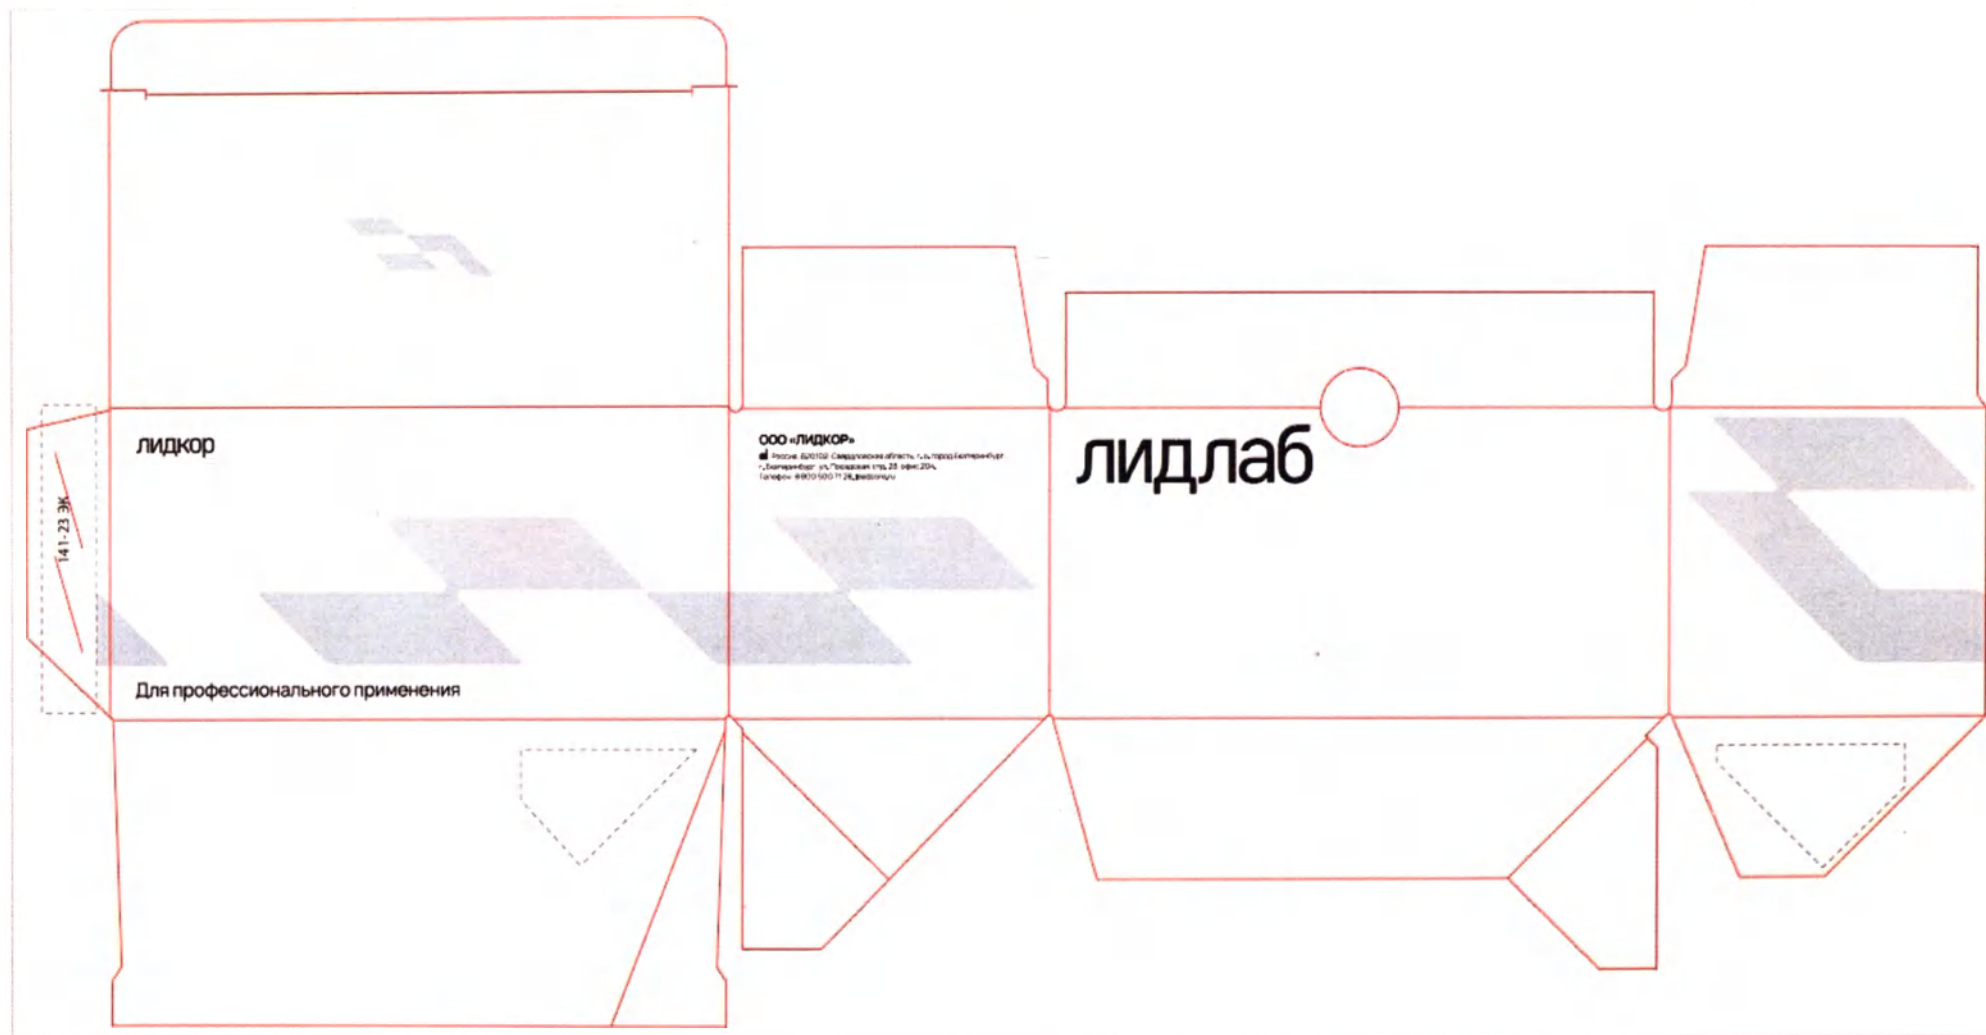

	 Наименование изделияXXXXXX  Сведения об изделии / сведения об упаковке LOT XXXXXXXXXX REF XXXXXXXXXX		

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
11 (одиннадцать) л.

Директор

ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «ЛИДКОР»
Е.Ю. Голугут
«01» июля 2023 г.
М.П.
ООО «ЛИДКОР»
Российская Федерация
Свердловская область
г. Екатеринбург
ОГРН 110655800116

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НСV» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу гепатита С (Анти-НСV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-268-65614693-2022

2023

Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент меченых антител (R2), 4,0 мл/уп., Реагент для разведения образцов (R3), 4,0 мл/уп., Реагент для разведения при анализе (R4), 6,5 мл/уп.)



Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон

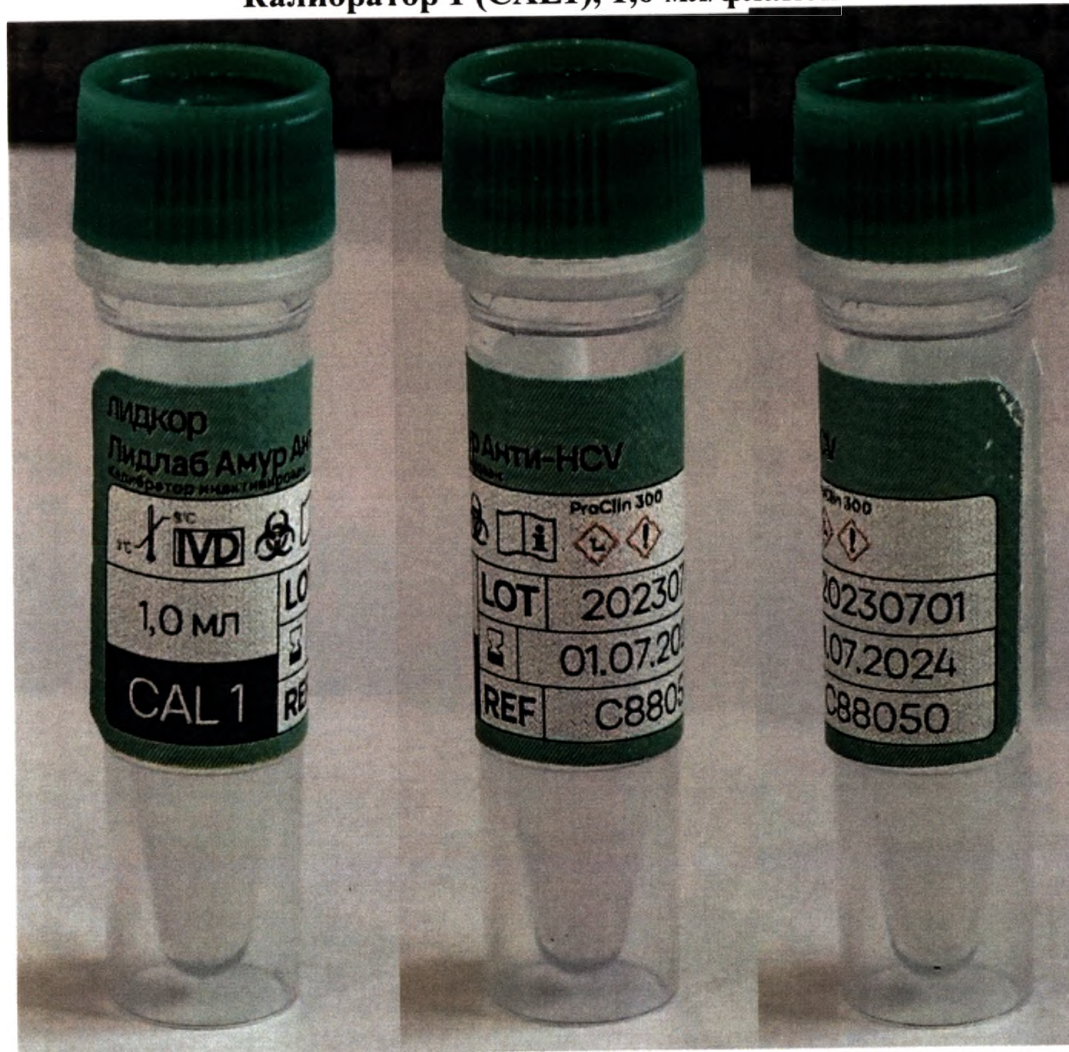

Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон




Пароизоляционные крышки




Набор реагентов на 100 тестов




Набор реагентов на 100 тестов. Вид сбоку

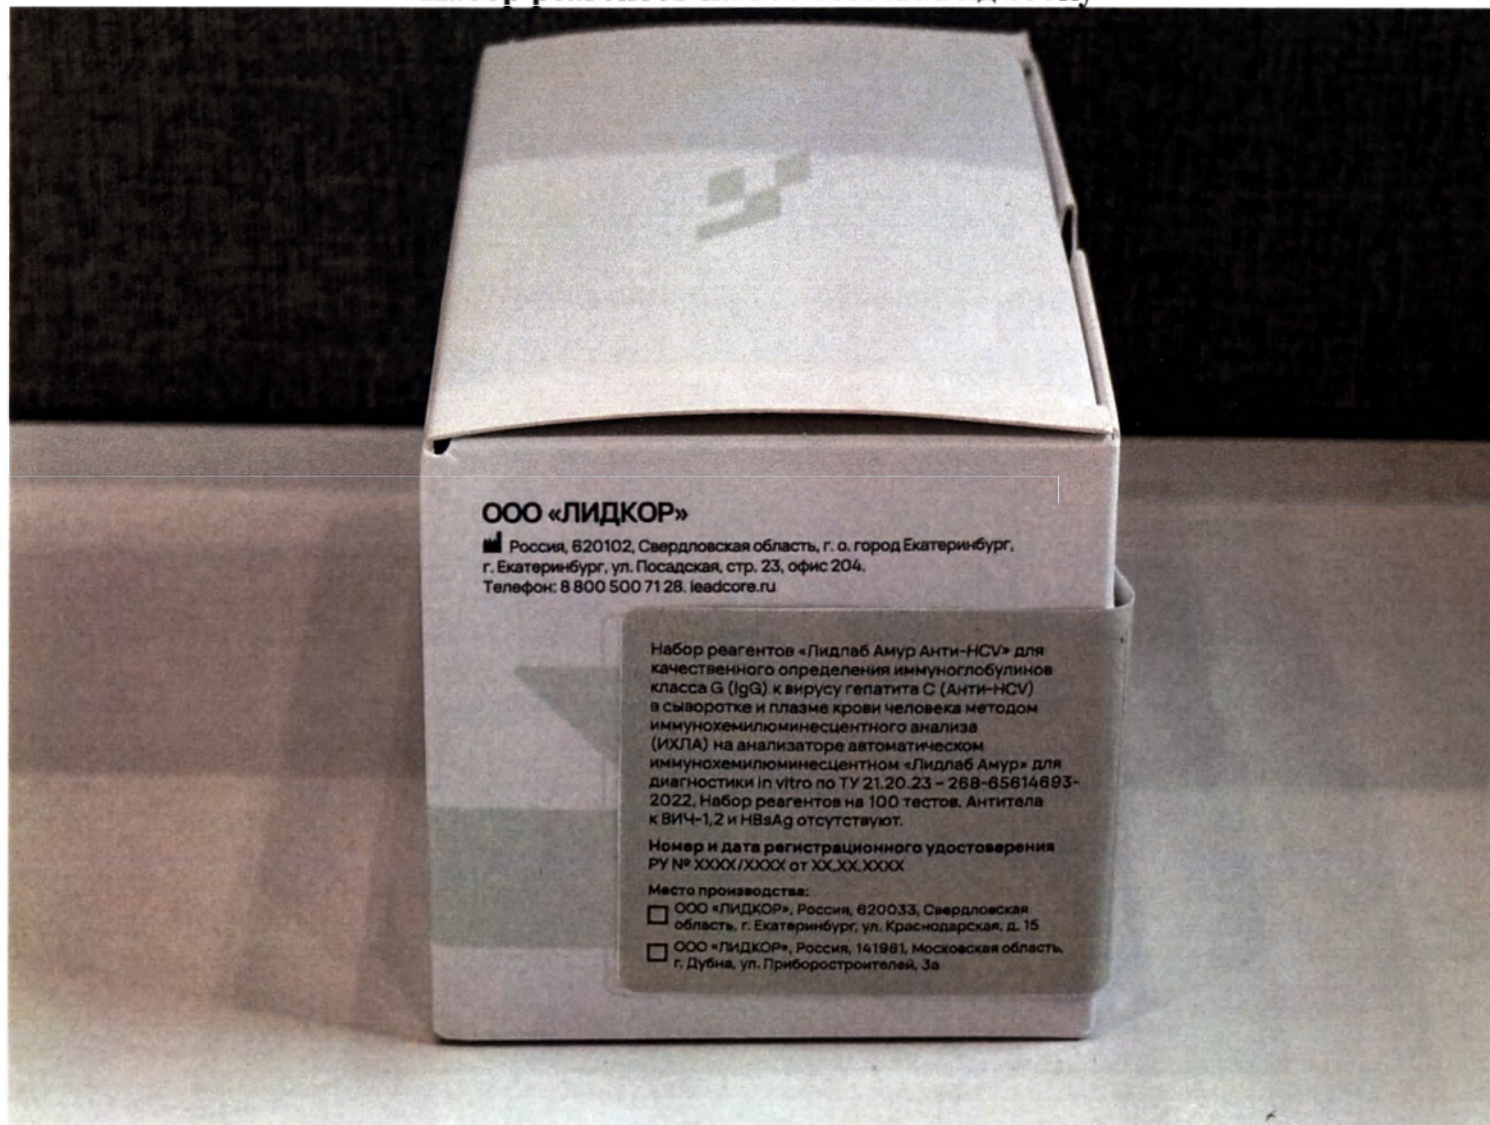

Набор реагентов на 100 тестов. Вид сзади

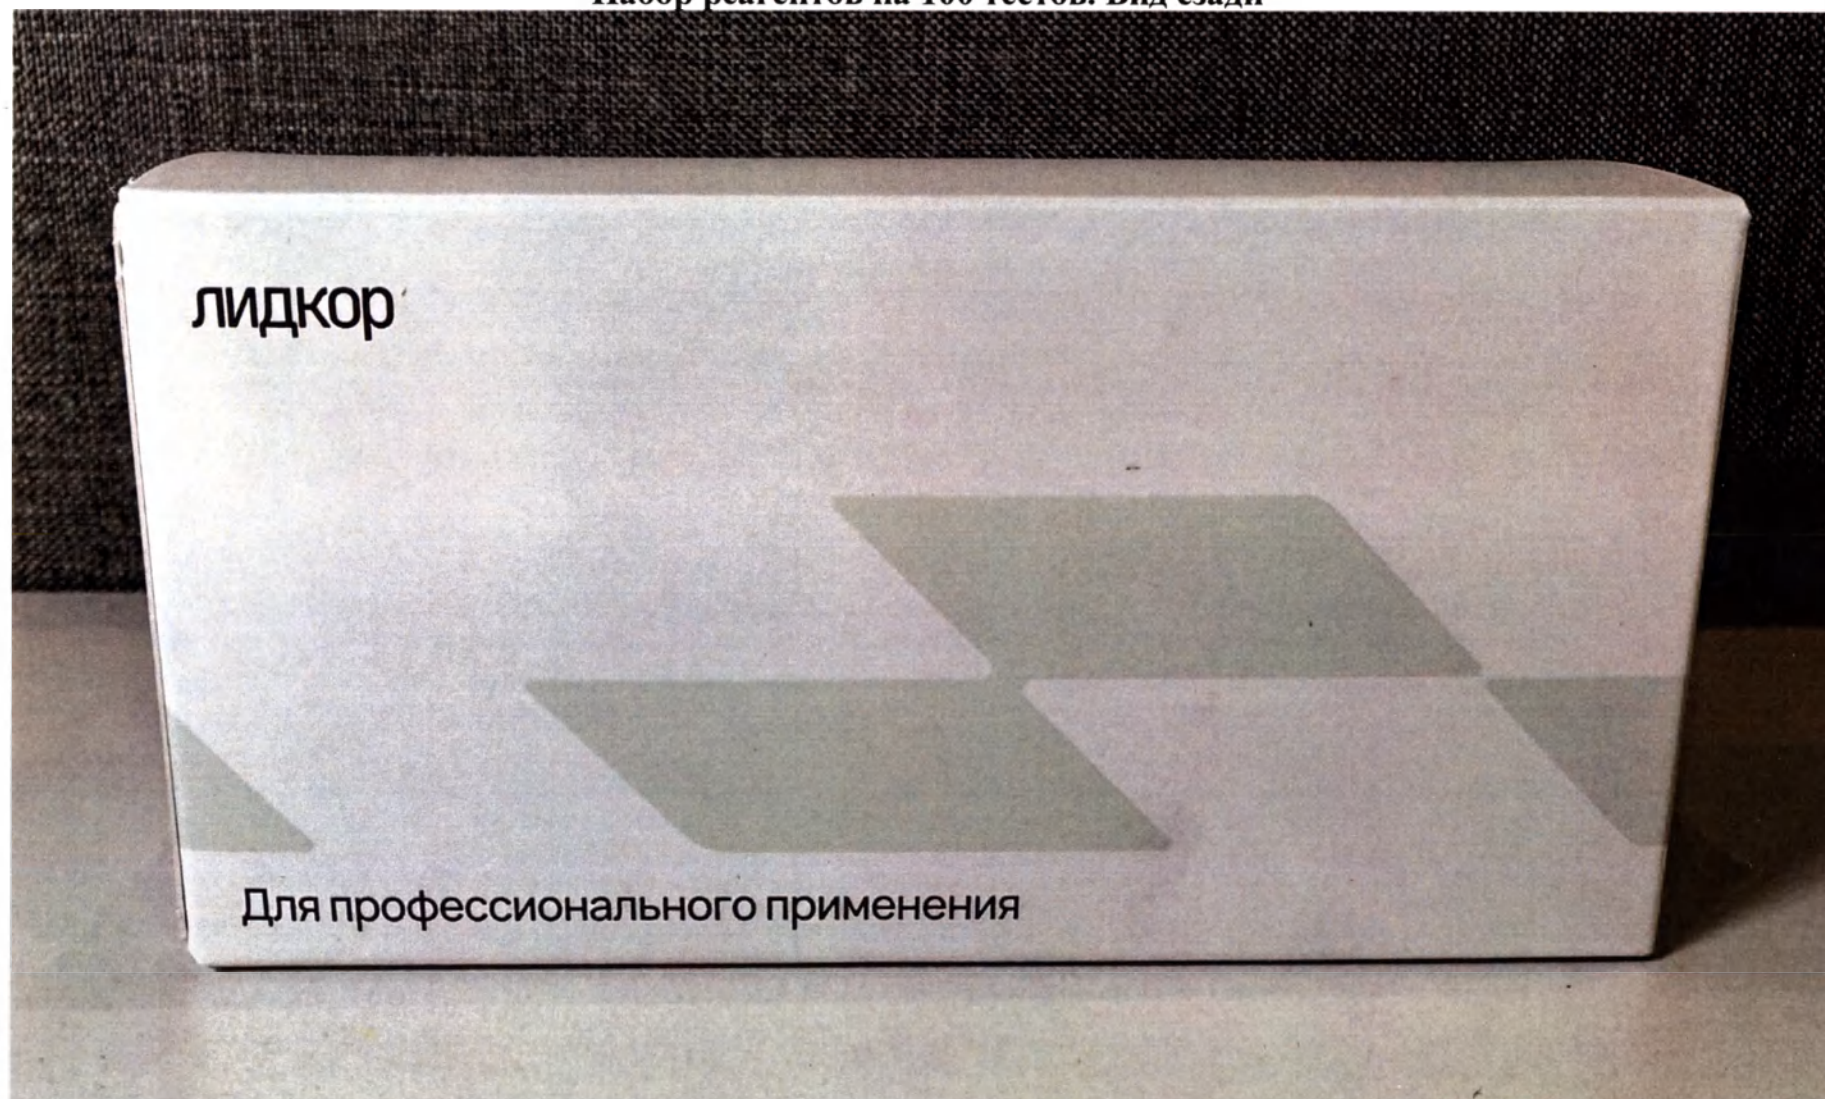

Набор реагентов на 200 тестов

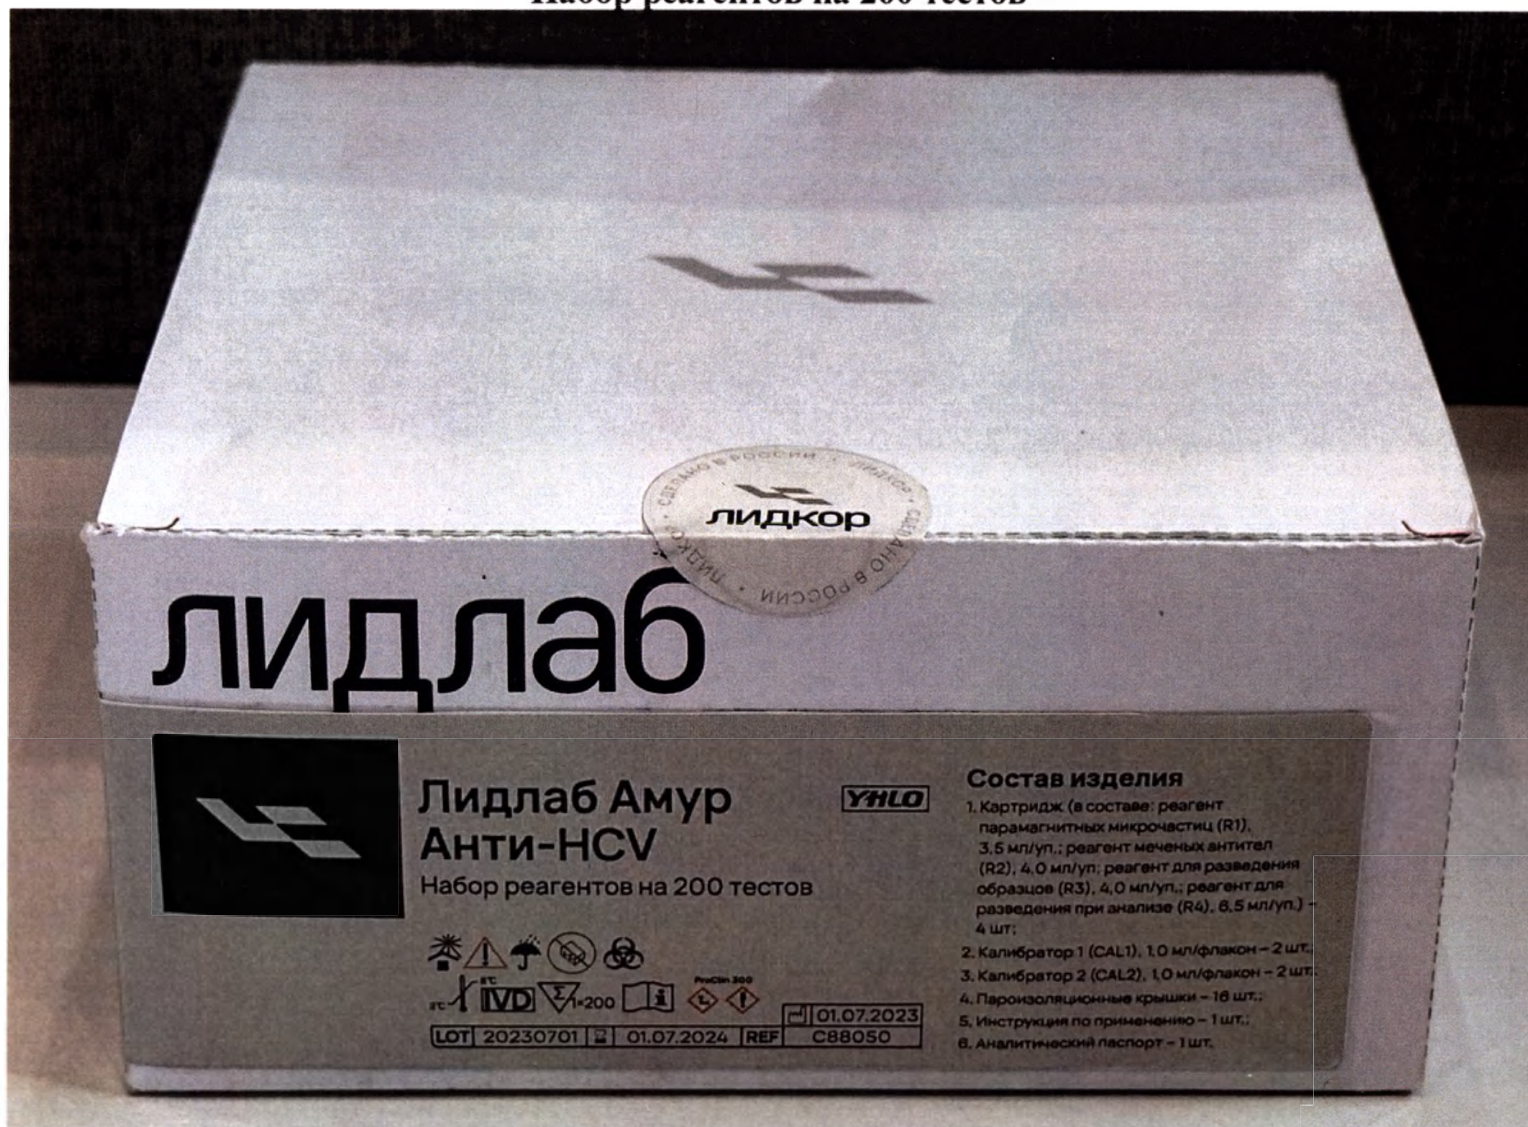

Набор реагентов на 200 тестов. Вид сбоку

ООО «ЛИДКОР»

620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НСV» для качественного определения иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу гепатита С (Анти-НСV) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23 - 268-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов. Антитела к ВИЧ-1,2 и HBsAg отсутствуют.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX


Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а


Набор реагентов на 200 тестов. Вид сзади



Набор реагентов на 500 тестов

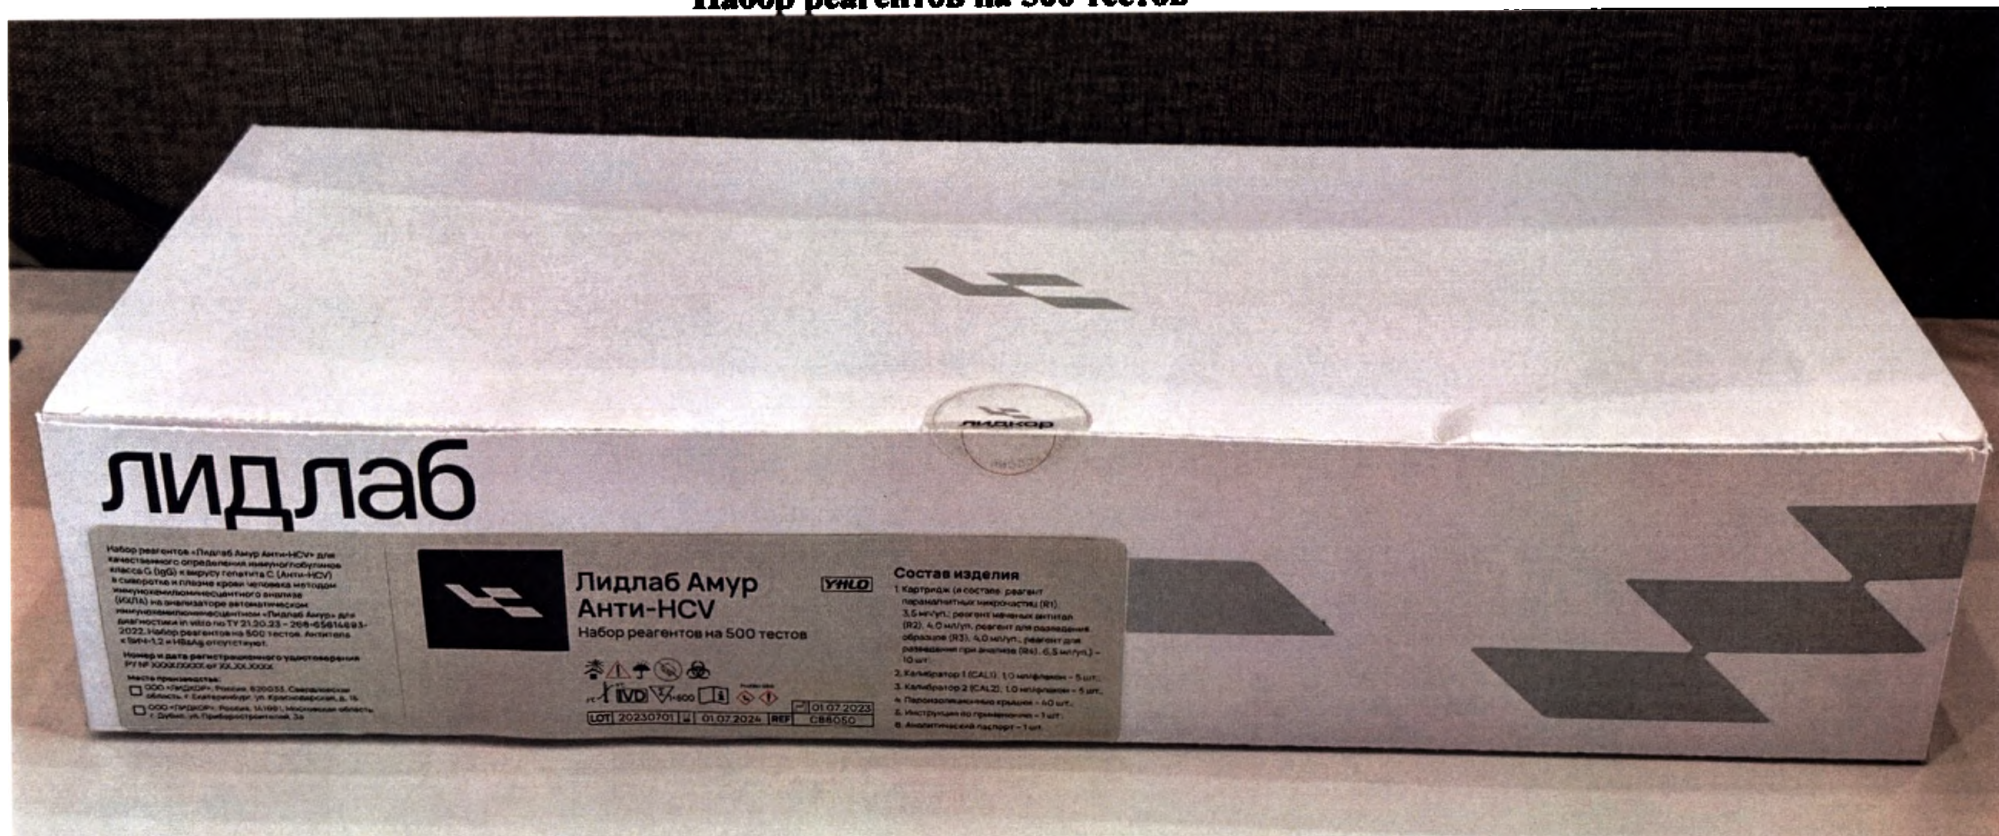


Набор реагентов на 500 тестов. Вид сбоку

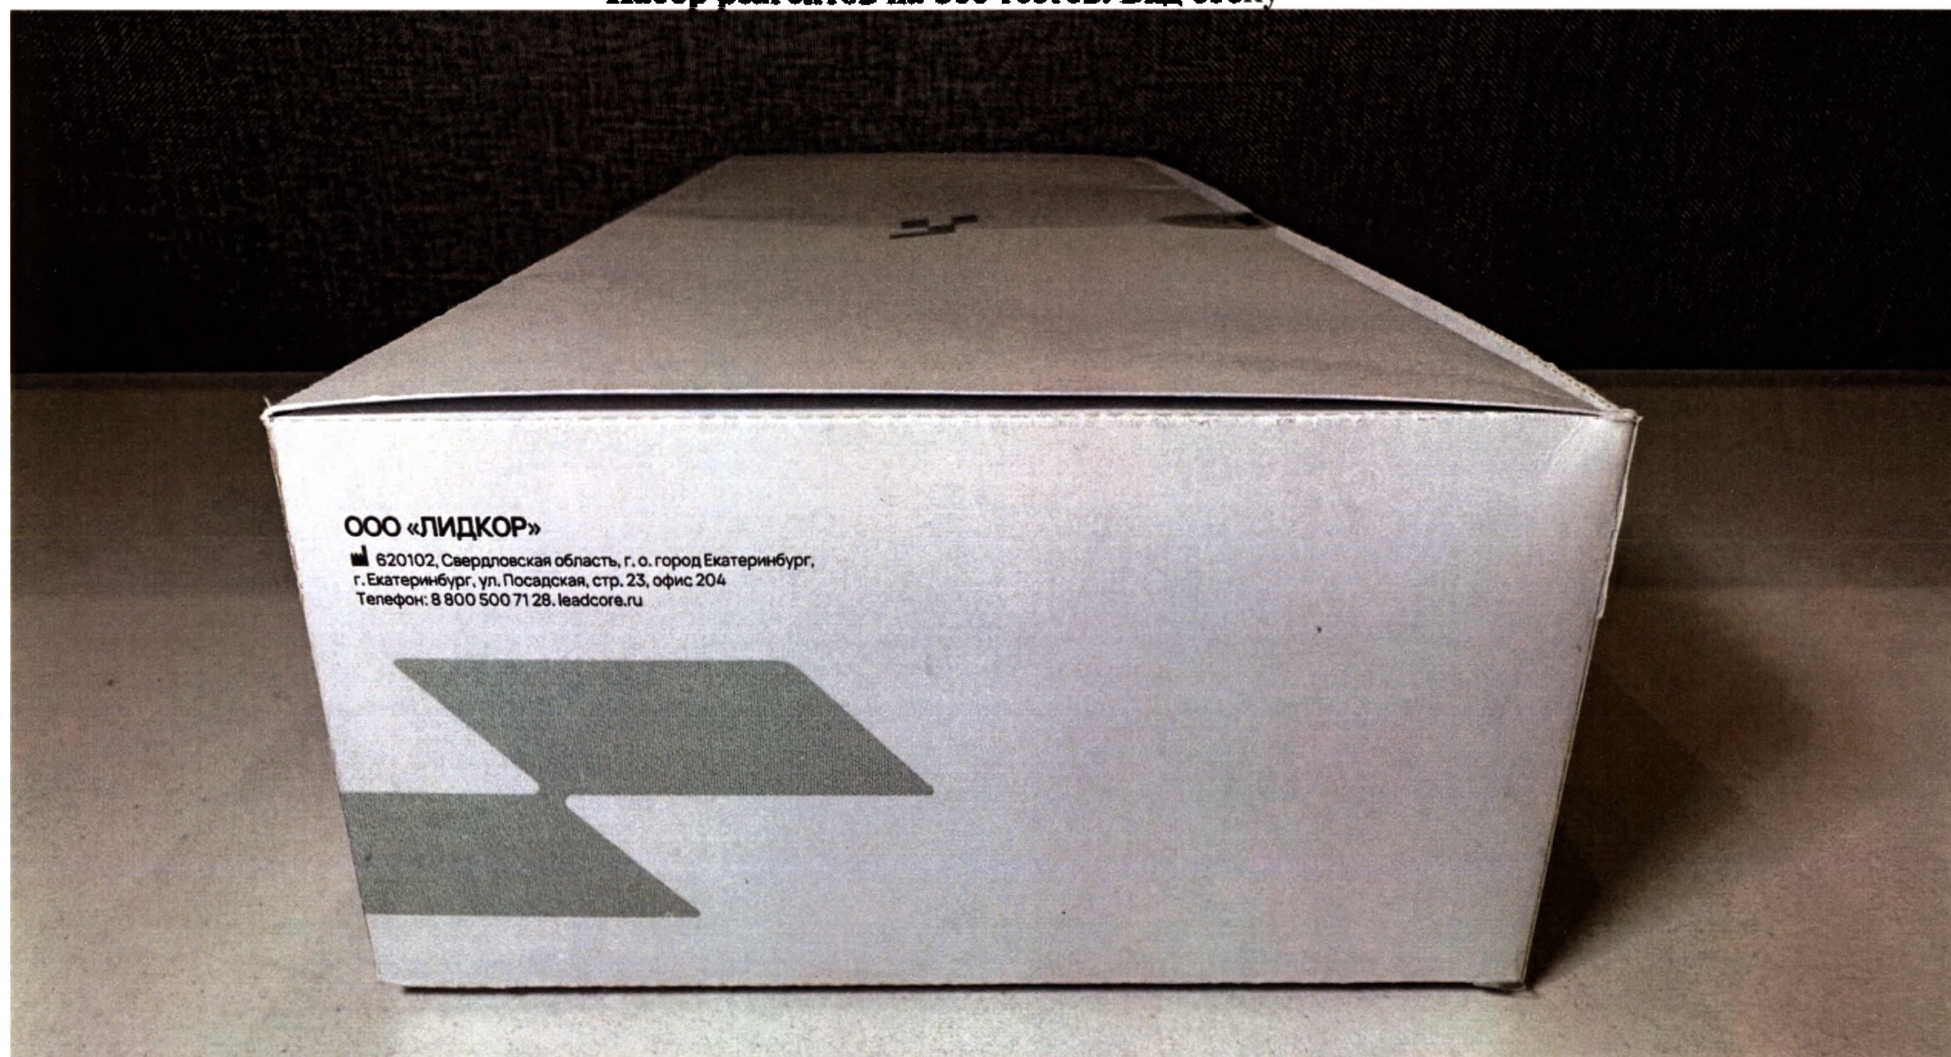

ООО «ЛИДКОР»

620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28, leadcore.ru


Набор реагентов на 500 тестов. Вид сзади

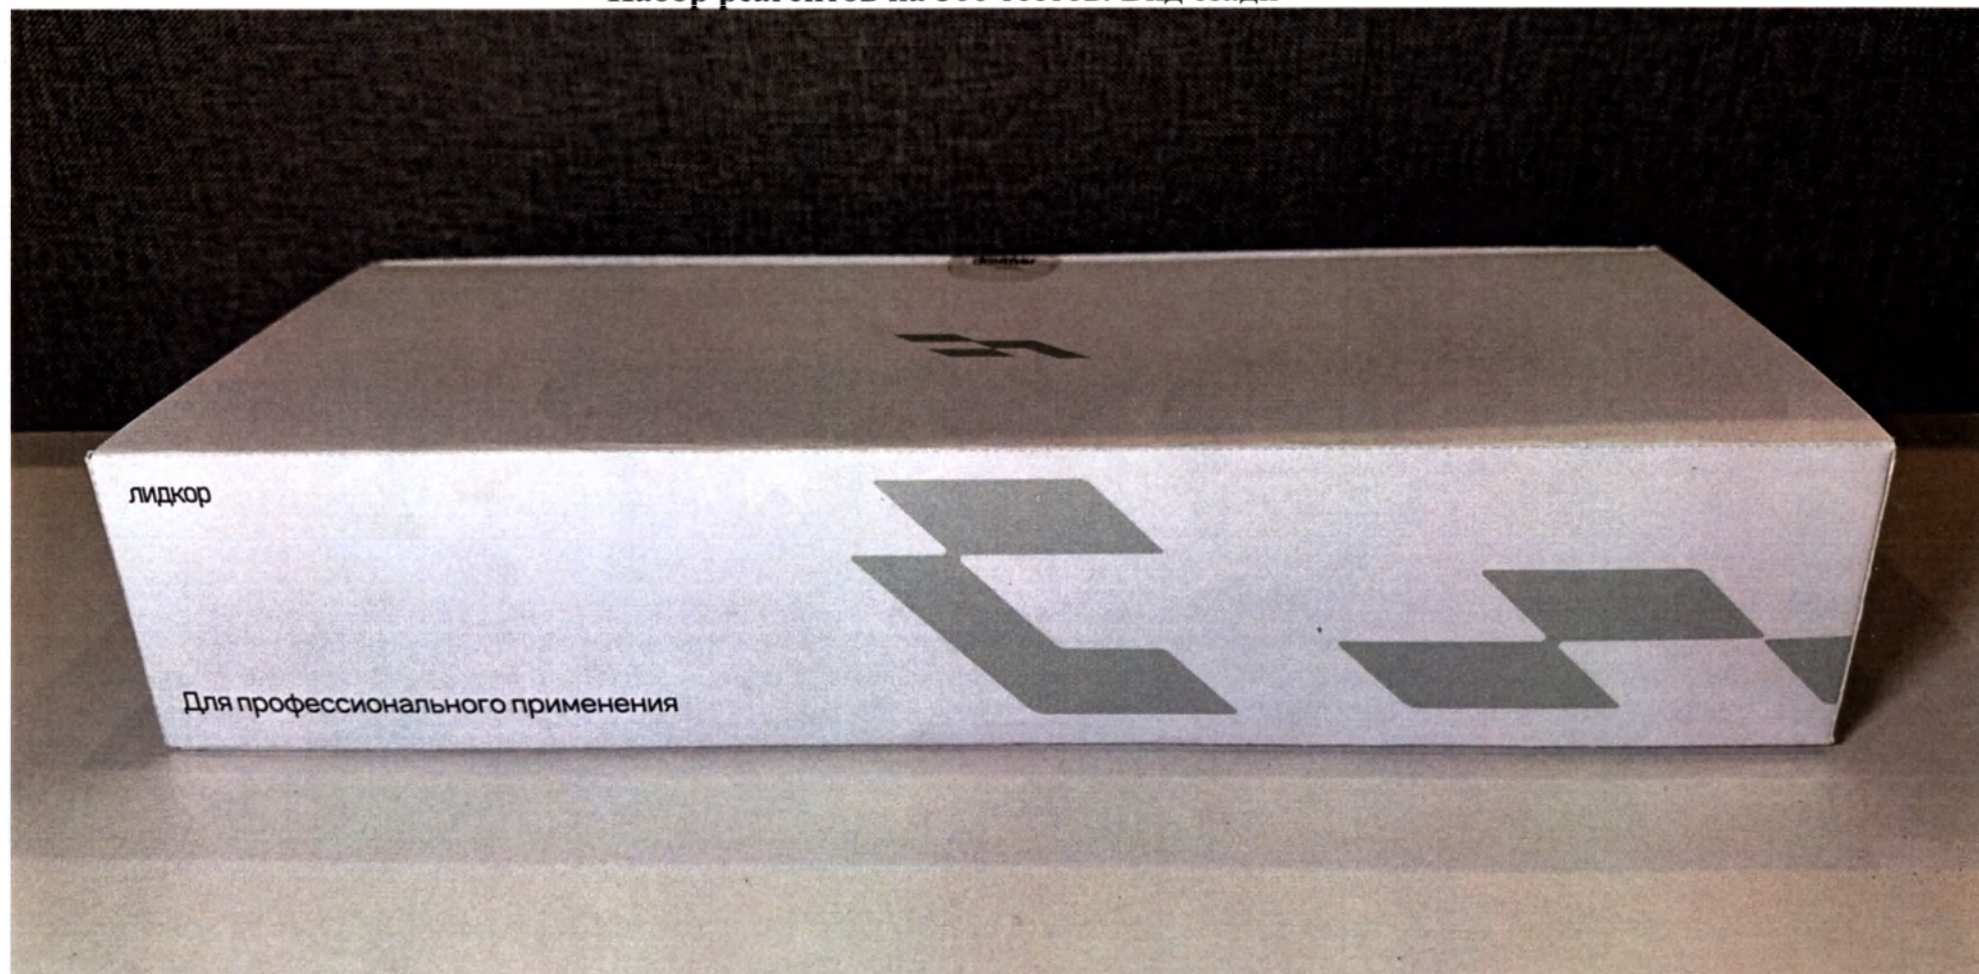

Набор реагентов на 1000 тестов




Набор реагентов «Лидлаб Амур Анти-НСV» для
анализа сыворотки, плазмы и мочи на наличие
антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV)
в лабораториях и клиниках для проведения тестов
на наличие антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV)
в сыворотке, плазме и моче. Набор реагентов для
анализа сыворотки, плазмы и мочи на наличие
антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV).
2022. Набор реагентов на 1000 тестов. Анти-НСV
в сыворотке, плазме и моче.



**Лидлаб Амур
Анти-НСV**
Набор реагентов на 1000 тестов

VHLD



ГОСТ 29350-2013 10.07.2023 1000 08050


Состав изделия

- 1. Карtridge 18 (состав: реагент
3.5 мл/шт., реактив для разведения
R22 4.0 мл/шт., реактив для разведения
образца R33 4.0 мл/шт., реактив для
разведения образца R34 4.0 мл/шт.) -
20 шт.
- 2. Калибратор 1 (CAL 1) 1.0 мл/шт. - 10 шт.
- 3. Калибратор 2 (CAL 2) 1.0 мл/шт. - 10 шт.
- 4. Параллельные крышки - 80 шт.
- 5. Индикаторная лента - 1 шт.
- 6. Адаптерный кабель - 1 шт.

Набор реагентов на 1000 тестов. Вид сбоку



Набор реагентов на 1000 тестов. Вид сзади

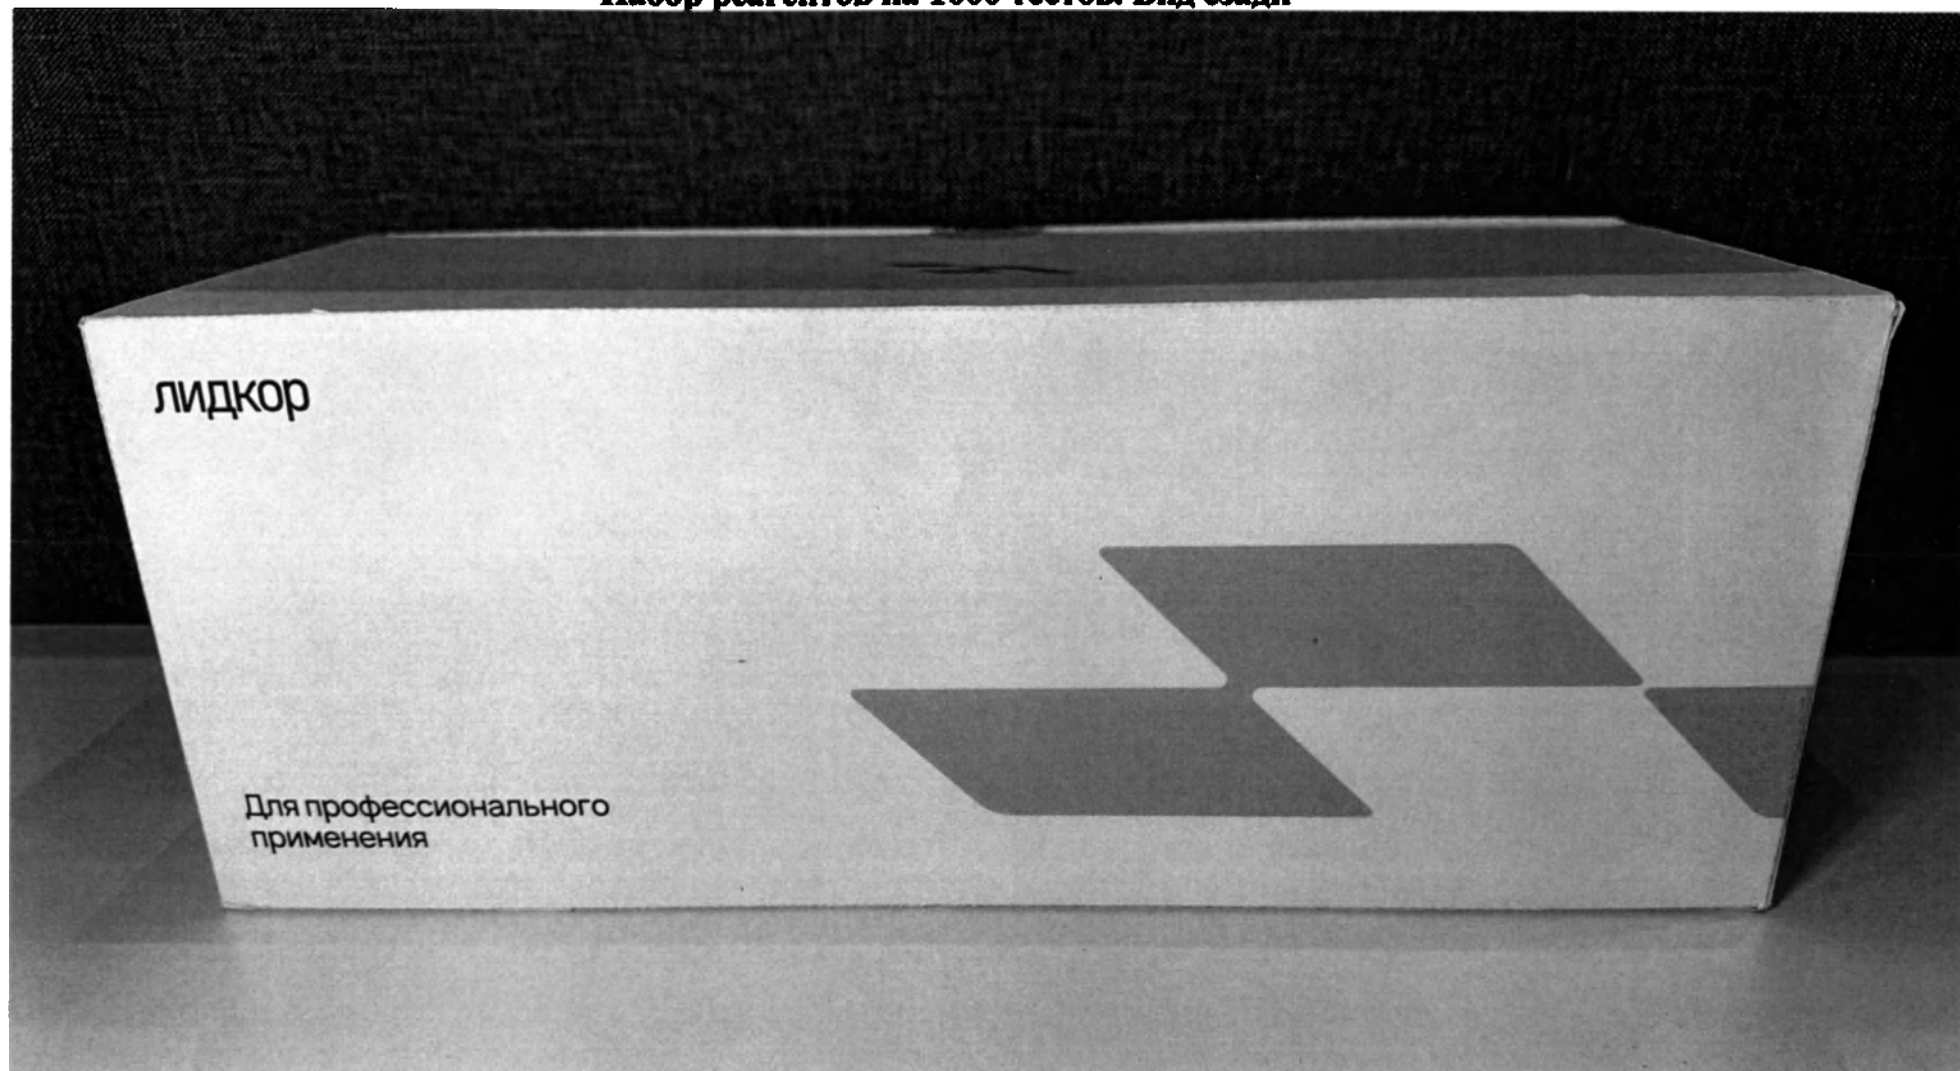

Общий вид медицинского изделия



Транспортная упаковка Набора реагентов на 100 тестов




Транспортная упаковка Набора реагентов на 200 тестов



Транспортная упаковка Набора реагентов на 500 тестов



Транспортная упаковка Набора реагентов на 1000 тестов

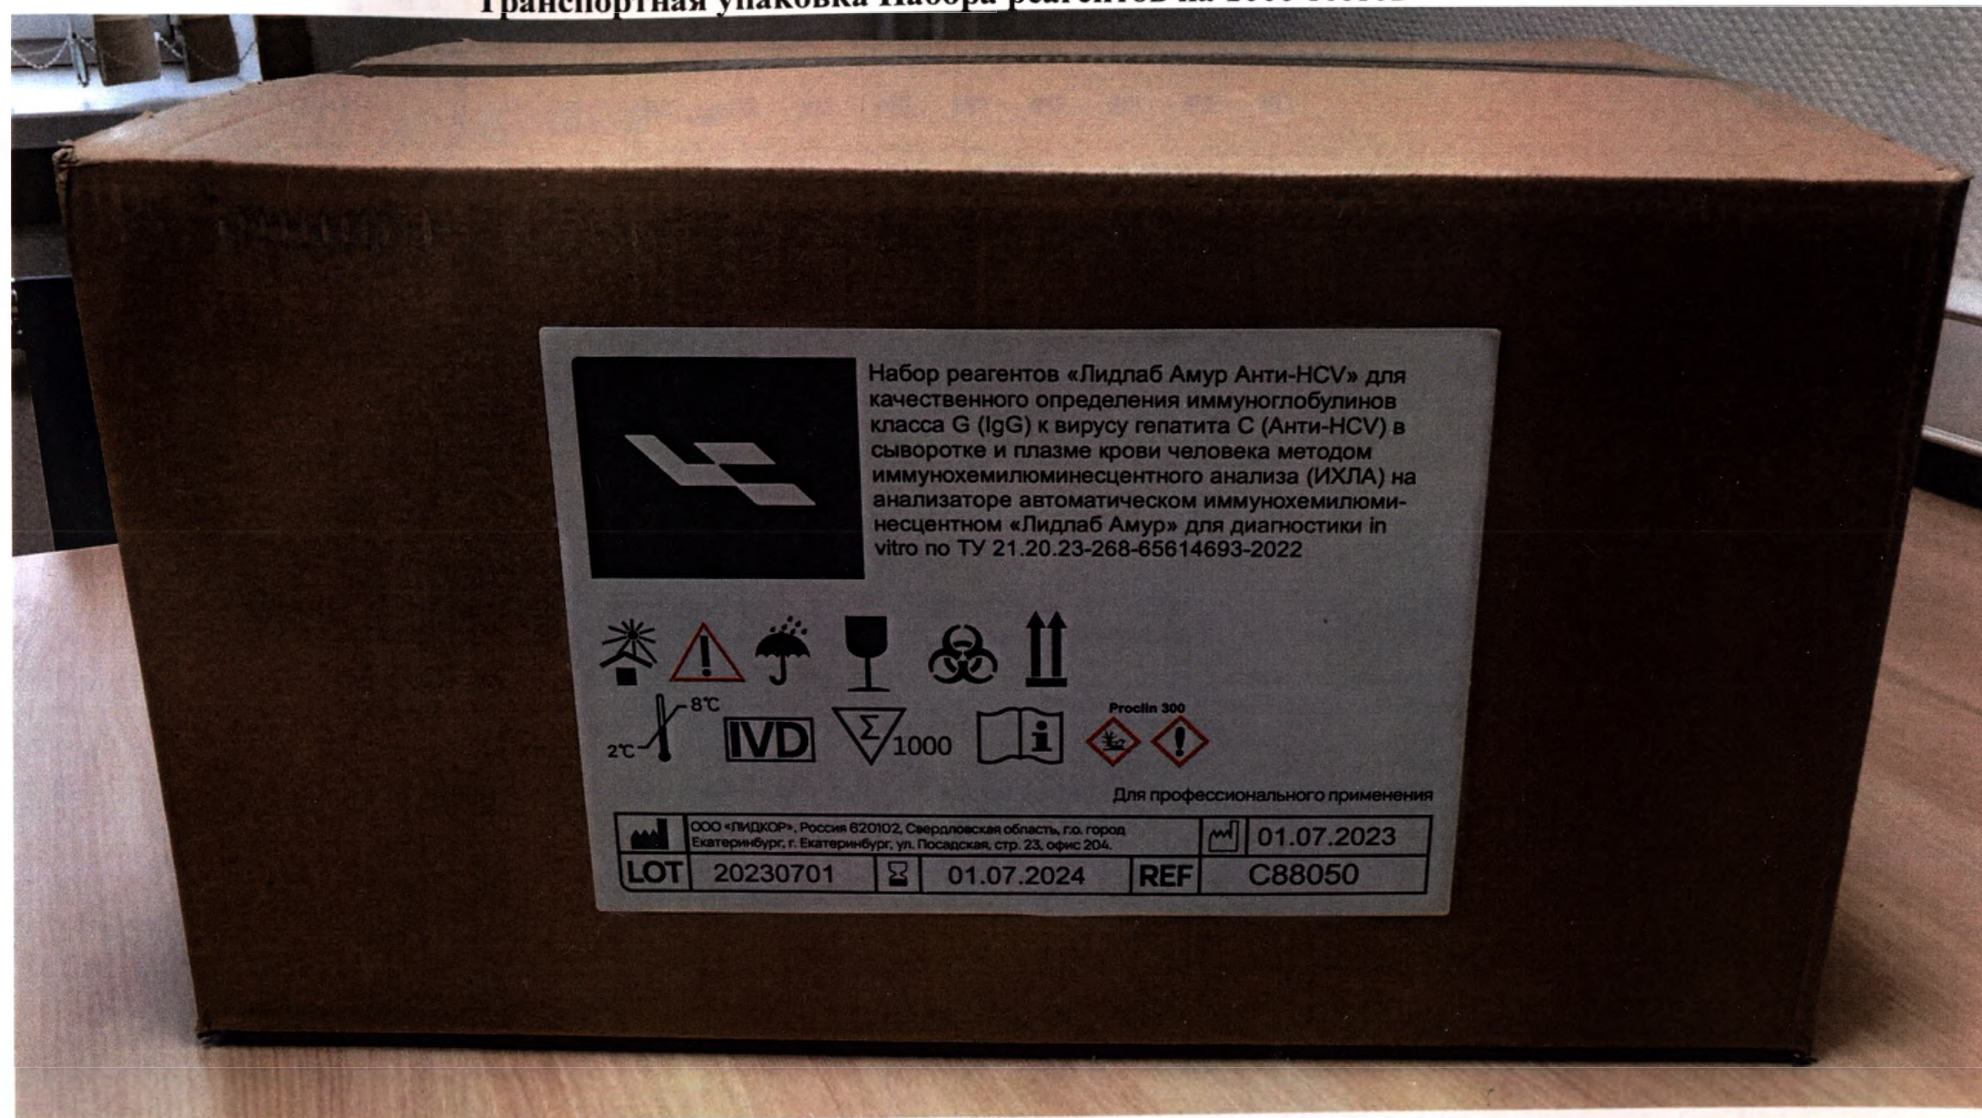

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

22 (двадцать два)

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/

